

Спирограф микропроцессорный СМП-02-“Р-Д” в варианте исполнения СМП-02-“Р-Д”/1

1.16



1.5



1.15



1.8



1.9



1.4



1.17



1.12



1.2

1.3



1.6



1.1



1.7



1.13



1.10



1.14



1.11

Спирограф микропроцессорный СМП-02-“Р-Д” в
варианте исполнения СМП-02-“Р-Д”/2



2.8



2.9




2.5



2.6

2.11

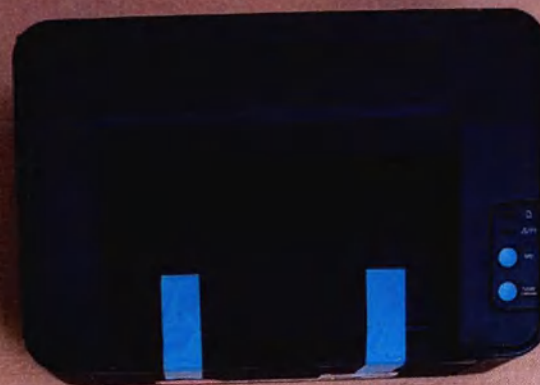

2.10



2.1



2.2



2.7



2.4



2.3

Перечень к фотографическим изображениям

	Наименование	Обозначение	Производитель
	Спирограф микропроцессорный СМП-02- "Р-Д" в вариантах исполнения		
	1. Вариант исполнения СМП-02-"Р-Д"/1 в составе:	МТЦ.73.00.000	ООО «НПП «Монитор», Россия
1.1	Блок спирографа	МТЦ.72.01.000	ООО «НПП «Монитор», Россия
1.2	Датчик спирографа	МТЦ.72.01.500	ООО «НПП «Монитор», Россия
1.3	Кабель датчика потока	МТЦ.71.04.501	"Hsuan Mao Technology Co., Ltd", Китай
1.4	Блок питания	GSM36B15-P1J	«Mean Well», Тайвань
1.5	Шнур сетевой	SCZ-20	"Planet Technology Corporation", Китай
1.6	Мундштук многоразовый	МТЦ.71.01.701	"Shandong Zhenfu Medical Device Co. , Ltd.", Китай
1.7	Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа МКФ1-«ПАЙП» по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018 (при необходимости)	РУ № РЗН 2019/8442	ООО «ПАЙП», Россия
1.8	Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии «ЛР-Регистрон» 110мм в рулоне	РУ № ФСР 2010/07976	АО «Регистрон», Россия
1.9	Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии «ЛР-Регистрон» 110мм в пачке (при необходимости)	РУ № ФСР 2010/07976	АО «Регистрон», Россия
1.10	Руководство по эксплуатации	МТЦ.73.00.100 РЭ	ООО «НПП «Монитор», Россия
1.11	Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - "ПАЙП" по ТУ 9398- 003-56156837-2014	РУ № РЗН 2014/2107	ООО "ПАЙП", Россия
1.12	Шприц калибровочный трехлитровый	МТЦ.71.01.301	ООО «НПП «Монитор», Россия
1.13	Программный модуль регистрации и архивации результатов спирометрии «Spiro PC2» и руководство пользователя на диске или флэш-накопителе из состава Программы компьютерные для регистрации, обработки и визуализации физиологических данных ПКФД-01-«Р-Д» по ТУ 509000-008-24149103-2014, РУ №	МТЦ.72.04.501	ООО «НПП «Монитор», Россия

	РЗН 2017/5268 (при необходимости)		
1.14	Модуль USB (при необходимости)	МТЦ.31.04.501	ООО «НПП «Монитор», Россия
1.15	Кабель USB (при необходимости)	B1705	“Buro, Китай
1.16	Лазерный принтер (при необходимости)	P1704	“PANTUM”, Китай
1.17	Внешняя клавиатура (при необходимости)	A1706	«Оклик», Китай
	2. Вариант исполнения СМП-02-“Р-Д”/2 в составе:	МТЦ.74.00.000	ООО «НПП «Монитор», Россия
2.1	Датчик спирографа	МТЦ.72.01.500	ООО «НПП «Монитор», Россия
2.2	Кабель USB	МТЦ.71.04.502	“Hsuan Mao Technology Co., Ltd”, Китай
2.3	Мундштук многоразовый	МТЦ.71.01.701	ООО «НПП «Монитор», Россия
2.4	Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа МКФ1-«ПАЙП» по ТУ 32.50.13-003-56156837-2018 (при необходимости)	РУ № РЗН 2019/8442	ООО «ПАЙП», Россия
2.5	Программный модуль регистрации и архивации результатов спирометрии «Spiro PC2» и руководство пользователя на диске или флэш-накопителе из состава Программы компьютерные для регистрации, обработки и визуализации физиологических данных ПКФД-01-«Р-Д» по ТУ 509000-008-24149103-2014, РУ № РЗН 2017/5268 (при необходимости)	МТЦ.72.04.501	ООО «НПП «Монитор», Россия
2.6	Руководство по эксплуатации	МТЦ.74.00.100 РЭ	ООО «НПП «Монитор», Россия
2.7	Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - "ПАЙП" по ТУ 9398-003-56156837-2014	РУ № РЗН 2014/2107	ООО "ПАЙП", Россия
2.8	Шприц калибровочный трехлитровый	МТЦ.71.01.301	ООО «НПП «Монитор», Россия
2.9	Персональный компьютер в сборе (при необходимости)	A1701	“Acer”, Тайвань или Китай
2.10	Ноутбук в сборе (при необходимости)	A1702	“Acer”, Китай или Тайвань
2.11	Лазерный принтер (при необходимости)	P1704	“PANTUM”, Китай

Спирограф микропроцессорный
СМП-02-«Р-Д»
в варианте исполнения
СМП-02-«Р-Д»/1

МАРКИРОВКА

ООО "НПП "МОНИТОР" СДЕЛАНО В РОССИИ Ростов-на-Дону



**СПИРОГРАФ
микропроцессорный
СМП-02-«Р-Д»/1**
ТУ 26.60.12-010-24149103-2022

ПИТАНИЕ

Аккумулятор: 7,4В; 2,0Ач; Li-Ion
От сетевого блока питания: 12-16В
Потребляемая мощность: не более 30ВА




**ДАТЧИК
СПИРОГРАФА**

СМП-02-«Р-Д»/1

Спирограф микропроцессорный
СМП-02-«Р-Д»
в варианте исполнения
СМП-02-«Р-Д»/1

УПАКОВКА

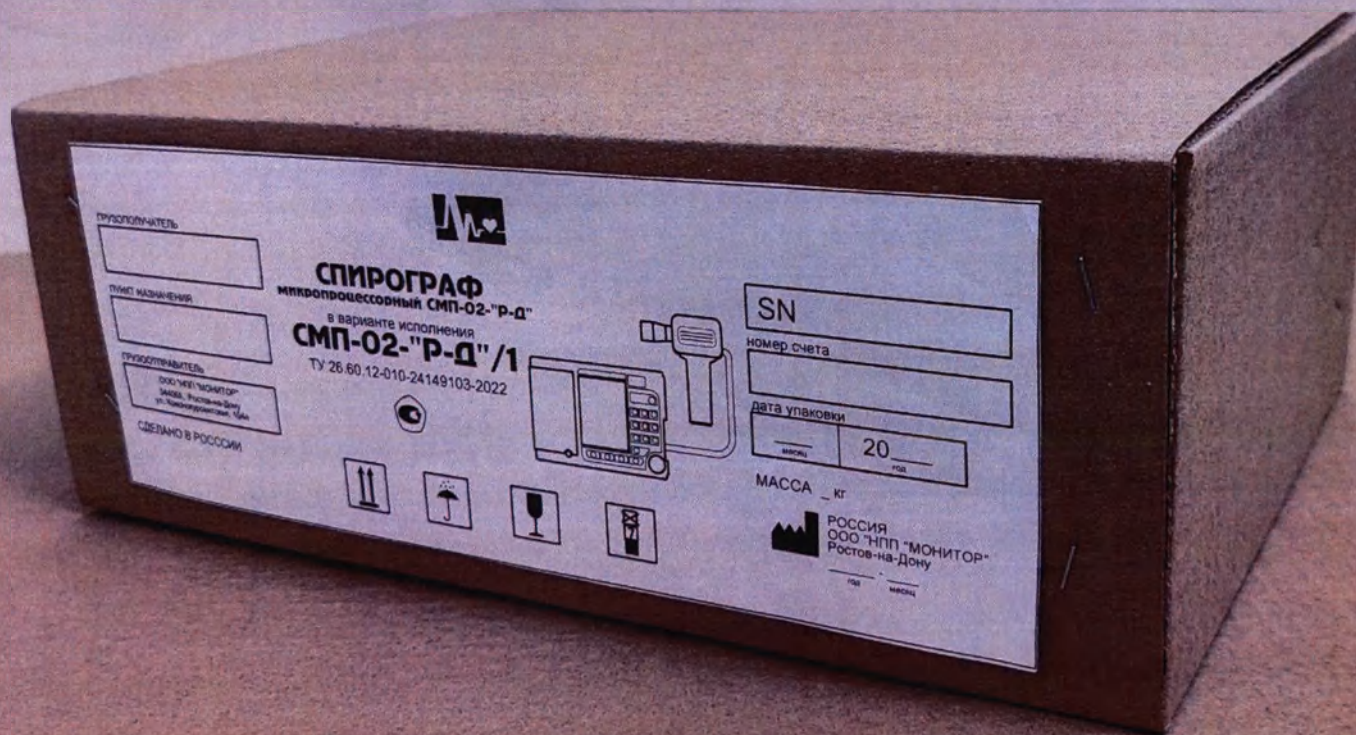


Спирограф микропроцессорный
СМП-02-«Р-Д»
в варианте исполнения
СМП-02-«Р-Д»/2

МАРКИРОВКА



Спирограф микропроцессорный
СМП-02-«Р-Д»
в варианте исполнения
СМП-02-«Р-Д»/2

УПАКОВКА

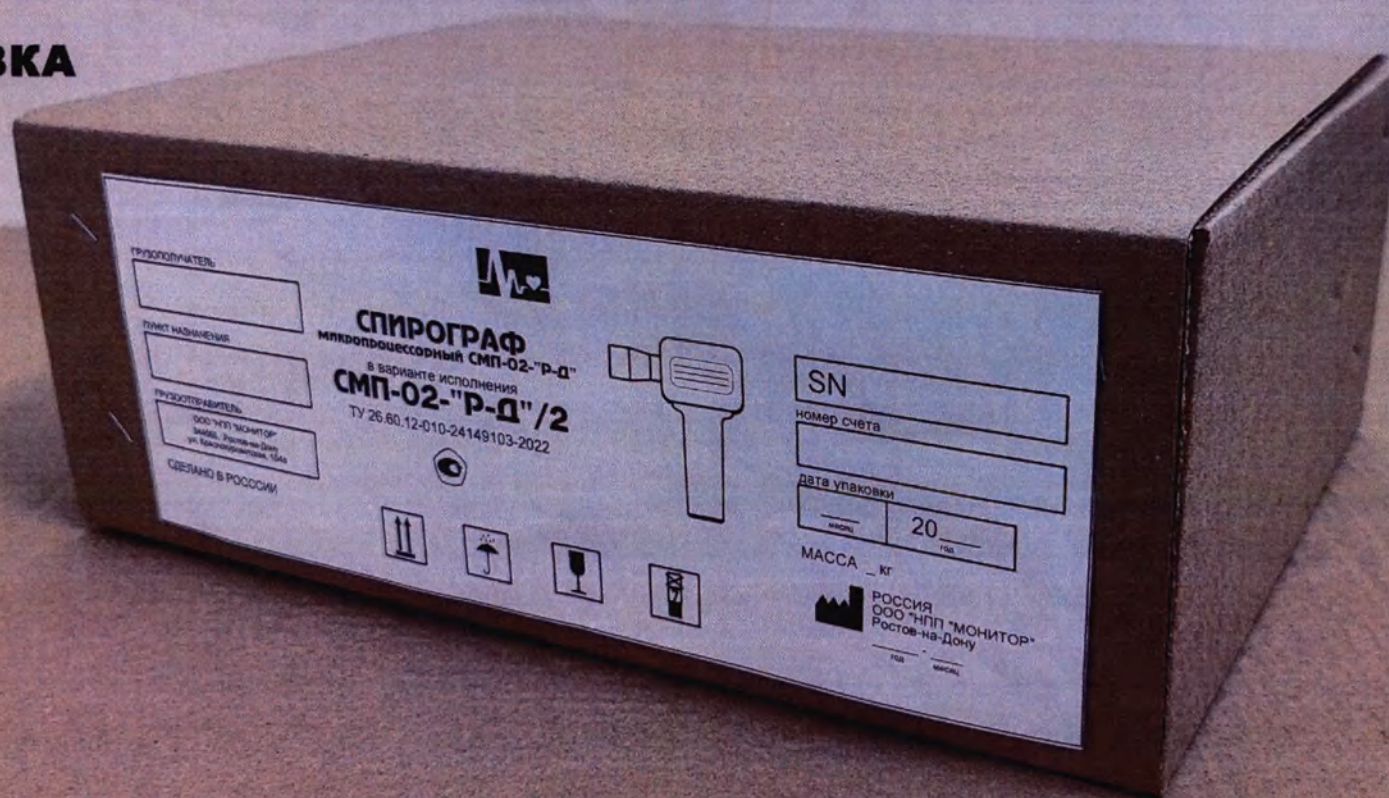


В данном документе прошито _____ листов


Генеральный директор А.В. Попов



22 сентября 2023








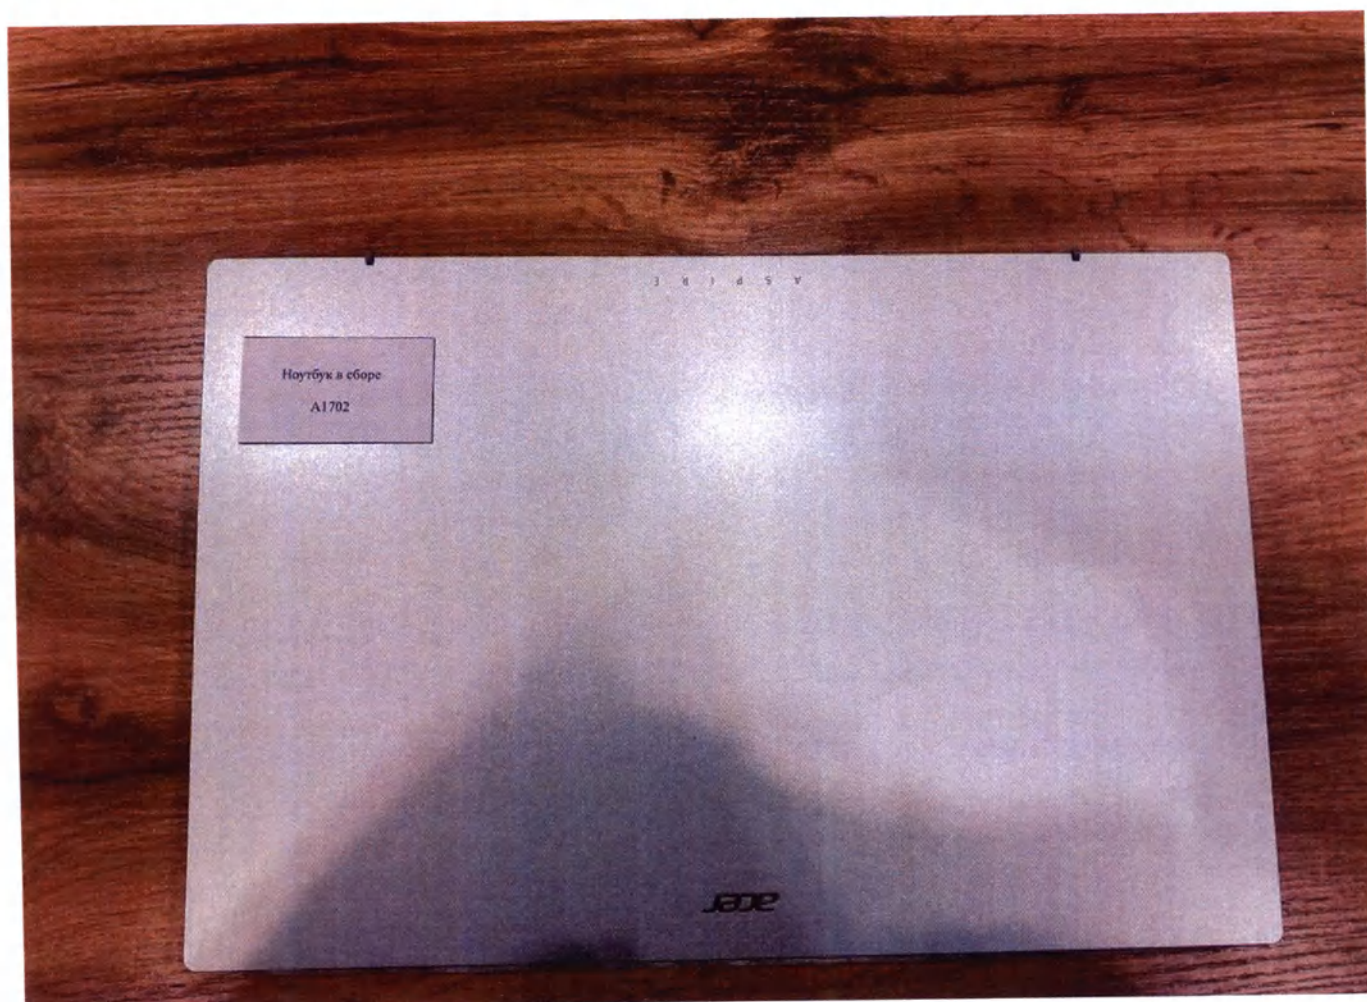

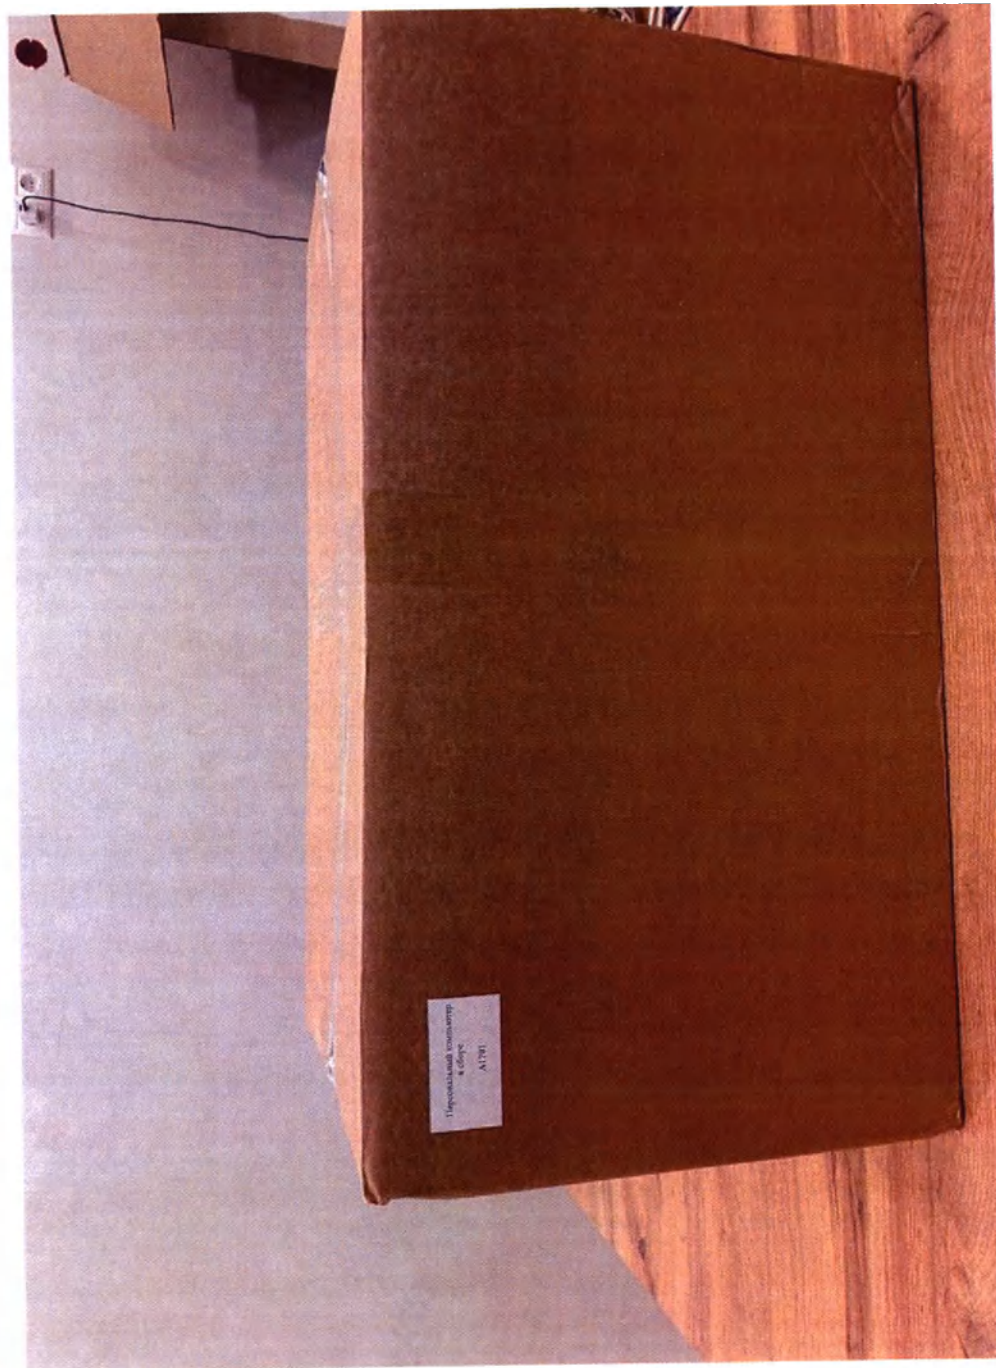

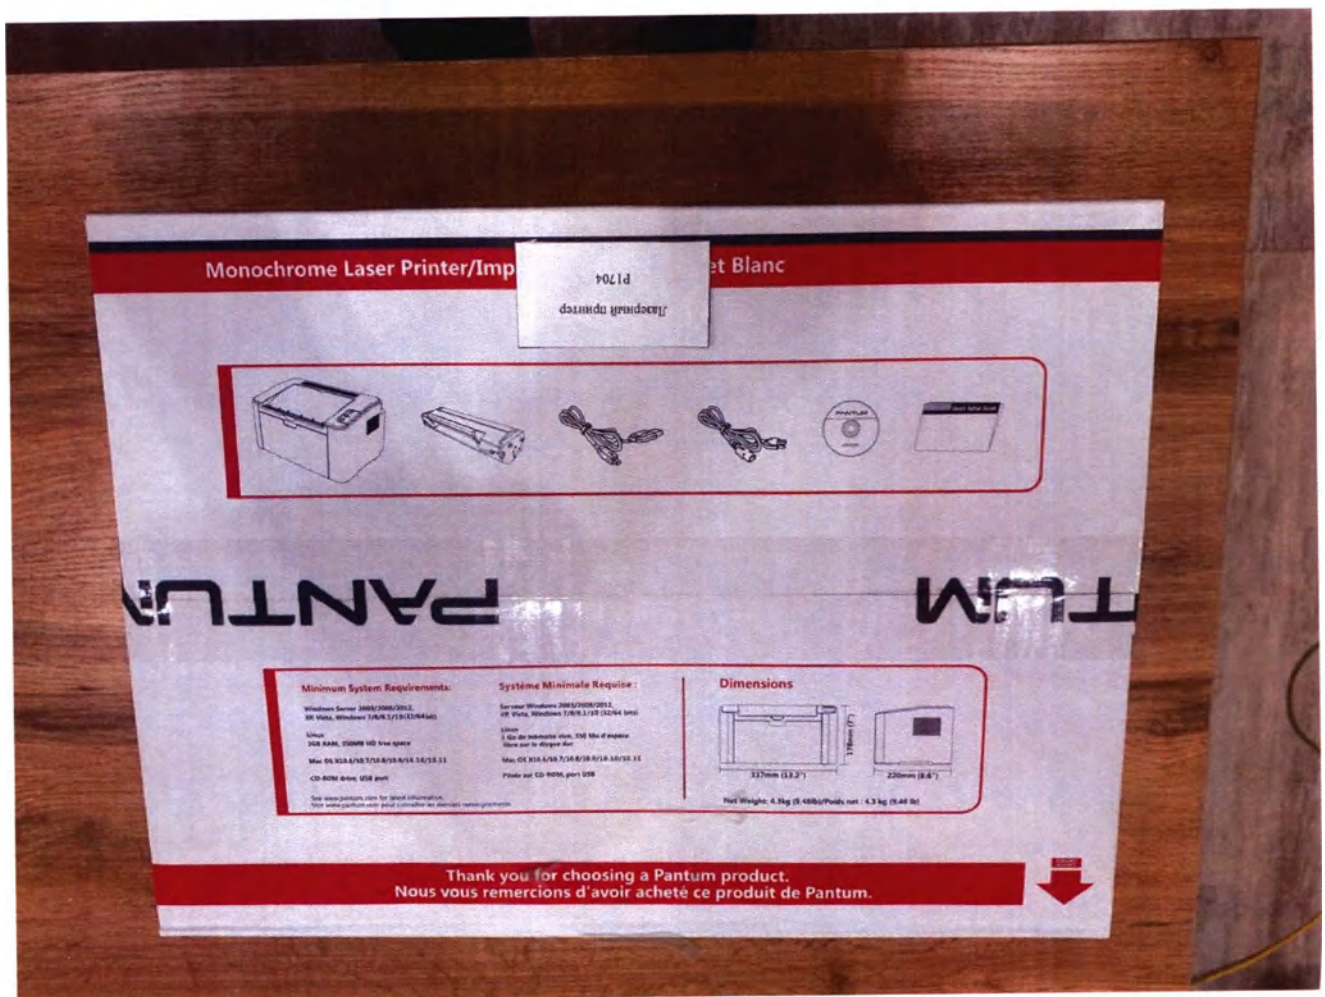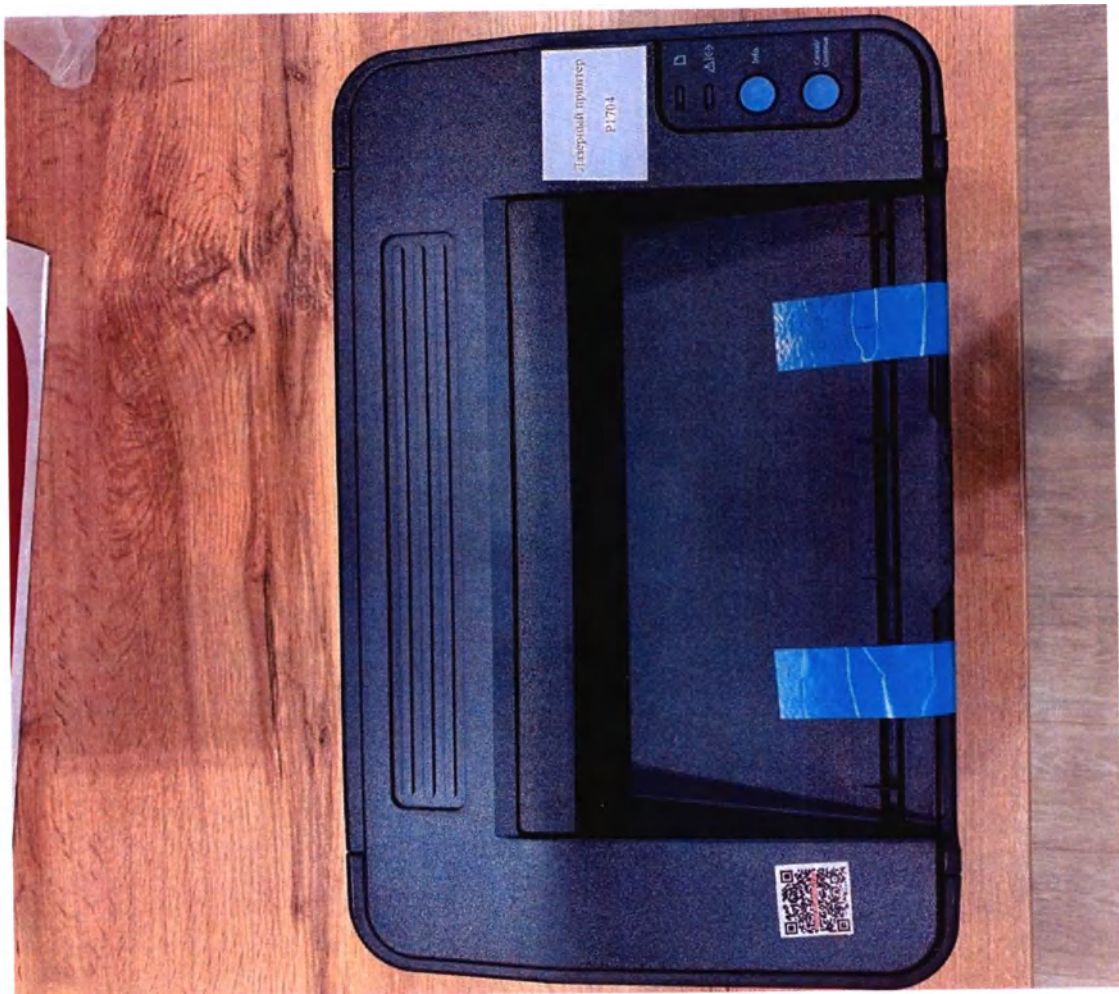

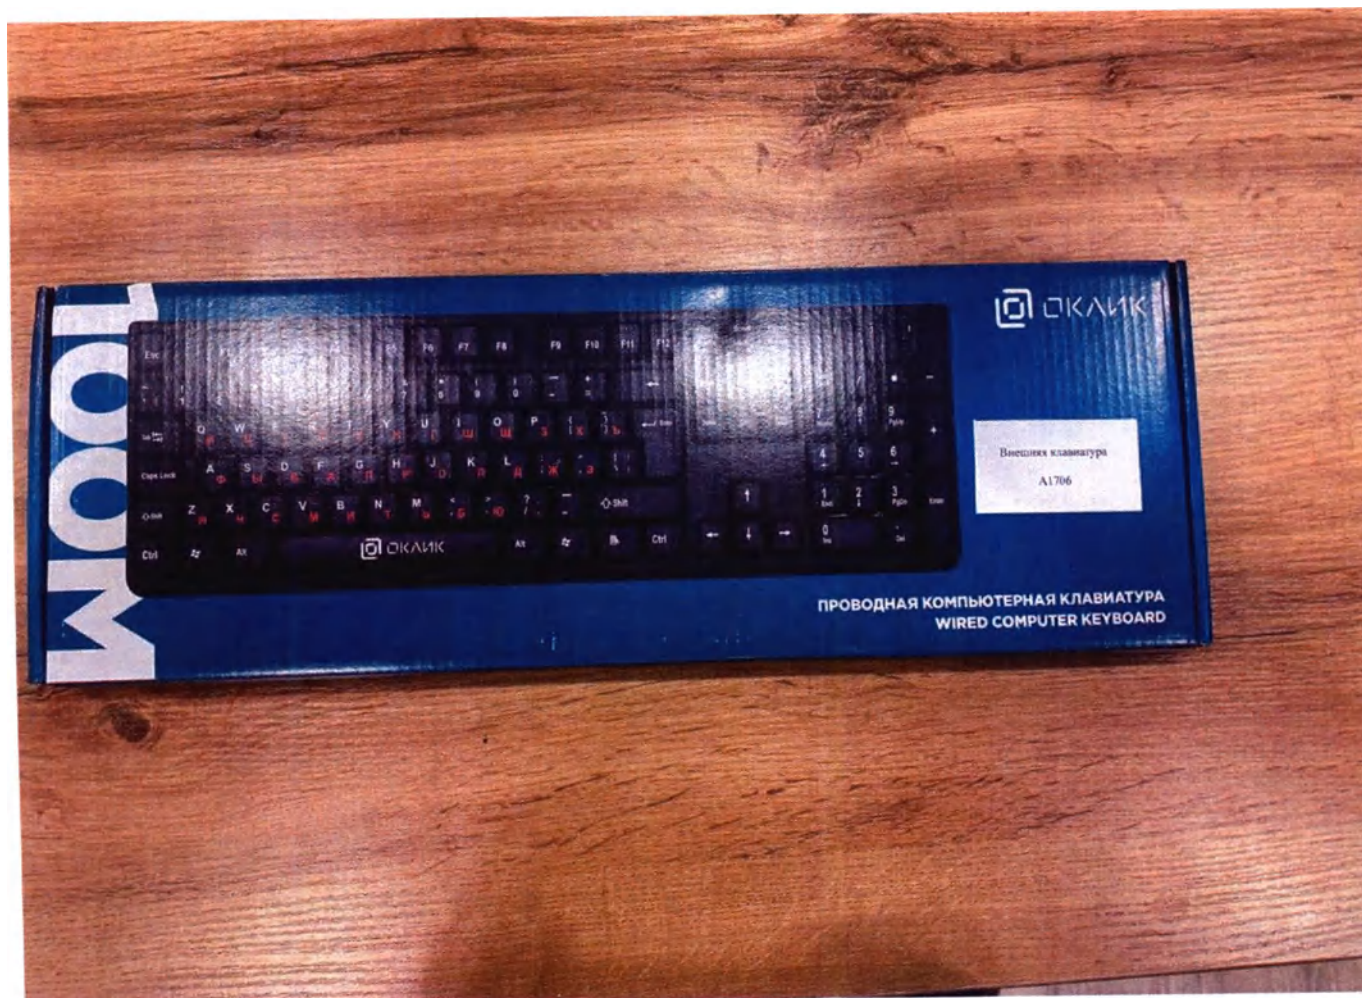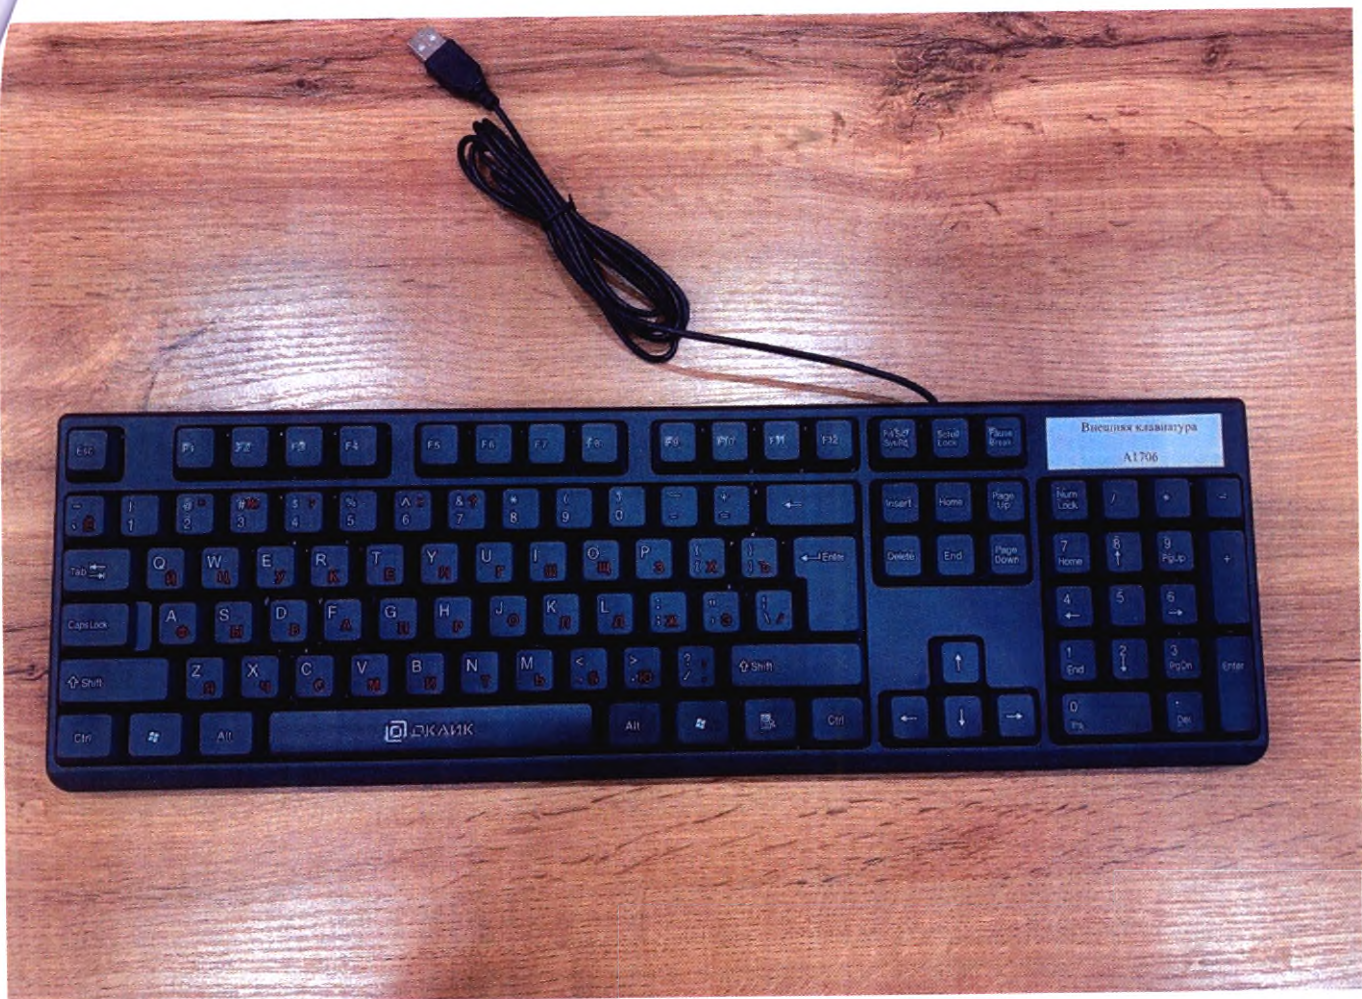

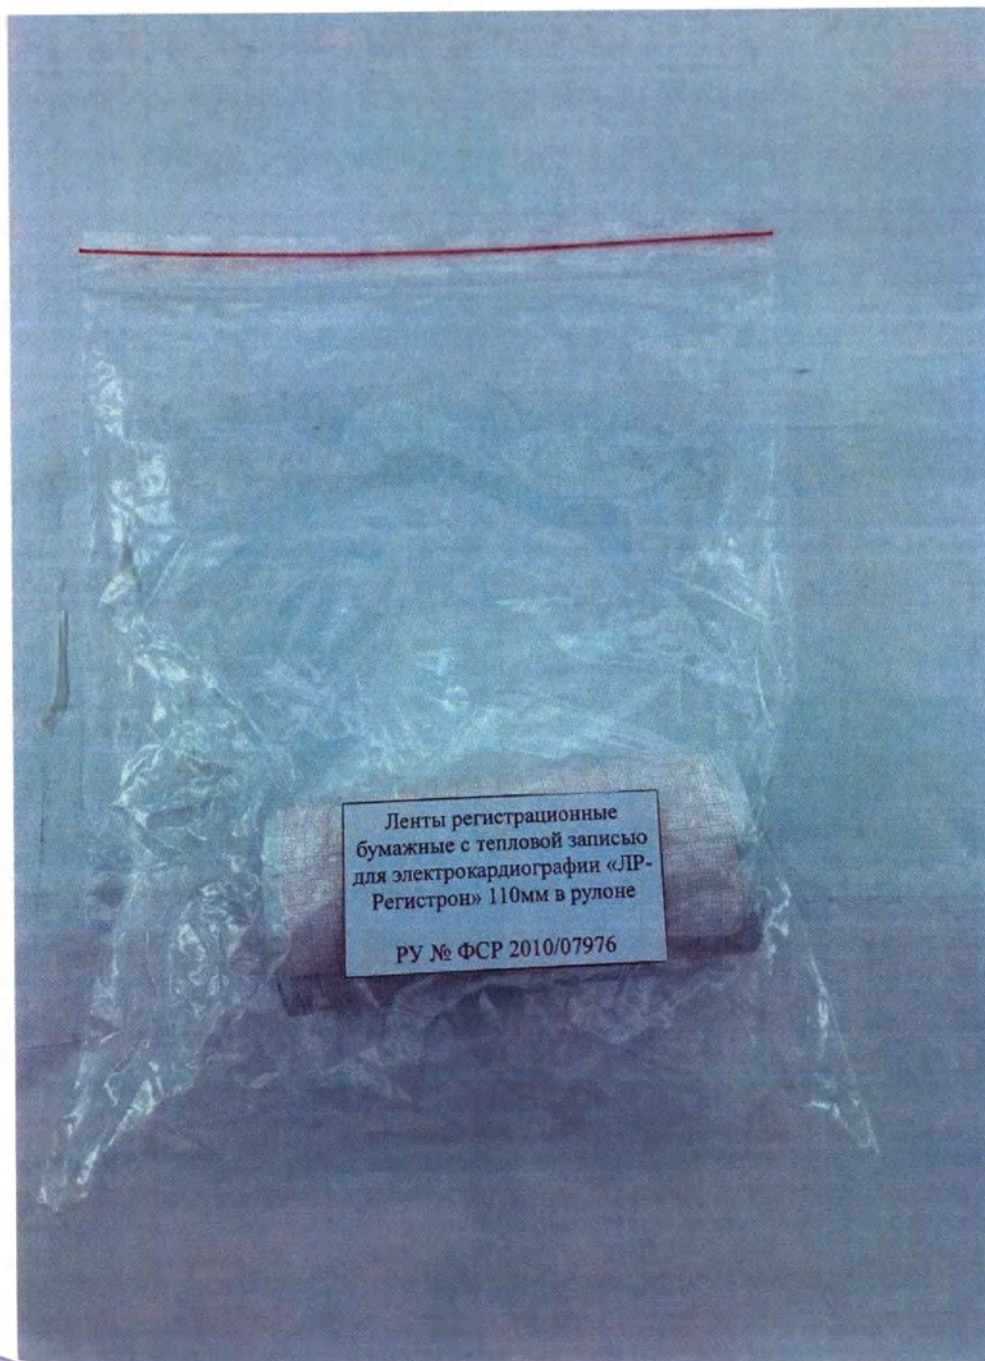

Зажим носовой медицинский
со сменными подушечками ЗП-«ПАЙП»
ТУ 9398-003-56156837-2014

Производитель: ООО «ПАЙП»

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская,

РУ Росздравнадзора № РЗН 2014/2107 от 23.08.2017 г.

Комплект: Зажим носовой «ПАЙП»-1 шт.,


«Сменная» подушечка «ПАЙП»- 6 шт.


Дата изготовления на коробке Гаранти. срок - 1 год







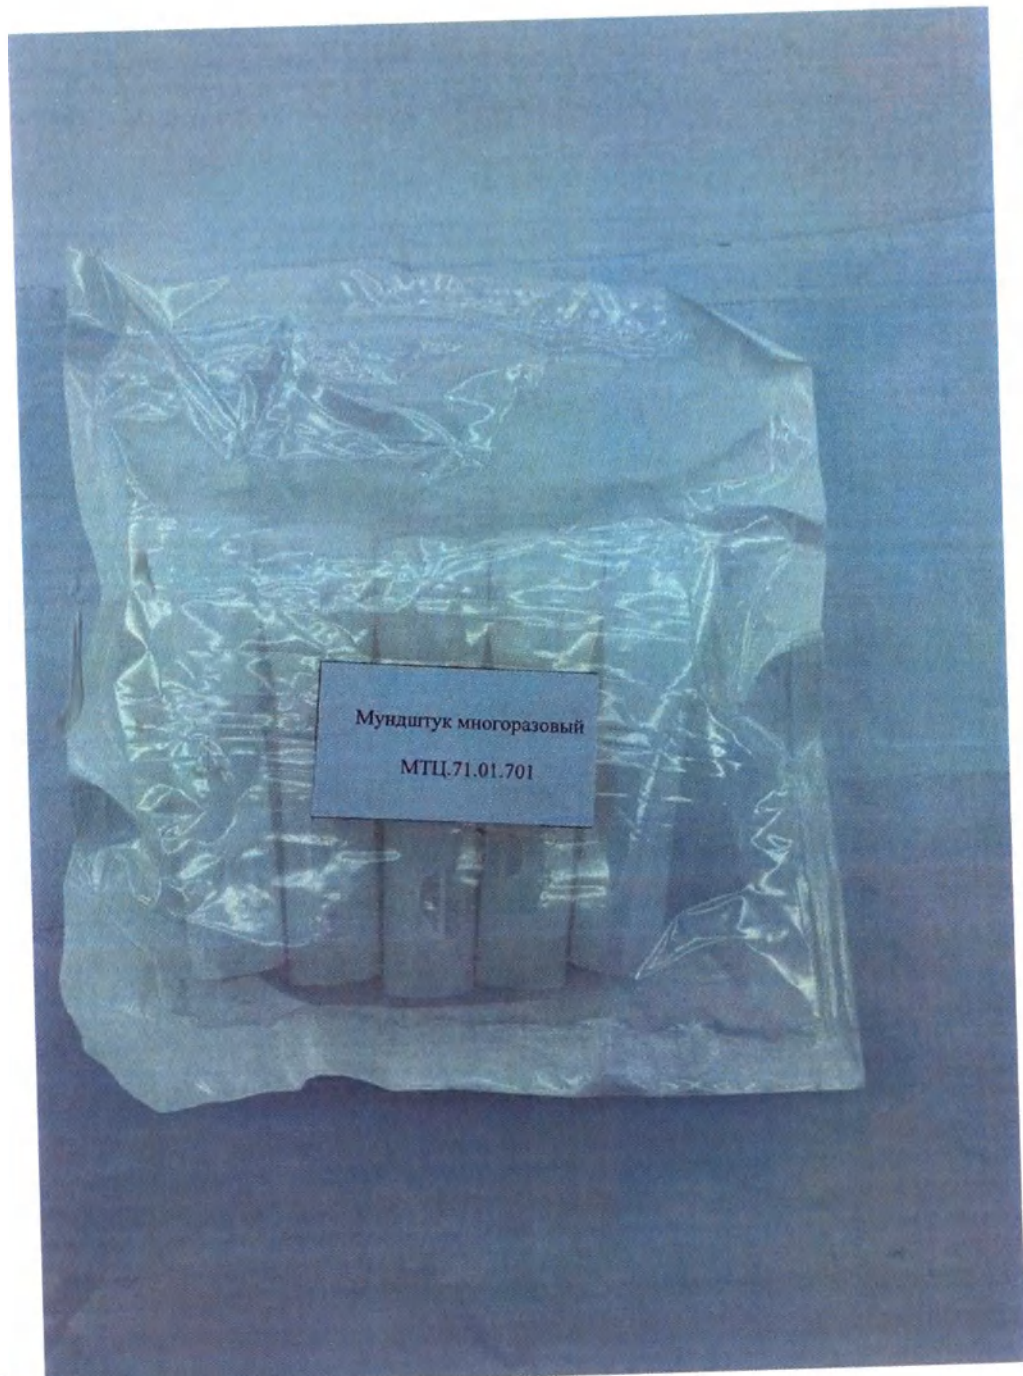

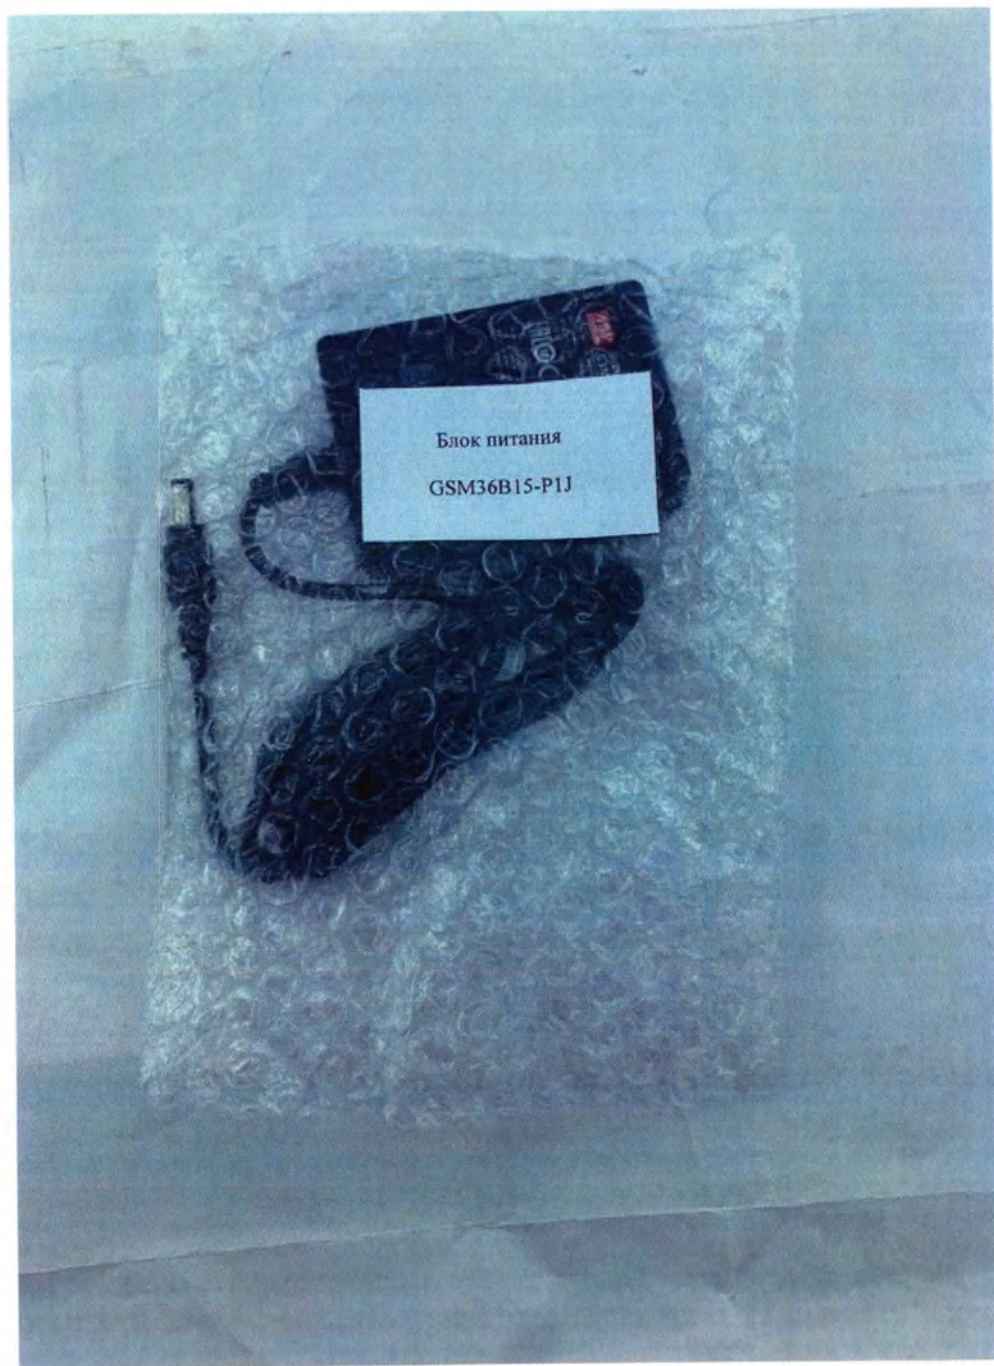

В данном документе прошито 11 листов

Генеральный директор Ю.Б. Попов

«22» Октября 2019г.

