
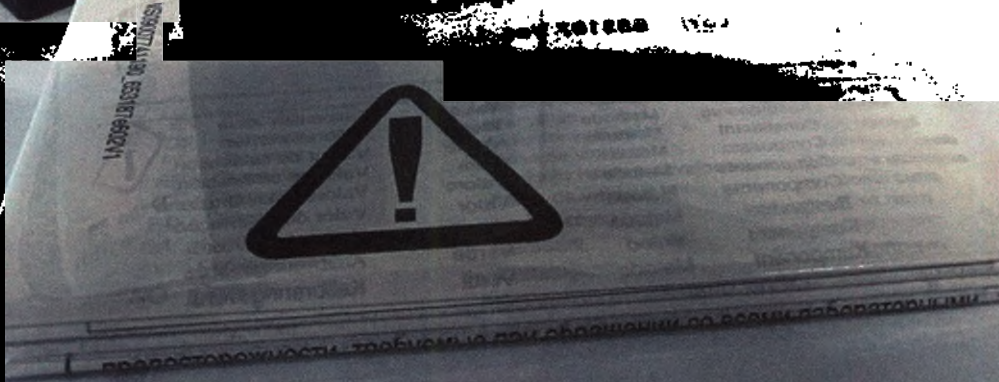


Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers)»

2023

Литы в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
флуоресцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elesys T4 cobas e
720), вариант исполнения 200 тестов

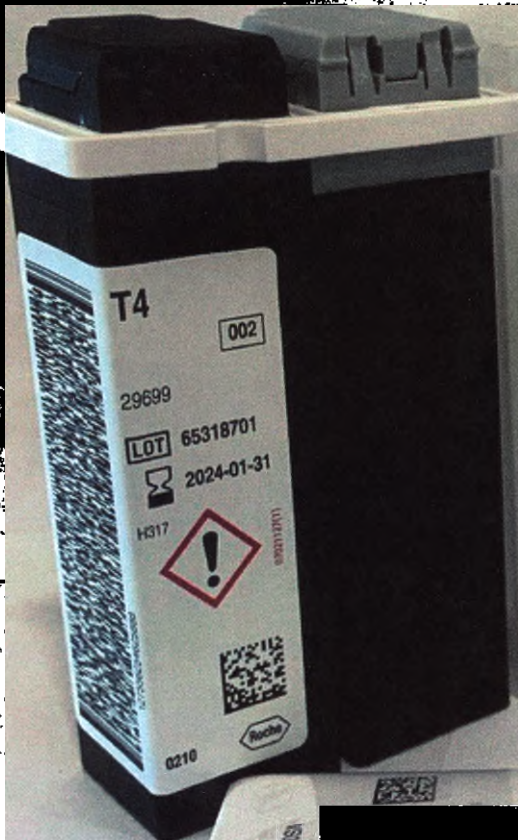

агенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e
analyzers), вариант исполнения 200 тестов

Elecsys T4

cobas e analyzers

REF 09007741190

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

07020295001(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany



H317,H412
P261,P273,P280
P333+P313
P362+P364,P501

CONTENT

Σ 200

M	12 mL
R1	18 mL
R2	18 mL



IVD **CE** 0123  2-8 °C

 dialog.roche.com

02

cobas[®]

Elecsys T4

REF 09007741190


For USA: CONTENT

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Polyclonal anti-T4-antibody (sheep) labeled with ruthenium complex 100 ng/mL; ANS 1mg/mL
- R2 Biotinylated T4 20 ng/mL



Rx only

01



...ного определения тироксина в сыворотке. В ...
... на анализаторах и модулях иммунохимического ...




Кассеты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
флуоресцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e
модуль), вариант исполнения 200 тестов



енты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
мунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e
alyzers), вариант исполнения 200 тестов



агенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e
analyzers), вариант исполнения 200 тестов

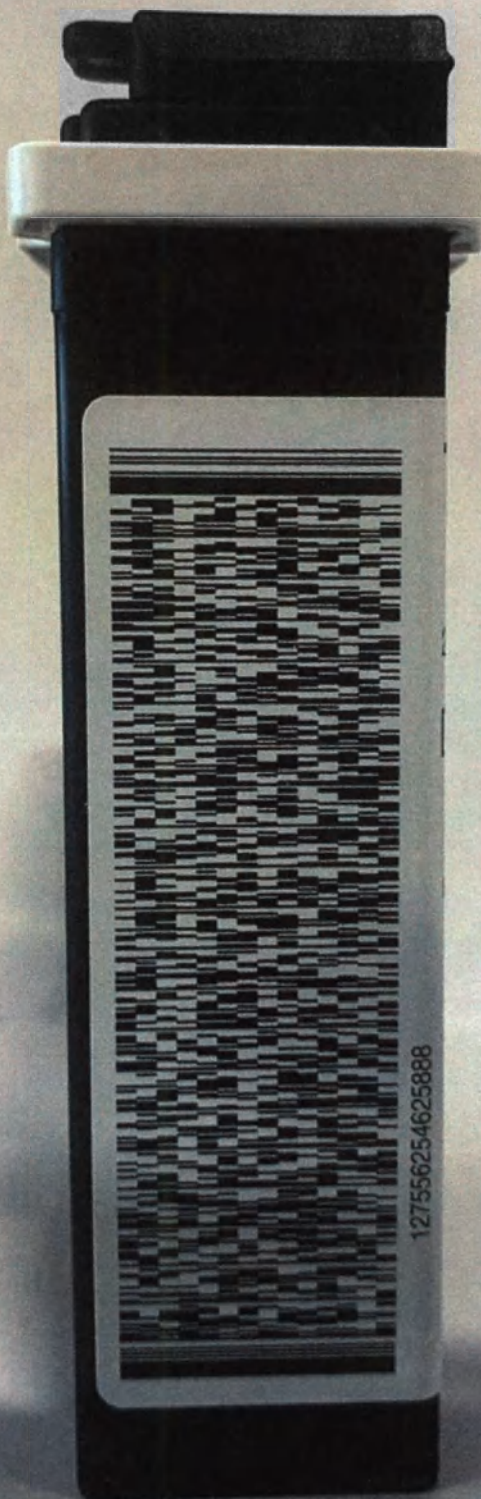

Реагенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант исполнения 200 тестов (маркировка на русском языке)

Реагенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант исполнения 200 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16565 от 22.02.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 09007741190

Реагенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимии cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант исполнения 300-тестов

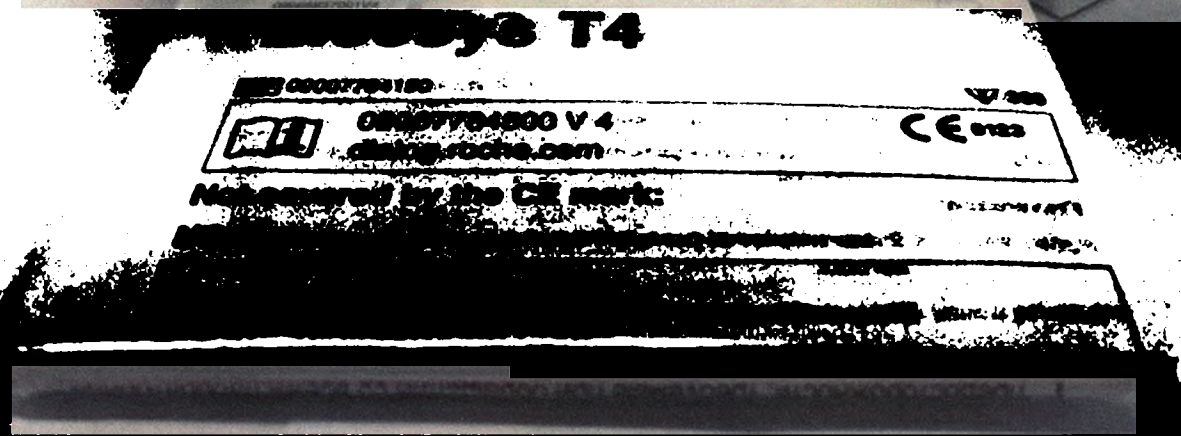

тты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
нохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант
олнения 300 тестов

Elecsys T4

cobas e analyzers

REF 09007784190

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

07020279001(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

H317, H412
P261, P273, P280
P333+P313
P362+P364, P501

CONTENT

Σ 300

R1 19.7 mL

R2 19.7 mL

M 13.2 mL



IVD

CE

0123

χ 2-8 °C



dialog.roche.com

02



cobas[®]

агенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант исполнения 300 тестов (маркировка на русском языке)

Elecsys T4

REF 09007784190

For **USA:** **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Polyclonal anti-T4-antibody (sheep) labeled with ruthenium complex 100 ng/mL; ANS 1mg/mL
- R2** Biotinylated T4 20 ng/mL



Реагенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант исполнения 300 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16565 от 22.02.2022

Срок годности см. на упаковке


Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-84. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com Кат. номер 09007784190



енты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
мунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов



T4

REF (240)09007784190

GTIN

(01)07613336171677

UDI



LOT (10)71166801



2024-06-30




2023-02-16

02



енты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
мунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант
полнения 300 тестов

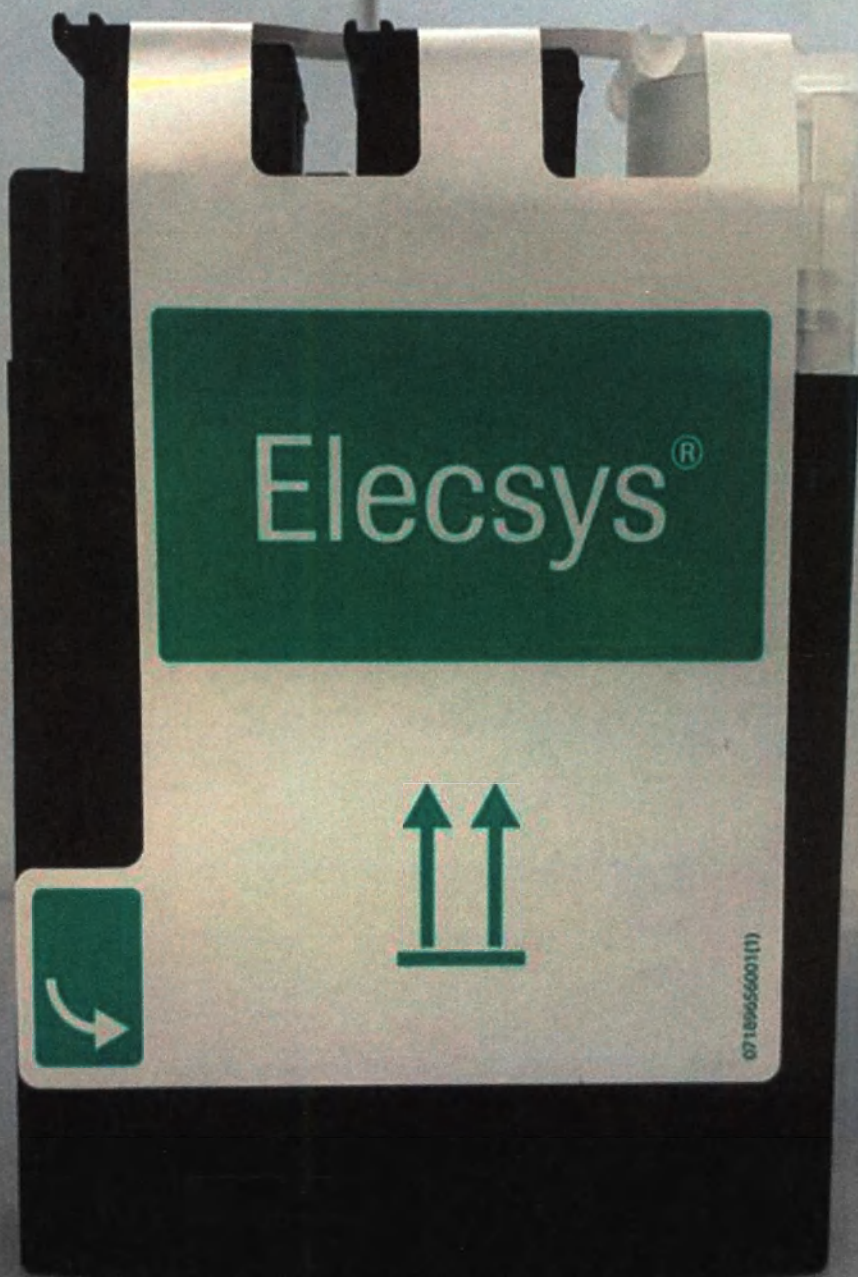

таты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови
унохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант
полнения 300 тестов



агенты в кассете для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T4 cobas e analyzers), вариант исполнения 300 тестов



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

16 листа (ов)



Евсеев А. Г.

по доверенности
от 30.01.2023 г.