

Общество с ограниченной ответственностью
«Комплексные автоматизированные системы»

Адрес: 634009, Россия, Томская область,
г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, офис 56-59
Тел./Факс: 8(3822)51-67-61
ИНН 7017338658/КПП 701701001
ОГРН 1137017019039

Р/с 40702810110030002118
в Филиал ОАО Банк ВТБ в г.
Красноярске
К/с 30101810200000000777
БИК 040407777

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КАС»

Е.В. Куриленко

_____ 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Автоматизированная система предсменных/предрейсовых
(послесменных/послереисовых) осмотров «АСПО»







ка монитора



ого монитора. (Вид спереди)



сенсорного монитора. (Вид сзади)




...не стойки монитора к основанию.




...ный блок в металлическом корпусе с предустановленным клиентским программным обеспечением



орный монитор

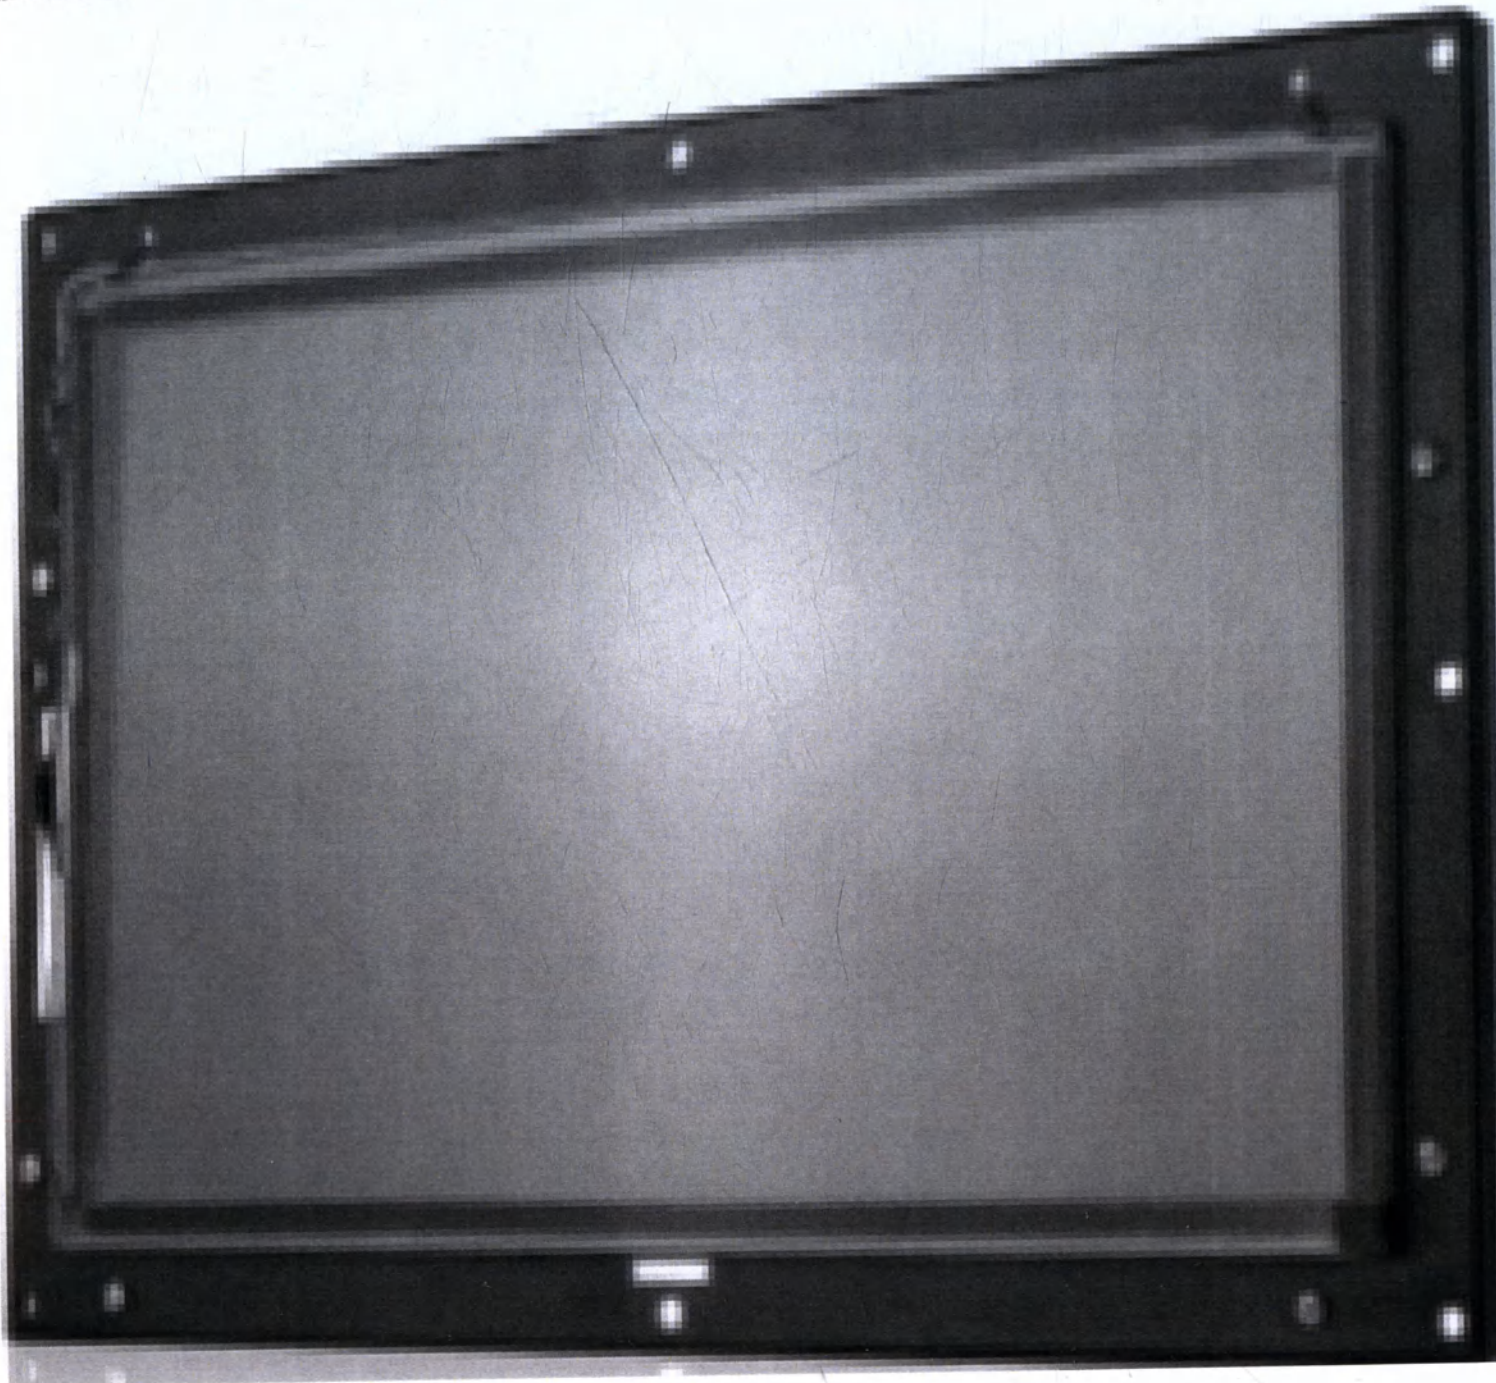

...е корпуса системного блока к основанию.

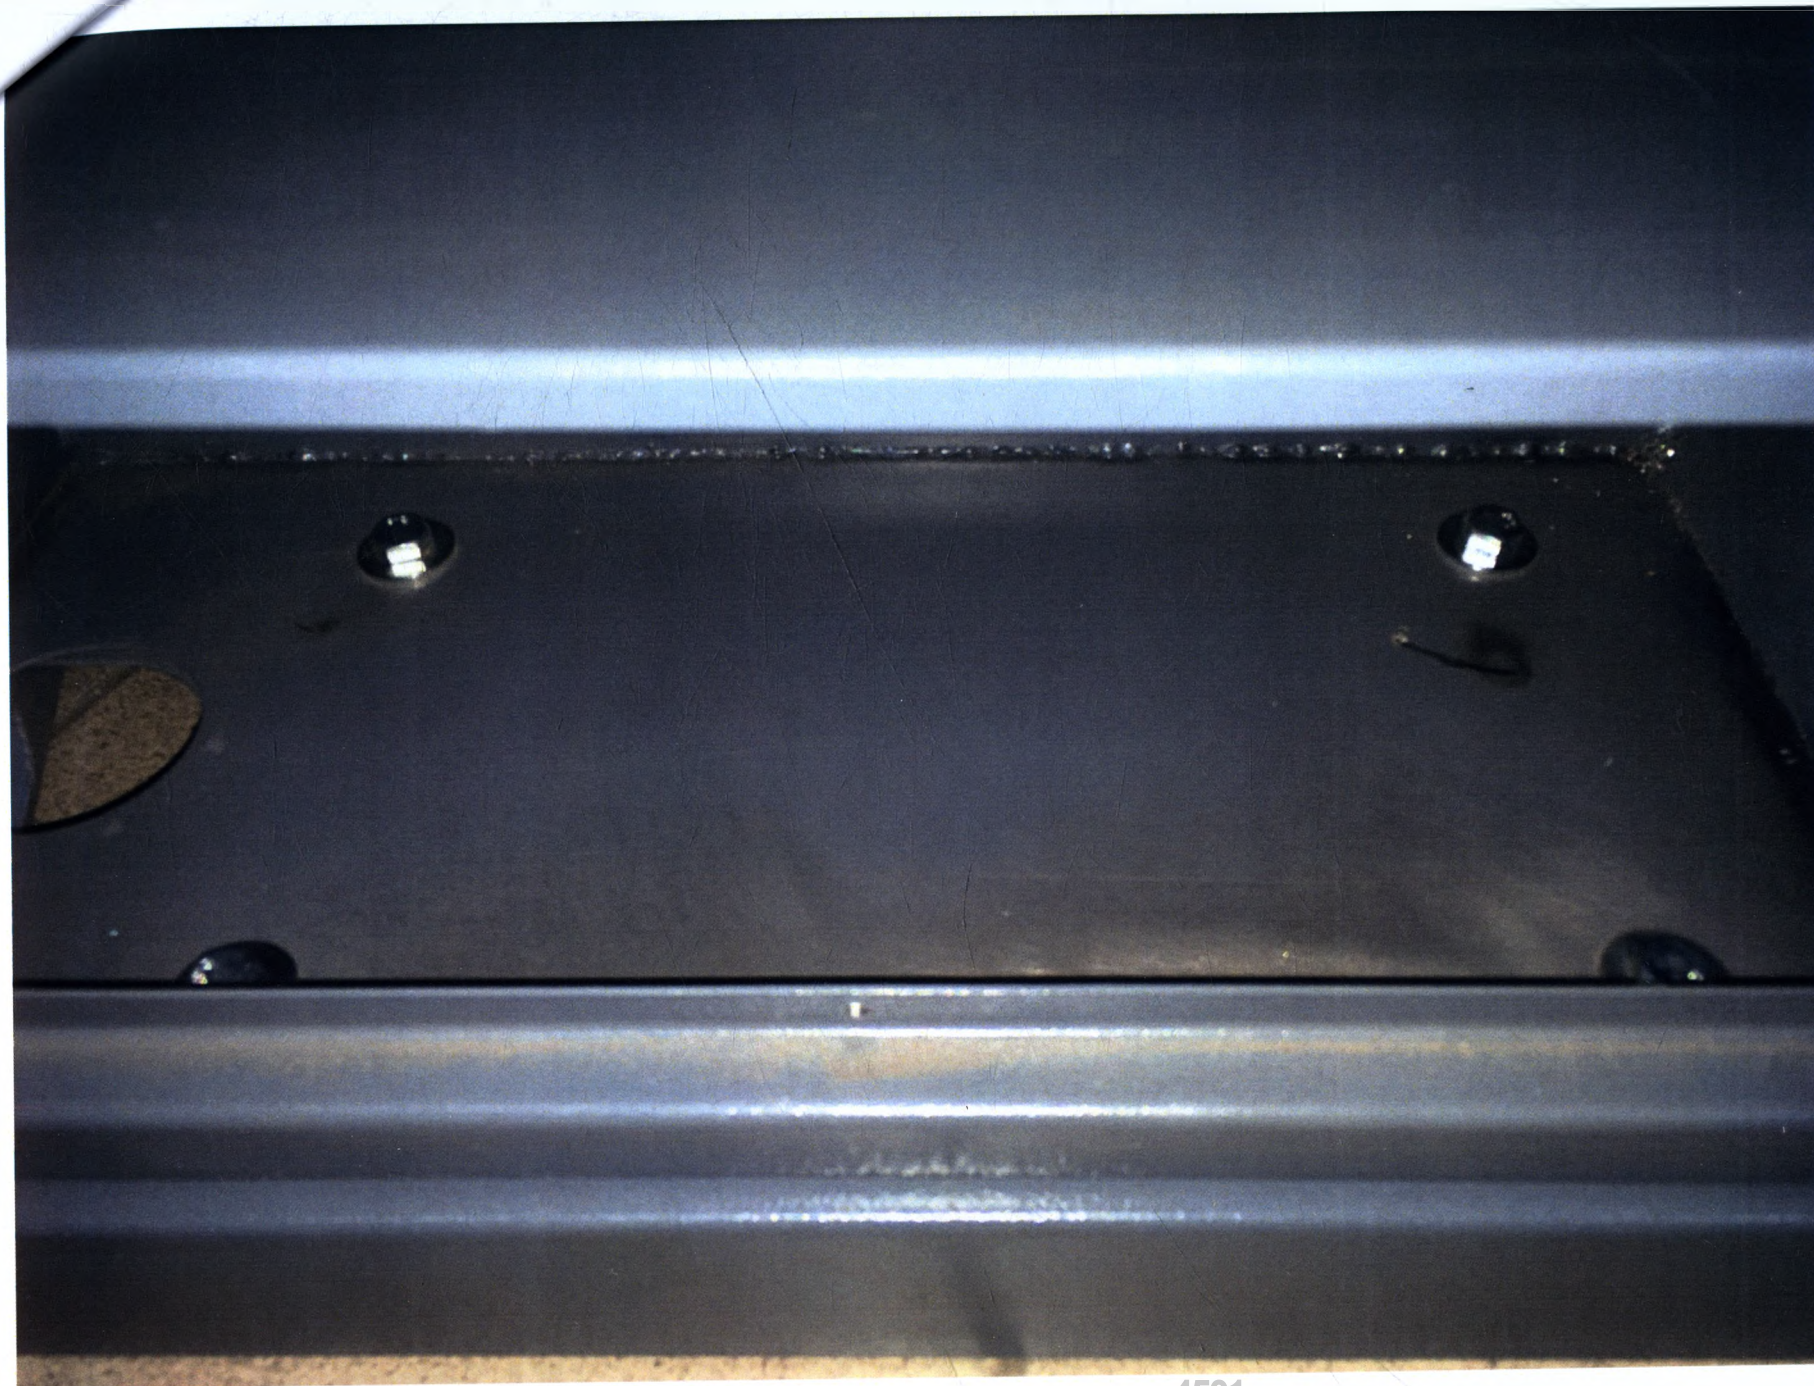



**Анализатор паров этанола
в выдыхаемом воздухе**



Динго В-01

1603015

Сер.номер

Класс ЭБ - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75

Климат. Исп.: ВЗ по ГОСТ 15150-69

Раб. температура : 0-40°C

Питание : 12В/1,5 А стабил.

Дата производства: 2014


Производитель: Sentech Korea Corp.


Официальный поставщик: ООО «СИМС-2»


www.alcotester.ru

Сделано в Корее

Порог срабатывания сигнализации 0,15 мг/л

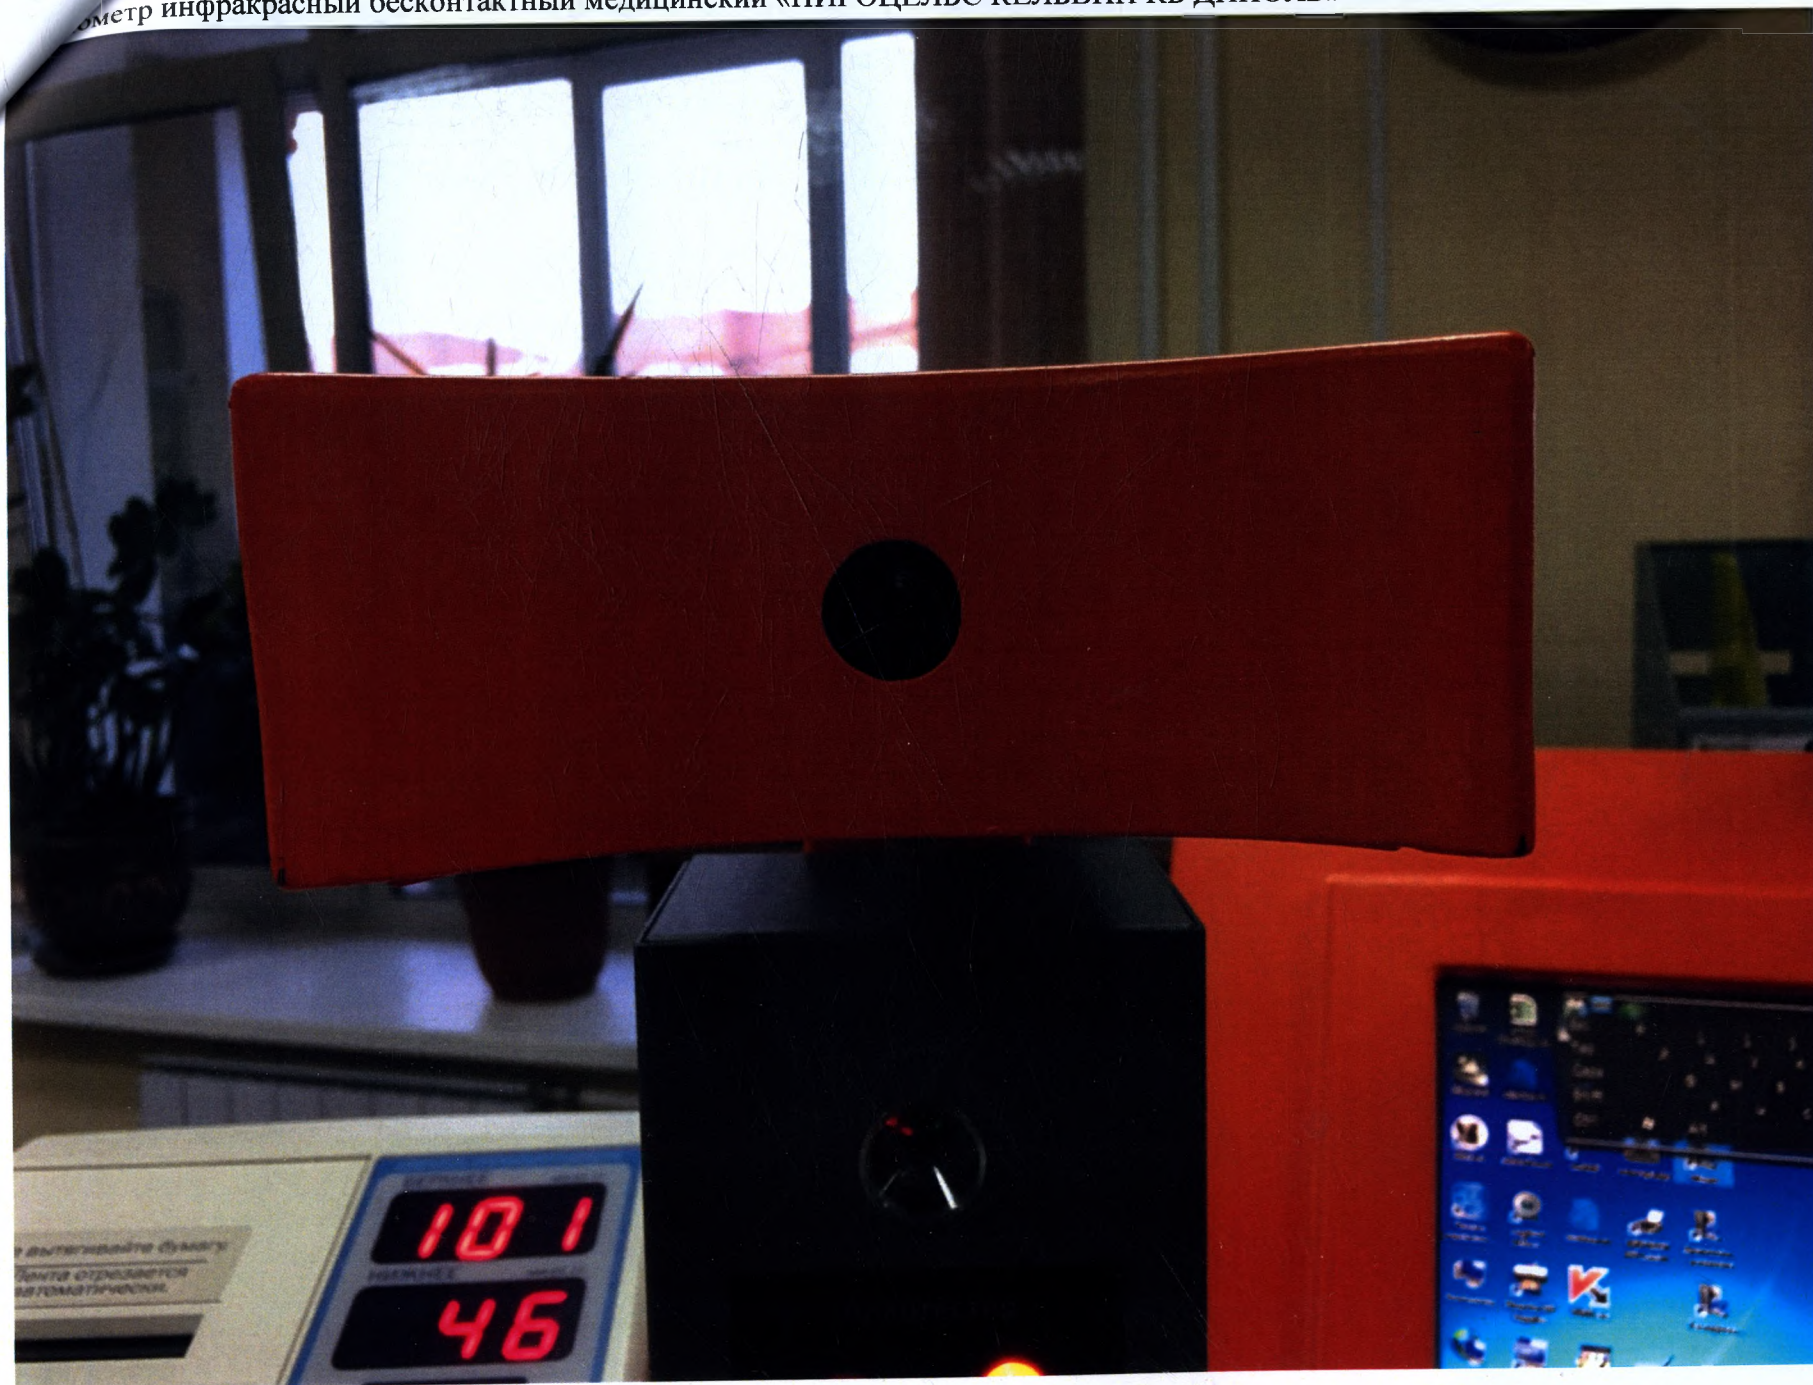

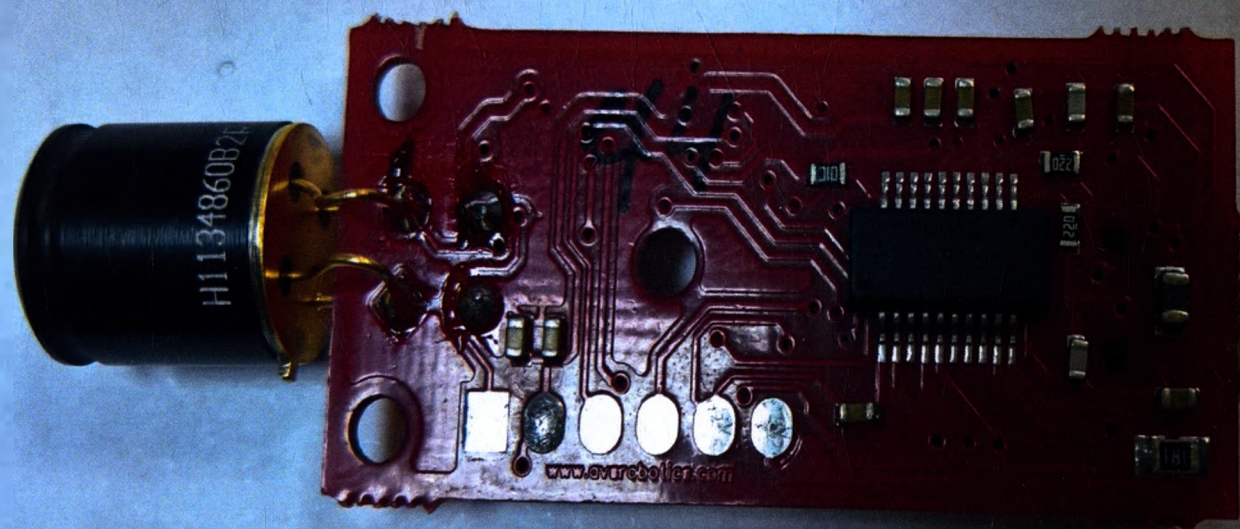


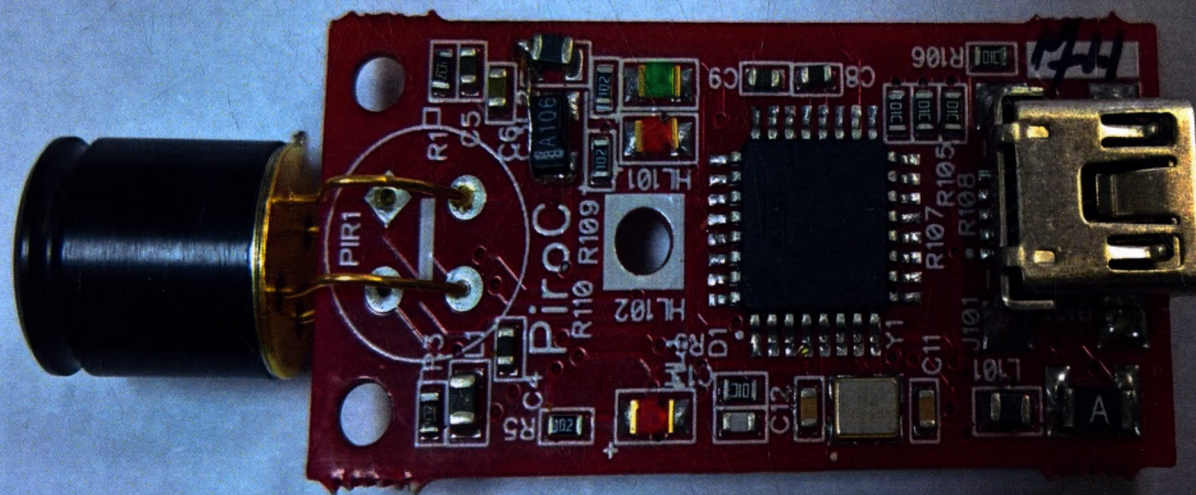

...ение вертикальной измерительной стойки к стальному корпусу системного блока. Общий вид.



...ня вертикальной измерительной стойки к стальному корпусу системного блока.

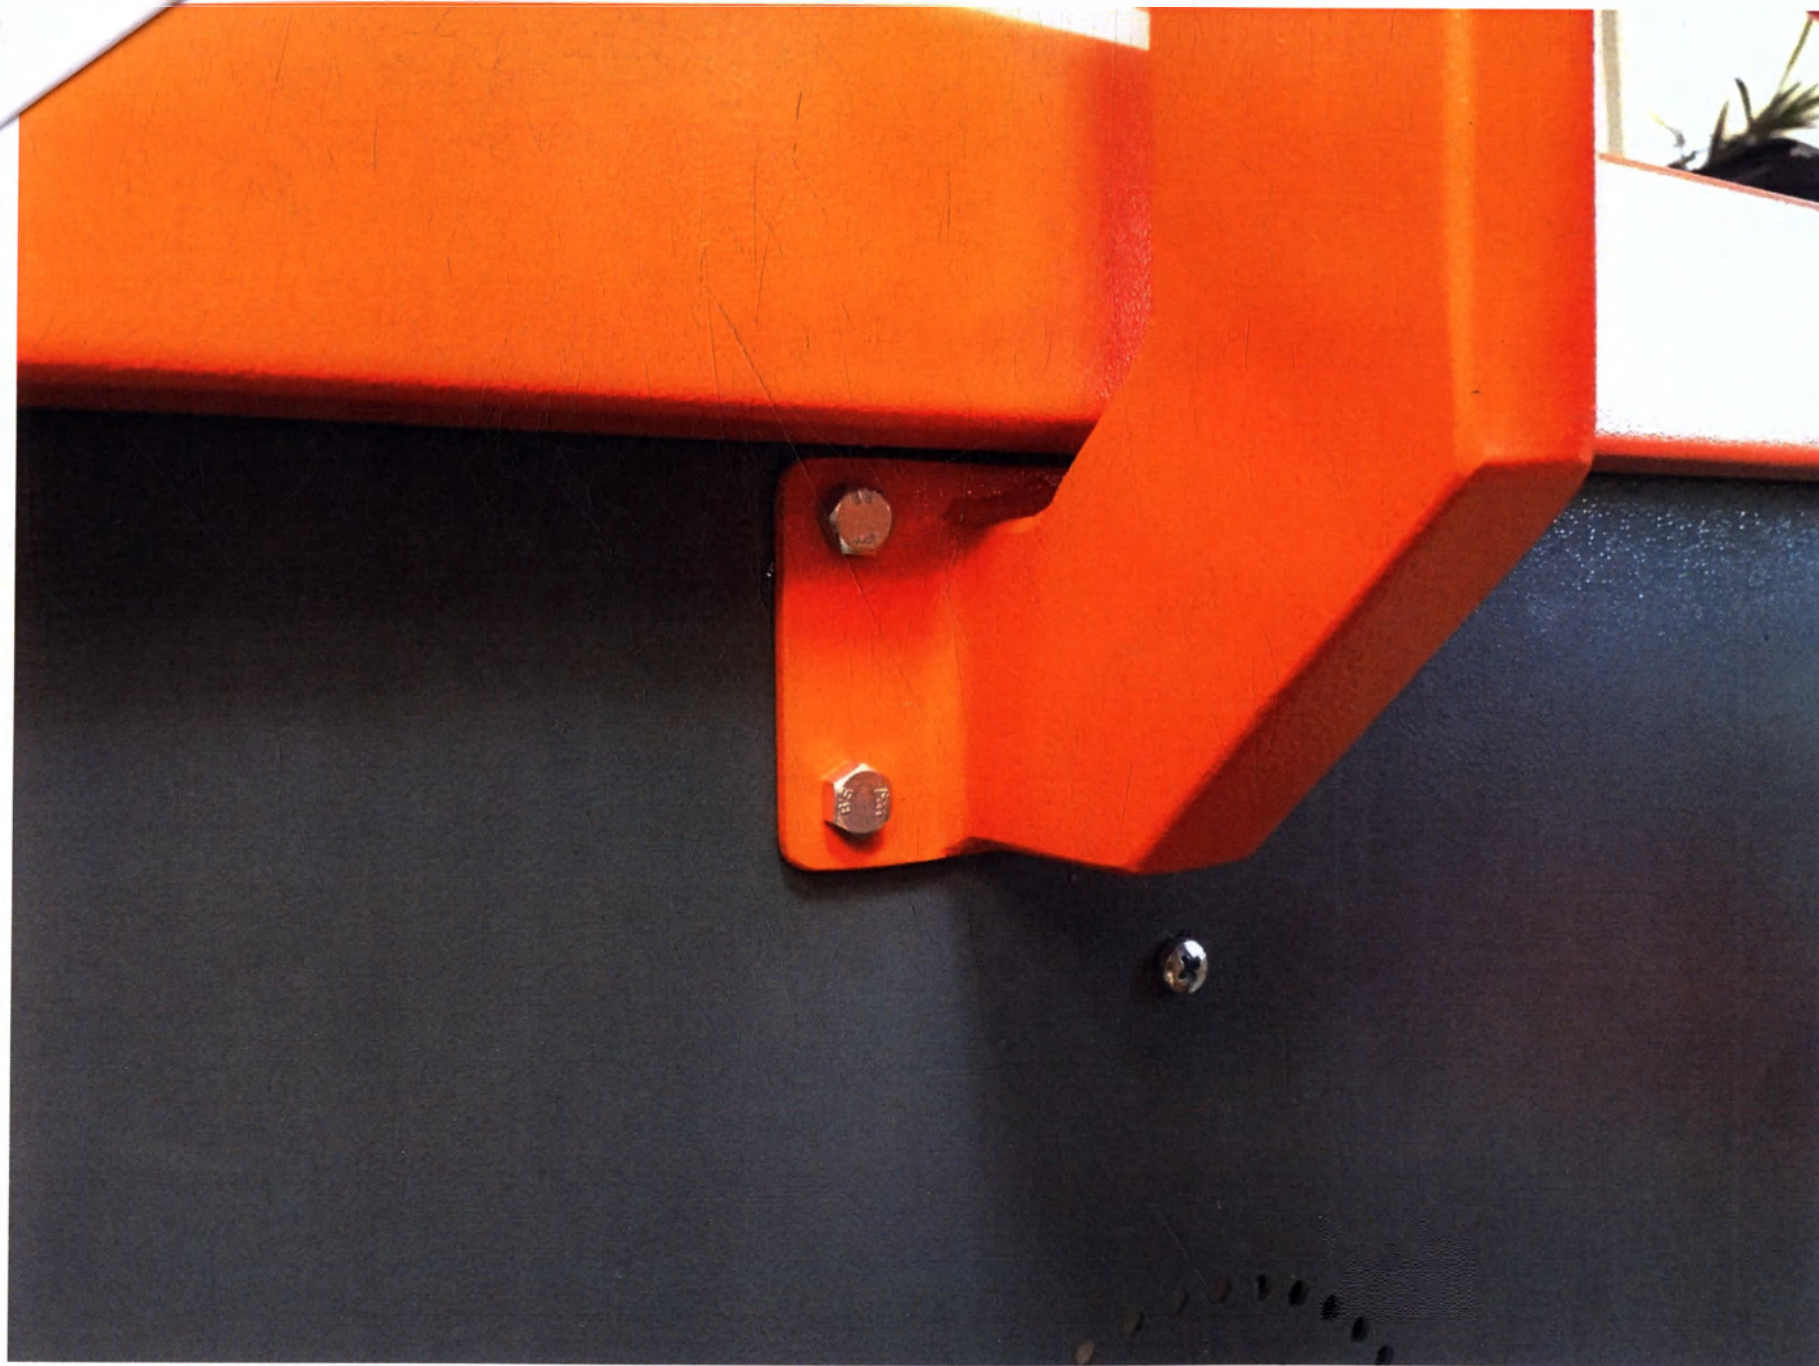



итель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой ТМ2655Р. (Вид сзади)



тель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой ТМ2655Р (маркировка)



ИНСТРУКЦИЯ

1. Поместите руку в отверстие прибора до упора локтя в специальное углубление и расслабьтесь.
2. Нажмите СТАРТ/СТОП кнопку.
3. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.
4. Выньте руку после появления результатов измерения на дисплее и выпуска воздуха из манжеты.

• Ваше кровяное давление изменяется в течение дня.
Этот прибор поможет вам измерять артериальное давление, но не сможет заменить регулярные консультации с врачом.

1084034284

**ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И
ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ**
МОДЕЛЬ: TM-2655P

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: 0-300 мм РТ.СТ.
ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ: ± 3 мм РТ.СТ.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 220В, 50Гц

РАЗРАБОТАНО: A&D Company, Limited, ТОКУО (ЯПОНИЯ)

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0										
1										
2										


S001

MODEL : TM-2655P

LOT

18-12

2018



S N

2A4210886



срца







ООО "КАС"


634009, Россия, Томская область,

г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, офис 56-59


Автоматизированная система предсменных/предрейсовых
(послесменных/послерейсовых) осмотров «АСПО»

TU 26.60.12-001-12425058-2018

№ РУ XXX от XXXX.XXXX



XX.YYYY



XXXXXX



IP20

V ~ 220В f ~ 50Гц I 2,7А

Масса, не более 100 кг

Всего прошито и
сверено печатью
и штампом
Руководитель Е. В.

