



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Сканер системы Flash мониторинга глюкозы
FreeStyle Libre 2***

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

подразделения средств диагностики диабета


ООО «Эбботт Лэбораториз»

Тямаева Л.А.

« 07 » ноября 2023 г.




Сканер системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 1. Сканер - 1 шт.

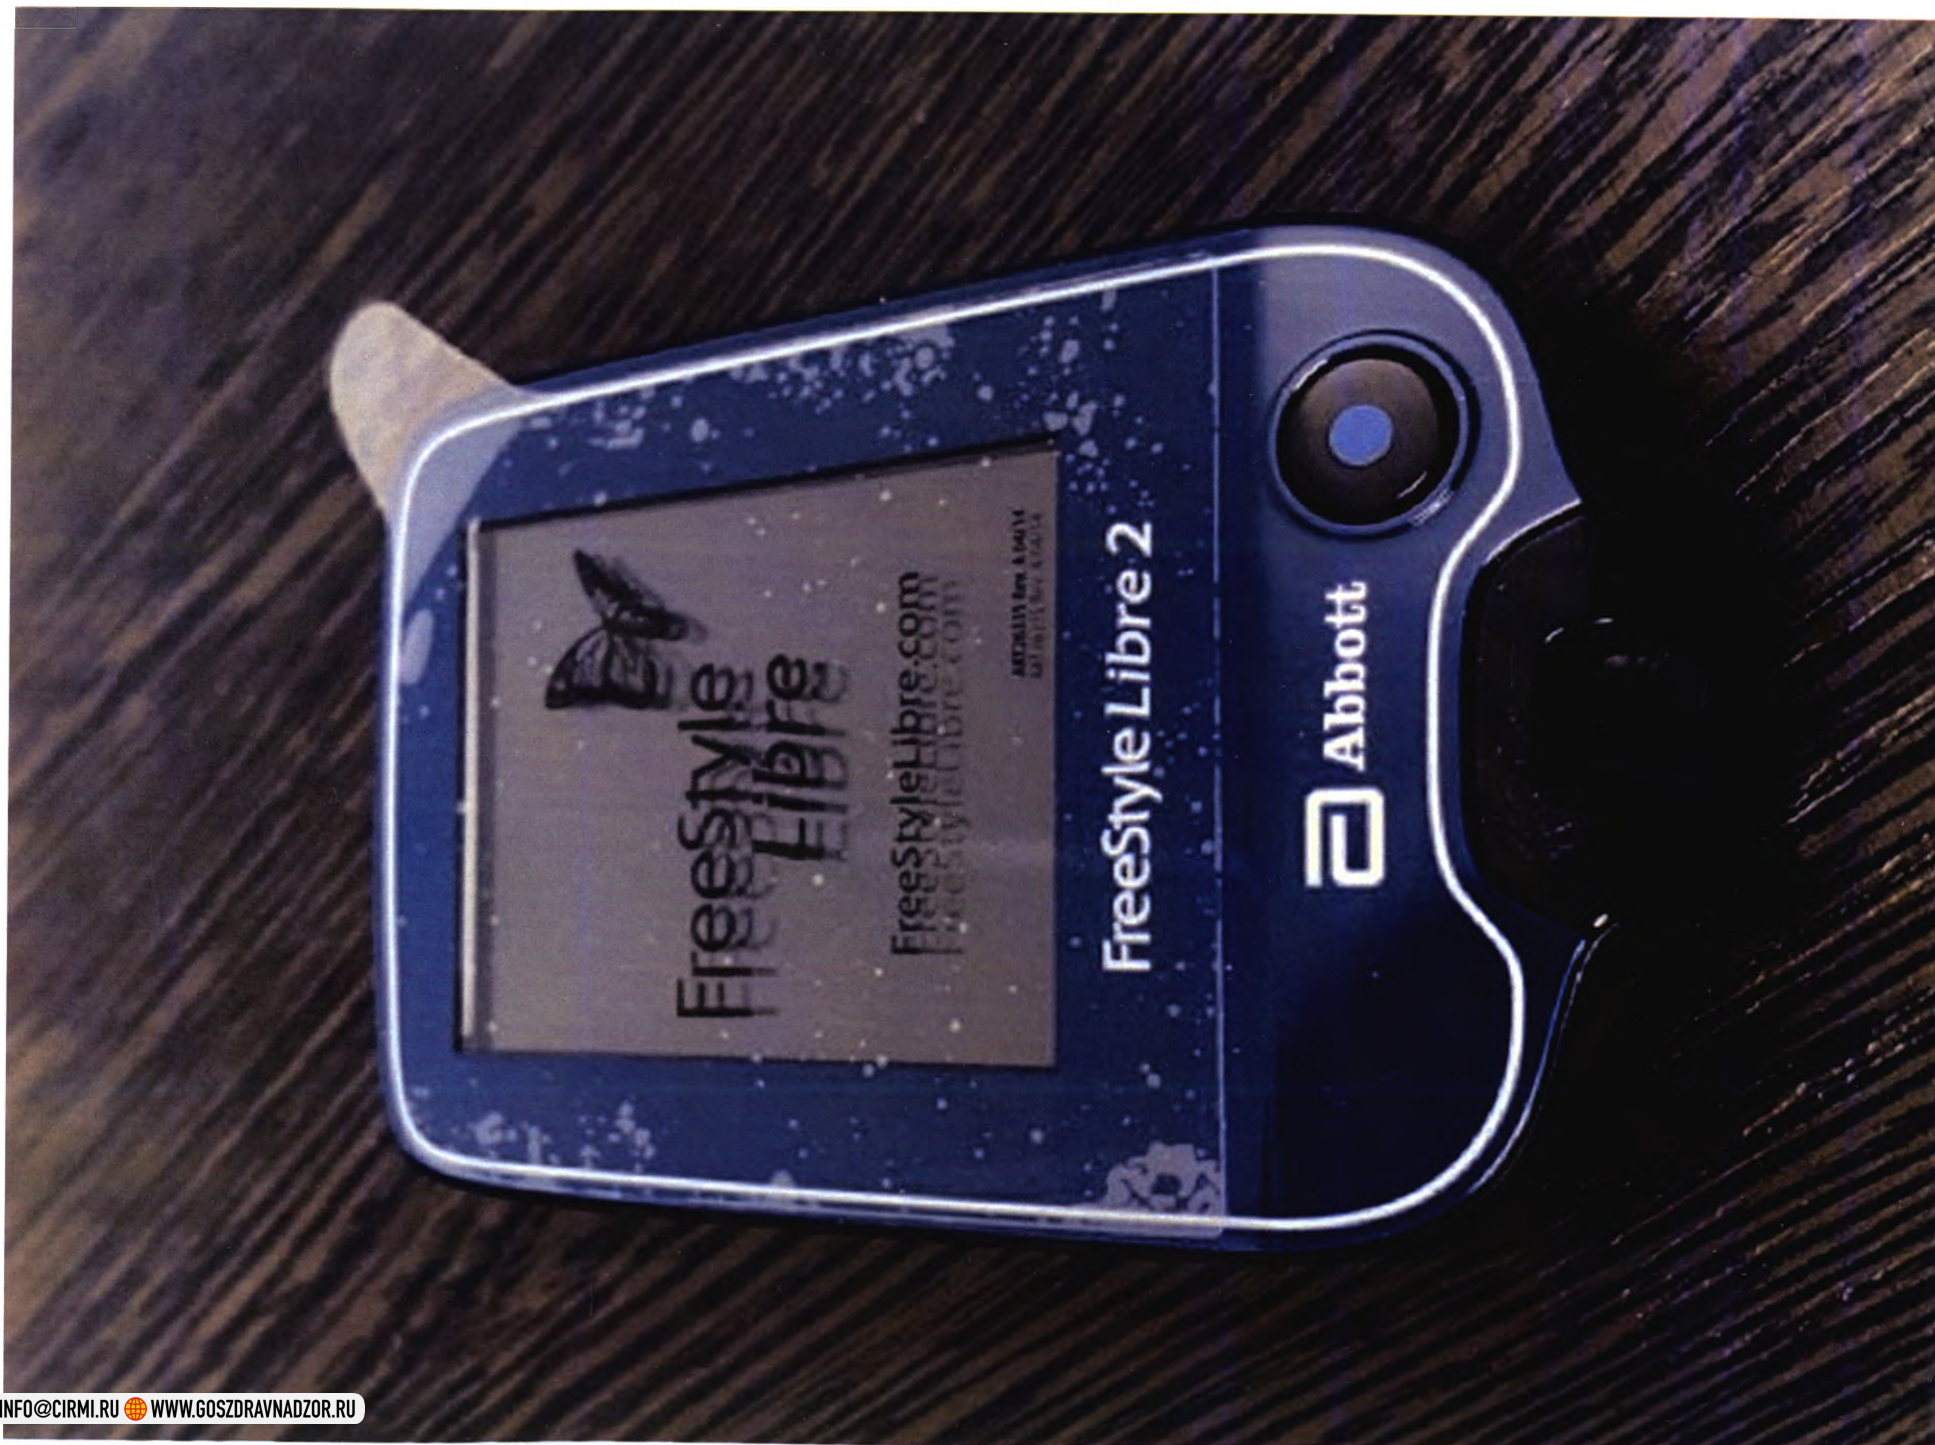




Сканер системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2, в составе: 3. Блок питания - 1 шт.

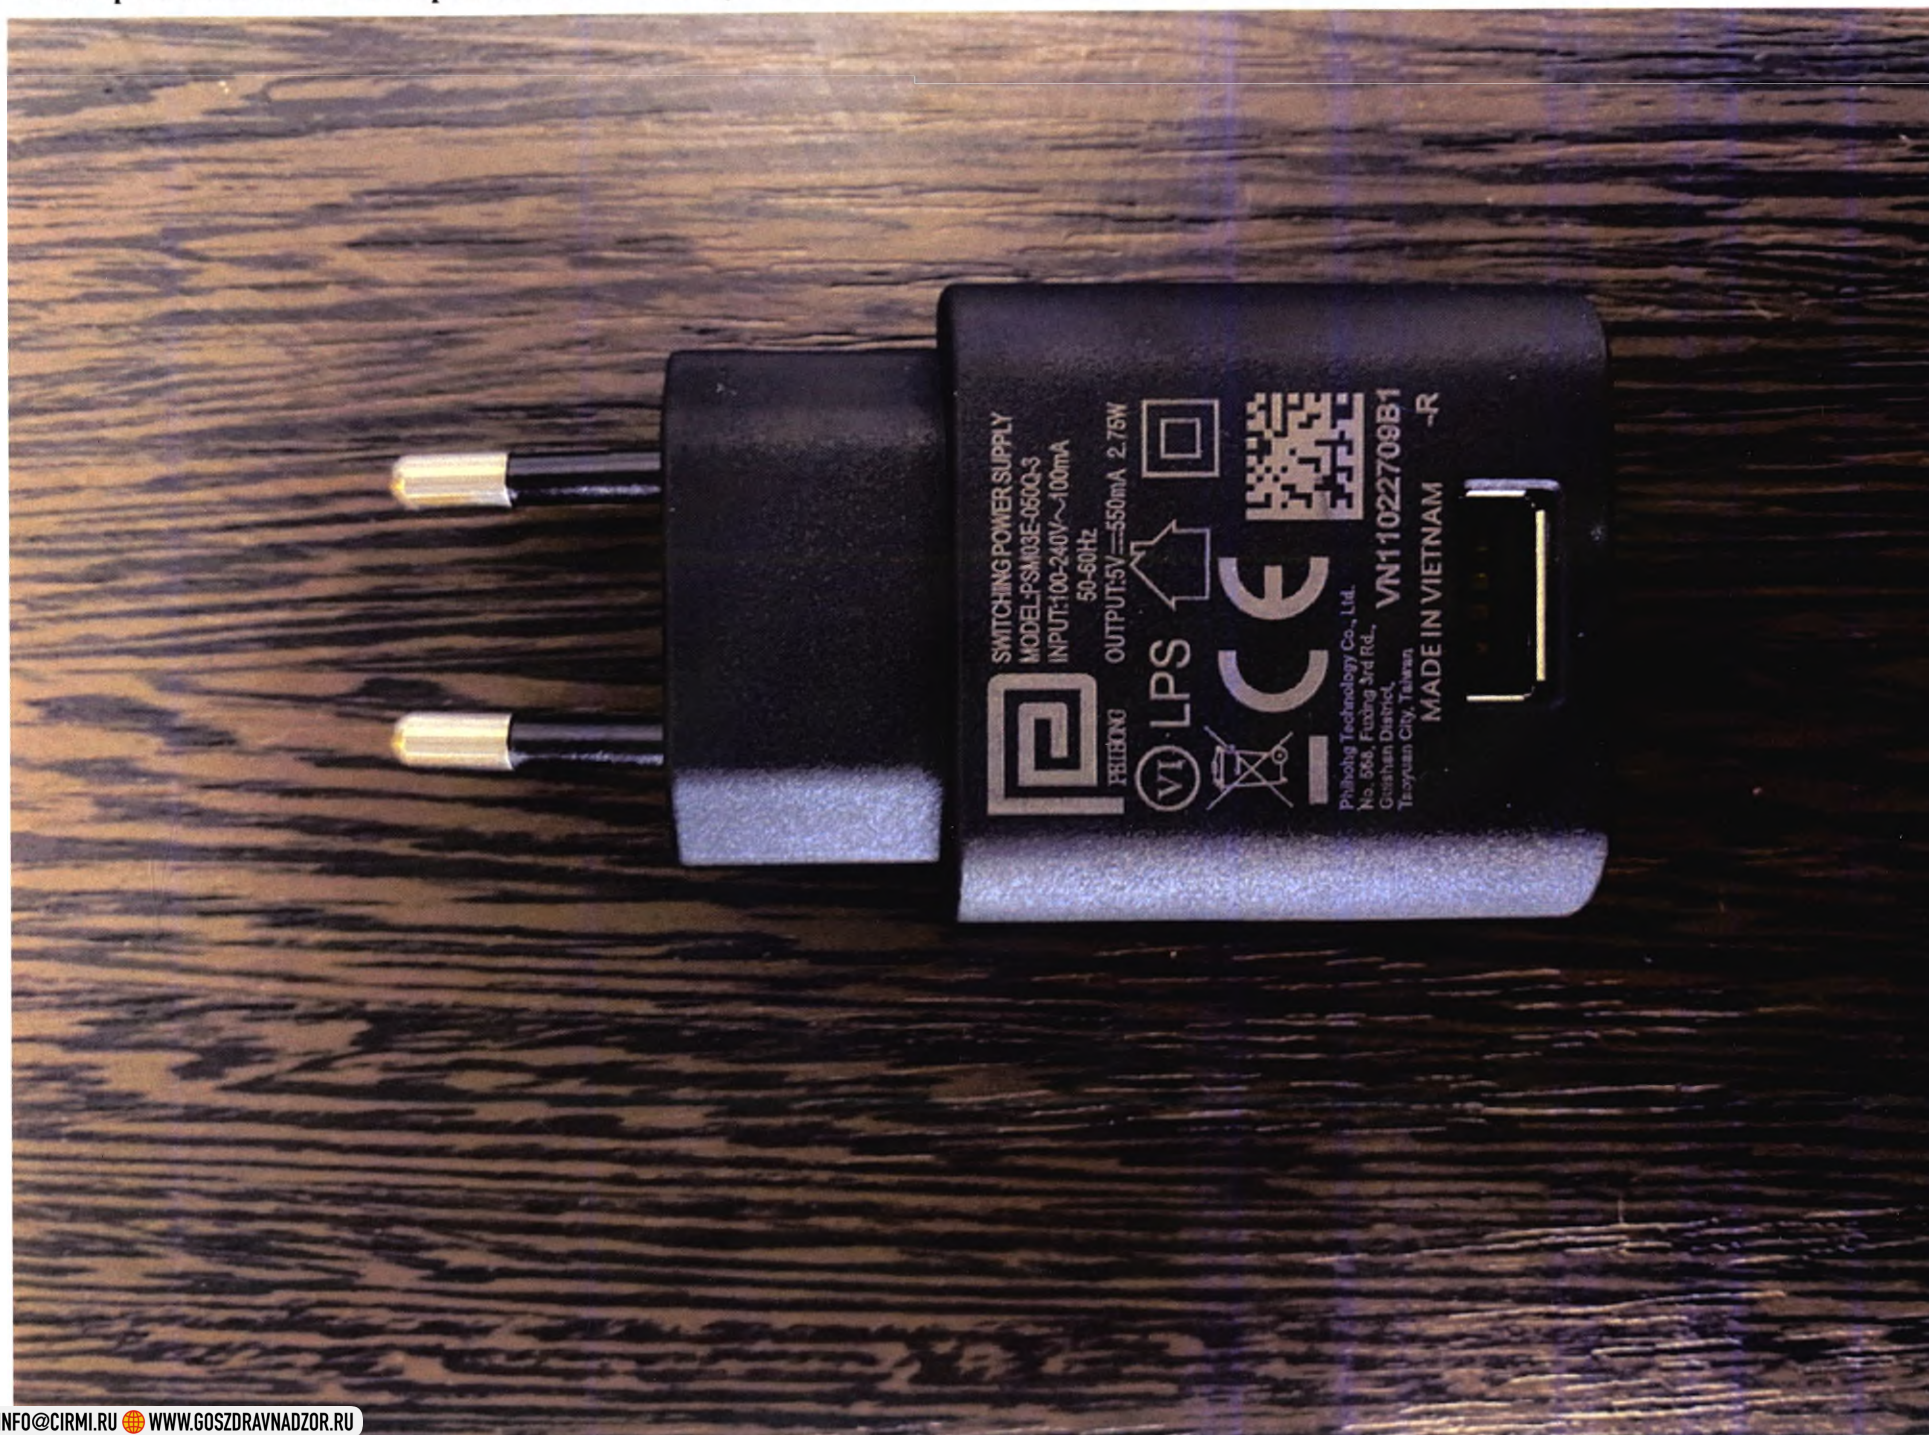



FreeStyle *Libre* 2

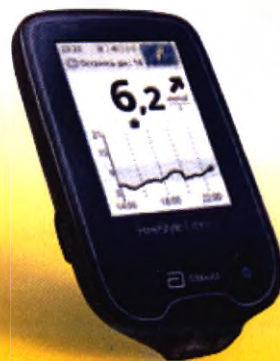

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Инструкция по применению
медицинского изделия

Сканер системы
Flash мониторинга глюкозы
FreeStyle Libre 2





FreeStyle *Libre* 2

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

**Краткое руководство
по эксплуатации**



Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2

Этот вкладыш с данными о производительности содержит данные о производительности датчика FreeStyle Libre 2 при использовании со сканером системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 в виде системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: проконсультируйтесь с медицинскими работниками о том, как использовать информацию этого раздела.

Рабочие характеристики

Рабочие характеристики датчика были оценены в контролируемом клиническом исследовании. Это исследование было проведено в 5 центрах, и в анализ эффективности были включены в общей сложности 146 больных диабетом. Каждый участник исследования носил до двух датчиков на задней поверхности плеча в течение до 14 дней. Во время исследования у участников анализировали уровень глюкозы в венозной крови в течение трех отдельных посещений клинического центра с использованием анализатора Yellow Springs Instrument Life Sciences 2300 STAT Plus™. В исследовании были испытаны три партии датчиков.




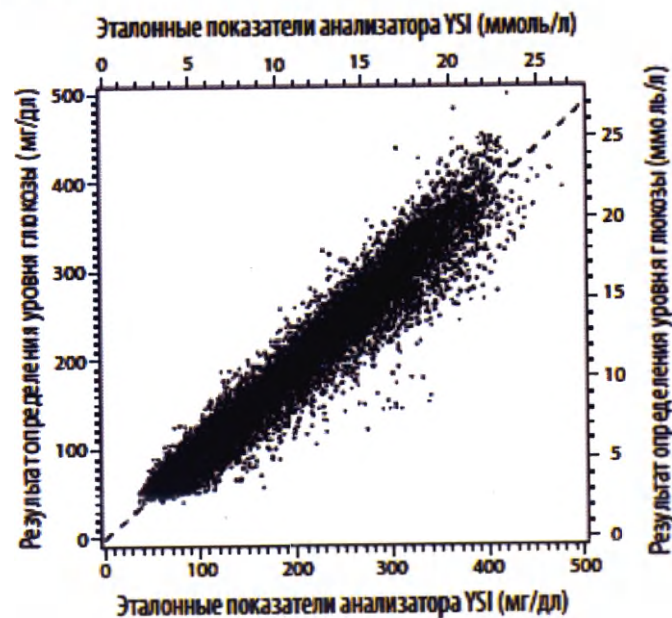


Рис. 1. Сравнение показаний датчиков с эталонными показателями анализатора YSI.

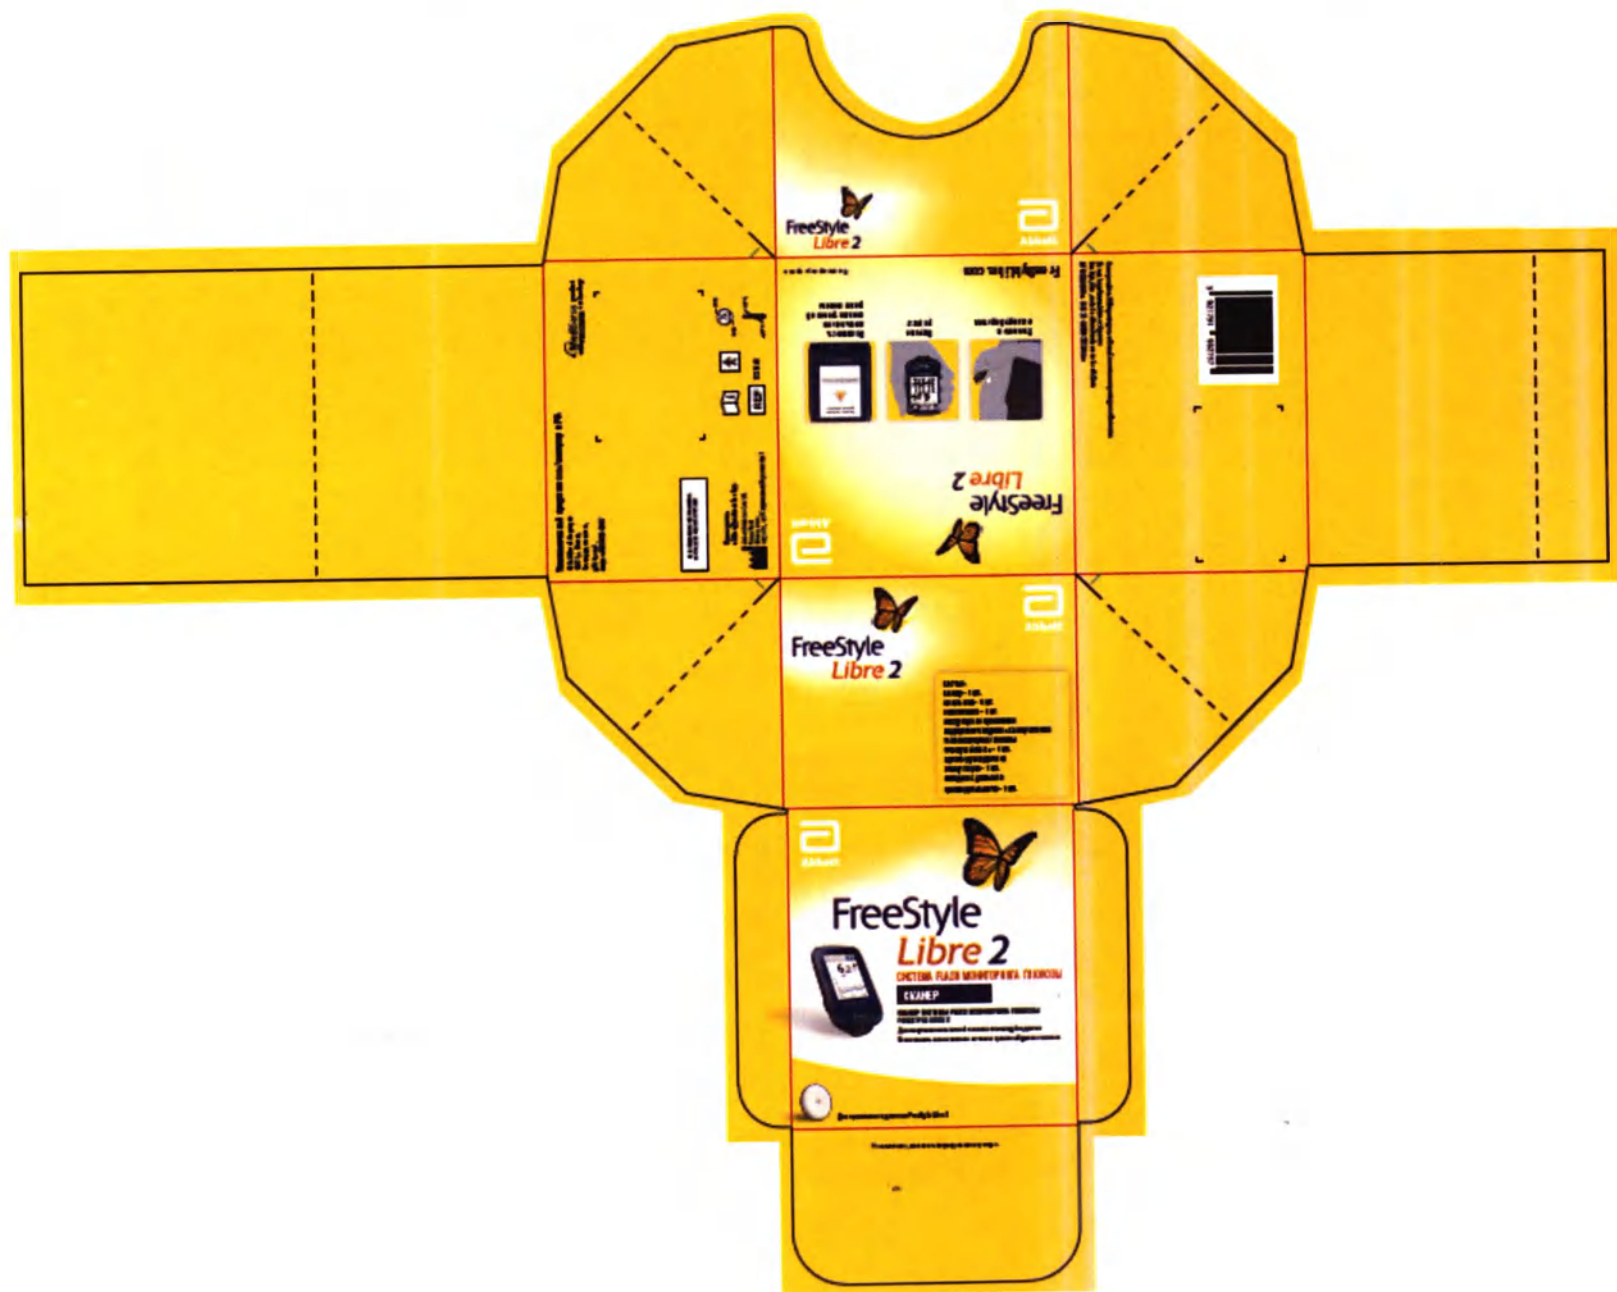

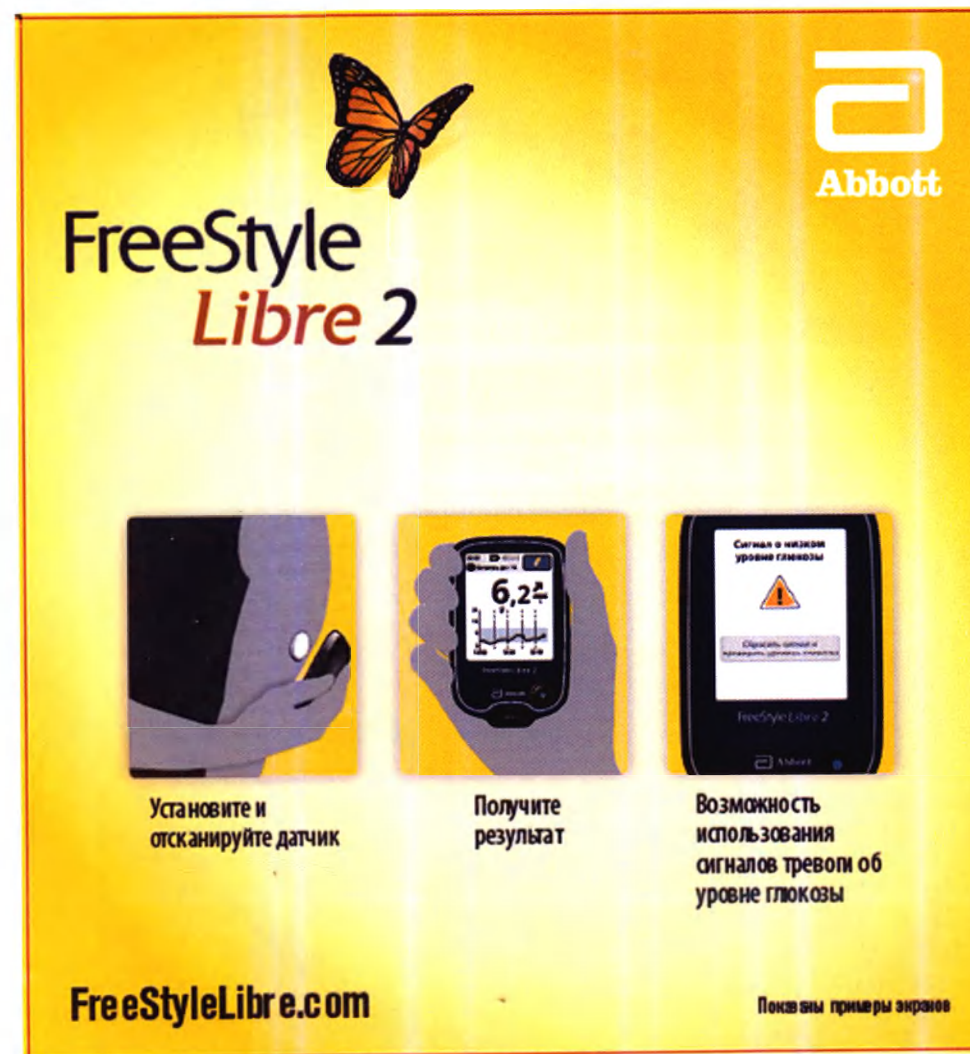

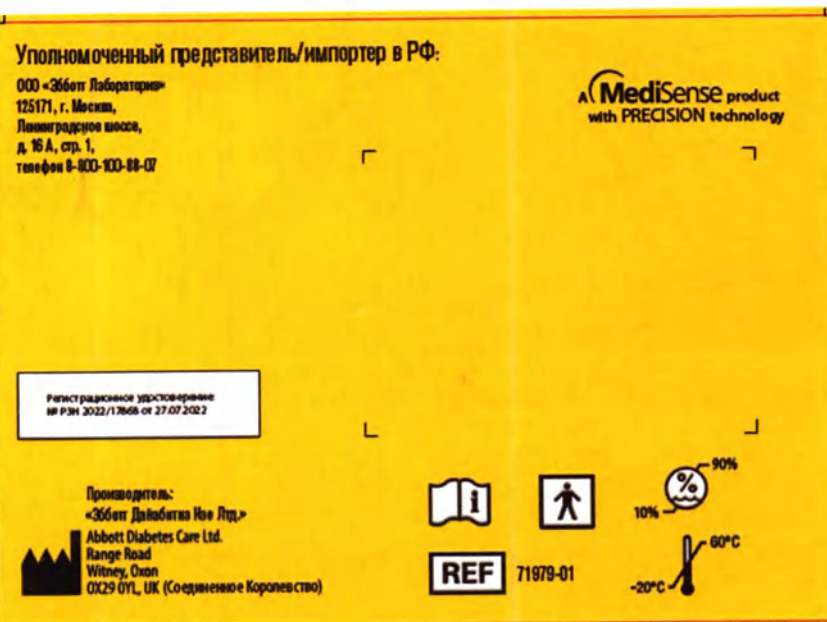

Сканер и кабель USB произведены в Китае. Блок питания произведен во Вьетнаме.
Патент: <https://www.abbott.com/patents>
FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.
ART41110-116 Rev. B 10/23 ©2010-2023 Abbott



FreeStyle
Libre 2



СОСТАВ:
Сканер – 1 шт.
Кабель USB – 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
Инструкция по применению
медицинского изделия «Сканер системы
Flash мониторинга глюкозы
FreeStyle Libre 2» – 1 шт.
Краткое руководство по
эксплуатации – 1 шт.
Вкладыш с данными о
производительности – 1 шт.



FreeStyle
Libre 2

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

СКАНЕР



СКАНЕР СИСТЕМЫ FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ
FREESTYLE LIBRE 2

Для получения показателя глюкозы отсканируйте датчик
Возможность использования сигналов тревоги об уровне глюкозы



Для применения с датчиком FreeStyle Libre 2

Не использовать, если опломбирование нарушено или отсутствует.

NDC	AREA 1
REF	AREA 2
SN	AREA 3
LOT	AREA 4
	AREA 5

ART09103 Rev. A 12/05

Макет маркировки на задней стороне Сканера FreeStyle Libre 2, предназначенной для российского рынка



Принято и произведено
12 (двенадцать) листов
Руководитель подразделения
средств диагностики здоровья
ООО «Эбботт Лэбораториз»

Темасева А. А.

