

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко



«30» августа 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (ЦЦП) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «АЦЦП-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-022-35531509-2022

...циклического
...ментного а

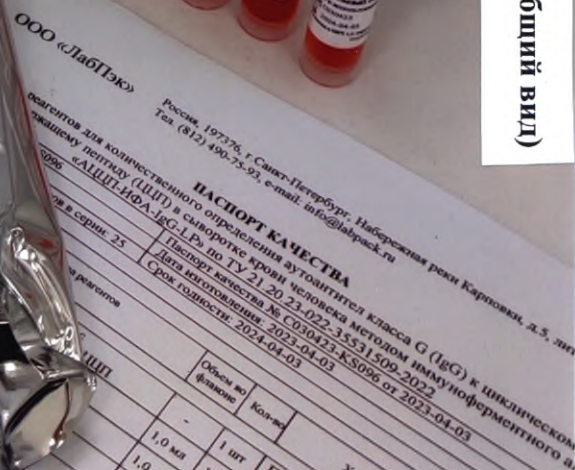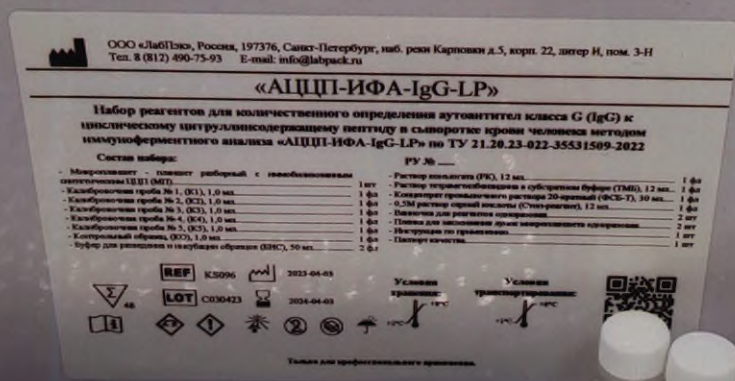

гентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к циклическому
пер...
000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ...ека методом иммуноферментного
анализа «АЦДП-ИФА-IgG-LP»
по ТУ 21.20.23-072 35531500 2022



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, корп. 22, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«АЦЦП-ИФА-IgG-LP»

Набор реагентов для количественного определения аутоантител класса G (IgG) к циклическому цитруллинсодержащему пептиду в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа «АЦЦП-ИФА-IgG-LP» по ТУ 21.20.23-022-35531509-2022

Состав набора:

- Микроплашкет - планшет разборный с иммобилизованным свететическим ЦЦП (МЦП)	1 шт
- Калибровочная проба № 1, (К1), 1,0 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 2, (К2), 1,0 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 3, (К3), 1,0 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 4, (К4), 1,0 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 5, (К5), 1,0 мл	1 фла
- Контрольный образец (КО), 1,0 мл	1 фла
- Буфер для разведения и инкубации образцов (ЕИС), 50 мл	2 фла

РУ № _____


- Раствор конъюгата (РК), 12 мл	1 фла
- Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере (ТМБ), 12 мл	1 фла
- Концентрат промывочного раствора 20-кратный (ФСБ-Т), 30 мл	1 фла
- 0.5M раствор серной кислоты (Стоп-реагент), 12 мл	1 фла
- Вязочки для реагентов одноразовые	2 шт
- Пилеза для записывания лунок микроплашкета одноразовая	2 шт
- Инструкция по применению	1 шт
- Паспорт качества	1 шт



Условия хранения:




Условия транспортирования:





Только для профессионального применения.





1. Микропланшет - планшет разборный с иммобилизованным синтетическим ЦЦП

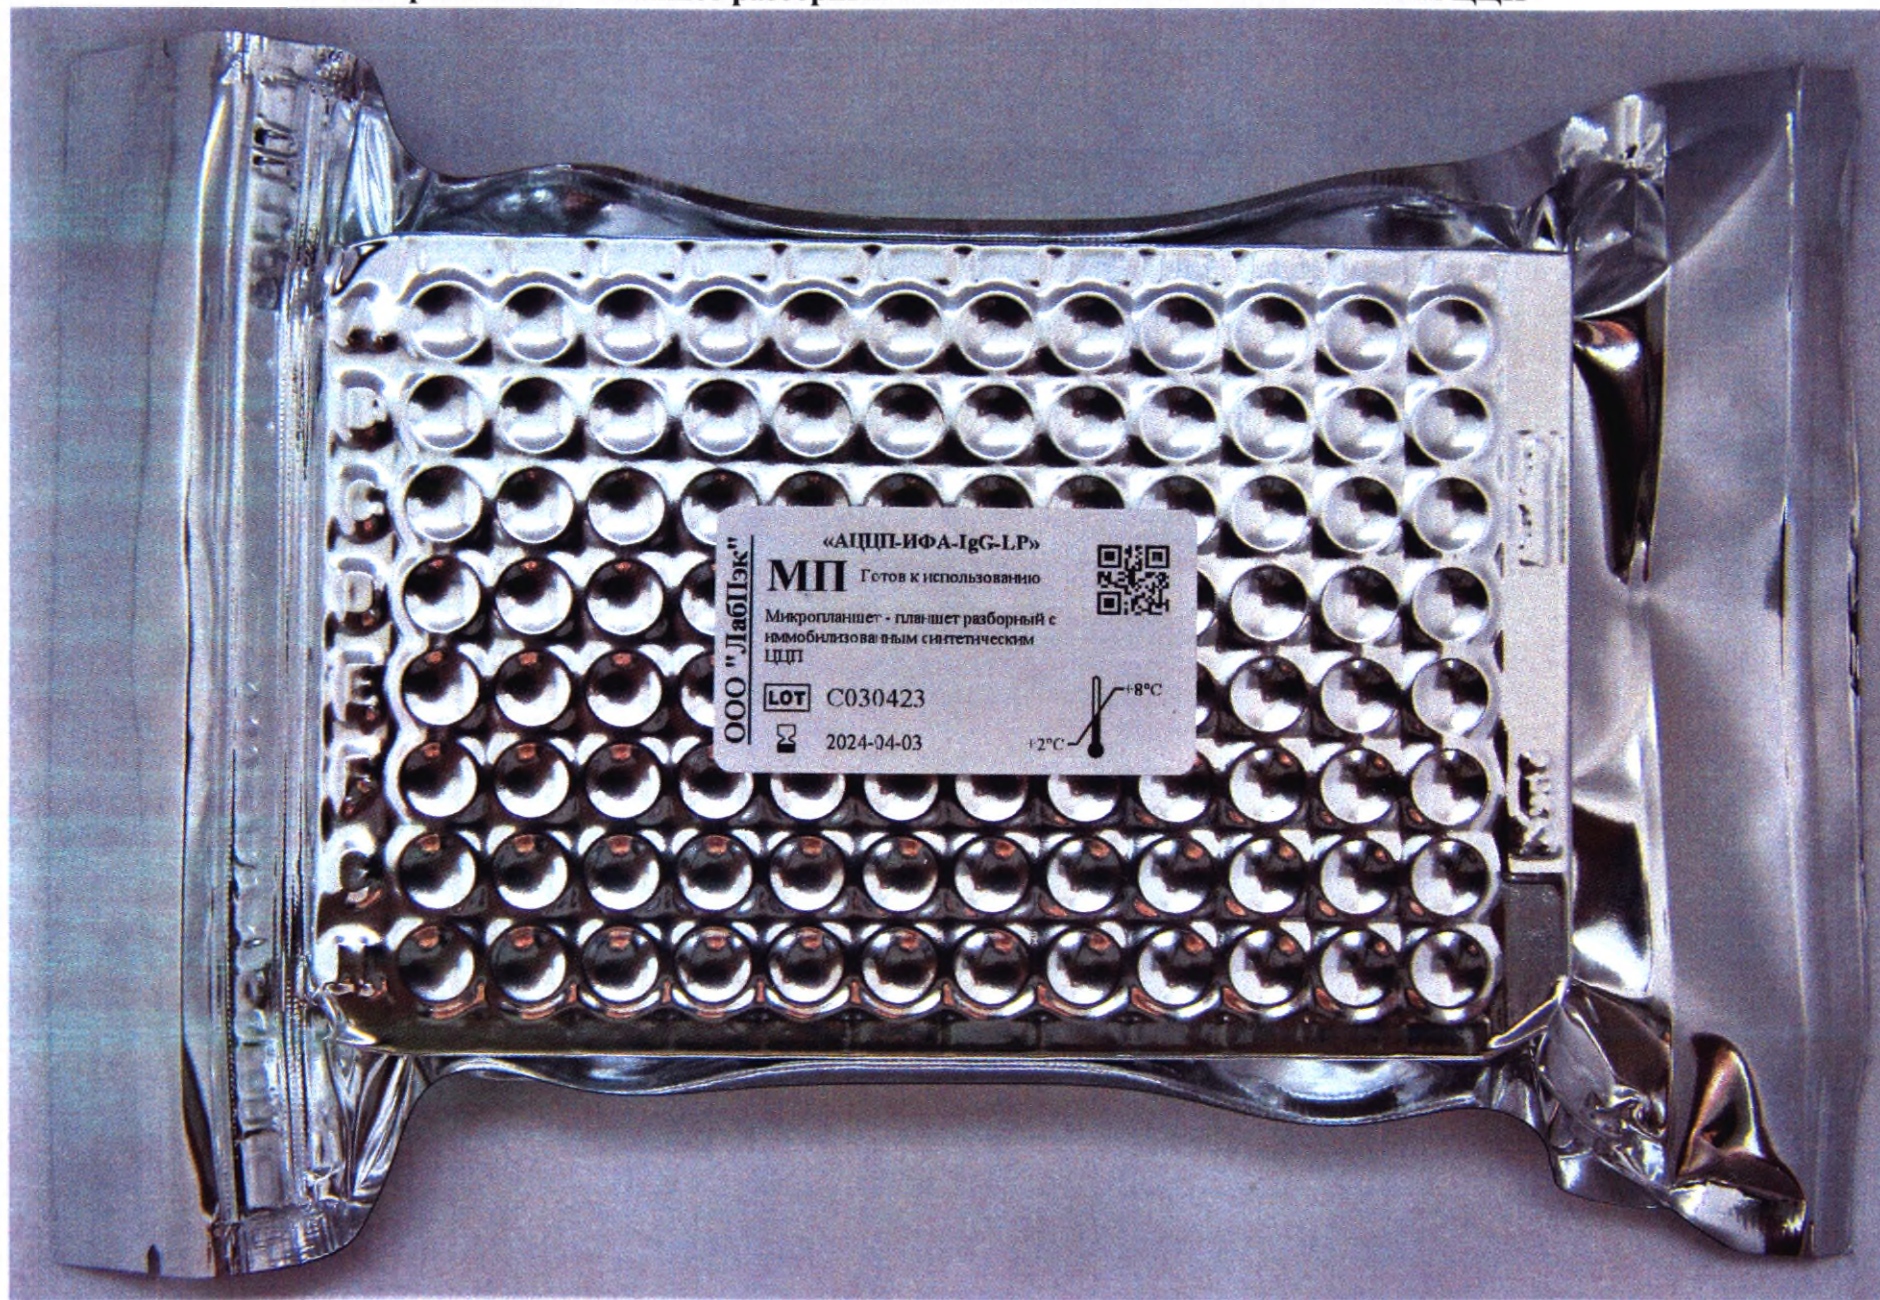


2. Калибровочная проба № 1

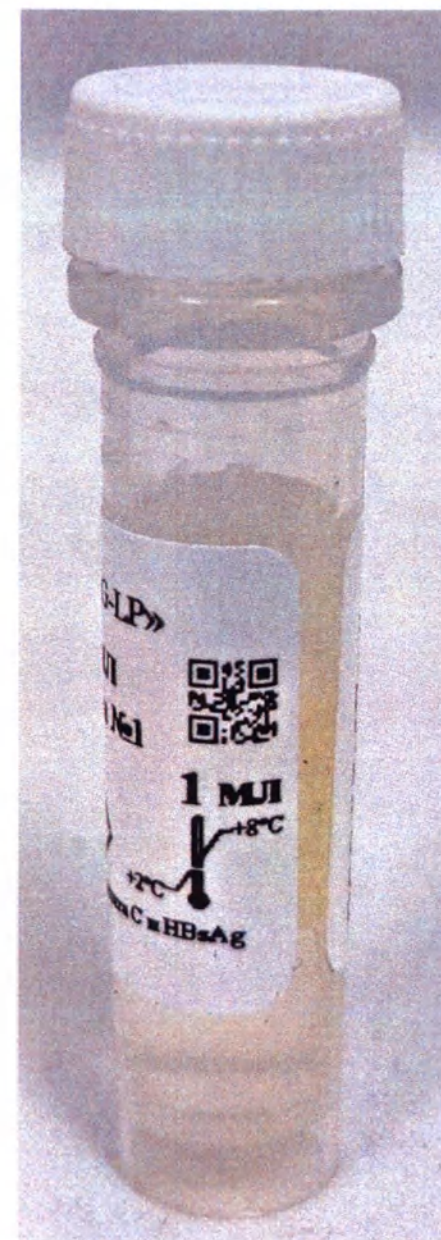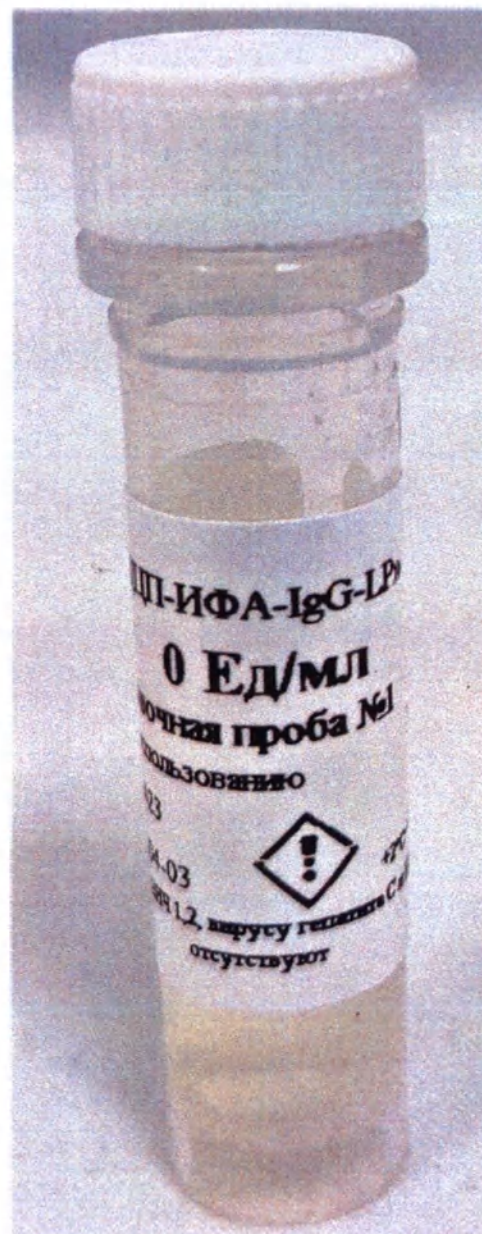



3. Калибровочная проба № 2

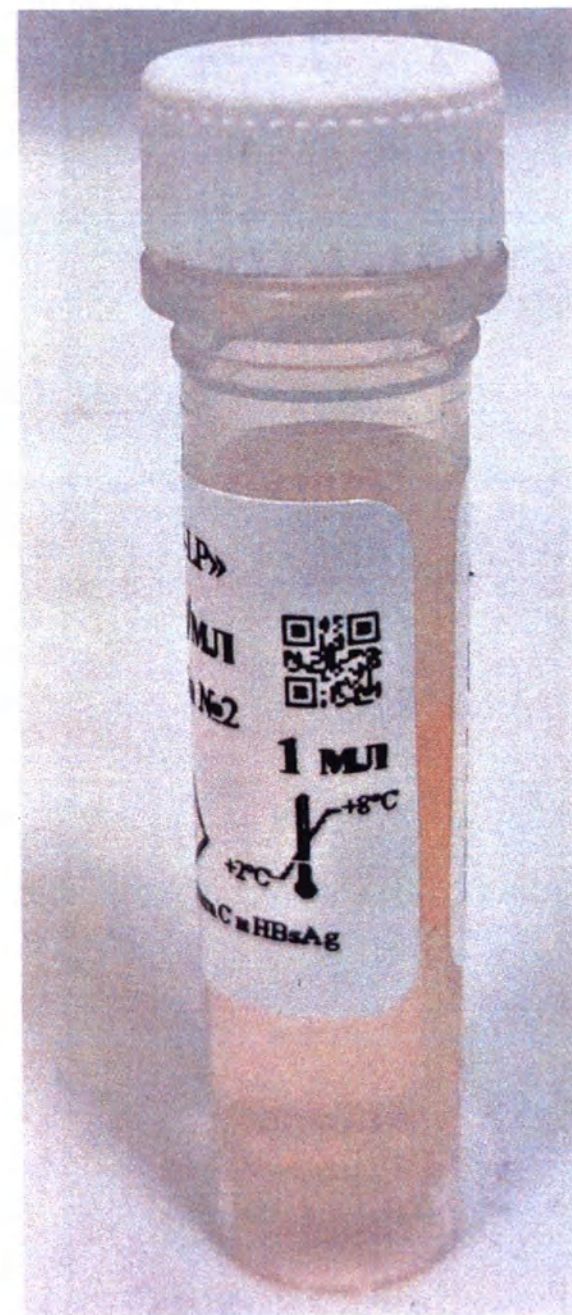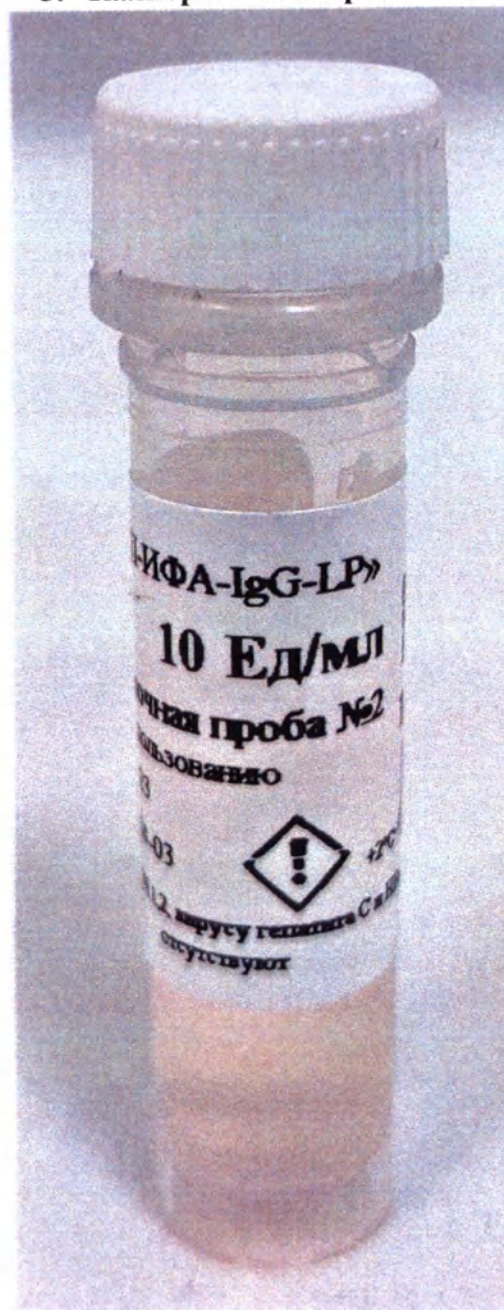


4. Калибровочная проба № 3

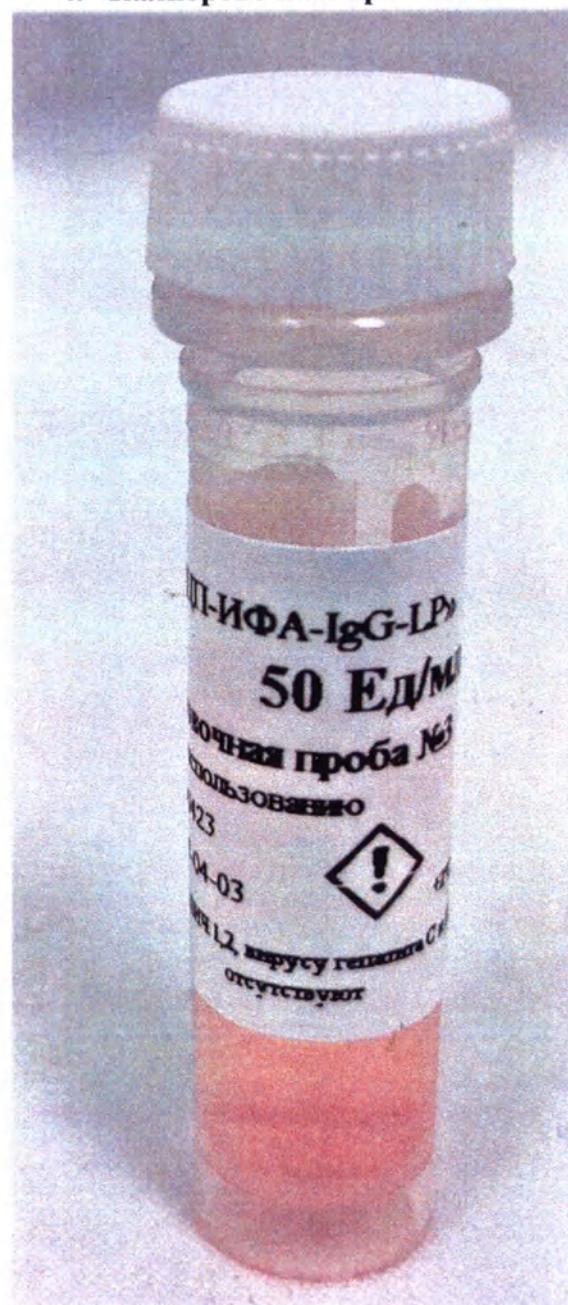

5. Калибровочная проба №4

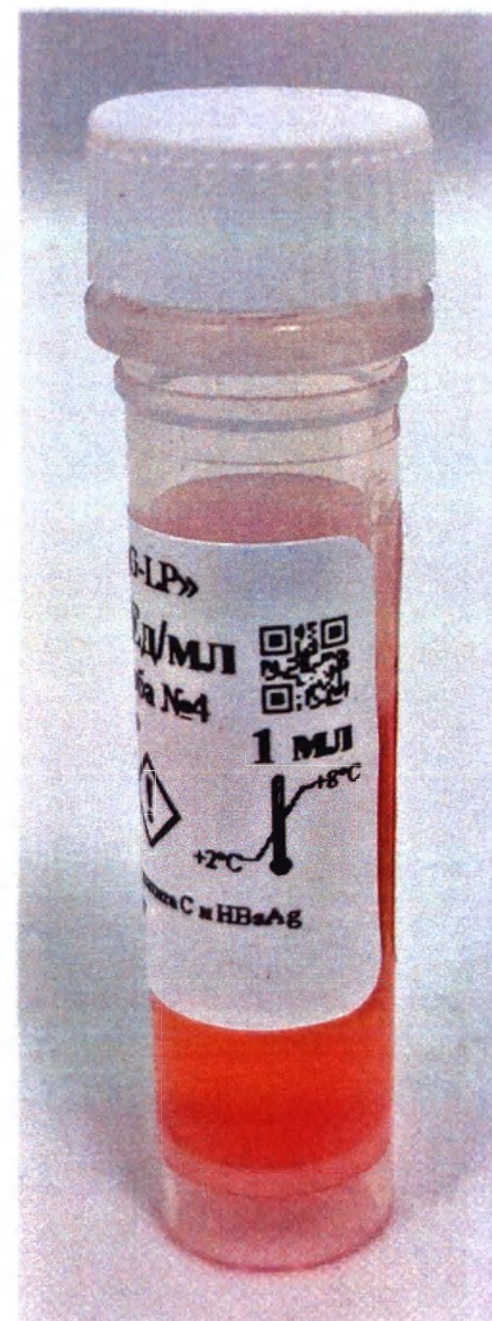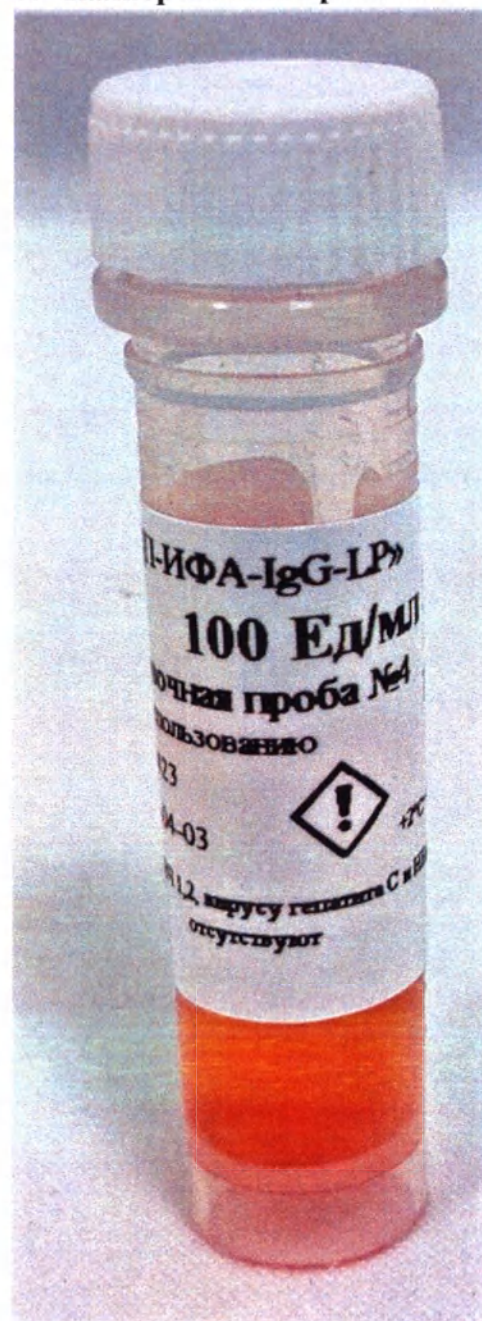

6. Калибровочная проба № 5

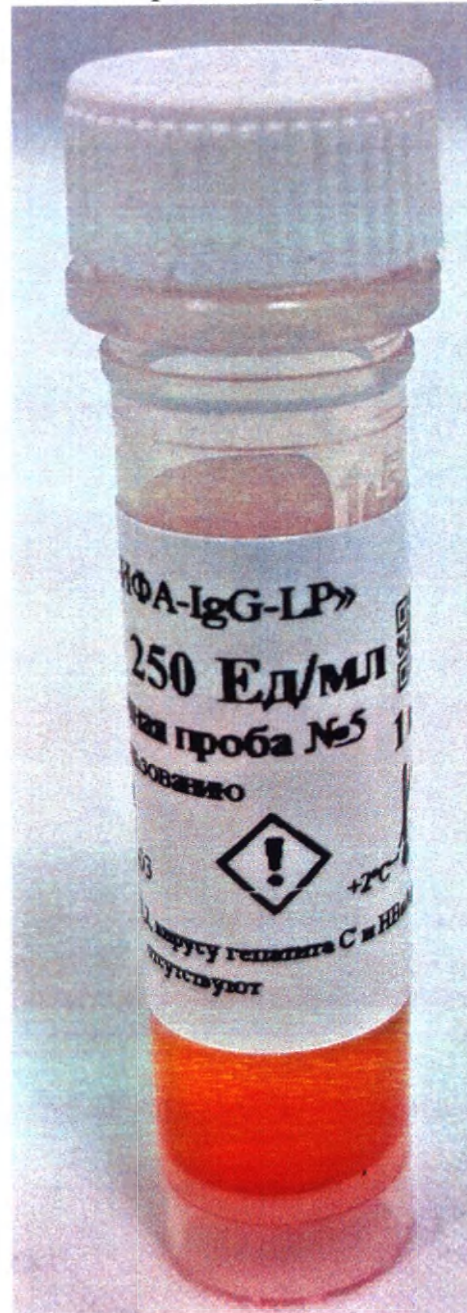

7. Контрольный образец



8. Буфер для разведения и инкубации образцов




9. Раствор конъюгата



10. Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере



11. Концентрат промывочного раствора 20-кратный

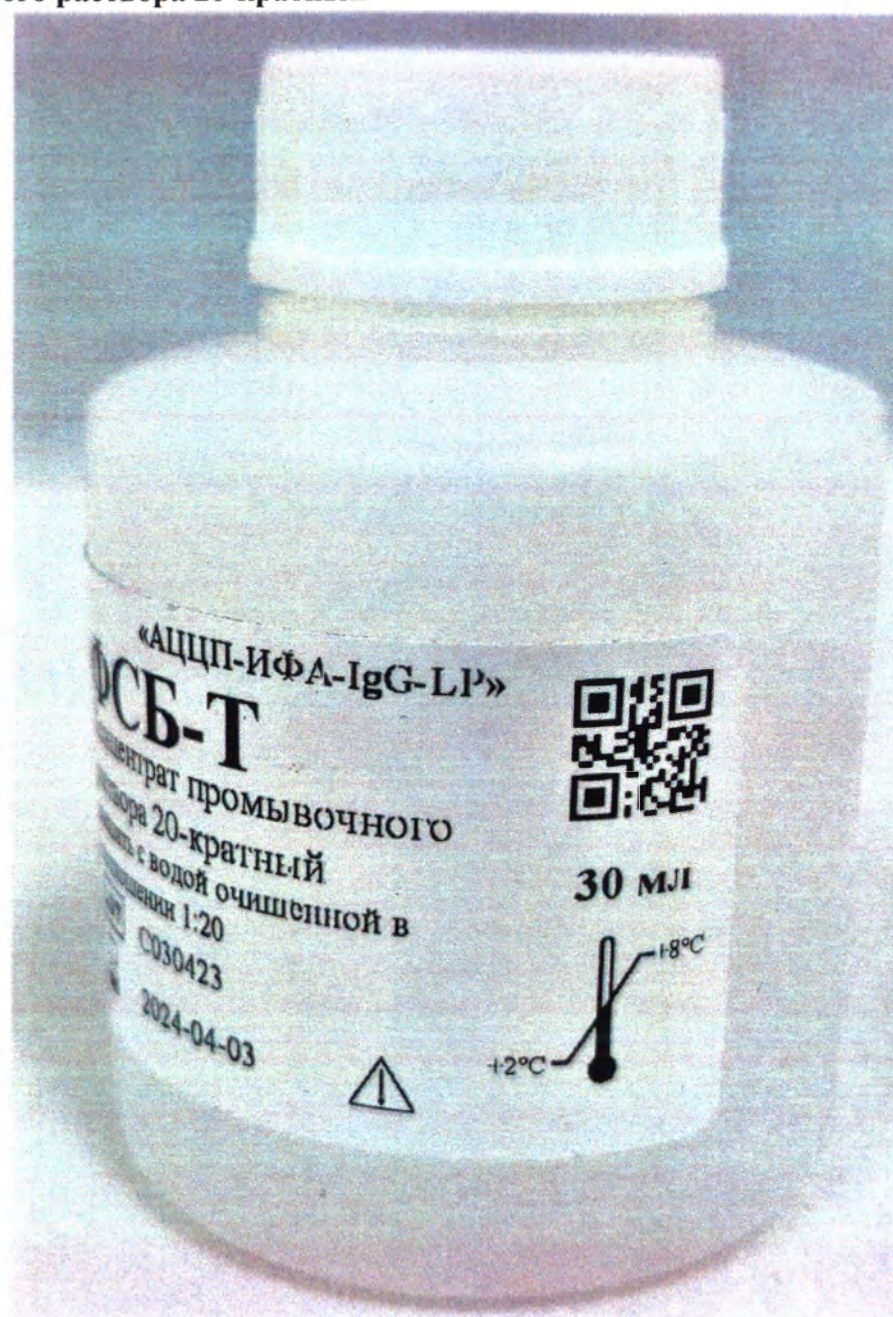

12. 0,5 М раствор серной кислоты



13. Ванночка для реагентов одноразовая, пленка для заклеивания лунок микропланшета одноразовая

