



ПОДТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по регистрации


ООО «Джонсон & Джонсон»

Кривенкова К.В.

2018 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная, варианты
исполнения: ZCB00V, AAB00**

2018

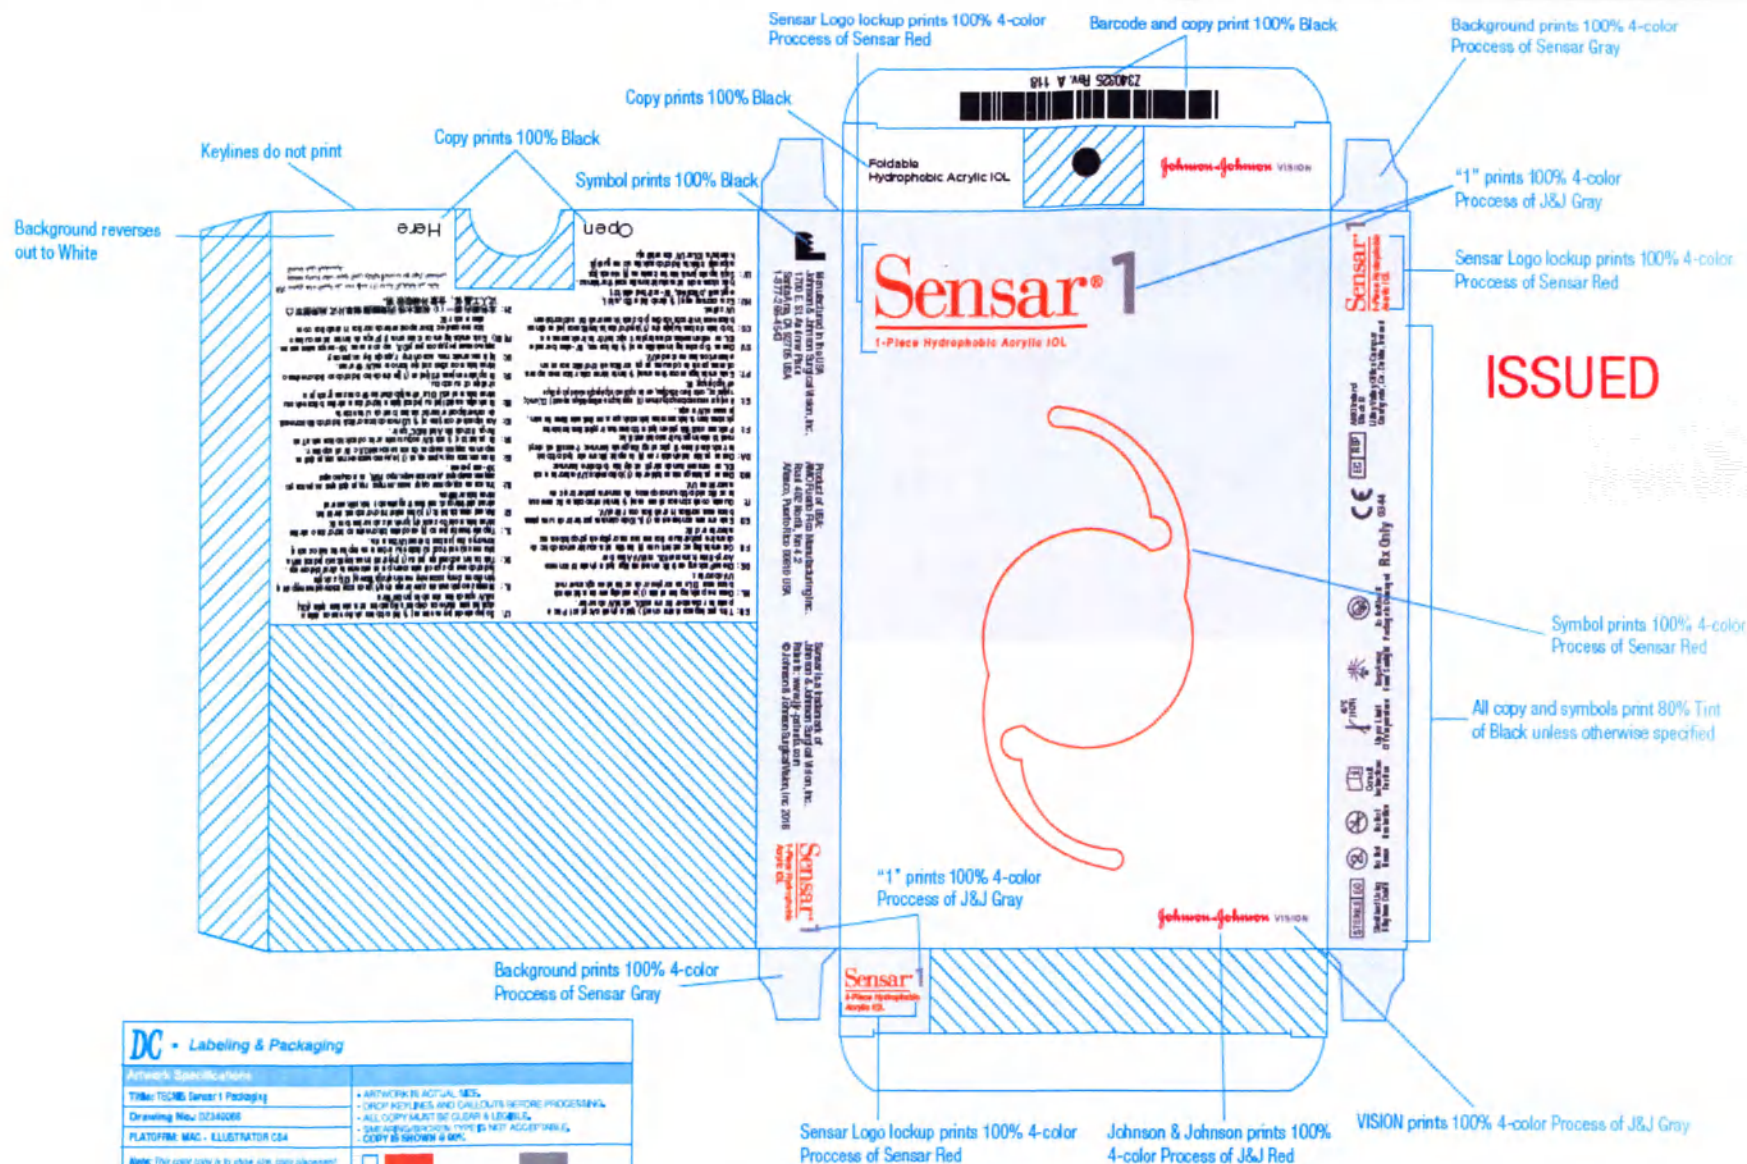

DC • Labeling & Packaging	
Artwork Specifications	
Title: TECHNID Sensar 1 Packaging	• ARTWORK IS ACTUAL SIZE
Drawing File: 02340008	• CROP WITH BLENDS AND CALCULATIONS BEFORE PROCESSING
Platform: MAC • ILLUSTRATOR CS4	• ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE
	• DIMENSIONS/SPACING/POPIES MUST ACCEPTANCE
	• COPY IS SHOWN AT 80%
Note: The color copy is to show size, copy placement and color limits. Actual colors will be matched on press to approved color standards and/or PMS color matches.	
	J&J Red C.O. M:100 Y:100 K:0 J&J Gray C.O. M:0 Y:0 K:100 Sensar Red C.O. M:80 Y:100 K:0 Black C.O. M:0 Y:0 K:100

AAB00**+20.0D****Sensar™**
1-Piece IOL


Johnson & Johnson VISION

2022-05-11

SN 123456 8888**AAB00****REF** AAB0000200**Sensar™**
1-Piece IOL

DIOPTER: +20.0D
SUGGESTED "A" CONSTANT: 118.4*
OVERALL DIAMETER ($\varnothing_T$): 13 mm
OPTIC DIAMETER ($\varnothing_B$): 6 mm
USE BY (YYYY-MM-DD): 2022-05-11
SERIAL NUMBER (SN): 123456 8888
MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): 2018-05-11

One piece aspheric posterior chamber biconvex IOL. Acrylic with UV absorber.
* "A" CONSTANT: Theoretically Derived.

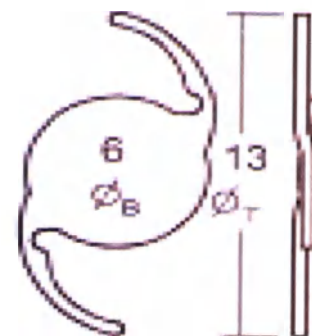**Product of USA.**

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, CA 92705 USA


Production site:
AMD Puerto Rico Manufacturing Inc.,
Anasco, PR 00610

CE
0344

(01) 02345678912345(17) 220511(11) 180511(21) 1234568888

Z352921 Rev. 01 518



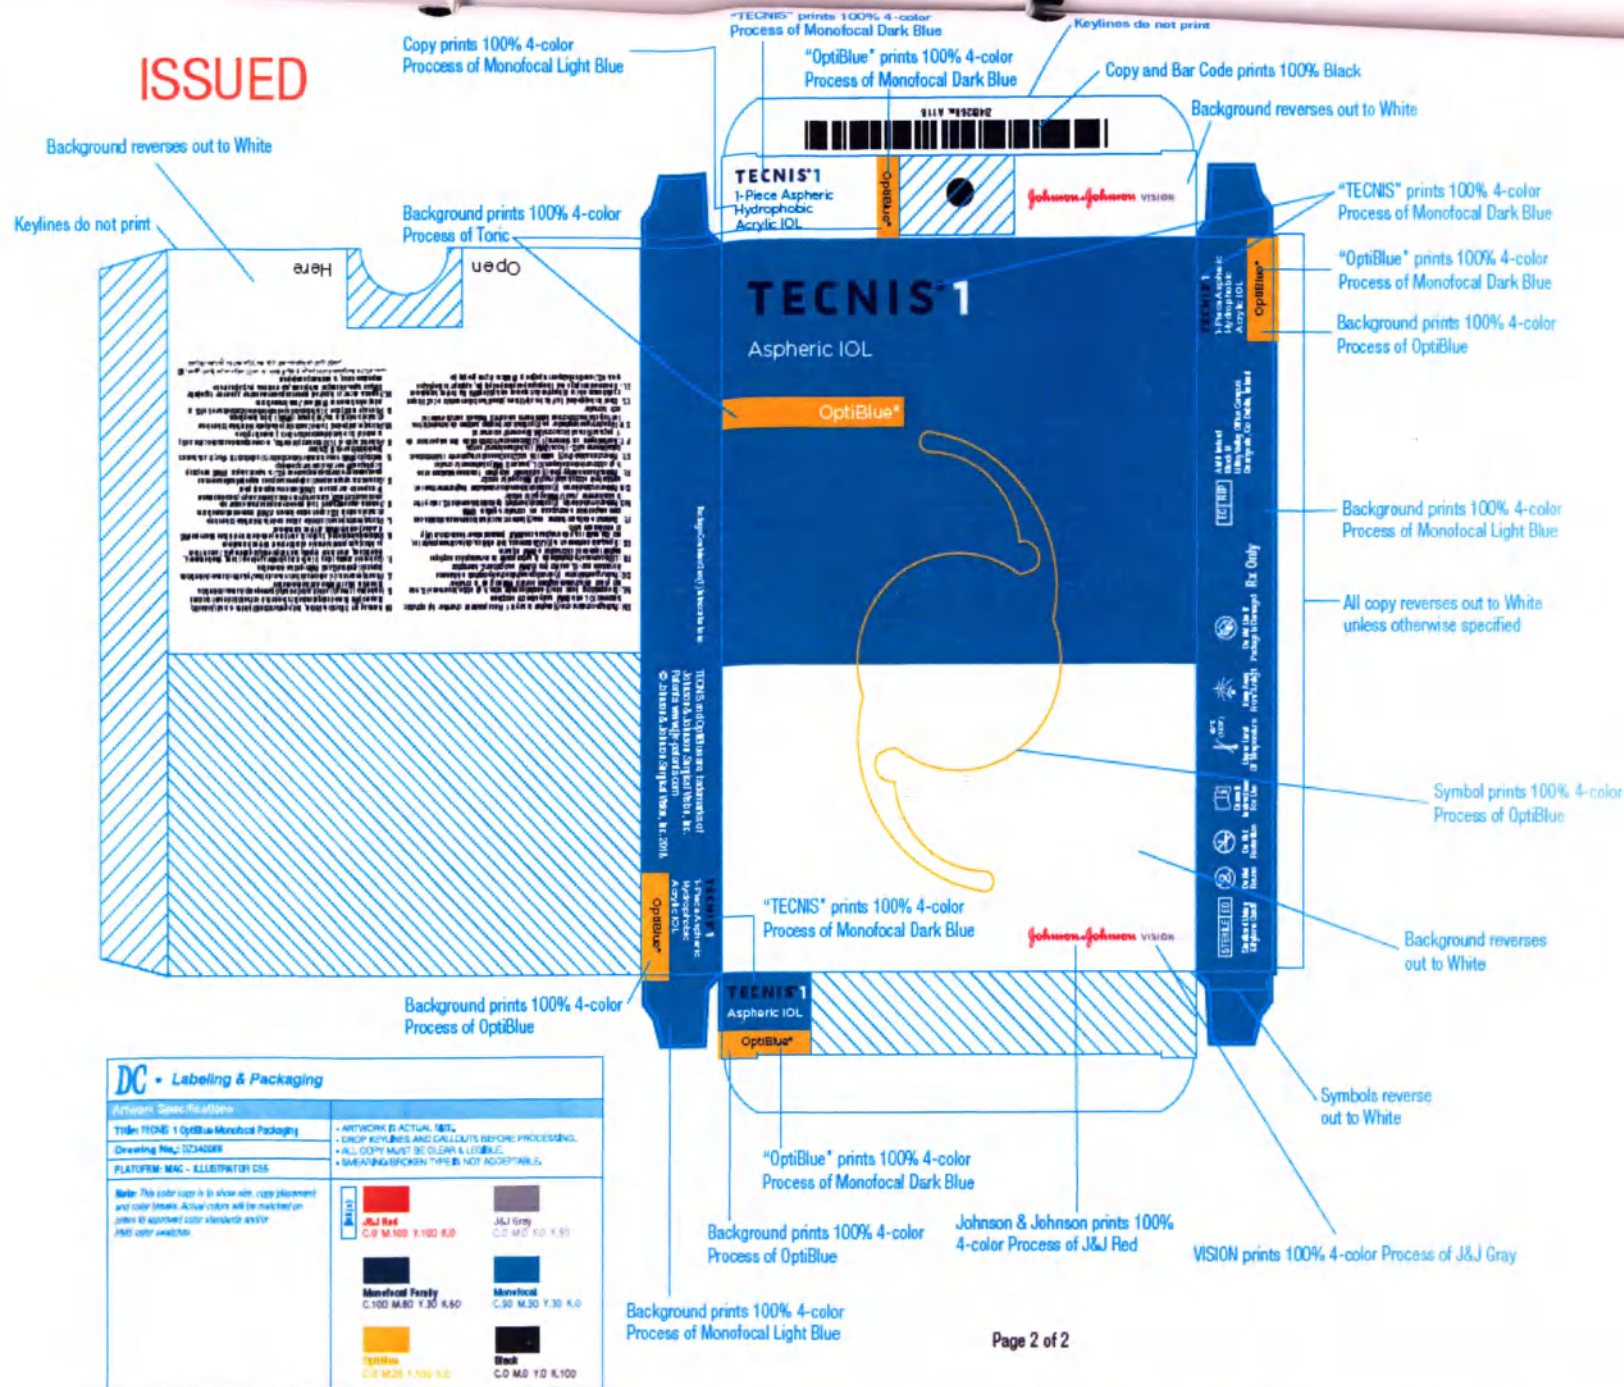

DC • Labeling & Packaging	
Johnson & Johnson Vision	
TECNIS 1 OptiBlue Monofocal Packaging	
Drawing No. 1024000	
PLATFORM: MAC - ILLUSTRATION DMS	
Note: This color spec is to show size, copy placement and color trends. Actual colors will be matched on print to approved color standards and/or PMS color swatches.	
RED J&J Red C:0 M:100 Y:100 K:0	GRAY J&J Gray C:0 M:100 Y:100 K:0
Monofocal Purple C:100 M:80 Y:30 K:50	Monofocal C:90 M:30 Y:30 K:50
OptiBlue C:0 M:20 Y:100 K:0	Black C:0 M:0 Y:0 K:100

ZCB00V
+5.0D

TECNIS®
OptiBlue®
1-Piece IOL

Johnson & Johnson VISION
2023-05-11
SN 123456 8888



ZCB00V

REF ZCB00V0050

TECNIS®
OptiBlue®
1-Piece IOL

DIOPTER: **+5.0D**
SUGGESTED "A" CONSTANT: **118.8***
OVERALL DIAMETER ($\varnothing_T$): **13 mm**
OPTIC DIAMETER ($\varnothing_B$): **6 mm**
USE BY (YYYY-MM-DD): **2023-05-11**
SERIAL NUMBER (SN): **1234568888**
MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): **2018-05-11**

One piece aspheric posterior chamber biconvex IOL:
Acrylic with UVAM and yellow Chromophore

* "A" CONSTANT: Theoretically Derived

Product of USA



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place,
Santa Ana, CA 92705 USA

Production site:
AMD Puerto Rico Manufacturing Inc.,
Anasco, PR 00610



CE
0344



(01) 02345678912345(17) 230511(11) 180511(21)1234568888

Z352923 Rev. 01 518



Линза интраокулярная акриловая однокомпонентная, варианты исполнения: AAB00

Номер и дата РУ: [Number / Date RC]

Назначение: Линза предназначена для визуальной коррекции зрения при афакии у взрослых пациентов, у которых пораженный катарактой хрусталик удален посредством экстракапсулярной экстракции катаракты. Это устройство помещается в капсулярный мешок.



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Джонсон & Джонсон» Сердечкал Вижн, Инк.), 1700 East St. Andrew Pl., Santa Ana, California 92705-4933, United States (США)

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Место производства:

[Malaysia] Малайзия или [Puerto Rico (US)] Пуэрто-Рико (США)

Production Site:



Diopter

Диоптрия:

Suggested "A" constant:

Поправочный коэффициент («А»-константа):

Overall diameter ($\varnothing_T$):

Общий диаметр ($\varnothing_T$):

Optic diameter ($\varnothing_B$):

Оптический диаметр ($\varnothing_B$):

Use by  (YYYY-MM-DD):

Срок годности  (TTT-MM-DD):

Serial number (SN):

Серийный номер (bIT):

Manufactured on  (YYYY-MM-DD)

Дата производства  (TTT-MM-DD):

ИОЛ однокомпонентная двояковыпуклая имплантируемая в заднюю камеру:

Акрил с ковалентно связанным поглотителем УФ излучения

* А-константа: теоретически выведенная.

STERILE EO

Стерилизовано
этиленоксидом



Повторное использование
запрещено



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкции по
применению



Верхний предел температуры



Не использовать, если
упаковка повреждена



Хранить вдали от солнечных
лучей

RxOnly

Для продажи только врачам

Акриленно
Нетоксично

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 8 листа(ов).

Должность *супервайзер по*

регистрации

ФИО *Кривенкова Е.В.*

Е.В. Кривенкова

(подпись)

М.П.

«З» сентября

20 18 года