


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

 Т.А. Носова

 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter), в вариантах
исполнения

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

(«Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай



Рис. 1 Внешний вид варианта исполнения PC-66B.



Рис. 2 Внешний вид варианта исполнения PC-66B. Разъемы подключения USB кабеля передачи данных, адаптера питания и датчика насыщения крови кислородом SpO₂



Рис. 3 Общий вид комплекта поставки варианта исполнения PC-66B. Блок основной PC-66B, Датчик насыщения крови кислородом SpO₂, модель KS-C01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd., Держатель, Адаптер питания, модель LXCP12-005120BEG, производства Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd, USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C, производства Weixunda Electronic Products Co., Ltd.

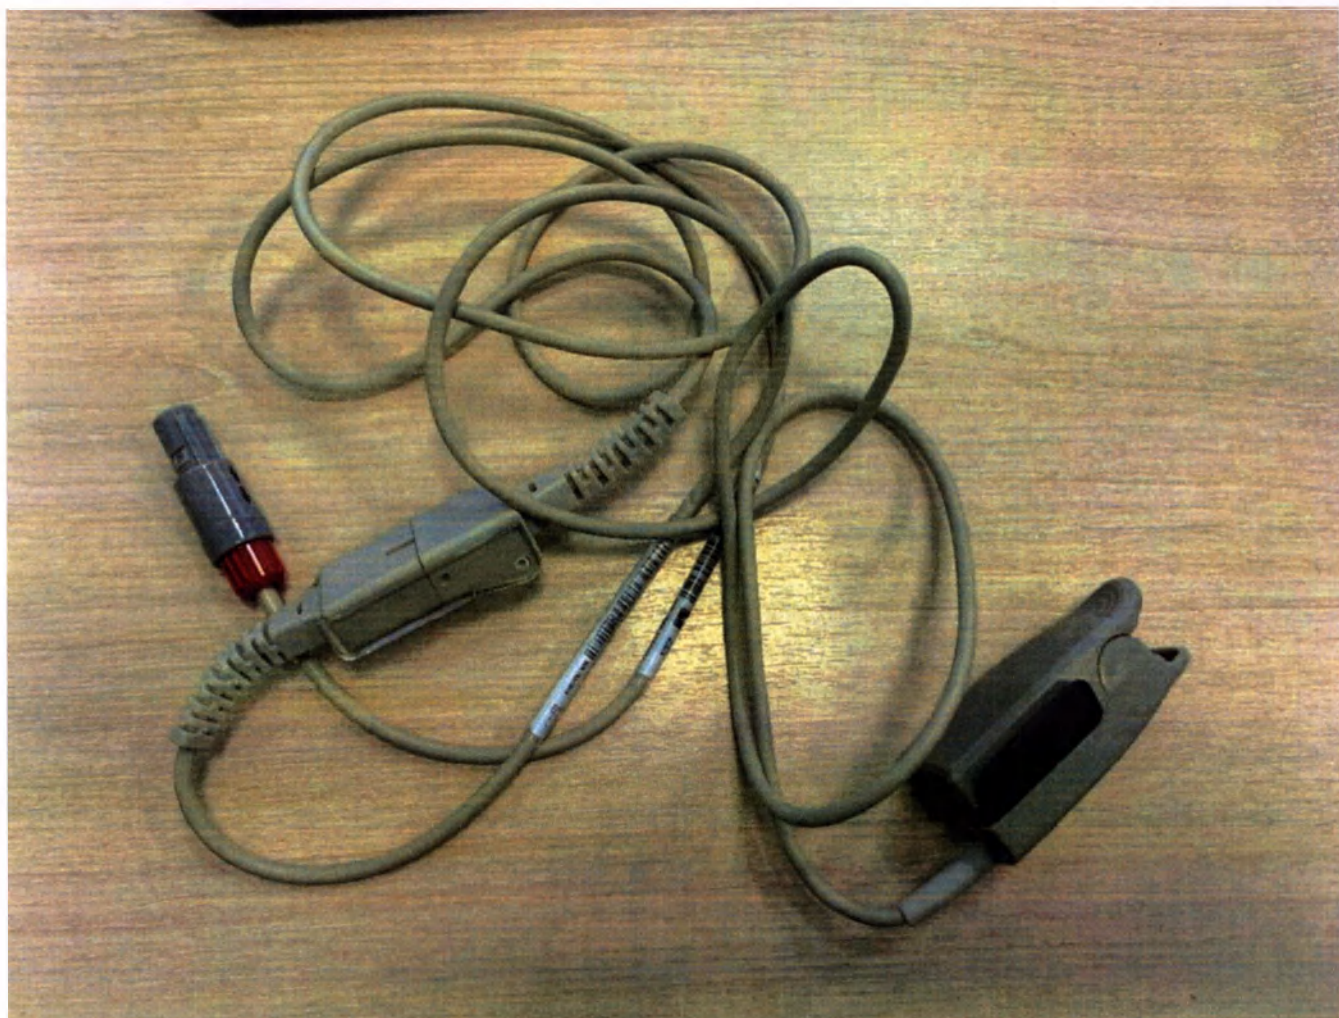


Рис. 4 Внешний вид варианта исполнения РС-66В. Датчик насыщения крови кислородом SpO_2 , модель KS-C01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd



Рис. 5 USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C, производства Weixunda Electronic Products Co., Ltd.



Рис. 6 Внешний вид варианта исполнения РС-66В. Адаптер питания, модель LXCP12-005120BEG, производства Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd.

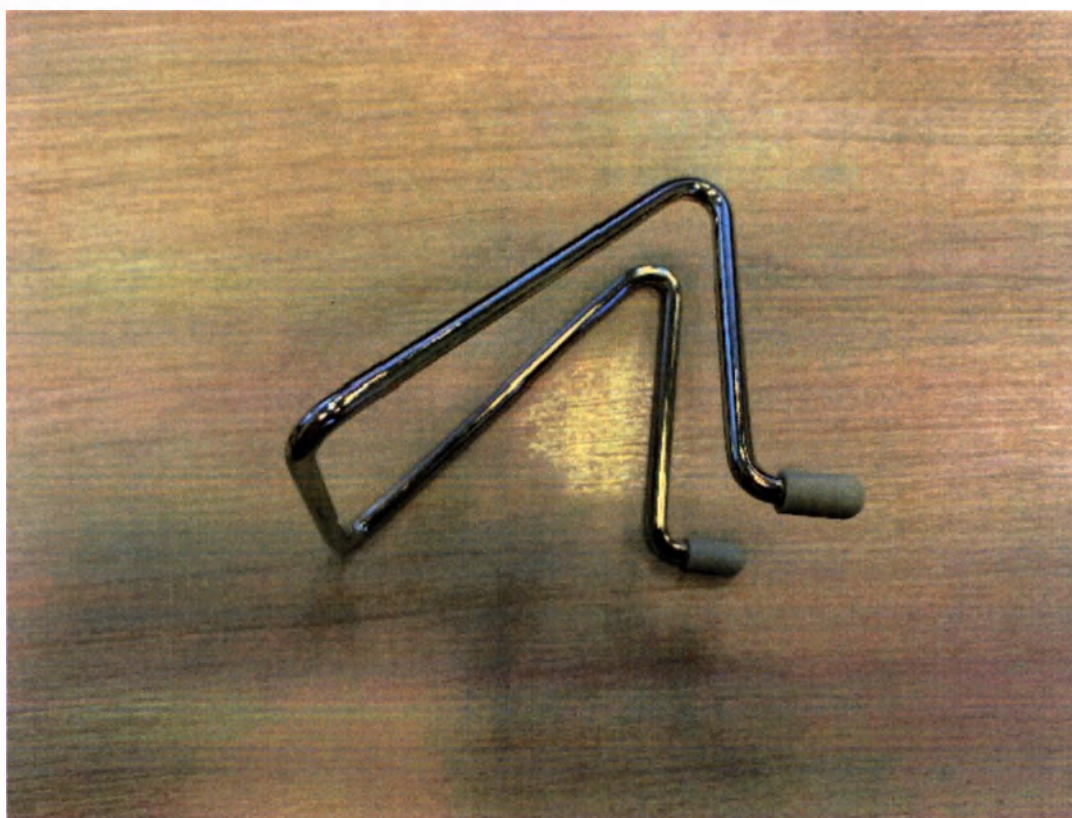


Рис. 7 Внешний вид варианта исполнения РС-66В. Держатель.



Рис. 8 Общий вид комплекта поставки варианта исполнения SP-20. Блок основной SP-20, Датчик насыщения крови кислородом SpO_2 , модель KS-AC01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd, Резиновый чехол для основного блока, Зарядная станция, модель SP-20, Адаптер питания, модель LXCP12-005120BEG, производства Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd., USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C, производства Weixunda Electronic Products Co., Ltd.



Рис. 9 Лицевая часть варианта исполнения SP-20

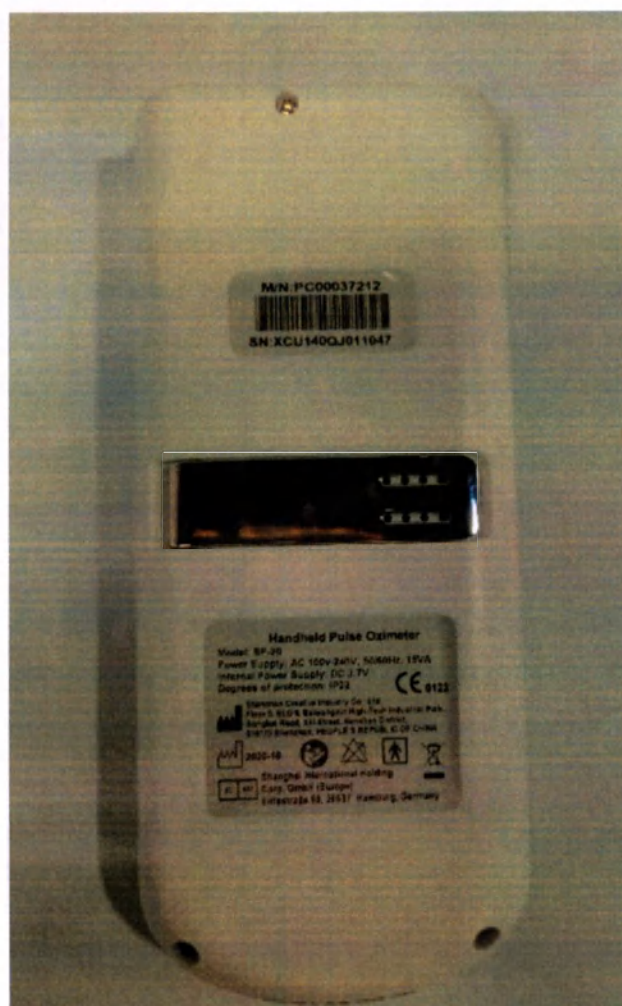


Рис. 10 Задняя часть варианта исполнения SP-20



Рис.11 Внешний вид варианта исполнения SP-20. Разъемы для подключения датчика насыщения крови кислородом SpO_2 и температуры (датчик температуры -не применимо на территории РФ)



Рис. 12 Внешний вид варианта исполнения SP-20. Датчик насыщения крови кислородом SpO_2 , модель KS-AC01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd

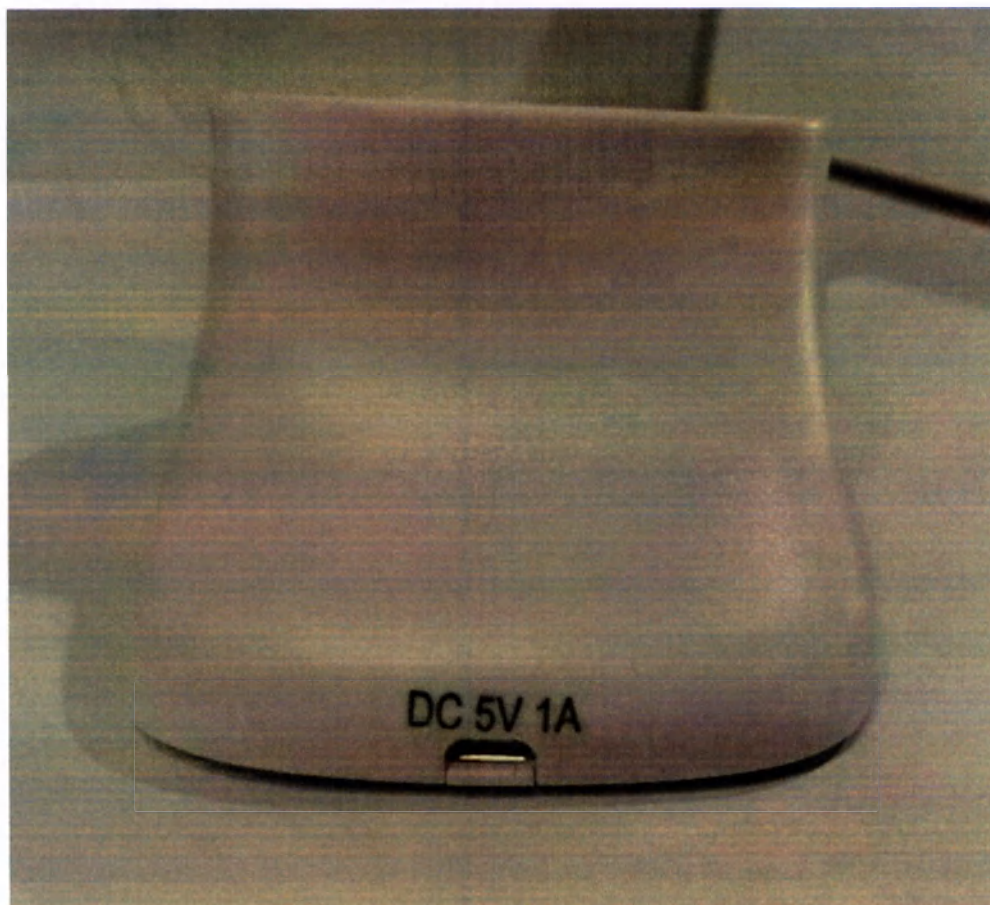


Рис. 13 Внешний вид варианта исполнения SP-20. Зарядная станция, модель SP-20

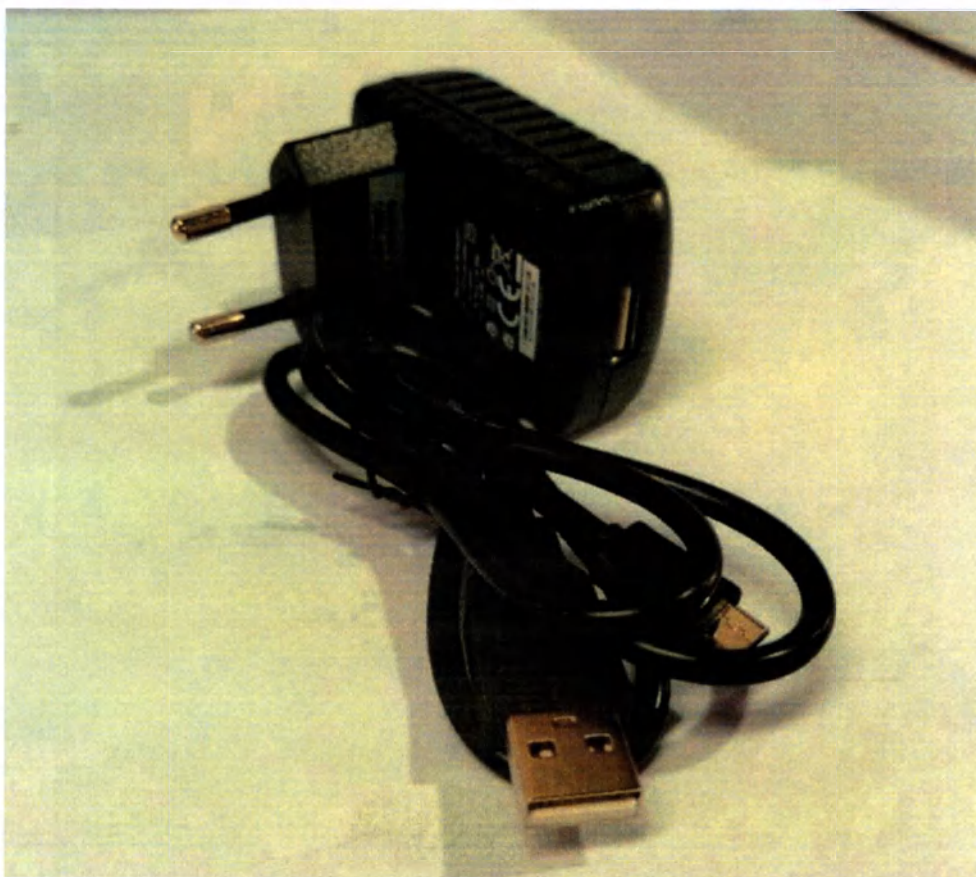


Рис. 14 Внешний вид варианта исполнения SP-20. Адаптер питания, модель LXCP12-005120BEG, производства Shenzhen Longxc Power Supply Co., Ltd.

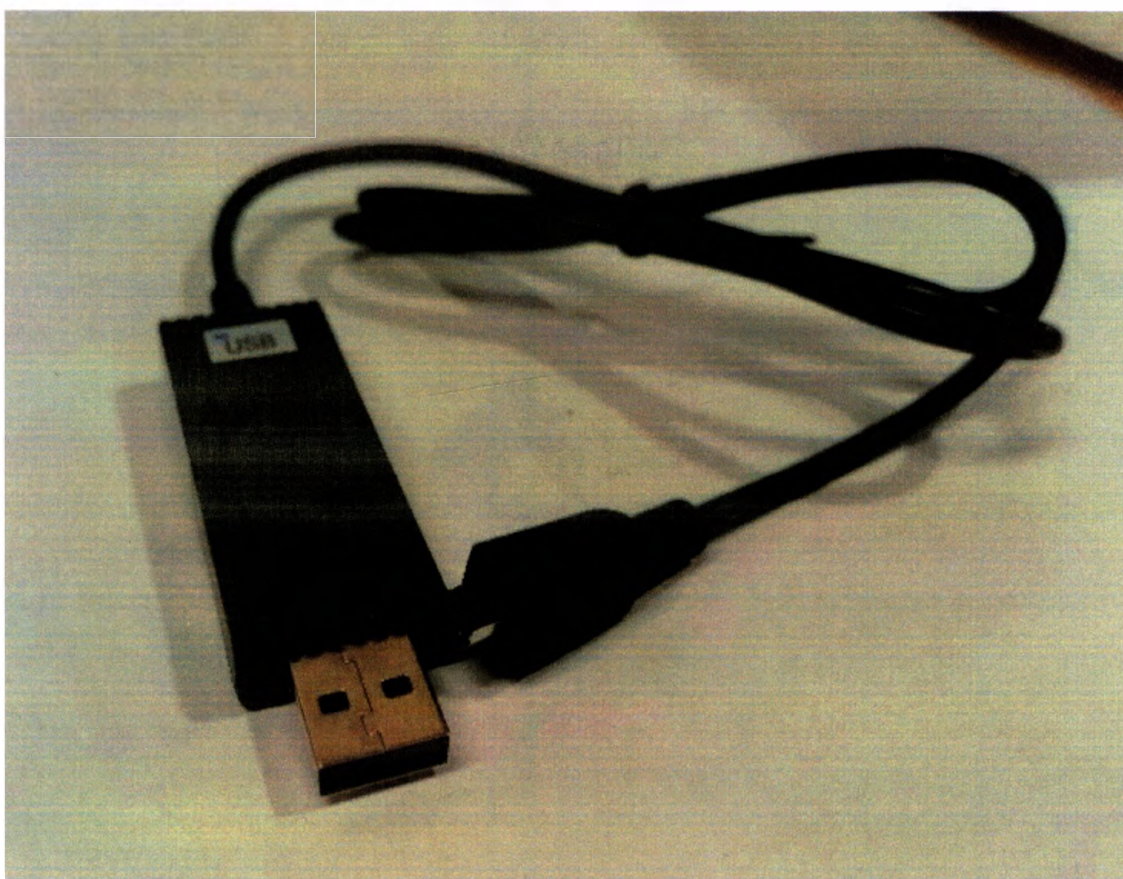


Рис. 15 USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C, производства Weixunda Electronic Products Co., Ltd.

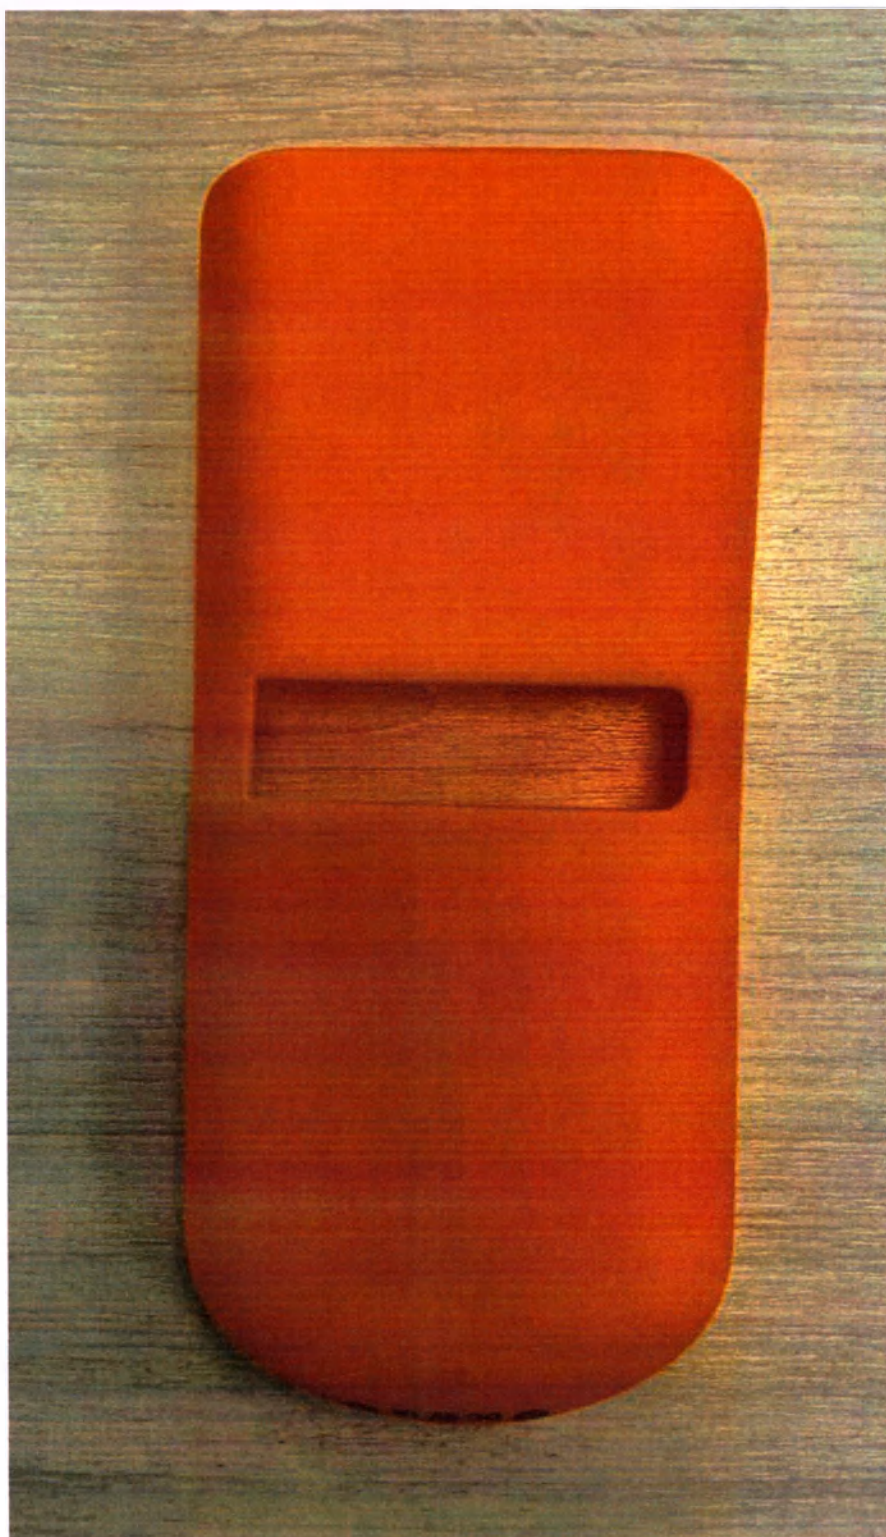


Рис. 15 Внешний вид варианта исполнения SP-20. Резиновый чехол для основного блока

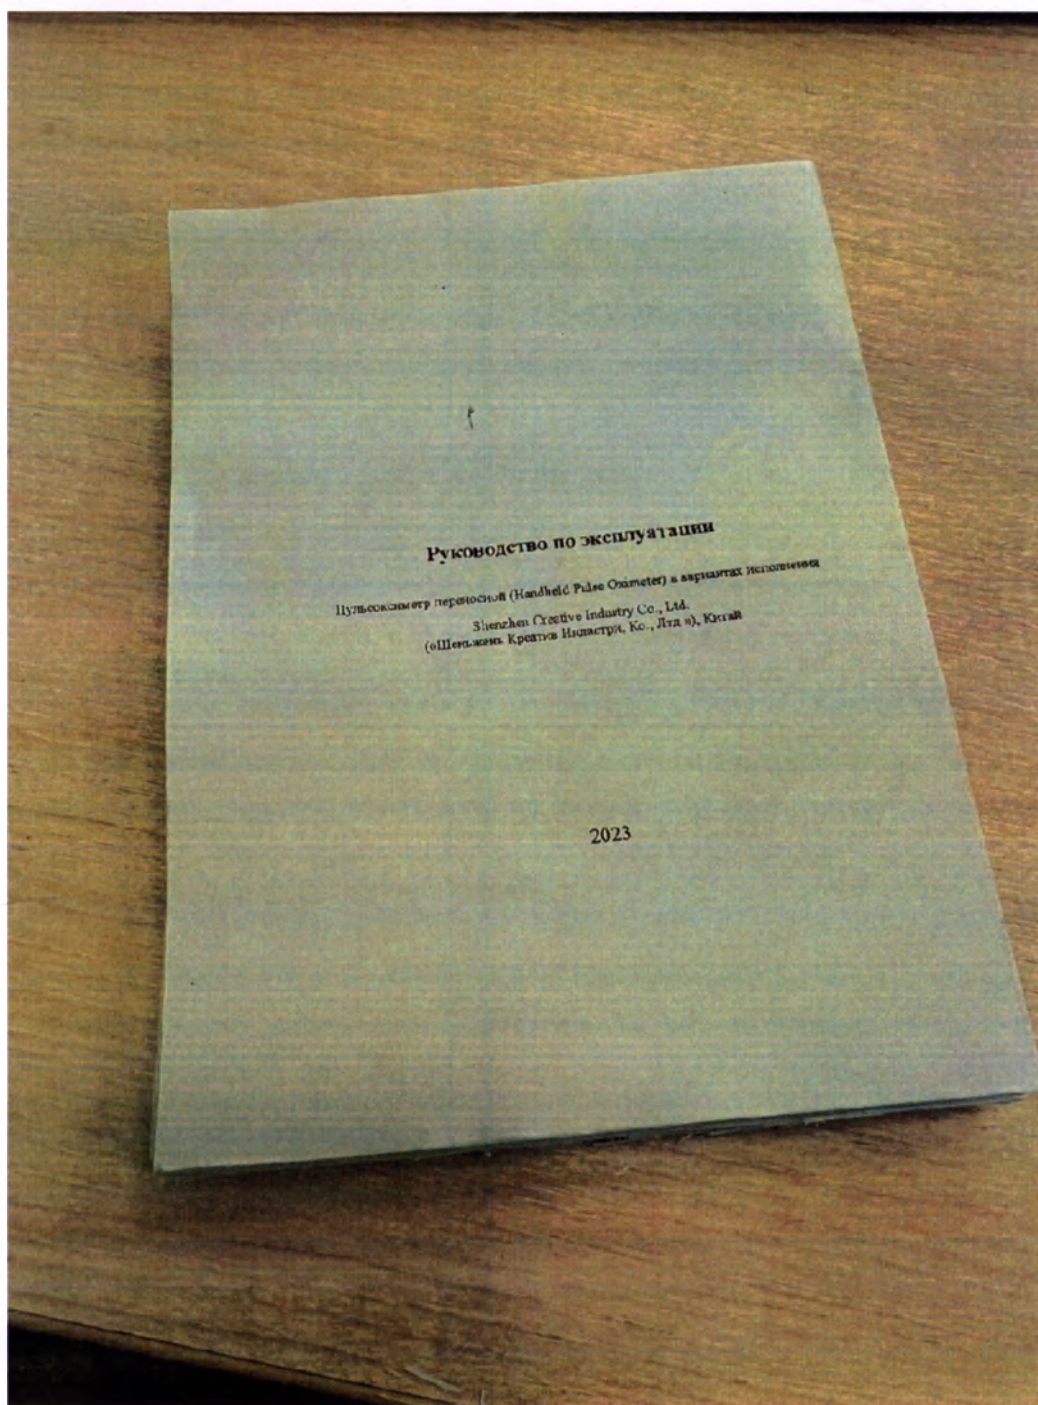


Рис. 16 Внешний вид эксплуатационной документации




SN:

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter),

в варианте исполнения **PC-66B**

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай
Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Адаптер питания: Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ВА

Внутренний источник питания: литиевая батарея 3.7 В

Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»,

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 281-67-68, info@beawire.com

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Рис. 17 Проект потребительской маркировки варианта исполнения PC-66B




SN:

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter),

в варианте исполнения **SP-20**

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай
Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Адаптер питания: Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ВА

Внутренний источник питания: литиевая батарея 3.7 В

Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»,

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

+7 (499) 281-67-68, info@beawire.com

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Рис. 18 Проект потребительской маркировки варианта исполнения SP-20




SN:

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter),

в варианте исполнения PC-66B

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай
Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Адаптер питания: Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ВА
Внутренний источник питания: литиевая батарея 3.7 В
Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»,
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
+7 (499) 281-67-68, info@beawire.com

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Рис. 19 Маркировки блока основного варианта исполнения PC-66B




SN:

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter),

в варианте исполнения SP-20

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай
Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Адаптер питания: Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ВА
Внутренний источник питания: литиевая батарея 3.7 В
Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»,
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
+7 (499) 281-67-68, info@beawire.com

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Рис. 20 Маркировка блока основного варианта исполнения SP-20

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter), в варианте исполнения PC-66B. Элемент: Датчик насыщения крови кислородом SpO ₂ , модель KS-C01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd	
SN:QE030CAFK43726	
	IPX1 M/N: 15040009

Рис. 21 Проект маркировки Датчик насыщения крови кислородом SpO₂, модель KS-C01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd варианта исполнения PC-66B

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter), в варианте исполнения SP-20. Элемент: Датчик насыщения крови кислородом SpO ₂ , модель KS-AC01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.	
SN:PI060CBDK38442	   
	IPX1 M/N: 15040091

Рис. 22 Проект маркировки Датчик насыщения крови кислородом SpO₂, модель KS-AC01, производства Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. варианта исполнения SP-20

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter), в варианте исполнения SP-20 Элемент: . Зарядная станция, модель SP-20 Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
 2020-10	 
Адаптер питания: Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ВА	

Рис. 23 Проект маркировки зарядная станция, модель SP-20 варианта исполнения SP-20

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter), в варианте исполнения PC-66B Элемент: . USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C Weixunda Electronic Products Co., Ltd	
 2020-10	 

Рис. 24 Проект маркировки USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C варианта исполнения PC-66B

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter), в варианте исполнения SP-20 Элемент: . USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C Weixunda Electronic Products Co., Ltd	
 2020-10	 

Рис. 25 Проект маркировки USB кабель передачи данных (при необходимости), модель USB-A/Type-C варианта исполнения SP-20



Рис. 26 Транспортная упаковка с маркировкой

Проекты маркировок транспортных упаковок для вариантов исполнения PC-66B, SP-20 указаны ниже

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter),

в варианте исполнения PC-66B

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко., Лтд.»), Китай
Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street,
Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»,
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
+7 (499) 281-67-68, info@beawire.com
Регистрационное удостоверение № _____ от _____



SN:

Пульсоксиметр переносной (Handheld Pulse Oximeter),

в варианте исполнения SP-20

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. («Шеньжень Креатив Индастри, Ко.,
Лтд.»), Китай
Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street,
Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»,
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
+7 (499) 281-67-68, info@beawire.com

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 4 листа (-ов)

Генеральный Директор Несова Т.А.
М.П.



МИТРУХИНА Ю.Ю.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АД3555350