

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Дентсплай Сирона»



Левин К.Г.

«*dd*»

03

2023г.

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21 ОТ 01.10.2021

**Фотографическое изображение
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Инструменты для системы дентальных имплантатов ASTRA TECH
Implant System, варианты исполнения: EV, TX, одноразовые
производства**

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany


Сверло копьевидное EV (Precision Drill EV)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).

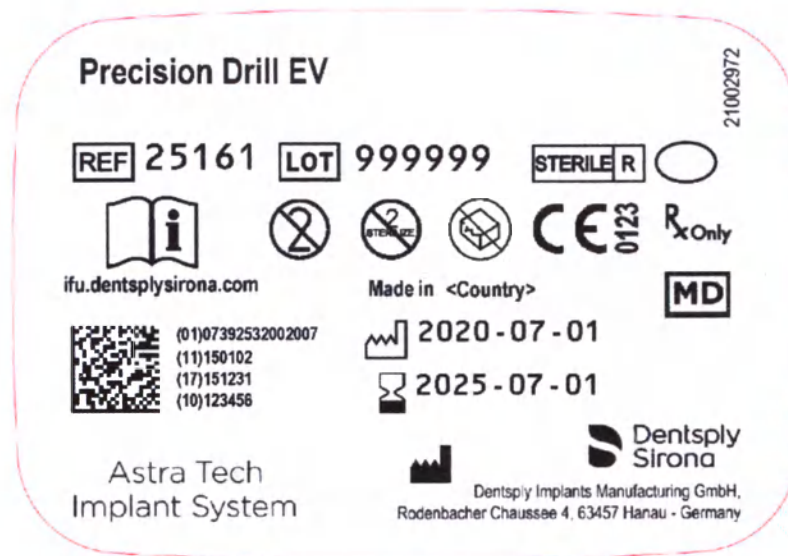


Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

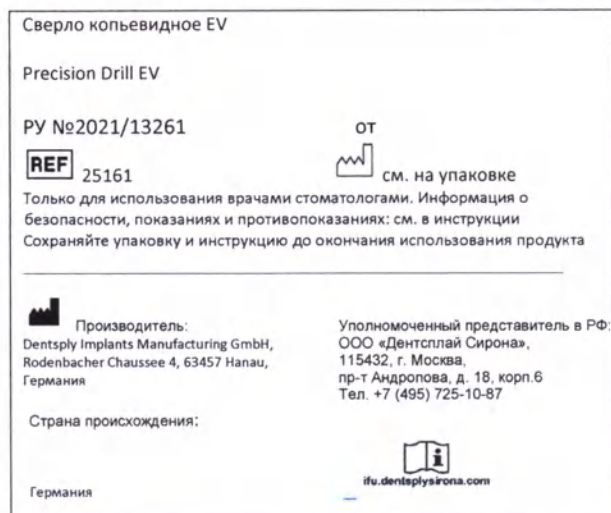


Цилиндр направляющий EV 5.4 (Guiding Cylinder EV 5.4)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на оборотную сторону блистера).

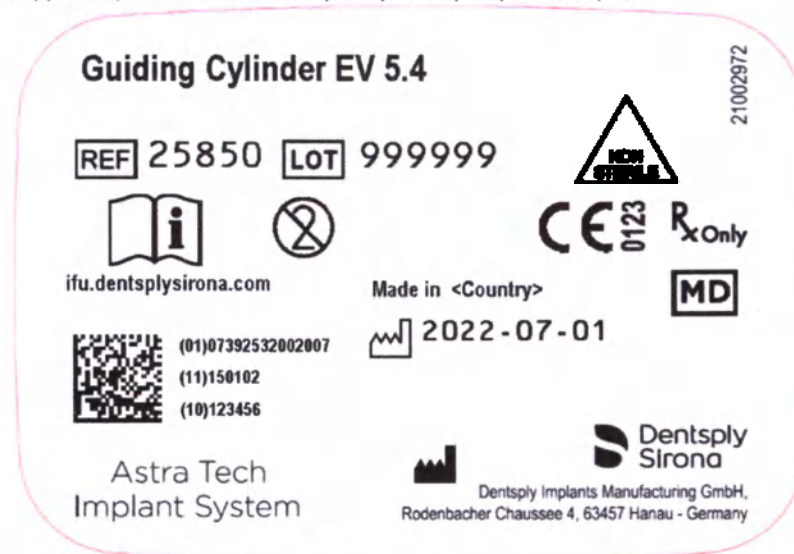


Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

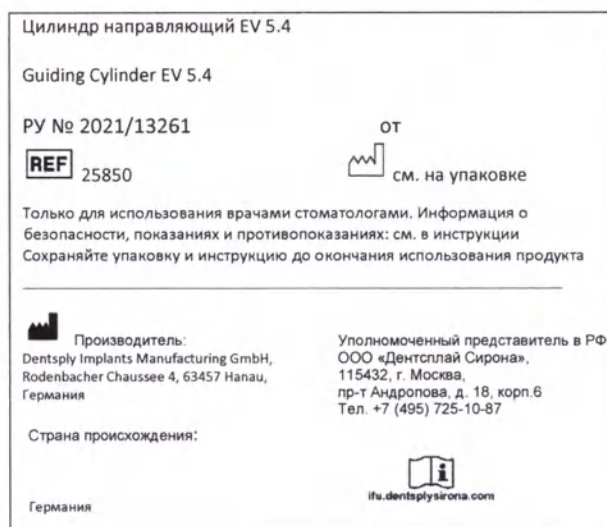


Цилиндр направляющий EV для абатмента Уни (Guiding Cylinder EV UniAbutmtnt)




Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).

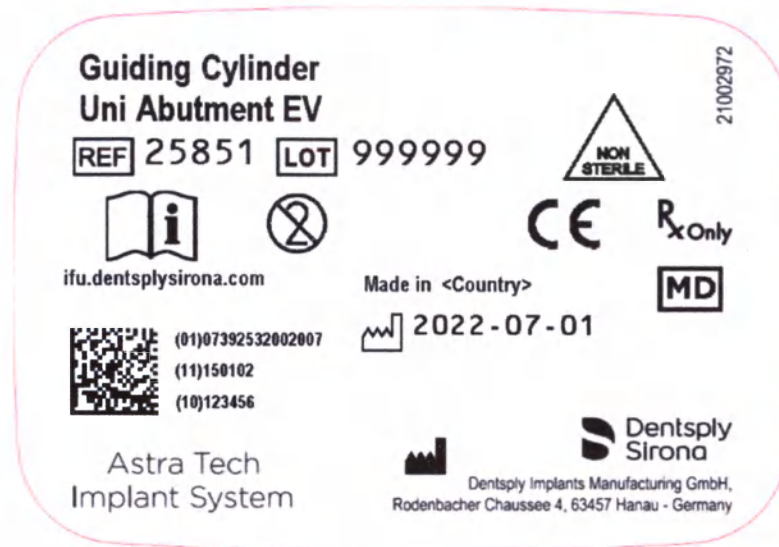

Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

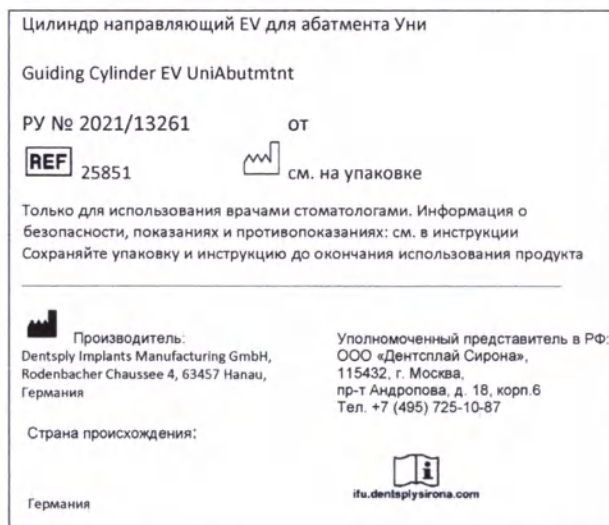


Трепанационное сверло 5.4, 6-13 мм (Trephine Drill 5.4, 6-13 mm)

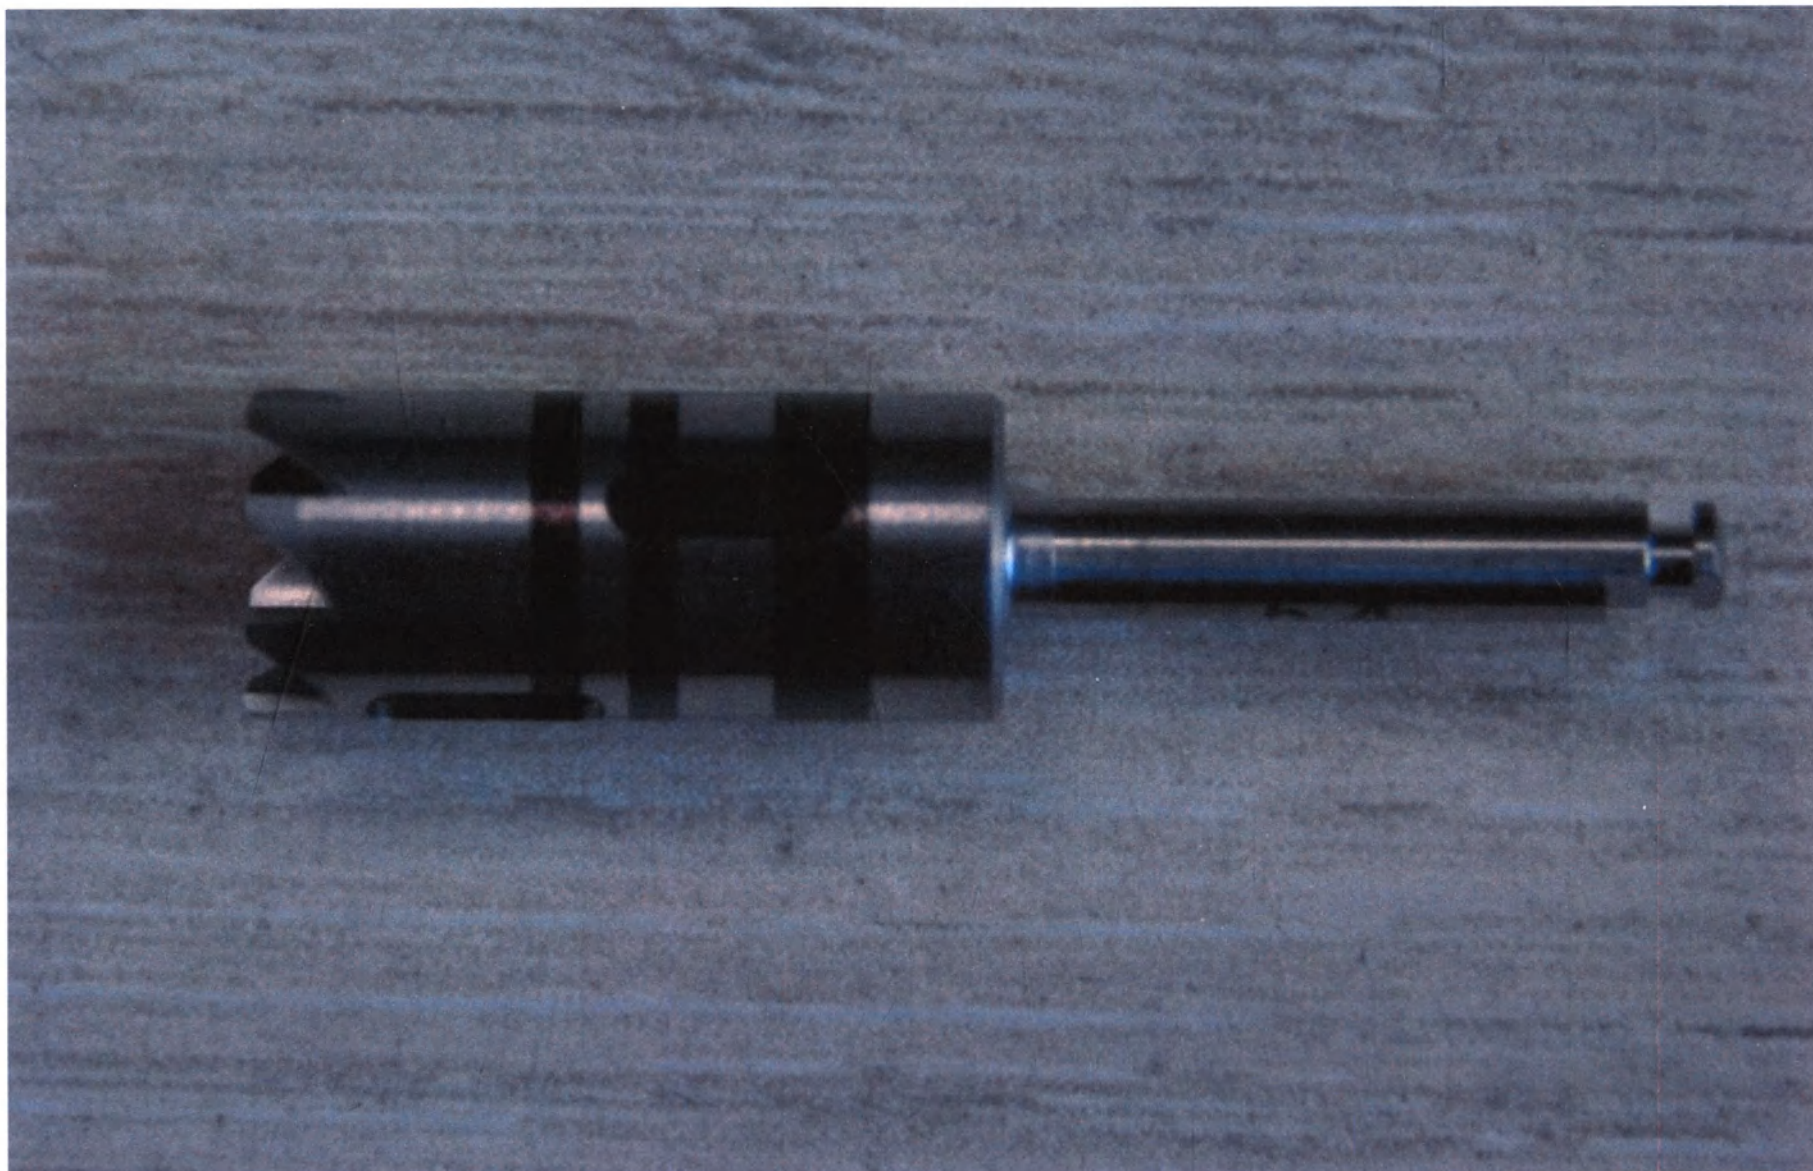

Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).




Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

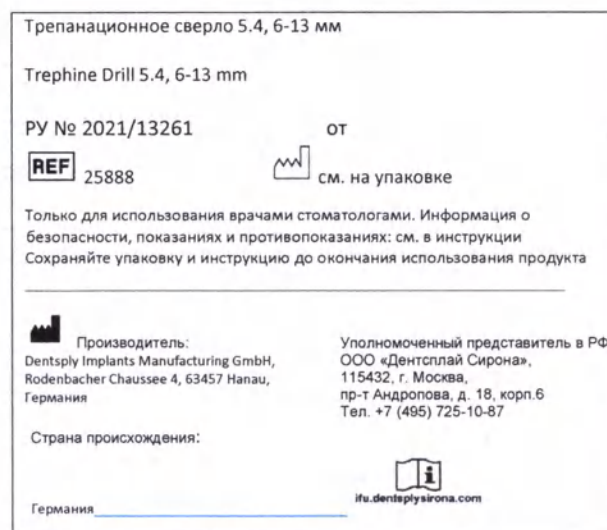


Вилка фрагментарная М1.8/М2.0 (Fragment Fork M1.8/M2.0)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).

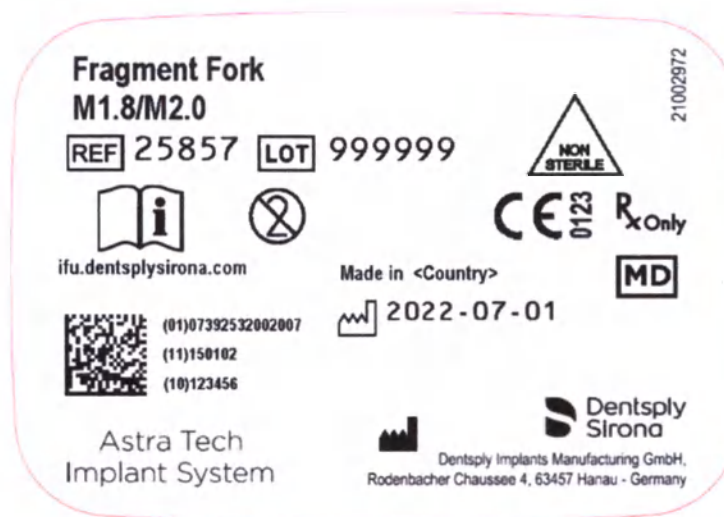


Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

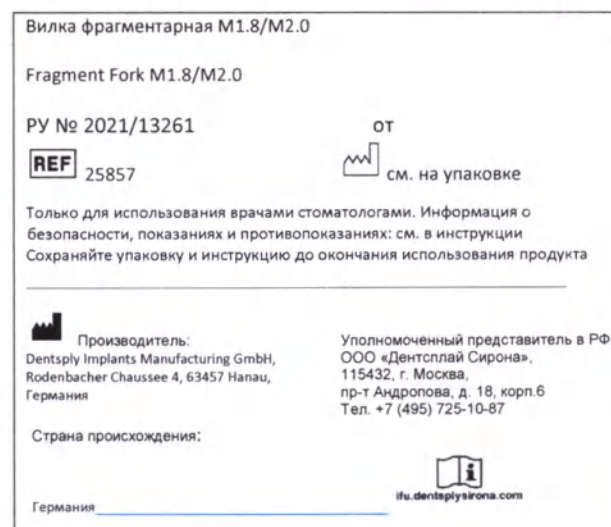

Фрагментарное сверло Ø1.0 (Fragment Drill Ø1.0)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).

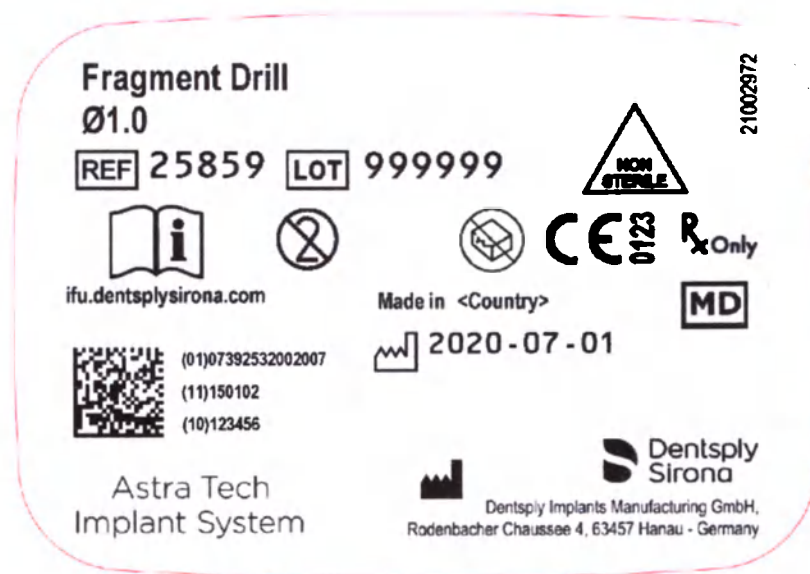


Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:




Винтовой экстрактор Ø1.0 (Screw Extractor Ø1.0)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).

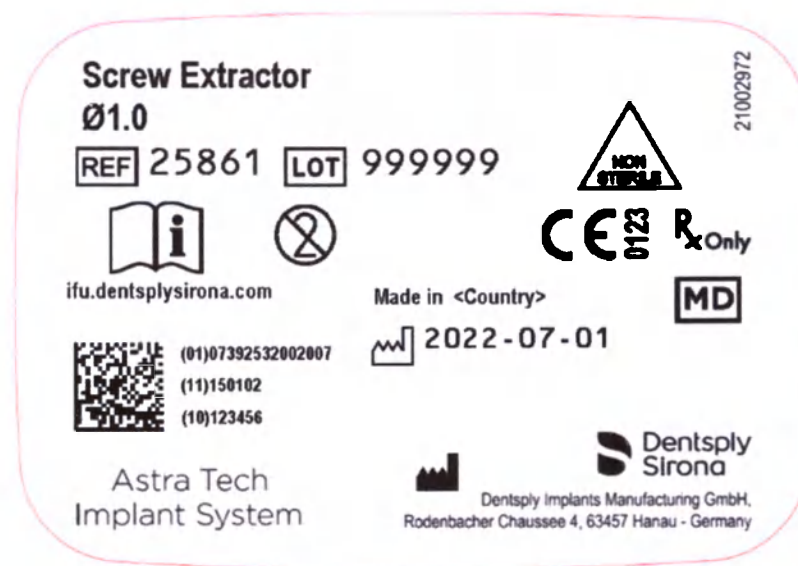

Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

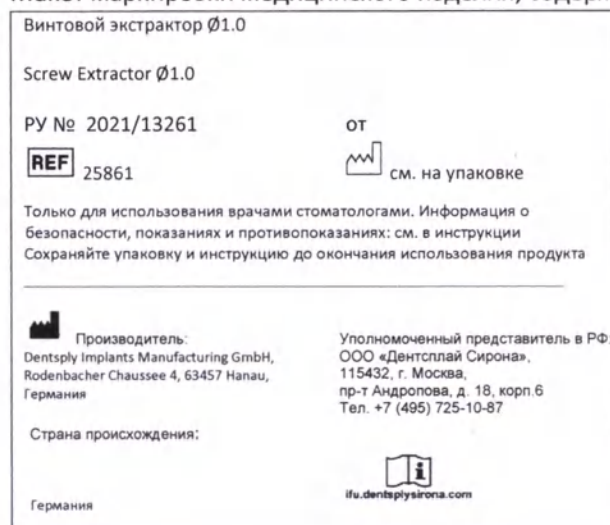


Очиститель резьбы М 2.0 (Thread Cleaner М 2.0)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).




Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

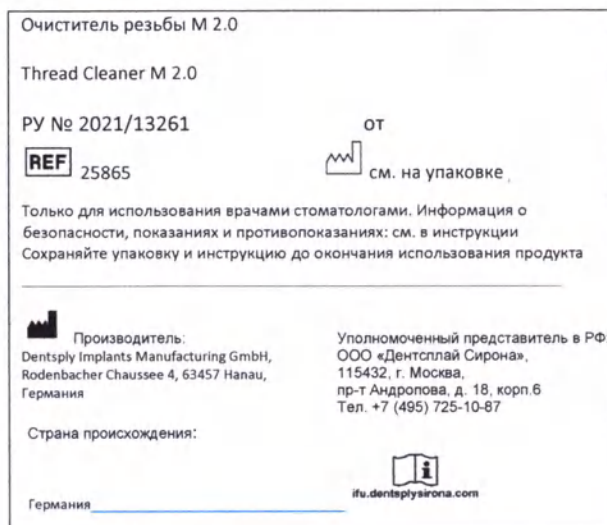


Мукотом EV-GS Ø4.8 (Punch EV-GS Ø4.8)



Макет основной маркировки медицинского изделия (наносится на обратную сторону блистера).

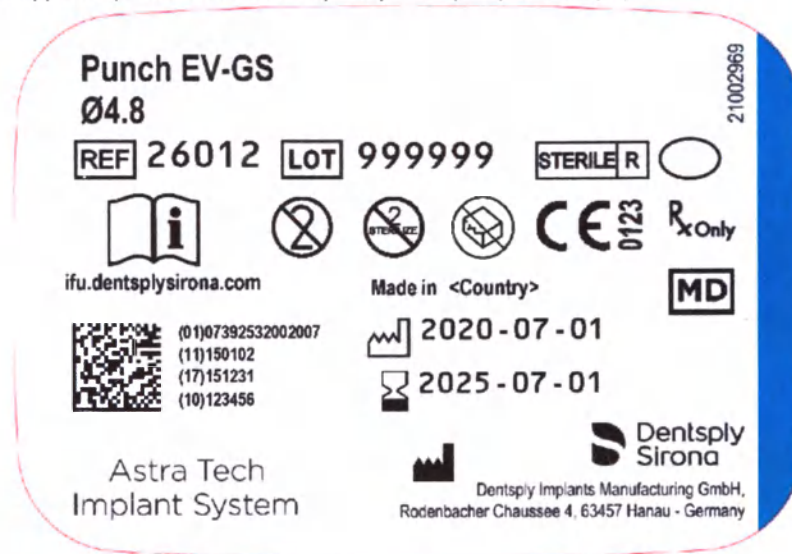


Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

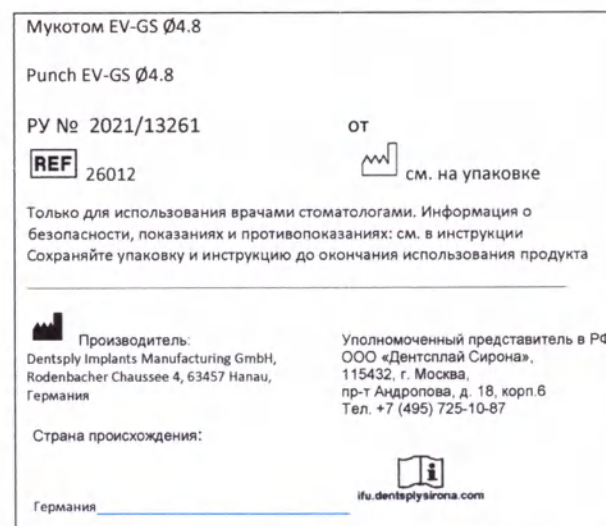

Сшито и скреплено печатью «19» листов.

Директор по регистрации Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»
Хаиндрава В.Г.



Дата: 22 03 2023 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21.01 01.10.2021

