

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ОССТЕМ»

Ли Чжэ Ву.

27.10. 2023 года

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Камера интраоральная беспроводная SNAP Wireless»,

производства «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), Корея



Л. Чжэ Ву
Генеральный директор
ООО «ОССТЕМ»





Насадка камеры (Camera head), пр-ва Genie Tech Inc.




1. Фото 3 — Адаптер питания (Power adapter) и Кабель адаптера питания (Adapter cable) 0,95 м



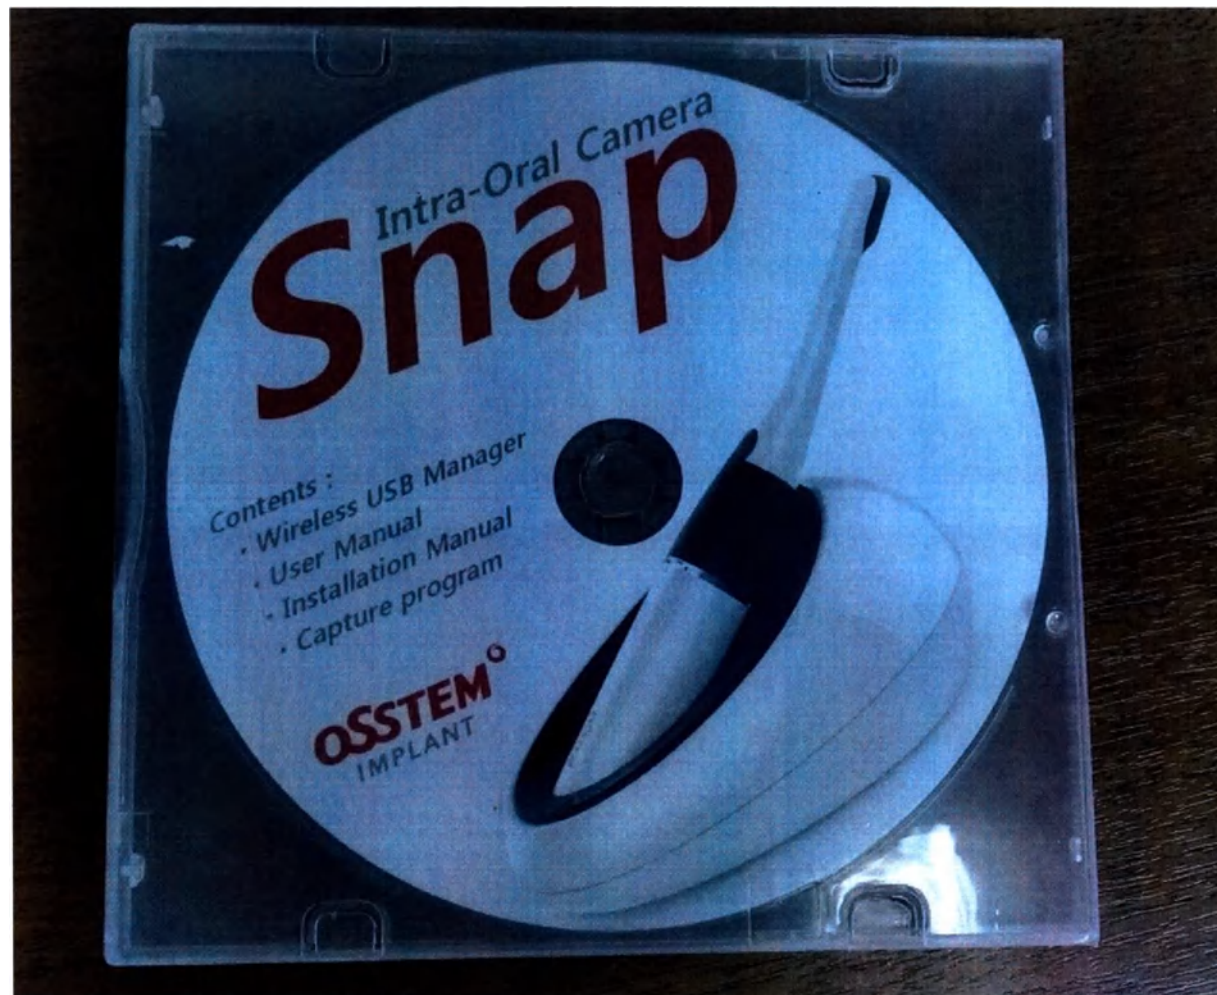

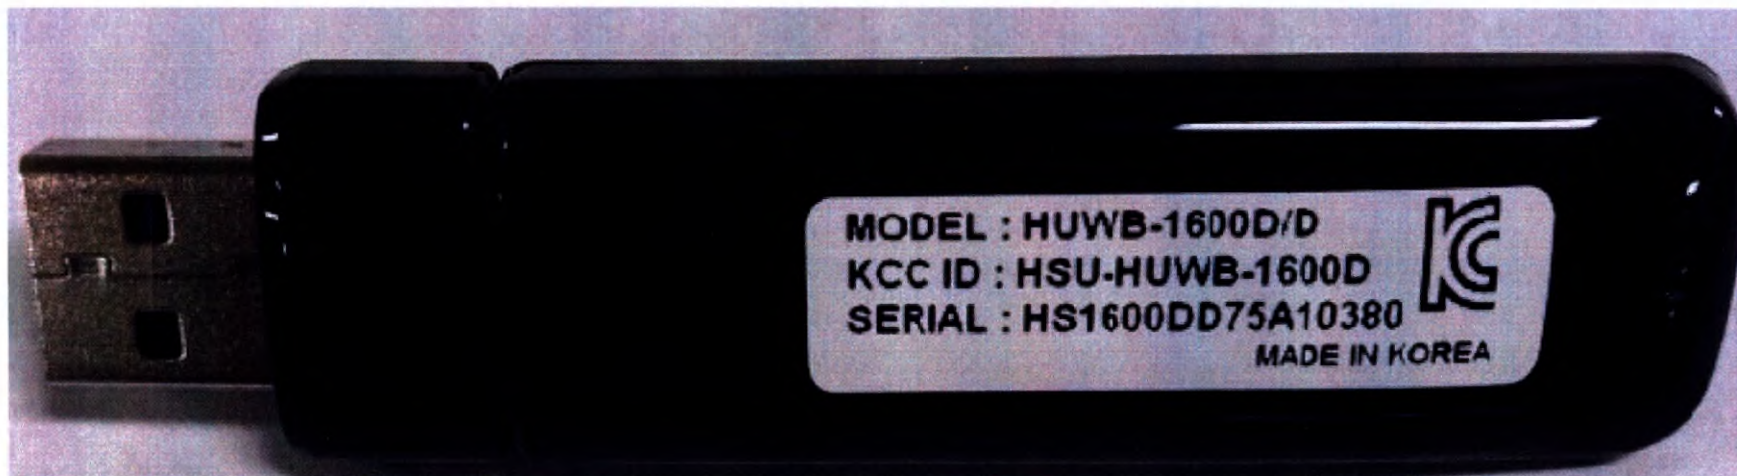

HUWB-1600D/D

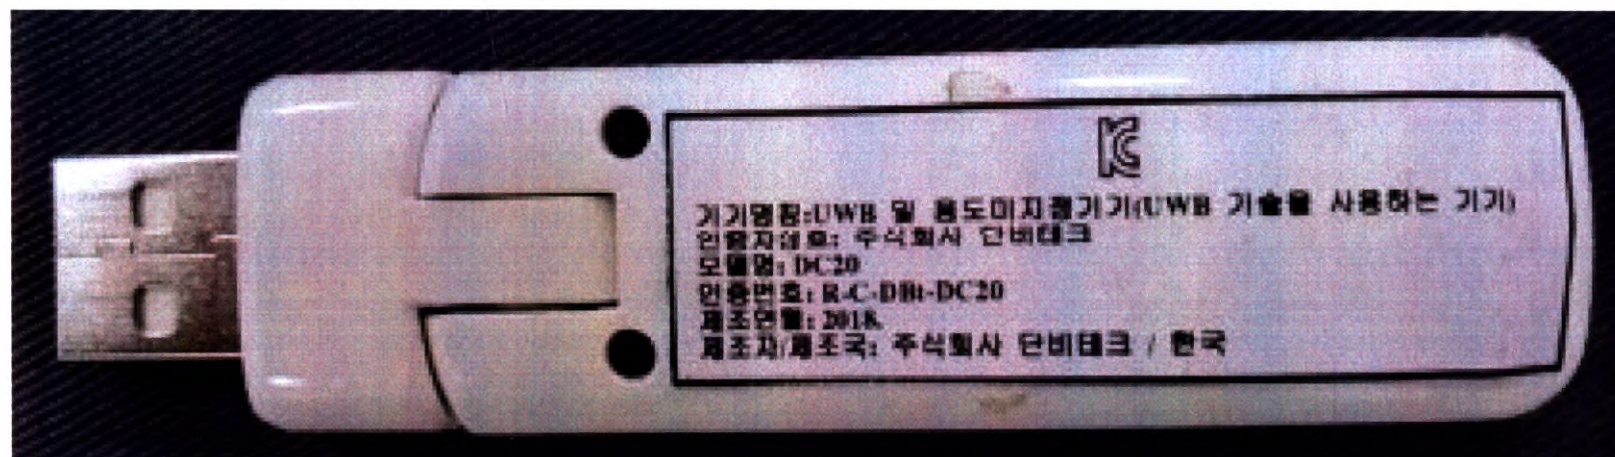

DC20



Фото 6 – USB кабель-удлинитель (USB extension cable) 3м

Фото 7 –Батарея (Battery) пр-ва HMTECH, LTD. (OSB2850S; OSB2850C)

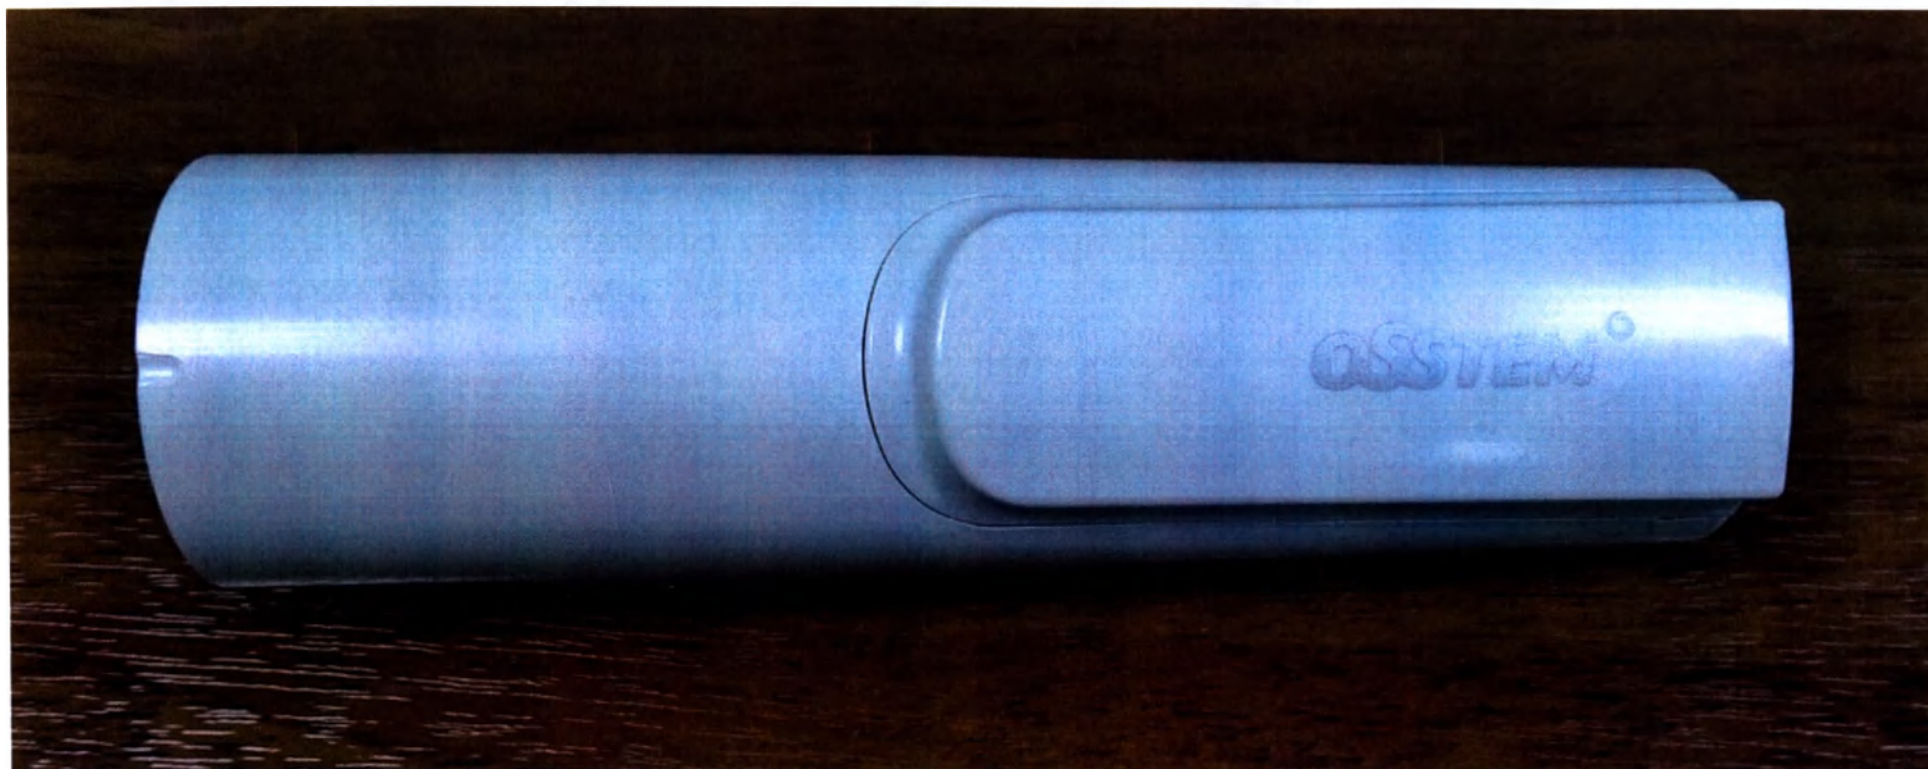




Фото 9 – Проект маркировки на территории Российской Федерации при поставке изделия с компонентом «Адаптер питания с батареей OSB2850S».

Проект маркировки на территории Российской Федерации при поставке изделия с компонентом «Батарея (Battery) OSB2850S пр-ва HMTECH, LTD».

При поставке с компонентом «Батарея (Battery) OSB2850C пр-ва HMTECH, LTD» на маркировке будут отражаться характеристики для батареек OSB2850C: 3,6 В постоянного тока; 2 600 мАч

Название товара
Модель
Производитель и адрес

Камера интраоральная беспроводная
SNAP Wireless
Осстем Имплант Ко., Лтд. (Osstem Implant Co., Ltd.)
3, Magokjungang 12-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07789 Republic of Korea (Корея)
Тел.: +82-2-2016-7000



Контактный номер
Страна производства
Номер отчета об изготовлении
Назначение

02-2016-7000
Южная Корея
№ СИН 18-691
Стоматологическая камера для проверки состояния зуба на компьютере после получения изображений с помощью модуля излучения света (оральный светодиод) для захвата изображения

Свойства и использование
Меры предосторожности при использовании

Подробнее см. в руководстве пользователя
Подробнее см. в руководстве пользователя



Упаковочная единица
Дата производства
Номер производства
№ классификации
Сайт: ifu.osstem.com
Номинальное напряжение

1 набор
Указана отдельно
Указан отдельно
A31020. 05 (1)

Адаптер питания	Вход: 100-240 В переменного тока; 50/60 Гц; 0,2 А. Выход: 5,0 В Постоянного тока; 1,0 А
Батарея	3,65 В постоянного тока; 2 850 мАч

Тип защиты и степень защиты от поражения электрическим током: 2-й класс и внутренний источник питания, крепление В-Туре

*Крепление: Головка камеры

Время активации (включения): 1 мин/ Время деактивации (выключения): 3 мин.

Данный продукт является [медицинским изделием]
Страна происхождения
Уполномоченный представитель в России

Сделано в Корее
Общество с ограниченной ответственностью «ОССТЕМ»
(ООО «ОССТЕМ»), 115432, г. Москва, пр. Андропова, д.18, кор.7, эт.8, оф.1
+7-495-739-99-25
info@osstem.ru



www.osstem.com

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (десять) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись И. М. С. / Ли Чан Ву /

« 27 » октября 20 23 г. М. П.

