

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»



Фотографические изображения

«Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для кардиостимуляции с принадлежностями»

Производитель: "Кардиак Пэйсмейкерс Инкорпорейтед, находящегося в собственности
компании Гайдент Корпорейшн, находящимся в полной собственности компании Бостон
Сайентифик Корпорейшн", США

Cardiac Pacemakers Incorporated a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation a wholly owned
subsidiary of Boston Scientific Corporation, USA

4100 Hamline Avenue North, Saint Paul, Minnesota, 55112-5798, USA

Boston
Scientific

Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для
кардиостимуляции, модель: 7840

PV-N P3H 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.
Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для
кардиостимуляции с принадлежностями

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315,
Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2
E-mail: Info-russia@bsci.com

Нетоксично, асептировано
Хранить при температуре 15-30 °C См. буклет.

INGEVITY™+

REF 7840

2024-04-18

BN 1061433

2022-04-18

45cm

☒ (1)



STERILE EO

MD




RU-Inst.com




(01)00802526604418;17;240418;21;1061433

647840-200

Вторичная упаковка

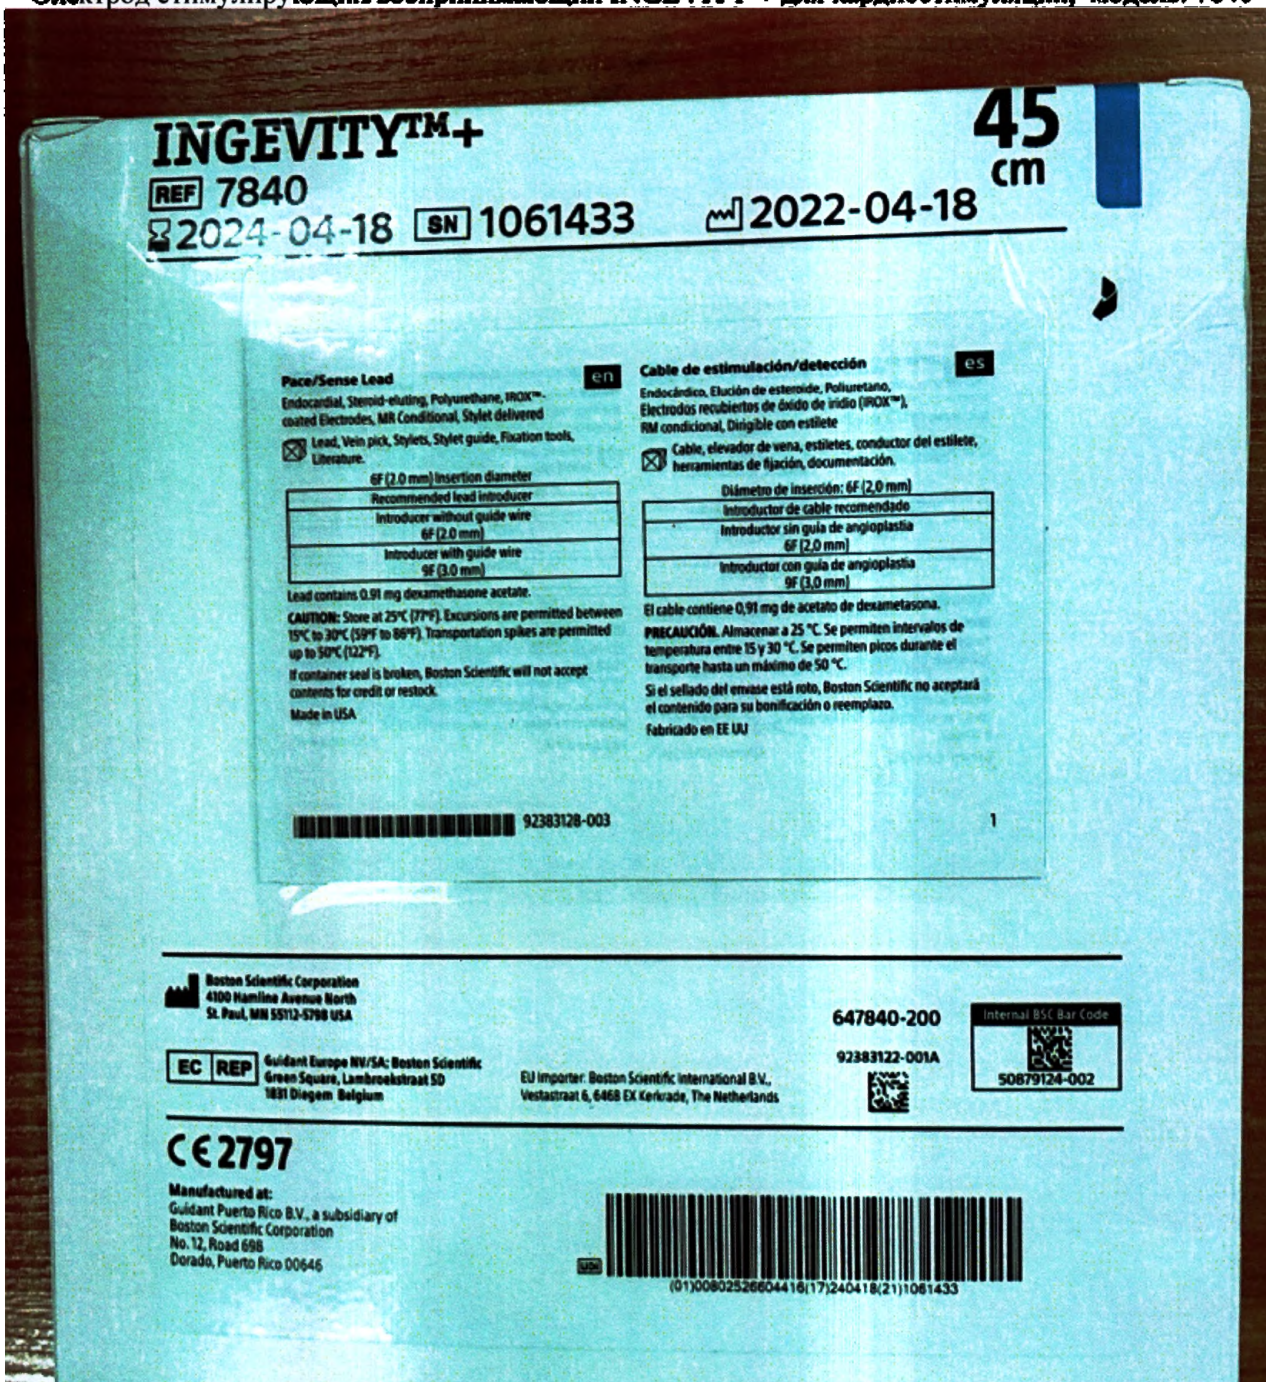


Маркировка на вторичной упаковке

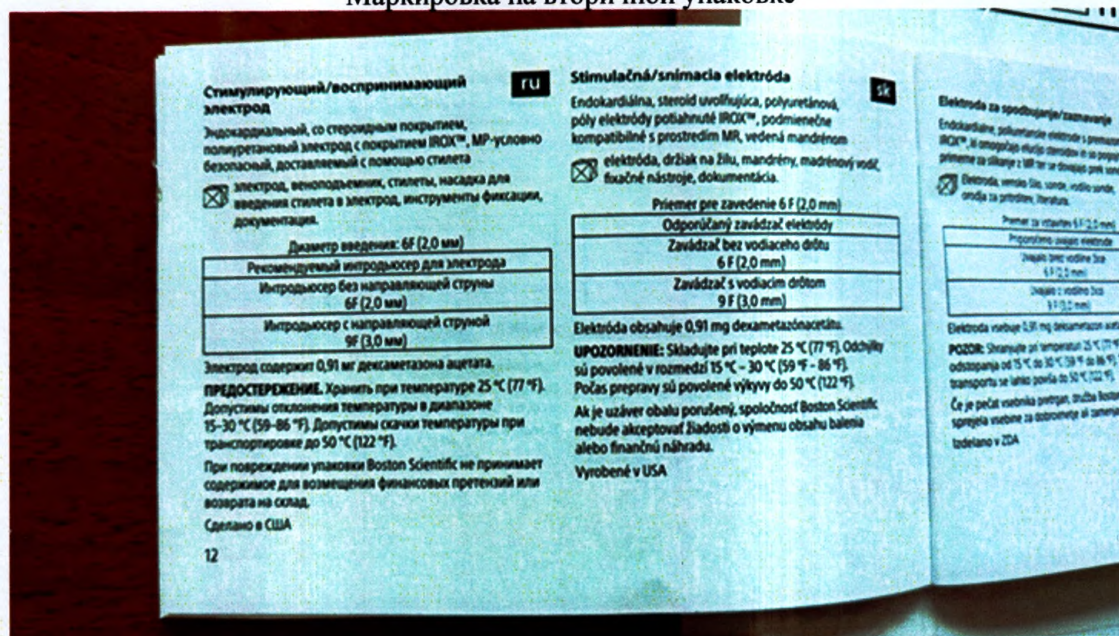


Буклет на коробке на русском языке



Первичная упаковка

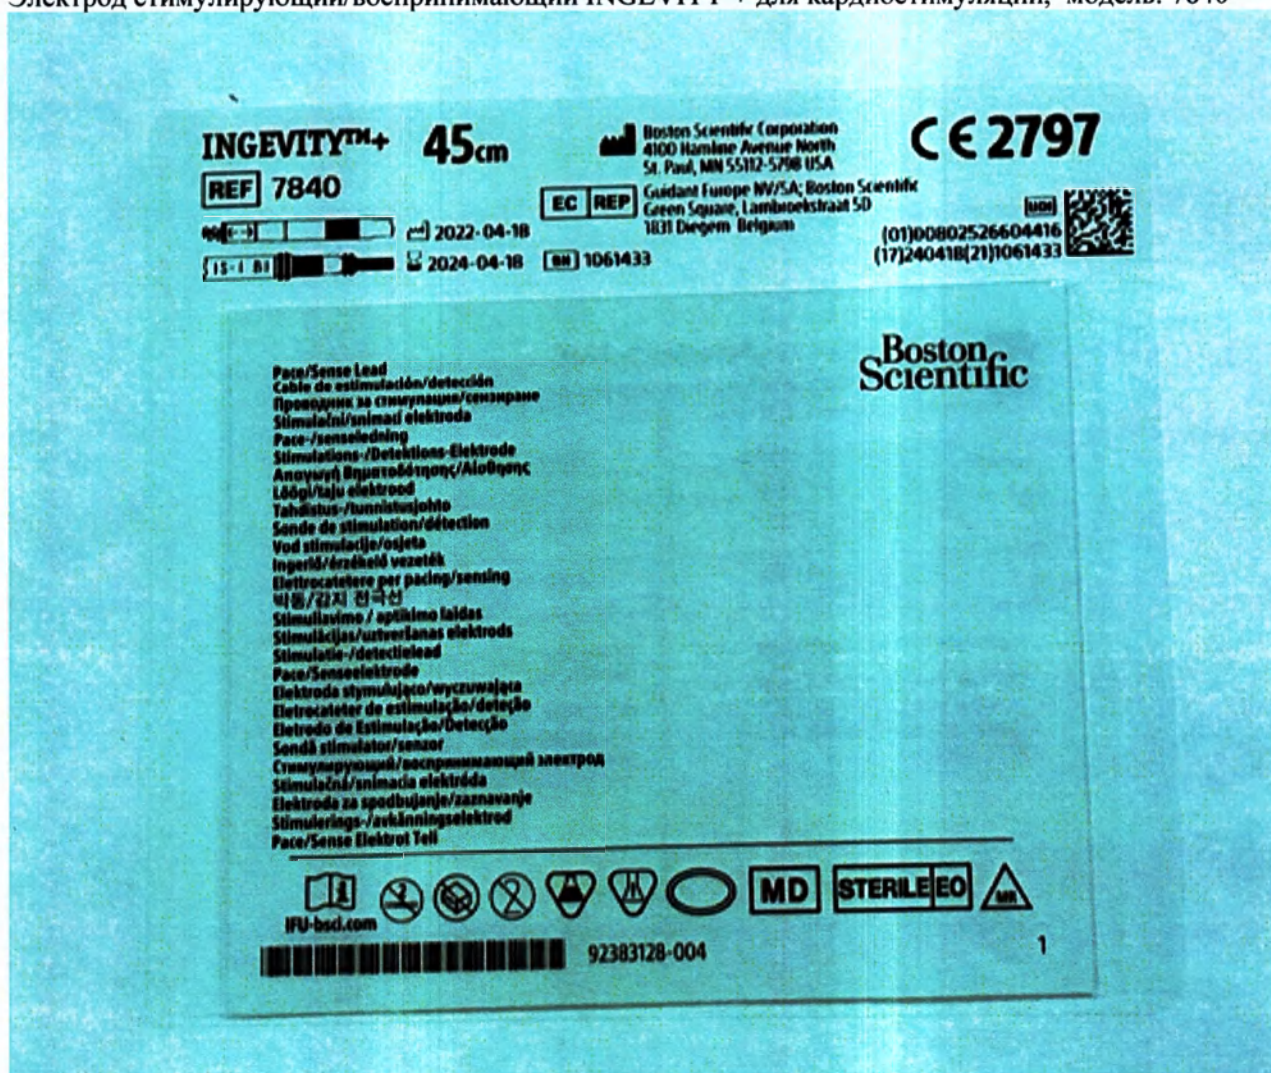

Маркировка на первичной упаковке

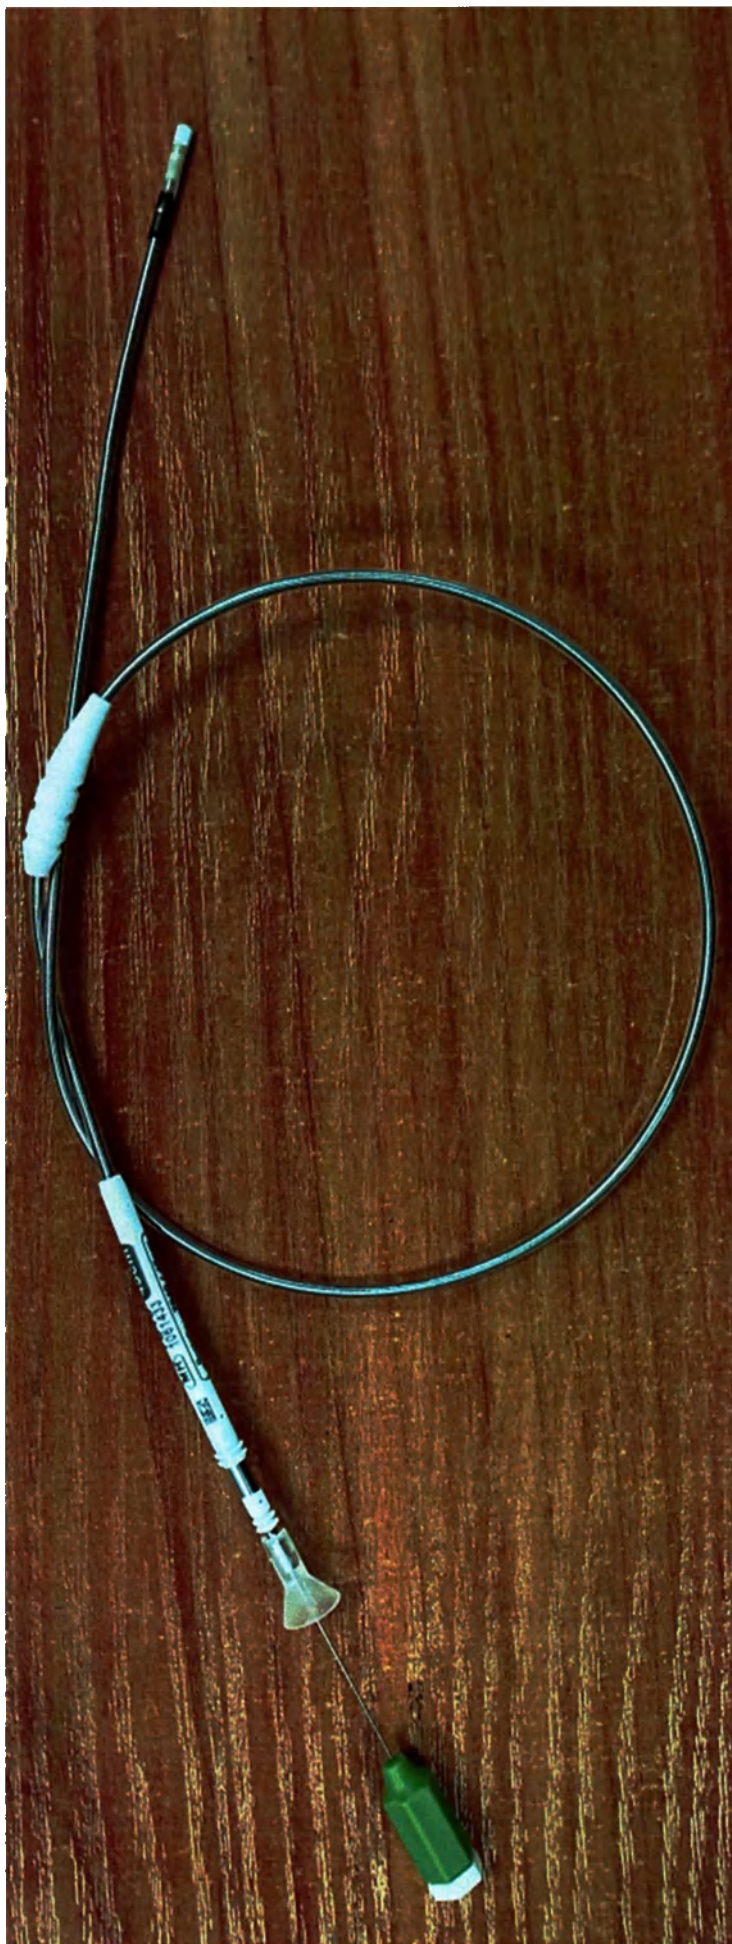

Электрод




Маркировка на электроде



Веноподъемник



Насадка для введения стилета в электрод

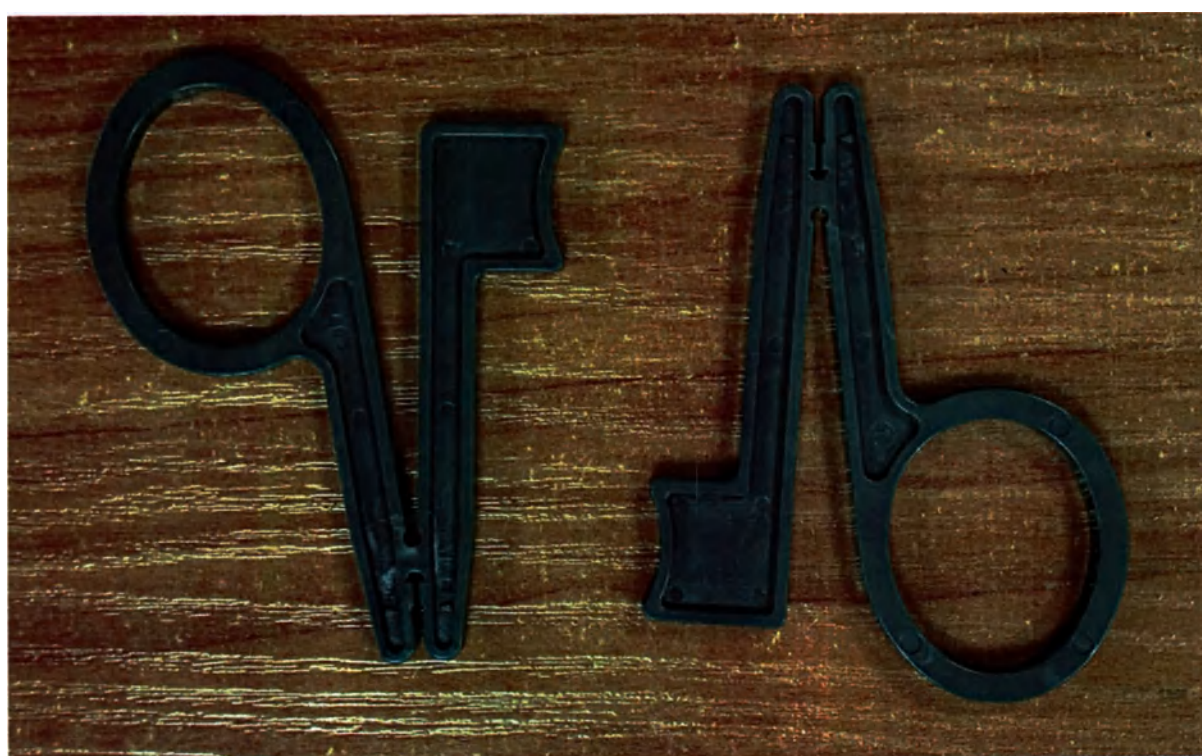

Инструмент фиксации:



Стилеты





Boston Scientific Corporation
 4100 Hamline Avenue North
 St. Paul, MN 55112-5798
 USA
 1-800-CARDIAC (227-3422)
 Worldwide: +1-651-582-4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling
www.bostonscientific.com/imageready

2019-10
50879125-004



Implant Card • Tarjeta del implante • Carte d'implant • Implantatkarte • Scheda di impianto • Implantaatkaart • インプラントカード • Implantatkort • Κάρτα εμφυτεύματος • Cartão de Implante • Implantatkort • Implantációs kártya • Karta s informacemi o implantátu • Karta implantu • Implantatkort • 植入物说明卡 • 이식 장치 카드 • Implant Karti • Cartão de implante • Implanttikortti • Card implant • Karta • Karta implantátu • Karta za implant • Kartica implantata • Implantaadi kaart • Ígræðiskort • Implantata karte • Implanto kortelé • Kartica vsadka • Kartu Implan




Карточка имплантата

Internal BSC Bar Code
50879126-001

647840-200
92383122-002A

(01)00802526604416
(17)240418(21)1061223



Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm 2024-04-18 1061223  Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm 2024-04-18 1061223  Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm 2024-04-18 1061223  Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm 2024-04-18 1061223 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td style="width: 50%;">Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> <tr><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td><td>Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm</td></tr> </table>	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																
Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm	Boston Scientific INGEVITY™+ REF 7840 45cm																

Наклейки

Boston
Scientific

Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY +
для кардиостимуляции, модель: 7841

PV № P3H 20XXXXXX от XXXX 20XX

Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для кардиостимуляции
с принадлежностями

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315, Россия, г.

Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2

E-mail: Info-russia@bsci.com

Нетоксично, асептично

Хранить при температуре 15-30 °C См. буклет

INGEVITY™+

REF 7841

2024-08-26

SN 1194890

2022-08-26

52cm

☒ (1)



STERILE

MD




ISO 13485




(01)00802526604539(17)240826(21)1194890

647841-200

Вторичная упаковка

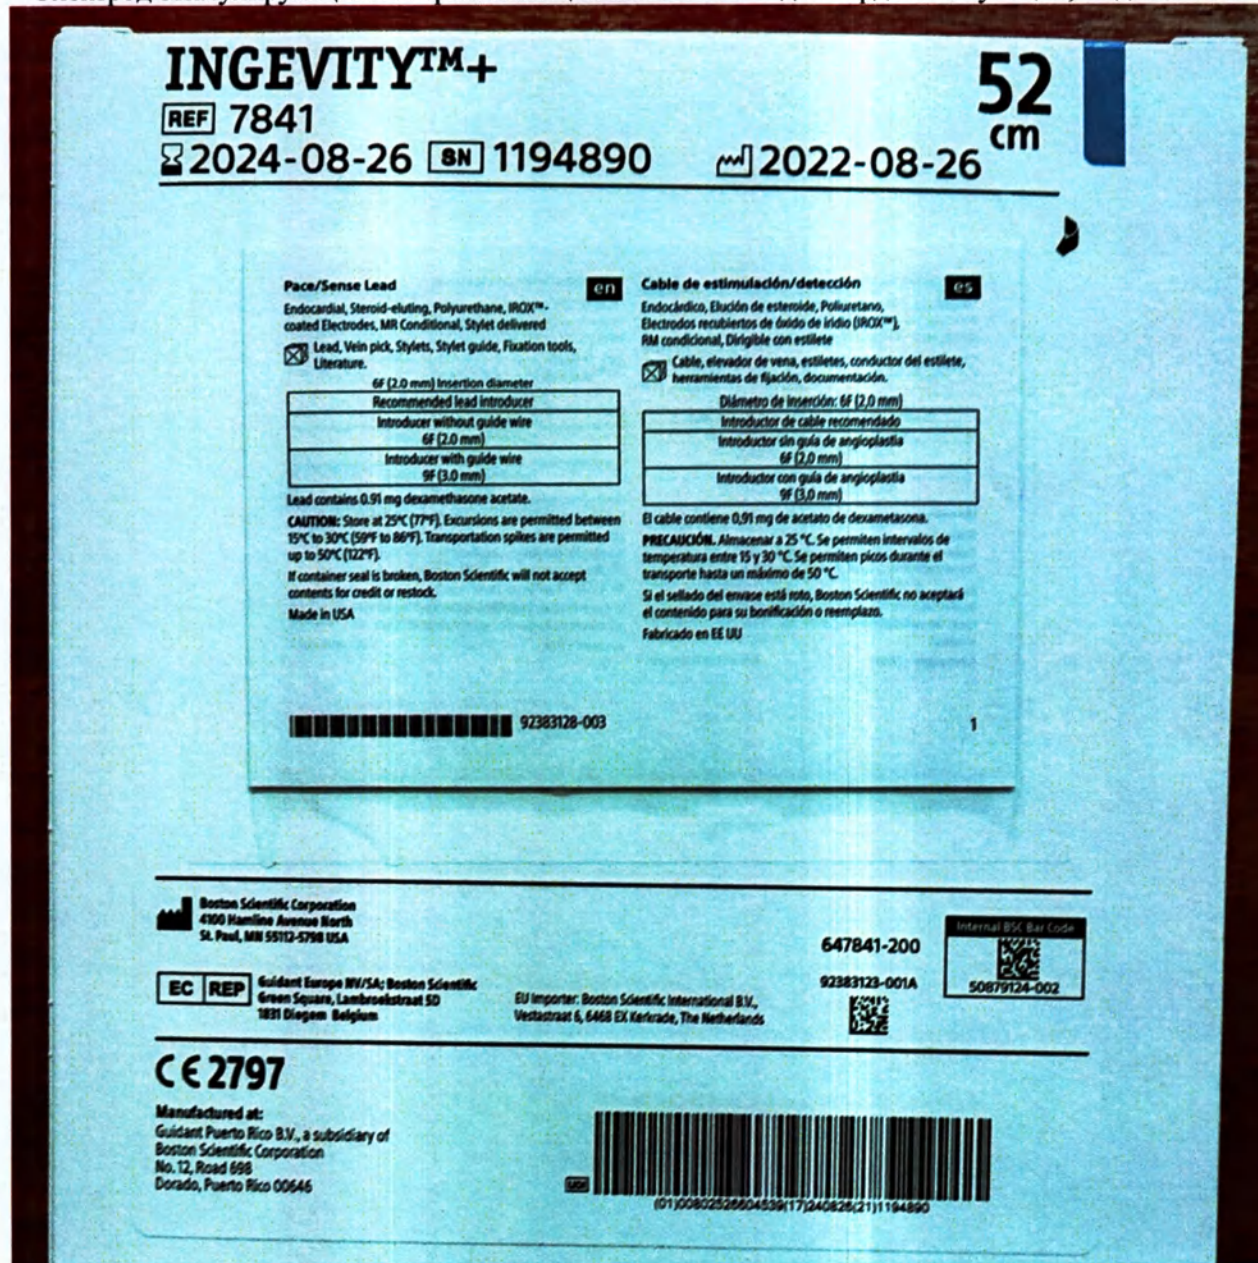

Маркировка на вторичной упаковке

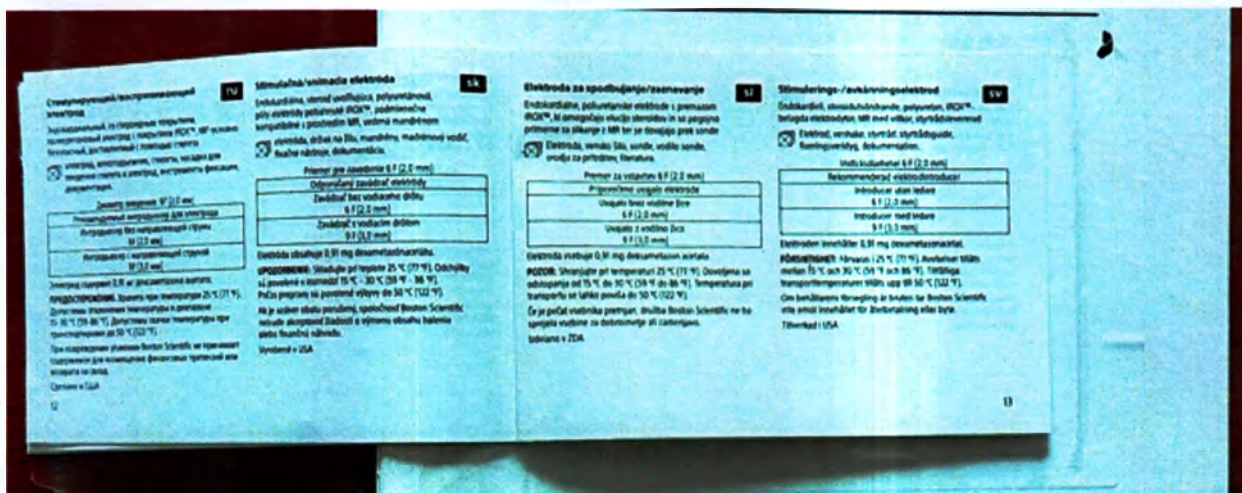

Буклет на коробке на русском языке

Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для кардиостимуляции, модель: 7841




Первичная упаковка


Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для кардиостимуляции, модель: 7841




Маркировка на первичной упаковке

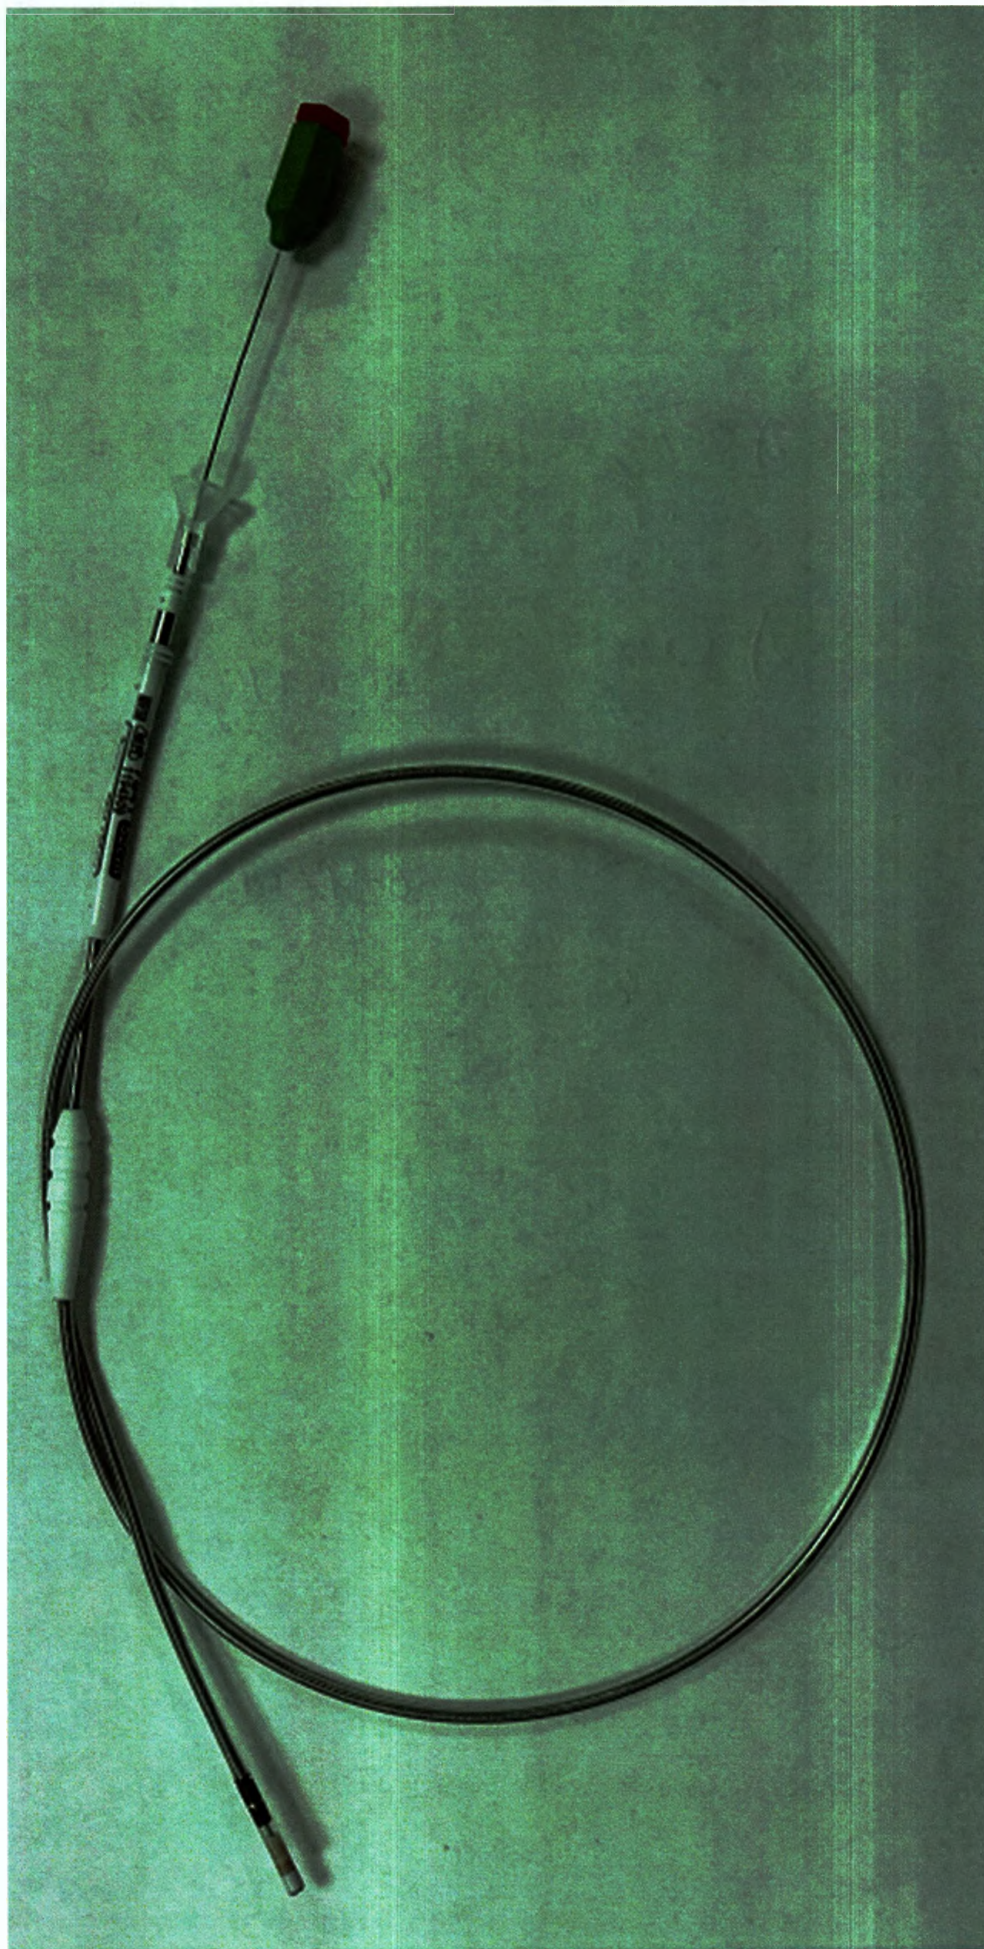

Электрод

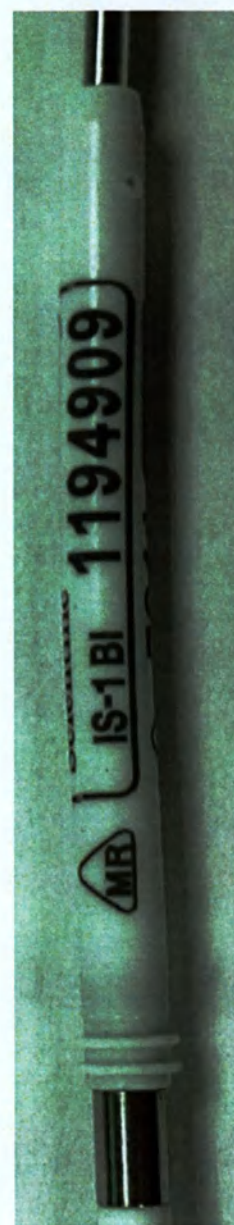


Маркировка на электроде

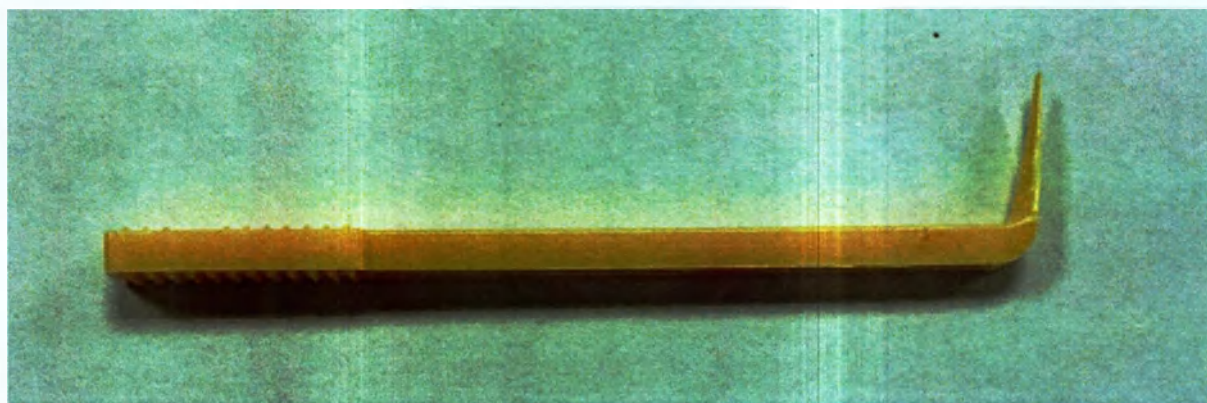


Веноподъемник



Насадка для введения стилета в электрод:

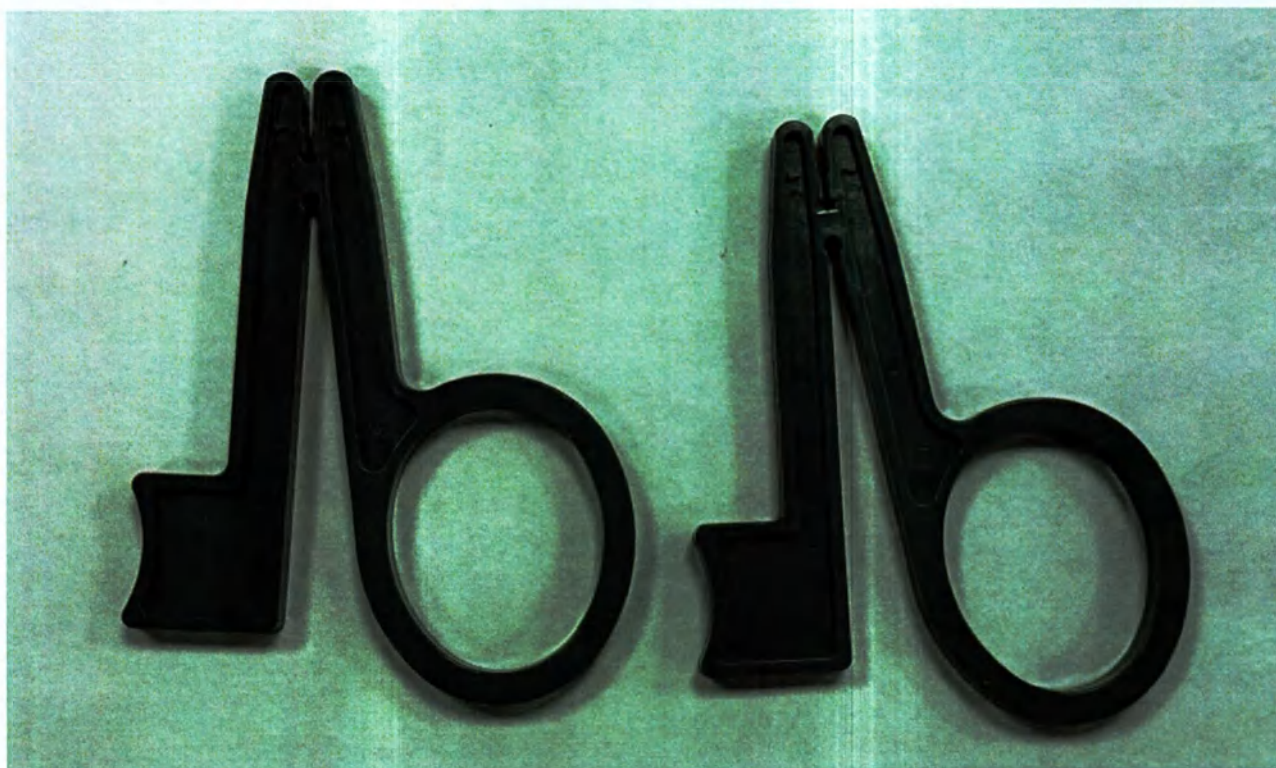

Инструмент фиксации:

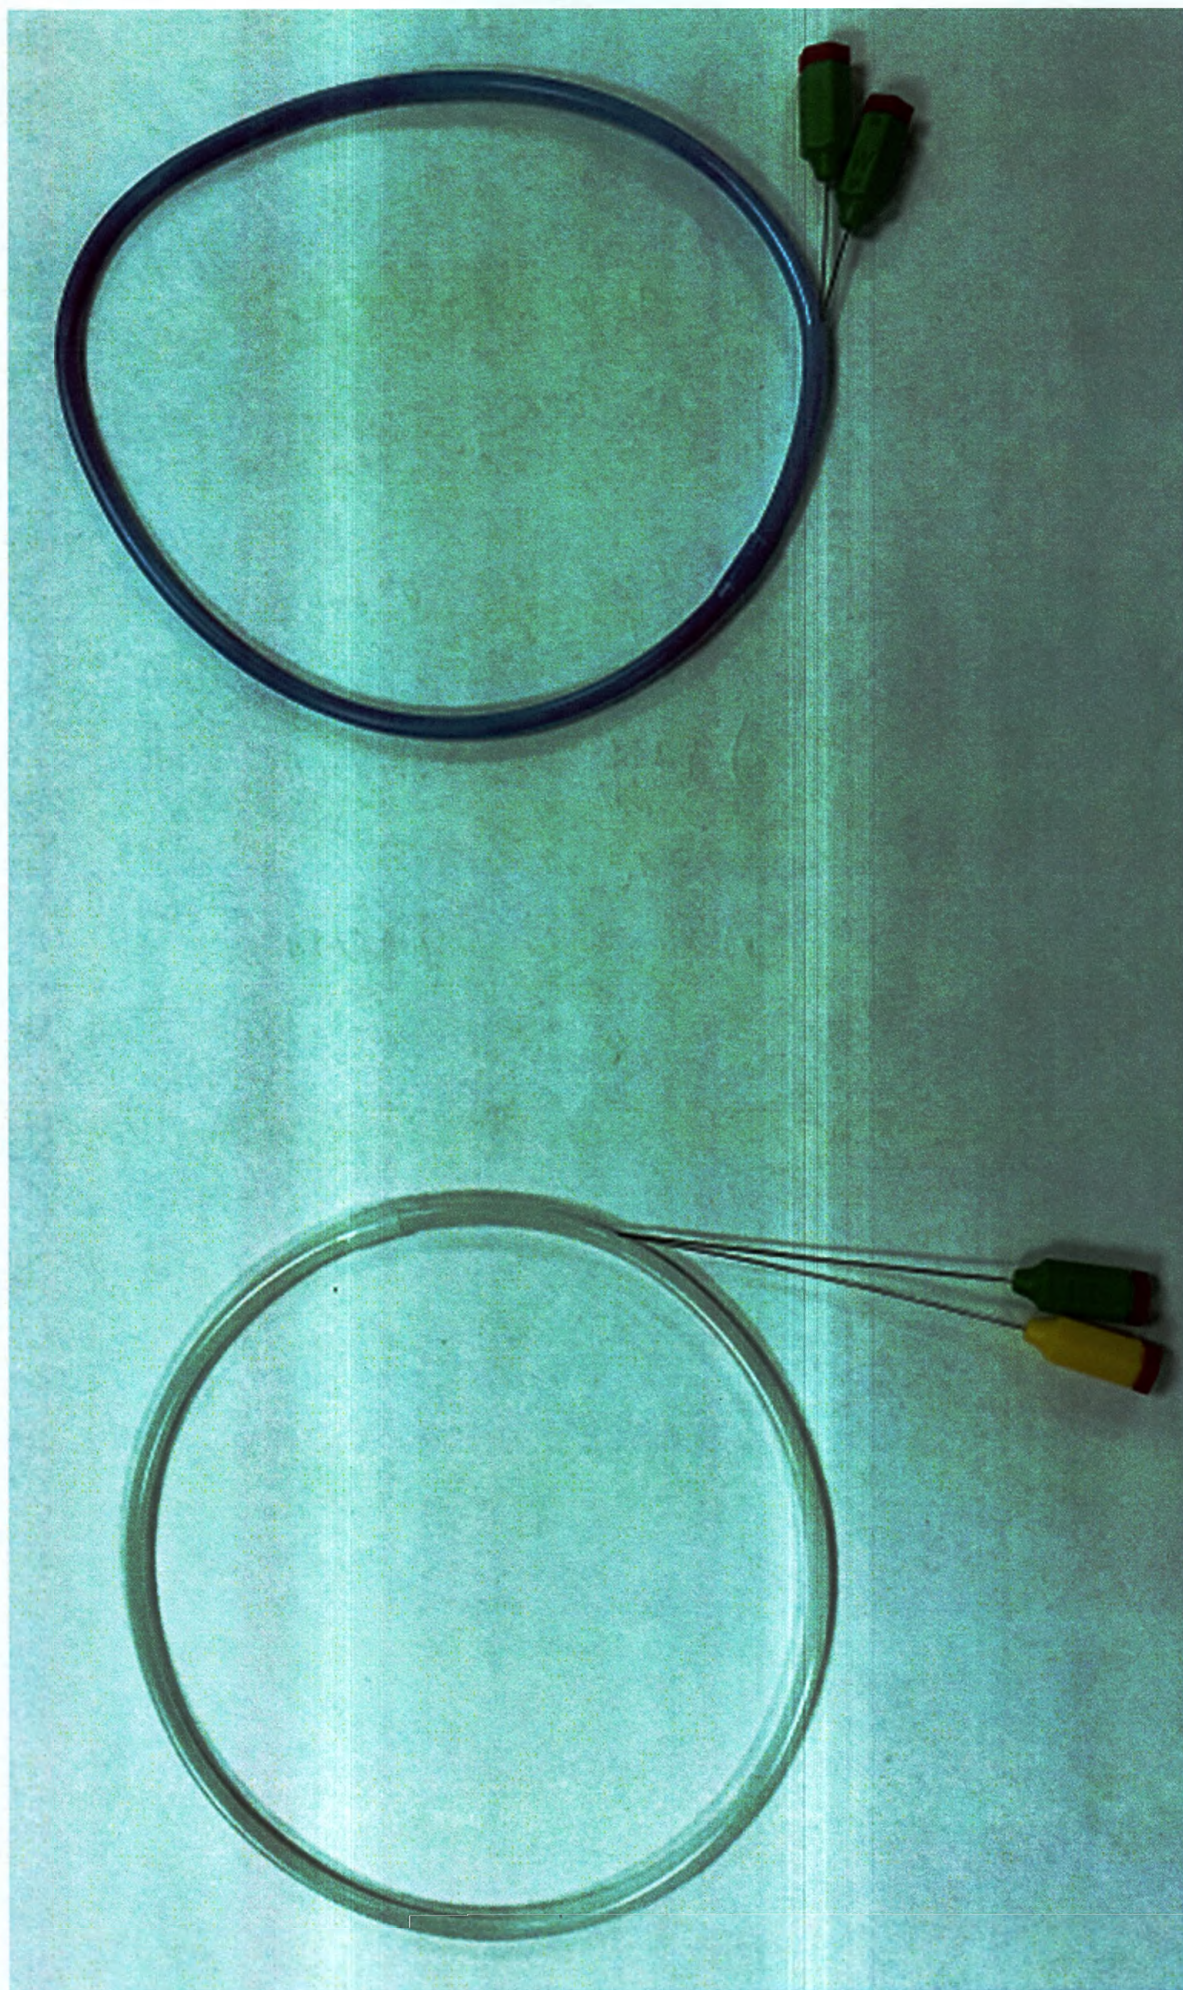

Стилеты

Internal BSC Bar Code
50879126-001

647841-200
92383123-002A

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

**Boston Scientific
INGEVITY™+**

7841

2024-08-26

1194890

52cm

(01)00802526604539
(17)240826(21)1194890

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Boston
Scientific

Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY +
для кардиостимуляции, модель: 7842

РУ № P3H 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для
кардиостимуляции с принадлежностями

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315,

Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2

E-mail: Info-russia@bsci.com

Нетоксично, асептировано

Хранить при температуре 15-30 °C. См. буклет.

INGEVITY™+

REF 7842

2024-08-28

SN 1123223

2022-08-28

59cm

☒ (1)



STERILE EO

MD



RU-test.com



(01)00802526604546(17)240626(21)1123223

647842-200

Вторичная упаковка

INGEVITY™+

REF 7842

2024-08-28

SN 1123223

2022-08-28

59 cm

Pace/Sense Lead

Endocardial, Steroid-eluting, Polyurethane, IROX™-coated Electrodes, MR Conditional, Stylet delivered Lead, Vein pick, Stylets, Stylet guide, Fixation tool, Literature.

6F (2.0 mm) Insertion diameter
Recommended lead introducer
Introducer without guide wire
6F (2.0 mm)
Introducer with guide wire
9F (3.0 mm)

Lead contains 0.91 mg dexamethasone acetate.

CAUTION: Store at 25°C (77°F). Excursions are permitted between 15°C to 30°C (59°F to 86°F). Transportation spikes are permitted up to 50°C (122°F).

If container seal is broken, Boston Scientific will not accept contents for credit or restock.

Made in USA

en

Cable de estimulación/detección

Endocárdica, Elución de esteroide, Poliuretano, Electrodo recubiertos de óxido de iridio (IROX™), MR condicional, Dirigible con estilo.

Cable, elevador de vena, estiloles, conductor del estilo, herramientas de fijación, documentación.

Diámetro de inserción: 6F (2.0 mm)
Introducir de cable recomendado
Introducir sin guía de angioplastia
6F (2.0 mm)
Introducir con guía de angioplastia
9F (3.0 mm)

El cable contiene 0.91 mg de acetato de dexametasona.

PRECAUCIÓN: Almacenar a 25 °C. Se permiten intervalos de temperatura entre 15 y 30 °C. Se permiten picos durante el transporte hasta un máximo de 50 °C.

Si el sellado del envase está roto, Boston Scientific no aceptará el contenido para su bonificación o reemplazo.

Fabricado en EE UU

92383128-003

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA, Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

EU Importer: Boston Scientific International B.V.,
Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

647842-200

92383127-001A

Internal BSC Bar Code

50879124-002

CE 2797

Manufactured at:
Guidant Puerto Rico B.V., a subsidiary of
Boston Scientific Corporation
No. 12, Road 698
Dorado, Puerto Rico 00646



(01)0080252604546(17)240828(21)1123223

Маркировка на вторичной упаковке

Стимулирующий/воспринимающий электрод

Эндокардиальный, со стероидным покрытием, полиуретановый электрод с покрытием IROX™, MR-условно безопасный, доставляемый с помощью стилета.

Электрод, веноподъемник, стилеты, насадка для введения стилета в электрод, инструменты фиксации, документация.

Диаметр введения: 6F (2.0 mm)
Рекомендуемый интродьюсер для электрода
Интродьюсер без направляющей струны
6F (2.0 mm)
Интродьюсер с направляющей струной
9F (3.0 mm)

Электрод содержит 0,91 мг дексаметазона ацетата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранить при температуре 25 °C (77 °F). Допустимы отклонения температуры в диапазоне 15-30 °C (59-86 °F). Допустимы скачки температуры при транспортировке до 50 °C (122 °F).

При повреждении упаковки Boston Scientific не принимает содержимое для возмещения финансовых претензий или возврата на склад.

Сделано в США

12

ru

Stimulačná/snímacia elektróda

Endokardiálna, steroid uvoľňujúca, polyuretánová, póly elektródy potiahnuté IROX™, podmienené kompatibilné s prostredím MR, vedená mandrénou

elektróda, držiak na žilu, mandrény, madrénový vodič, fixačné nástroje, dokumentácia.

Priemer pre zavedenie 6F (2.0 mm)
Odporičaný zvädzač elektródy
Zvädzač bez vodiaceho drôtu
6F (2.0 mm)
Zvädzač s vodiacim drôtom
9F (3.0 mm)

Elektróda obsahuje 0,91 mg deksexmetazonacetátu.

UPOZORNENIE: Skladujte pri teplote 25 °C (77 °F). Odchýlky sú povolené v rozmedzí 15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F). Počas prepravy sú povolené výkyvy do 50 °C (122 °F).

Ak je uzáver obalu porušený, spoločnosť Boston Scientific nebude akceptovať škody o výmery obsahu balenia alebo finančnú náhradu.

Vyrobené v USA

sk

Elektroda za spodbujanje/zaznavanje

Endokardialne, poluretanse elektrode s premazom IROX™, ki omogoča elucijo steroidov in so pogojno primerne za slikanje z MR ter se dovajajo prek sonde

Elektroda, venična šilo, sonda, vodilo sonde, orodja za pritrditev, literatura

Priemer za vstavljanje 6F (2.0 mm)
Prilporučeno uvajajo elektrode
Uvajalo brez vodilne žice
6F (2.0 mm)
Uvajalo z vodilno žico
9F (3.0 mm)

Elektroda vsebuje 0.91 mg deksexmetazon acetata.

POZOR: Shranjujte pri temperaturi 25 °C (77 °F). Dovoljena so odstopanja od 15 °C do 30 °C (59 °F do 86 °F). Temperatura pri transportu se lahko povzra do 50 °C (122 °F).

Če je pečat vsebnika pretrgan, družba Boston Scientific ne bo sprejela vsebine za obnovo ali zamenjavo.

Izdelano v ZDA

sl

Stimulerings-/afkenningselektrode

Endokardiel, steroidafkennende, polyuretan, IROX™-belagde elektroden, MR met uitsluiting, stylenetgeveerd

Elektrode, venele, stijl, sonde, stijlgeveerd, vasthoudings, documentatie.

Invoerdiameter 6F (2.0 mm)
Bevallen elektrode
Introducer utan ledare
6F (2.0 mm)
Introducer med ledare
9F (3.0 mm)

Elektroden innehåller 0.91 mg deksexmetazonacetat.

FÖRSICHTIGHEIT: Försvara i 25 °C (77 °F). Avvikelse tillåts mellan 15 °C och 30 °C (59 °F och 86 °F). Tillåtna transporttemperaturer tillåts upp till 50 °C (122 °F).

Om behållarens försegling är bruten tar Boston Scientific inte emot innehåll för återbruk eller byte.

Tillverkad i USA


13

Буклет на коробке на русском языке


Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для кардиостимуляции, модель: 7842



Первичная упаковка

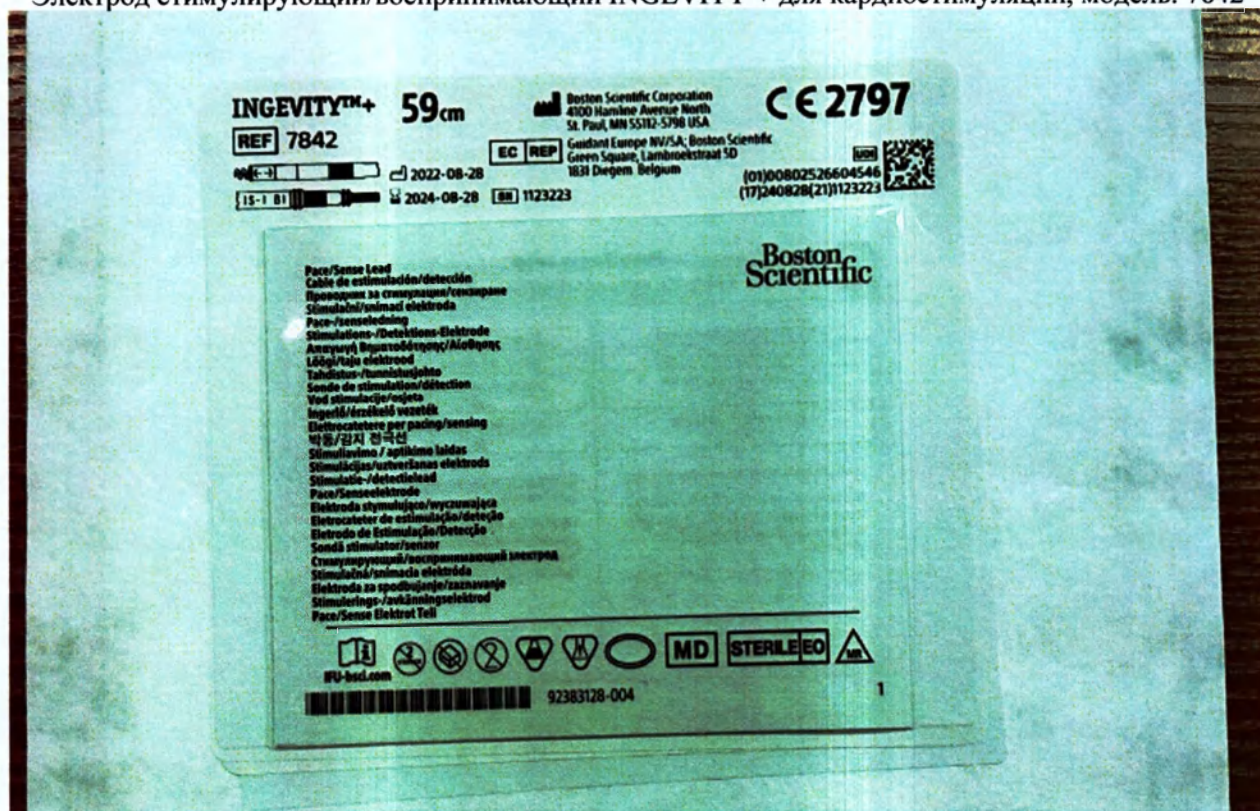

Маркировка на первичной упаковке

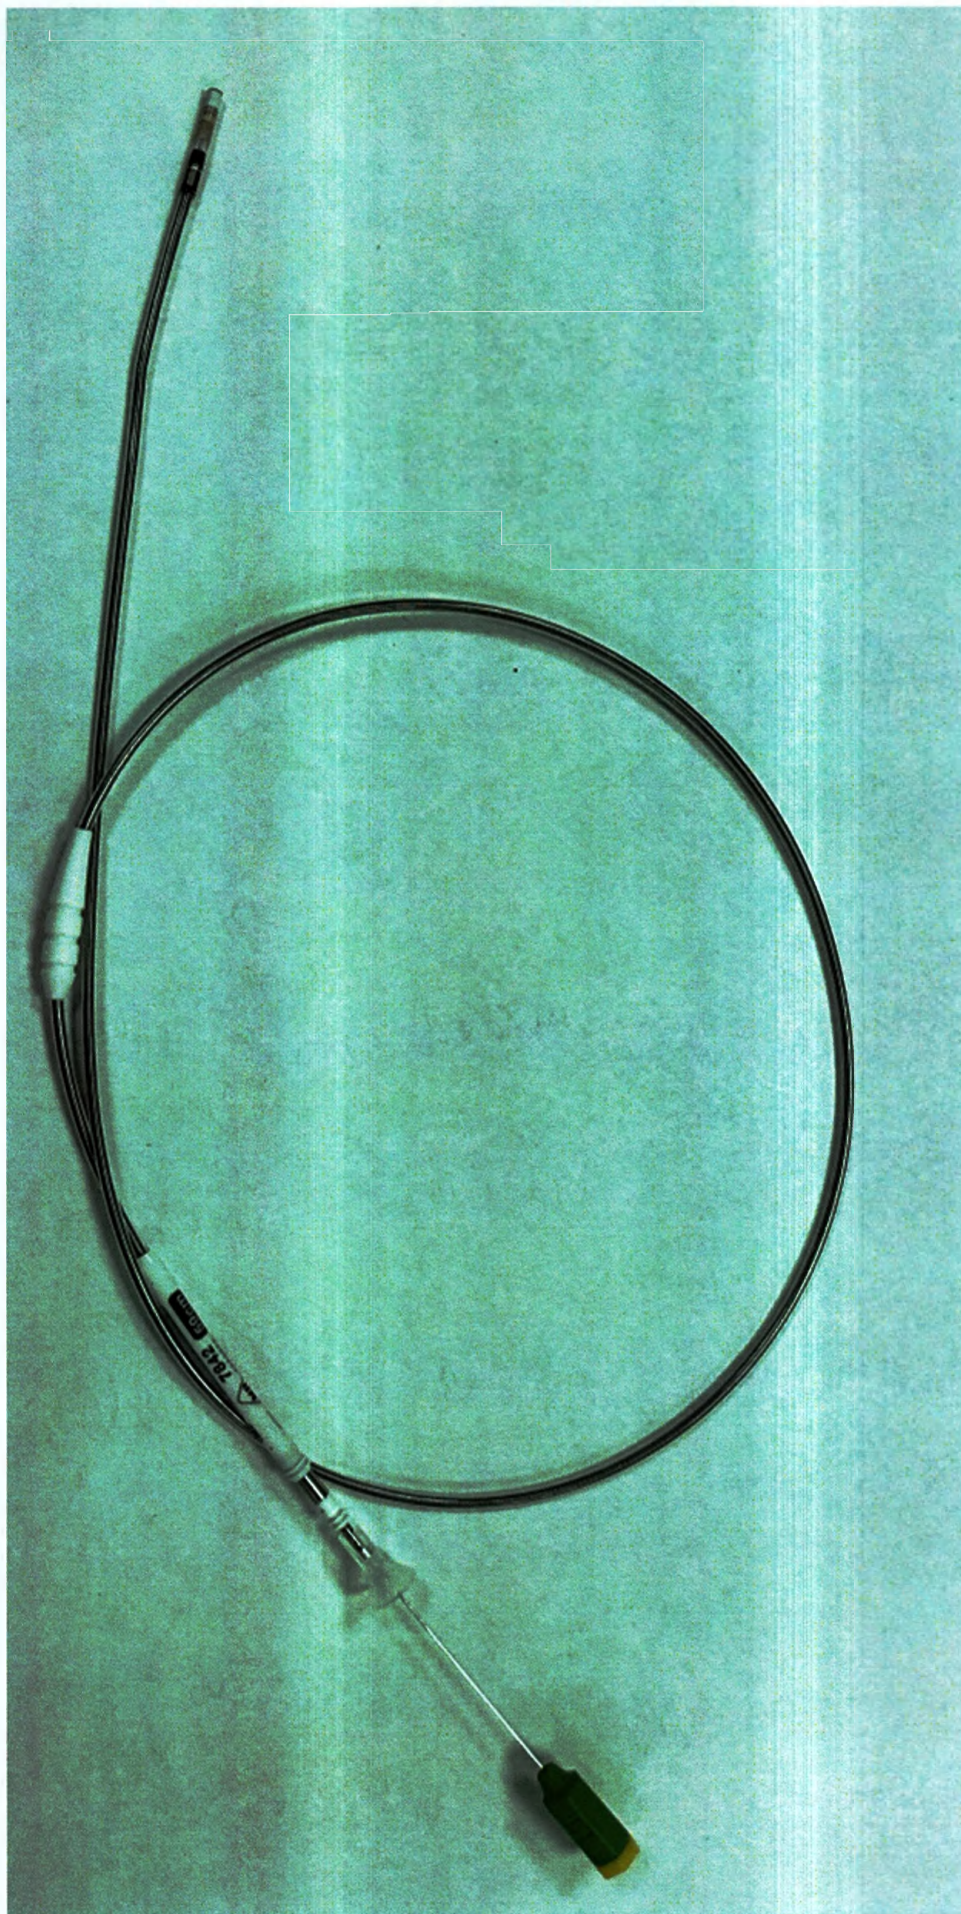

Электрод;




Маркировка на электроде



Веноподъемник




Насадка для введения стилета в электрод

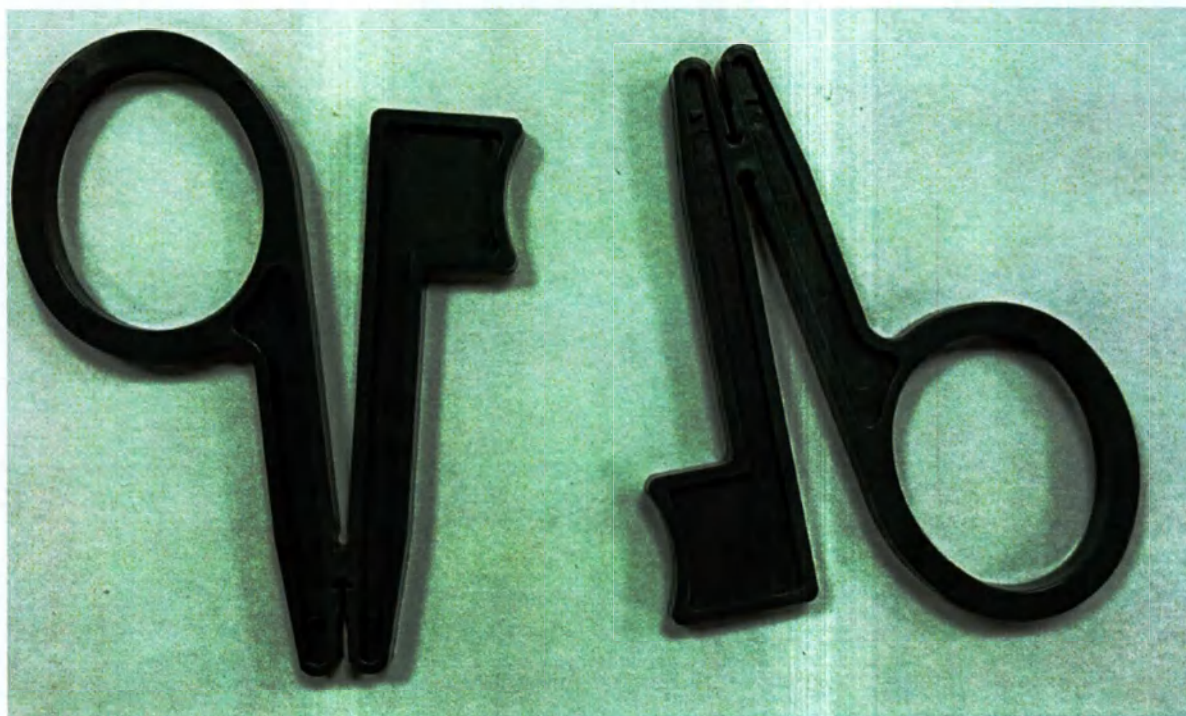


Инструмент фиксации


Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY + для кардиостимуляции, модель: 7842

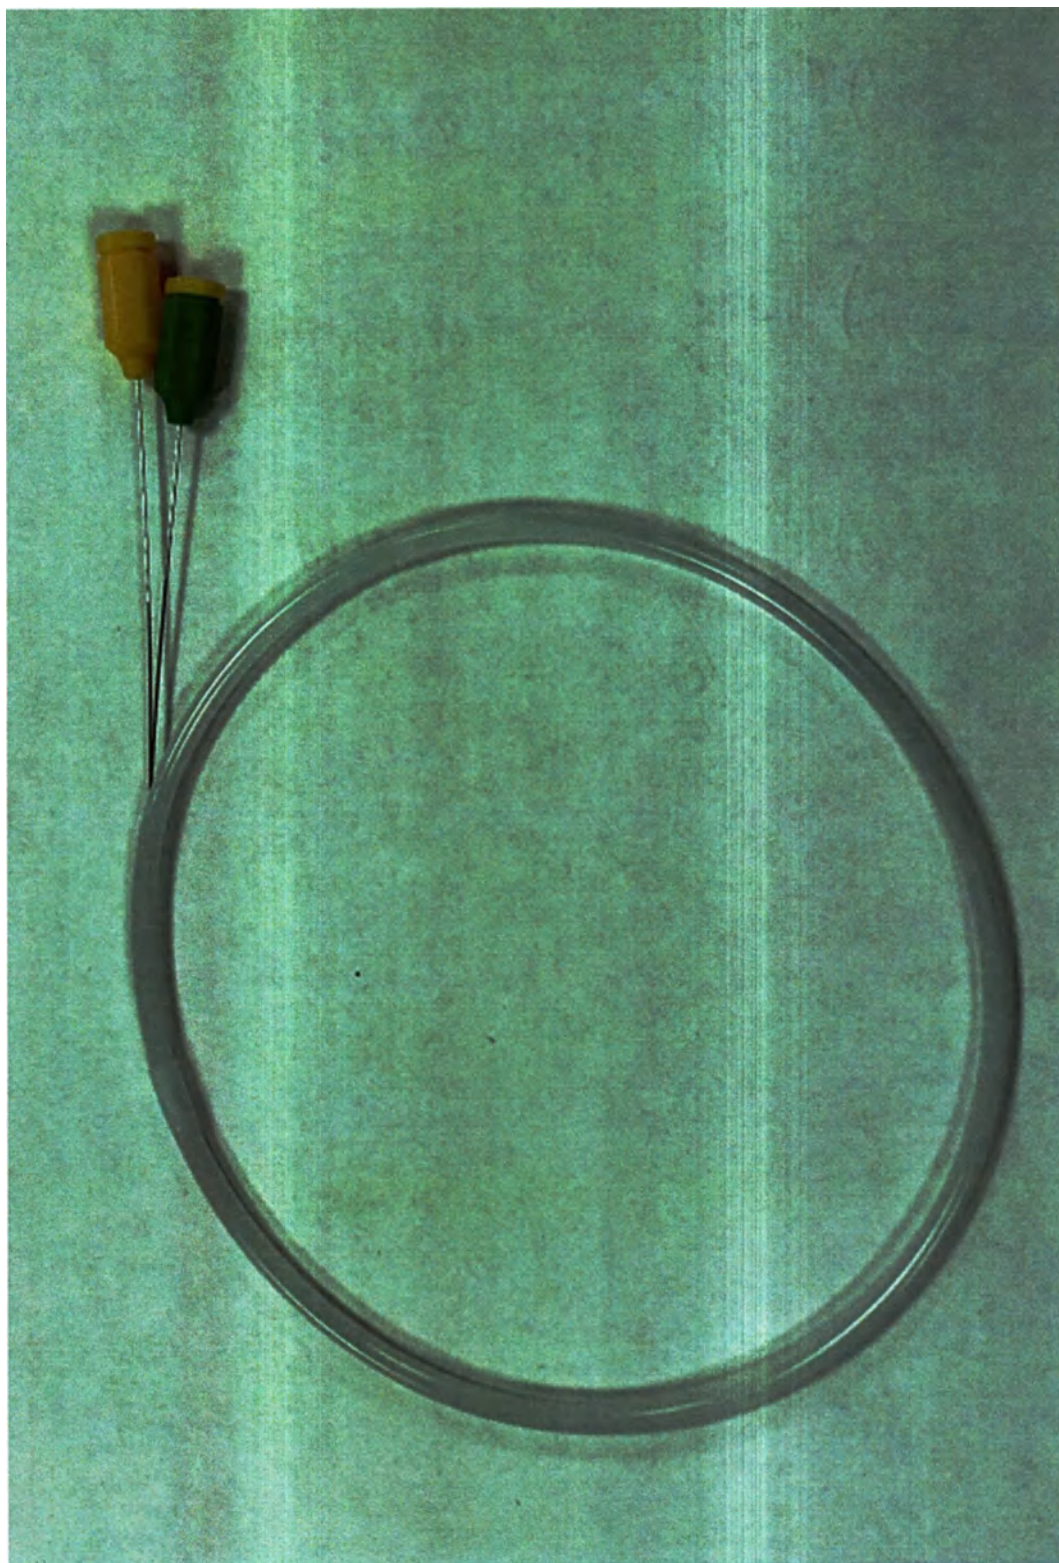

Стилеты

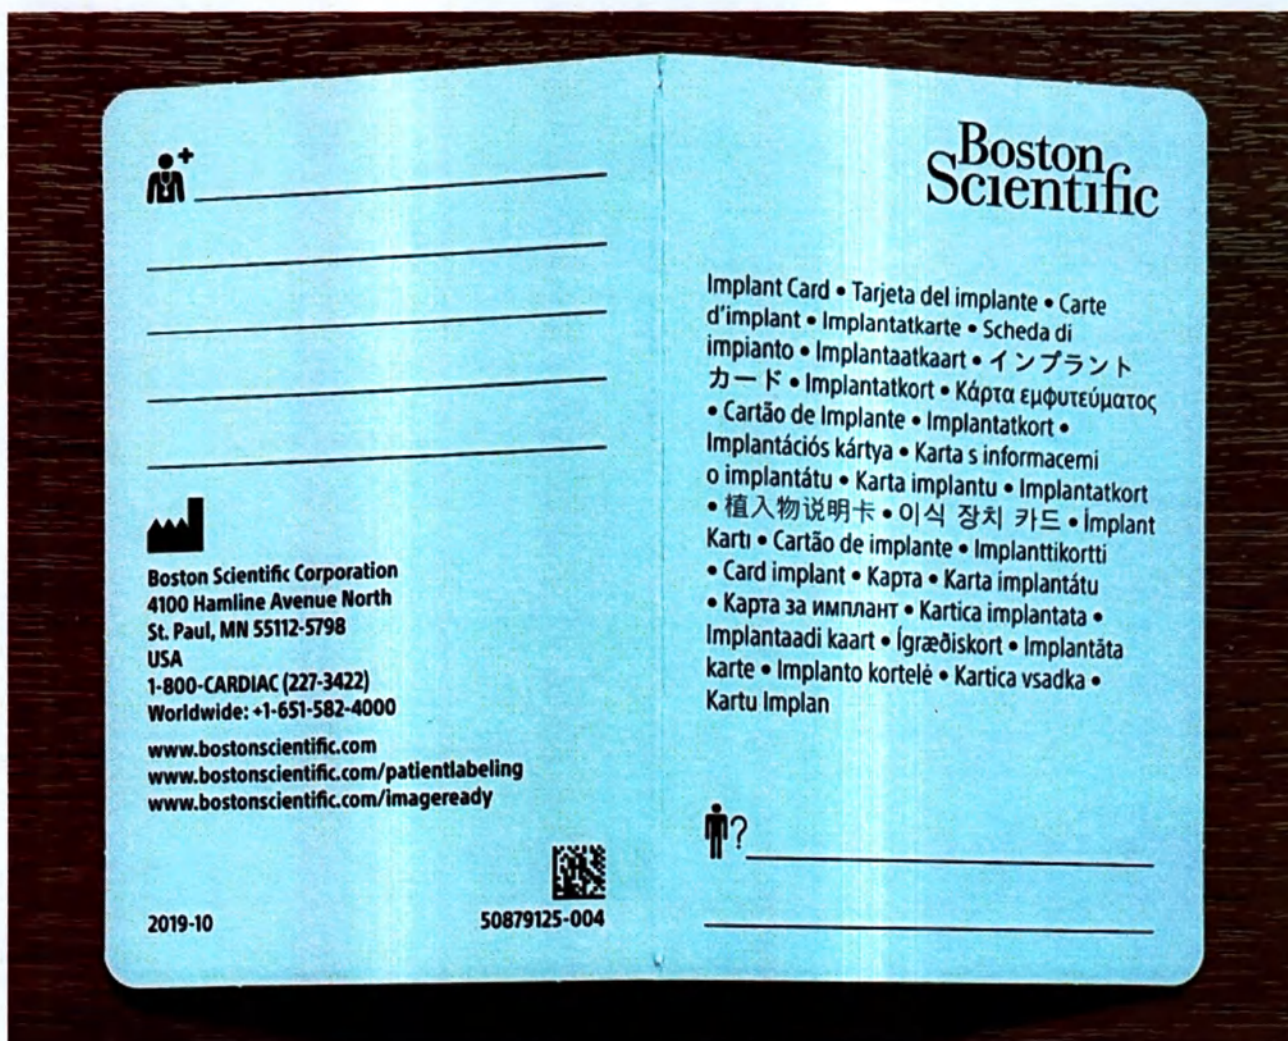

Карточка имплантата

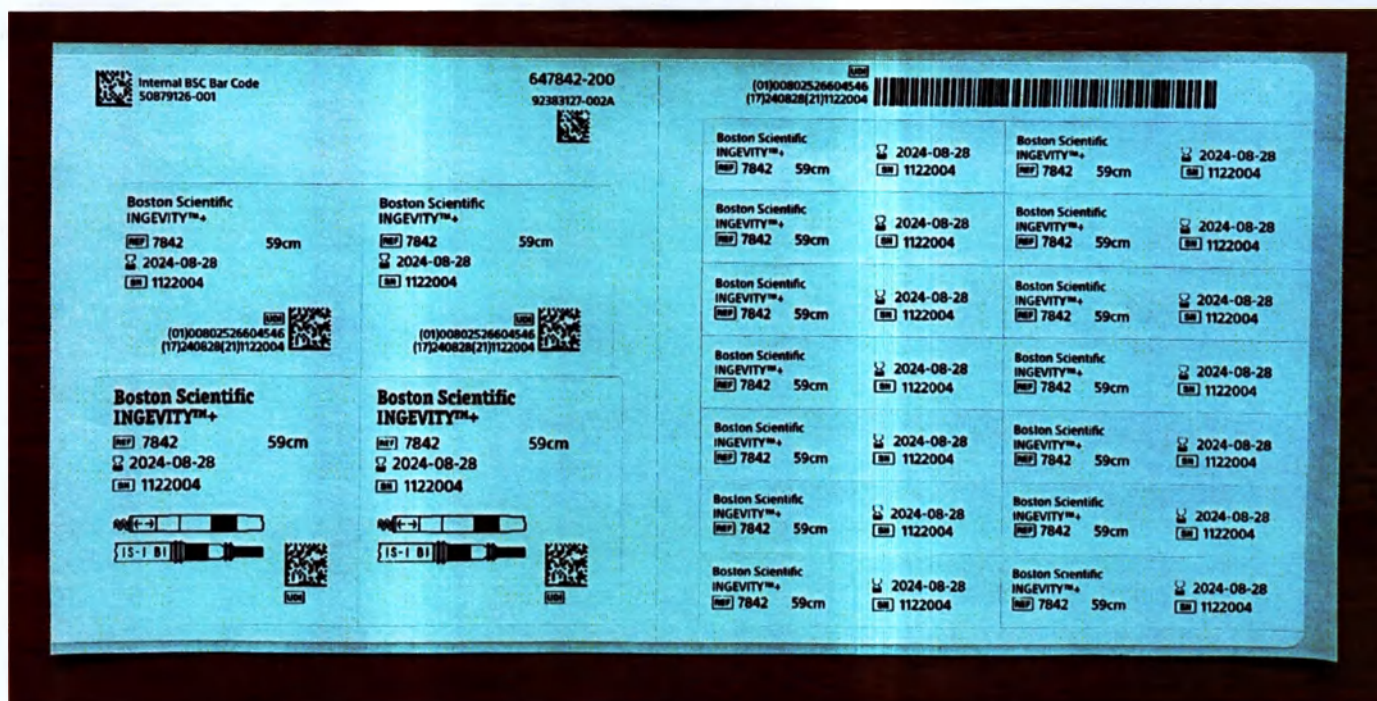


Наклейки



Общий вид принадлежности

Стилет длиной 45 см, модель 5012

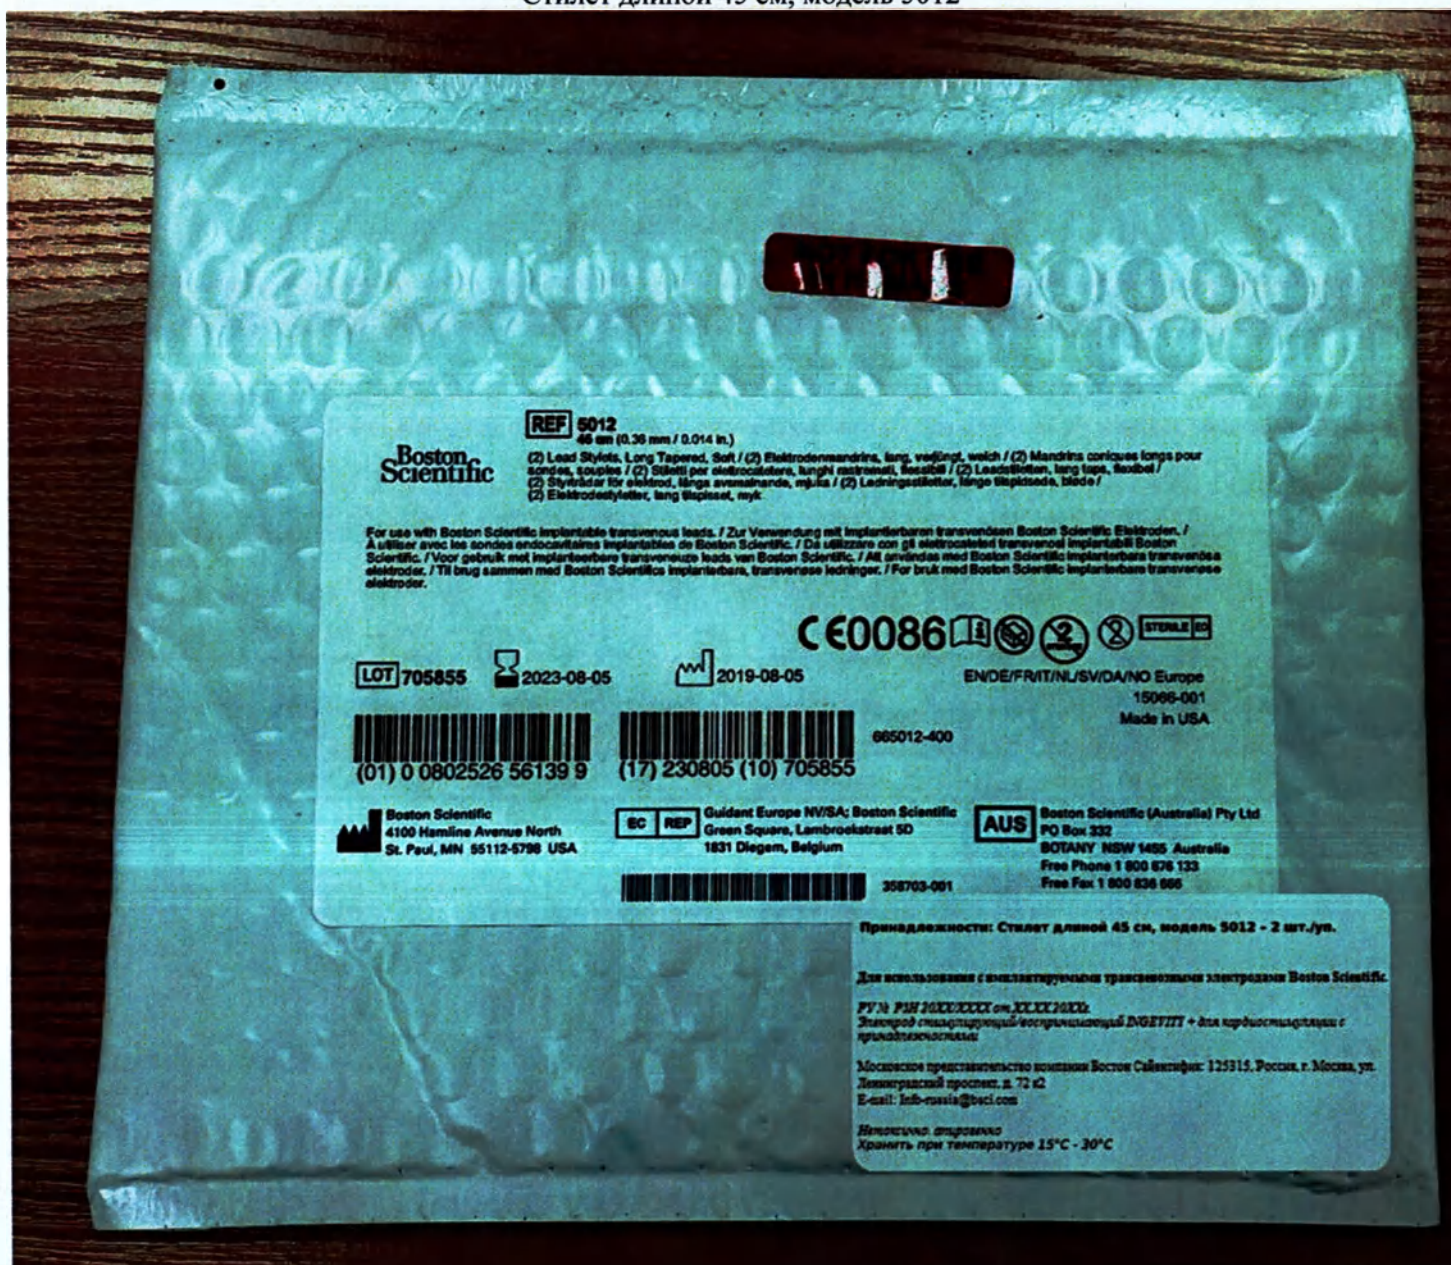

**Boston
Scientific**

REF 5012

45 cm (0.36 mm / 0.014 in.)

(2) Lead Stylets, Long Tapered, Soft / (2) Elektrodenmandrins, lang, vejrgjort, weich / (2) Mandrins coriques longs pour
sondes, souples / (2) Stijlen per elektrocateter, lang, uitgerekt, flexibel / (2) Leadstijlen, lang, zacht, flexibel /
(2) Stijlen voor elektrocateter, lang, uitgerekt, flexibel / (2) Ledingestijlen, lang, uitgerekt, flexibel /
(2) Elektrodestijlen, lang, uitgerekt, myk.

For use with Boston Scientific implantable transvenous leads. / Zur Verwendung mit implantierbaren transvenösen Boston Scientific Elektroden. /
À utiliser avec les sondes endocavitaires implantables de Boston Scientific. / Da utilizzare con gli elettrocateter transvenosi implantabili Boston
Scientific. / Voor gebruik met implanteerbare transvenieuze leads van Boston Scientific. / All användas med Boston Scientific implanterbara transvenösa
elektroder. / Til brug sammen med Boston Scientifics implanterbare, transvenøse ledninger. / For bruk med Boston Scientifics implanterbare transvenøse
elektroder.

CE0086     

LOT 705855

 2023-08-05

 2019-08-05

ENDE/FRUIT/NL/SV/DA/NO Europe

15068-001

Made in USA



(01) 0 0802526 56139 9



(17) 230805 (10) 705855

065012-400

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Gulden Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1485 Australia
Free Phone 1 800 878 133
Free Fax 1 800 838 965



308703-061

Принадлежности: Стилет длиной 45 см, модель 5012 - 2 шт./уп.

Для использования (имплантируемых) транскатетерных электродов Boston Scientific.


RV N RVN 20XXXXXX cm XXXX20XX

Экземпляр стандартной упаковки INGET777 + для идентификации с принадлежностями

Московское представительство компании Boston Сайентифик: 125315, Россия, г. Москва, ул.
Ленинградский проспект, д. 72 к2
E-mail: info-russia@bsci.com

Неоткрытое устройство
Хранить при температуре 15°C - 30°C

Стилет длиной 45 см, модель 5012

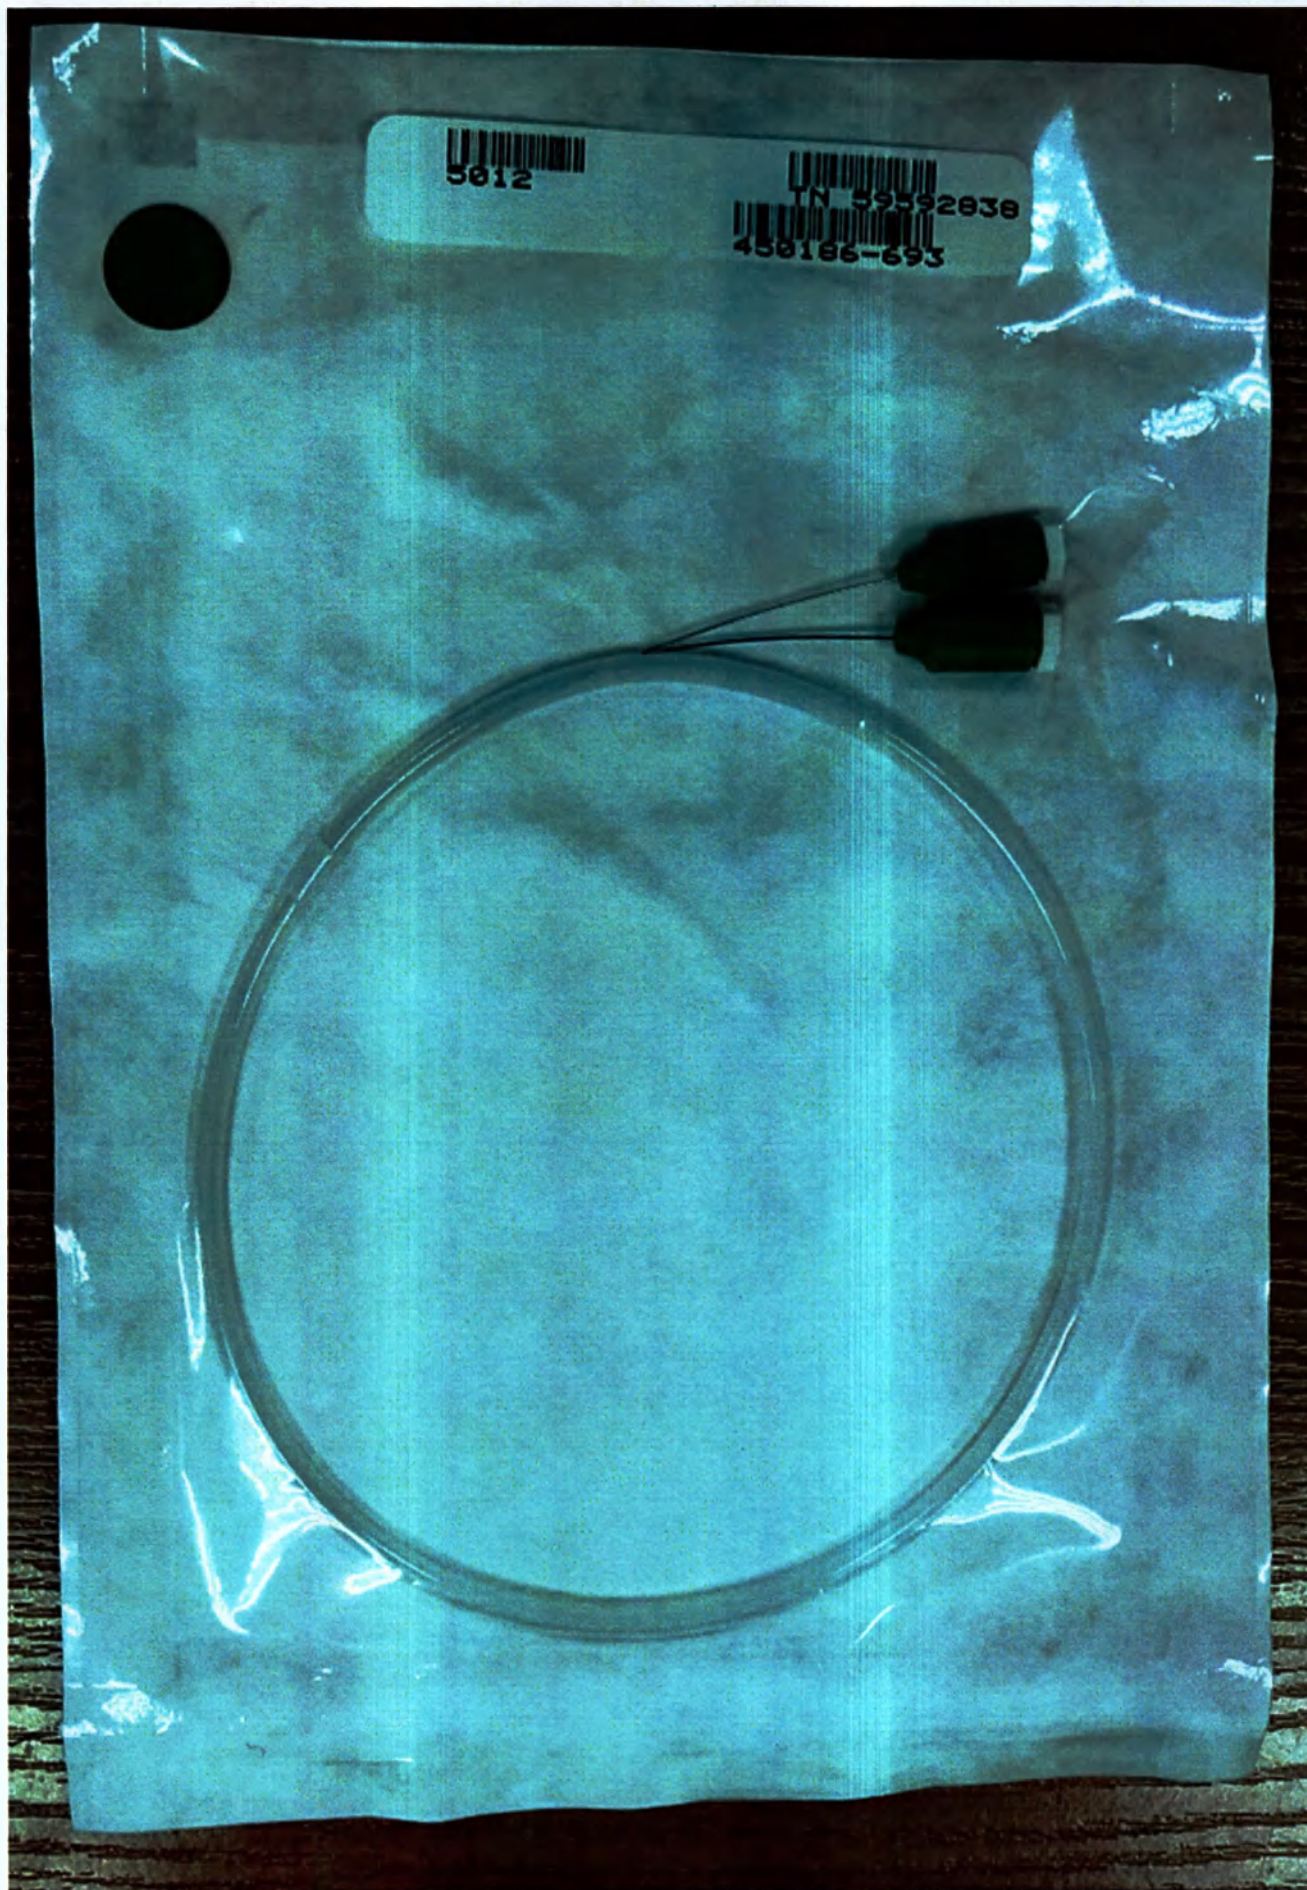

Общий вид принадлежности

Стилет длиной 52 см, модель 5013

Принадлежности: Стилет длиной 52 см, модель 5013 - 2 шт./уп.

Для использования с имплантируемыми трансвенозными электродами
Boston Scientific.

Р/У № Р/УН 20XX/XXXX см. XXXX 20XX

Электрод стимулирующий/восприимчивый INGEVITI + для
кардиостимуляции с принадлежностями

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315, Россия, г.
Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2
E-mail: info-russia@bsci.com

Нестерильно, асептично
Хранить при температуре 15°C - 30°C

**Boston
Scientific**

REF 5013
52 cm (0.36 mm / 0.014 in.)

(2) Lead Stylets, Long Tapered, Soft / (2) Elektrodenmandrins, lang, verjüngt, weich / (2) Mandrins coniques longs
pour sondes, souples / (2) Stiletti per elettrocateteri, lunghi rastremati, flessibili / (2) Leadstiletten, lang taps, flexibel /
(2) Styrtråder för elektrod, långa avsmalnande, mjuka / (2) Ledningsstiletter, lange tåspissede, bløde / (2) Elektrodestyler,
lang tåspisset, myk

For use with Boston Scientific implantable transvenous leads. / Zur Verwendung mit implantierbaren transvenösen Boston Scientific Elektroden. /
À utiliser avec les sondes endocavitaires implantables de Boston Scientific. / Da utilizzare con gli elettrocateteri transvenosi implantabili Boston
Scientific. / Voor gebruik met implantaerbare transvenieuze leads van Boston Scientific. / Att användas med Boston Scientific implantärbare transvenösa
elektroder. / Til brug sammen med Boston Scientifics implanterbare, transvenøse ledninger. / For bruk med Boston Scientific implanterbare transvenøse
elektroder.

CE 2797       **STERILE EO**

LOT 708692

 2026-03-21

 2022-03-21

EN/DE/FR/IT/NL/SV/DA/NO Europe

15067-001

Made in USA



(01) 0 0802526 56142 9



(17) 260321 (10) 708692

665013-400

 **Boston Scientific**
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium



358703-001


AUS Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 636 666


Стилет длиной 52 см, модель 5013



Общий вид принадлежности

Стилет длиной 59 см, модель 5014

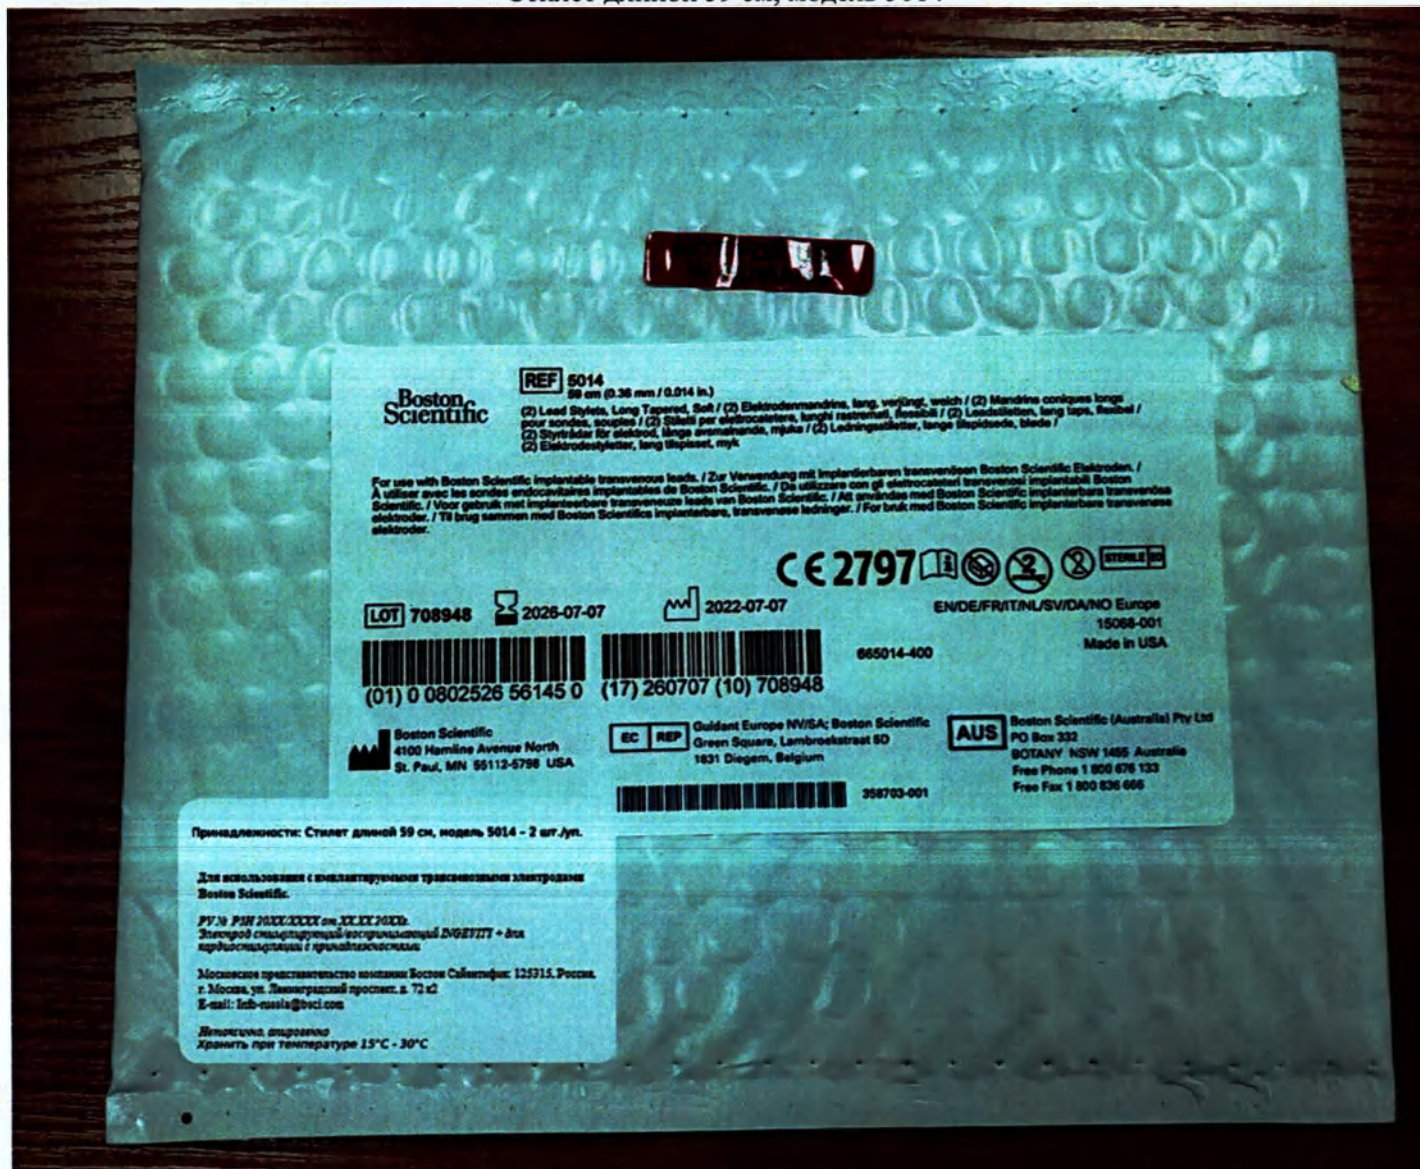

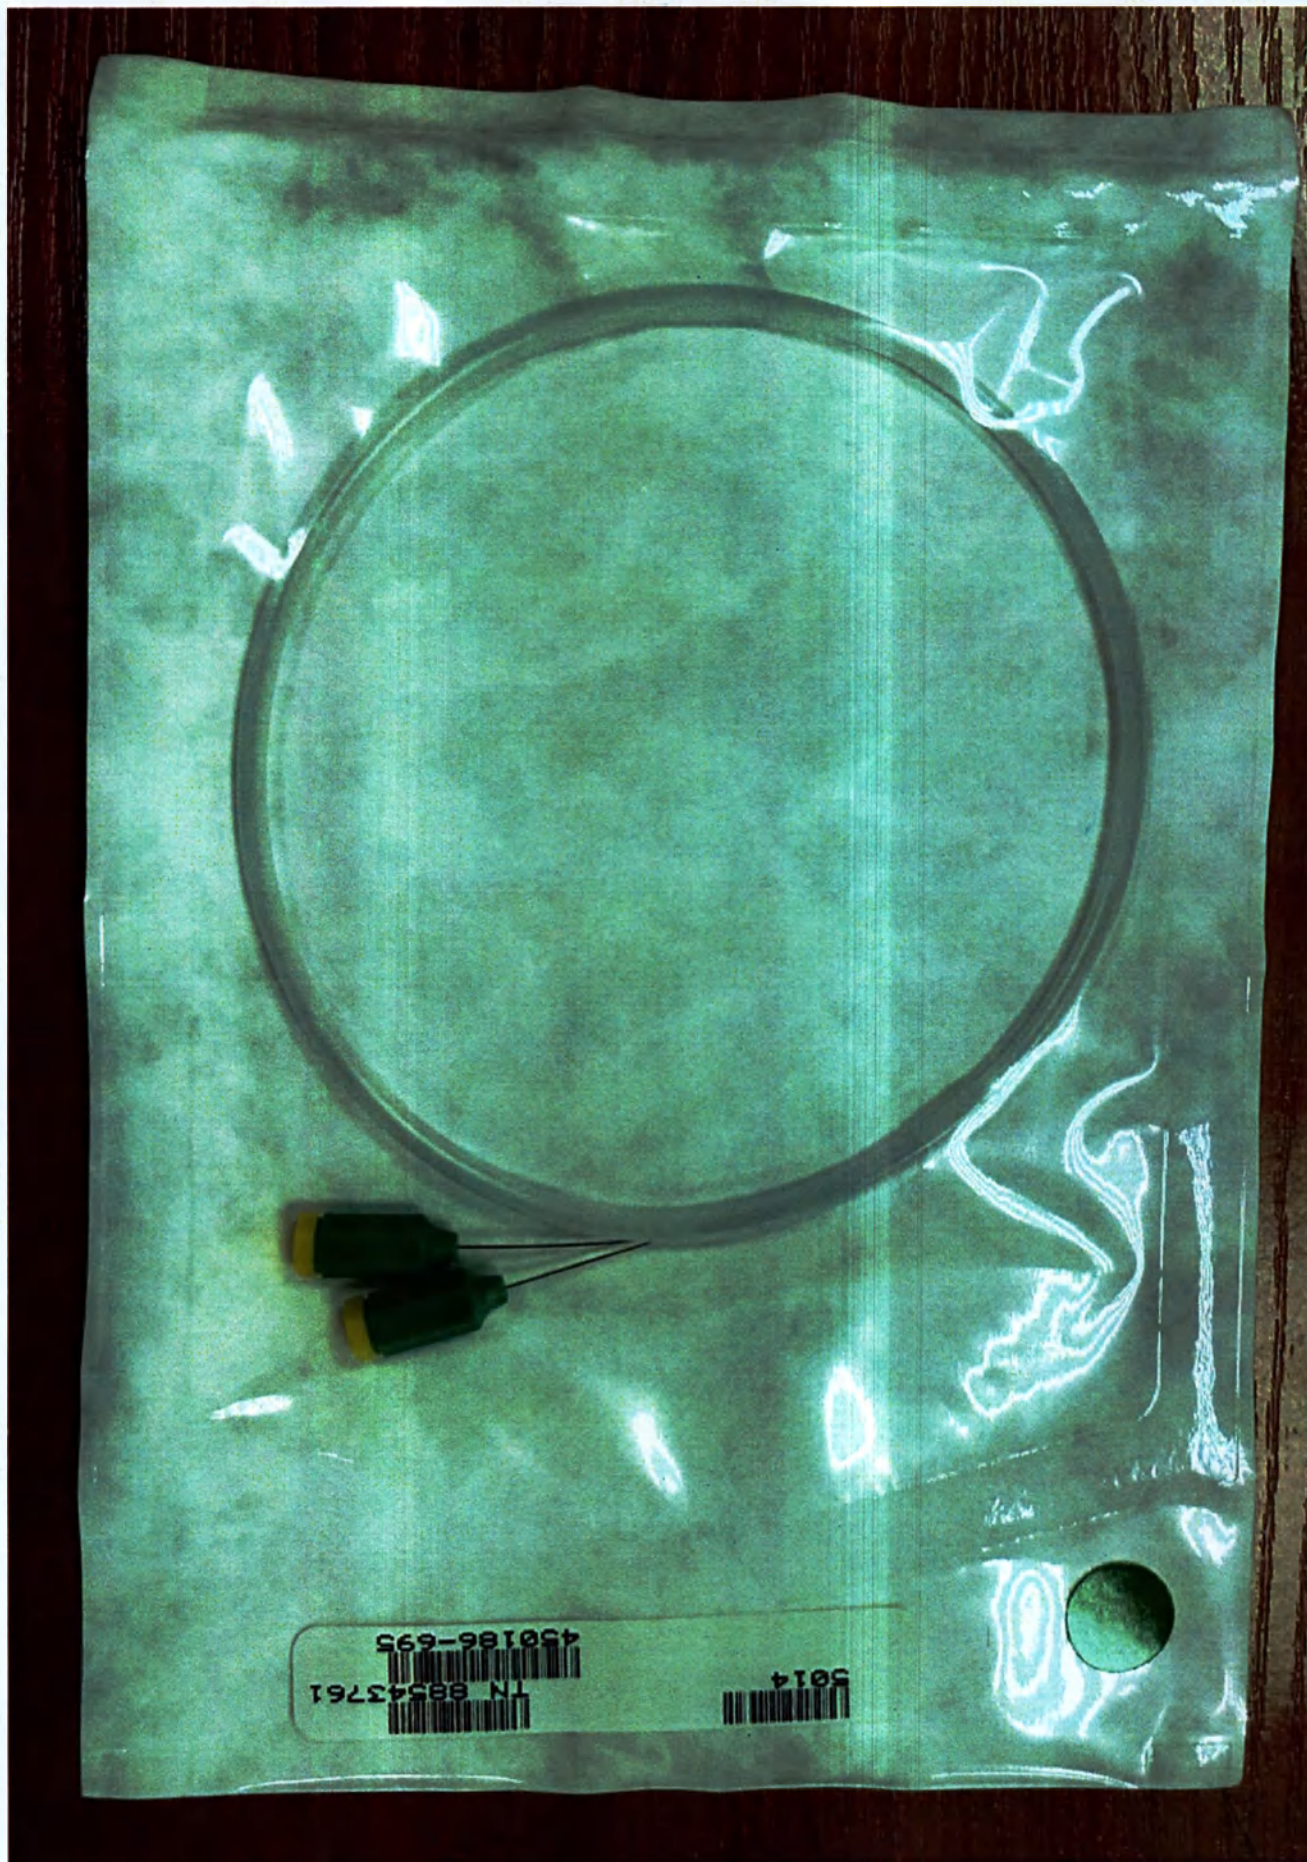

Общий вид принадлежности

Веноподъемник, модель 6541.

Применение: Веноподъемник, модель 6541.

Применение для: Веноподъемник, модель 6541.

Р/М РН 2020/0001 от 2020/0001
Заказчик: ООО "Системы безопасности" (ИНН 77/07/0001) - для профилактики

Медицинское предприятие ООО "Системы безопасности" 125315, Россия, г.

Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72/2

E-mail: info-cs@csd.com

Датировать, отгрузить

Хранить при температуре 15°C - 30°C

REF 6541

Boston Scientific

Vein Pick / Venenhalter / Chausse-veine / Dilata-veine / Venenhalter / Venenhalter

Use to open vein location before placing lead's electrode up into vein. / Zur Öffnung einer Venenstelle, bevor die Elektrodenkatheter in die Veine eingeführt wird. / Surt à ouvrir l'endroit où se trouve la veine avant d'y introduire l'électrode. / Usare per aprire la sede della vena prima di posizionare la punta dell'elettrodo dell'elaborazione. / Gebruik voor het openen van de vena-locatie voordat de elektrode wordt geplaatst. / Aankende für die Öffnung der Venenstelle, bevor die Elektrodenkatheter in die Veine eingeführt wird. / Aankende für die Öffnung der Venenstelle, bevor die Elektrodenkatheter in die Veine eingeführt wird. / Aankende für die Öffnung der Venenstelle, bevor die Elektrodenkatheter in die Veine eingeführt wird.

CE 2797

LOT 708860

2026-05-25

2022-05-25

ENDEFRUITING/VIDAANO Europe

14639-003

Made in USA

606541-402

(17) 260525 (10) 708860

(01) 0 0802526 50052 7

Green Square, Lambourn Road

4100 Hamline Avenue North

1831 Dieren, Belgium

St. Paul, MN 55112-5798 USA

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd

P.O. Box 332

BOTANY NSW 1485 Australia

Free Phone 1 800 878 132


Free Fax 1 800 826 806

30703-001



Общий вид принадлежности

2)





Общий вид принадлежности

Инструмент фиксации, модель 6616

Принадлежности: Инструмент фиксации, модель 6616.

Предназначено для использования с электродами компании Boston Scientific с концевым штырем, управляющий выкручиваемой/выкручиваемой спиралью

Р/У № Р/Н 20XX/XXXX от XXXX 20XX
Электрод стимулирующий/воспринимающий INGEVITY® для кардиостимуляторов с принадлежностями

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315, Россия,
г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2
E-mail: info-russia@bsci.com

Неокисляемая, апирогенная
Хранить при температуре 15°C - 30°C

**Boston
Scientific**

REF 6616

(1) Fixation tool / (1) Fixierwerkzeug / (1) Outil de fixation / (1) Strumento di fissaggio / (1) Fixatiehulpmiddel /
(1) Fixeringsverktøj / (1) Fikseringsverktøj / (1) Fikseringsverktøy

Use with Boston Scientific leads with a terminal-pin driven extendable/retractable helix. / Für die Verwendung mit Elektroden von Boston Scientific mit einer über den Anschlusstift aus-/einziehbarer Schraube. / Utiliser avec des sondes Boston Scientific en association avec une vis rétractable munie d'une broche terminale. / Utilizzare con gli elettrocateteri Boston Scientific con vite estraibile/retraibile guidata da pin terminale. / Gebruiken in combinatie met Boston Scientific-leads met een door de connectorpin aangedreven in- en uitdraaibare schroef. / Används med elektroder från Boston Scientific med en in-futskruvbar skruv som styrs av ett anslutningsstift. / Til brug med Boston Scientific-ledninger med en konektorstift-drevet skru-indtrækbar spiral. / Brukes med Boston Scientific-elektroder som har en terminalpluggdrevet forlengbar/tilbaketrekkelig skruv.

LOI 708877

2026-06-06

2022-06-06

CE 2797

ENDE/FR/ITAL/SV/DANO Europe
16037-001
Made in USA

(01) 0 0802526 57440 5 (17) 260606 (10) 708877

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP


Guidans Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1631 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 876 133
Free Fax 1 800 836 666

358703-001

Инструмент фиксации, модель 6616

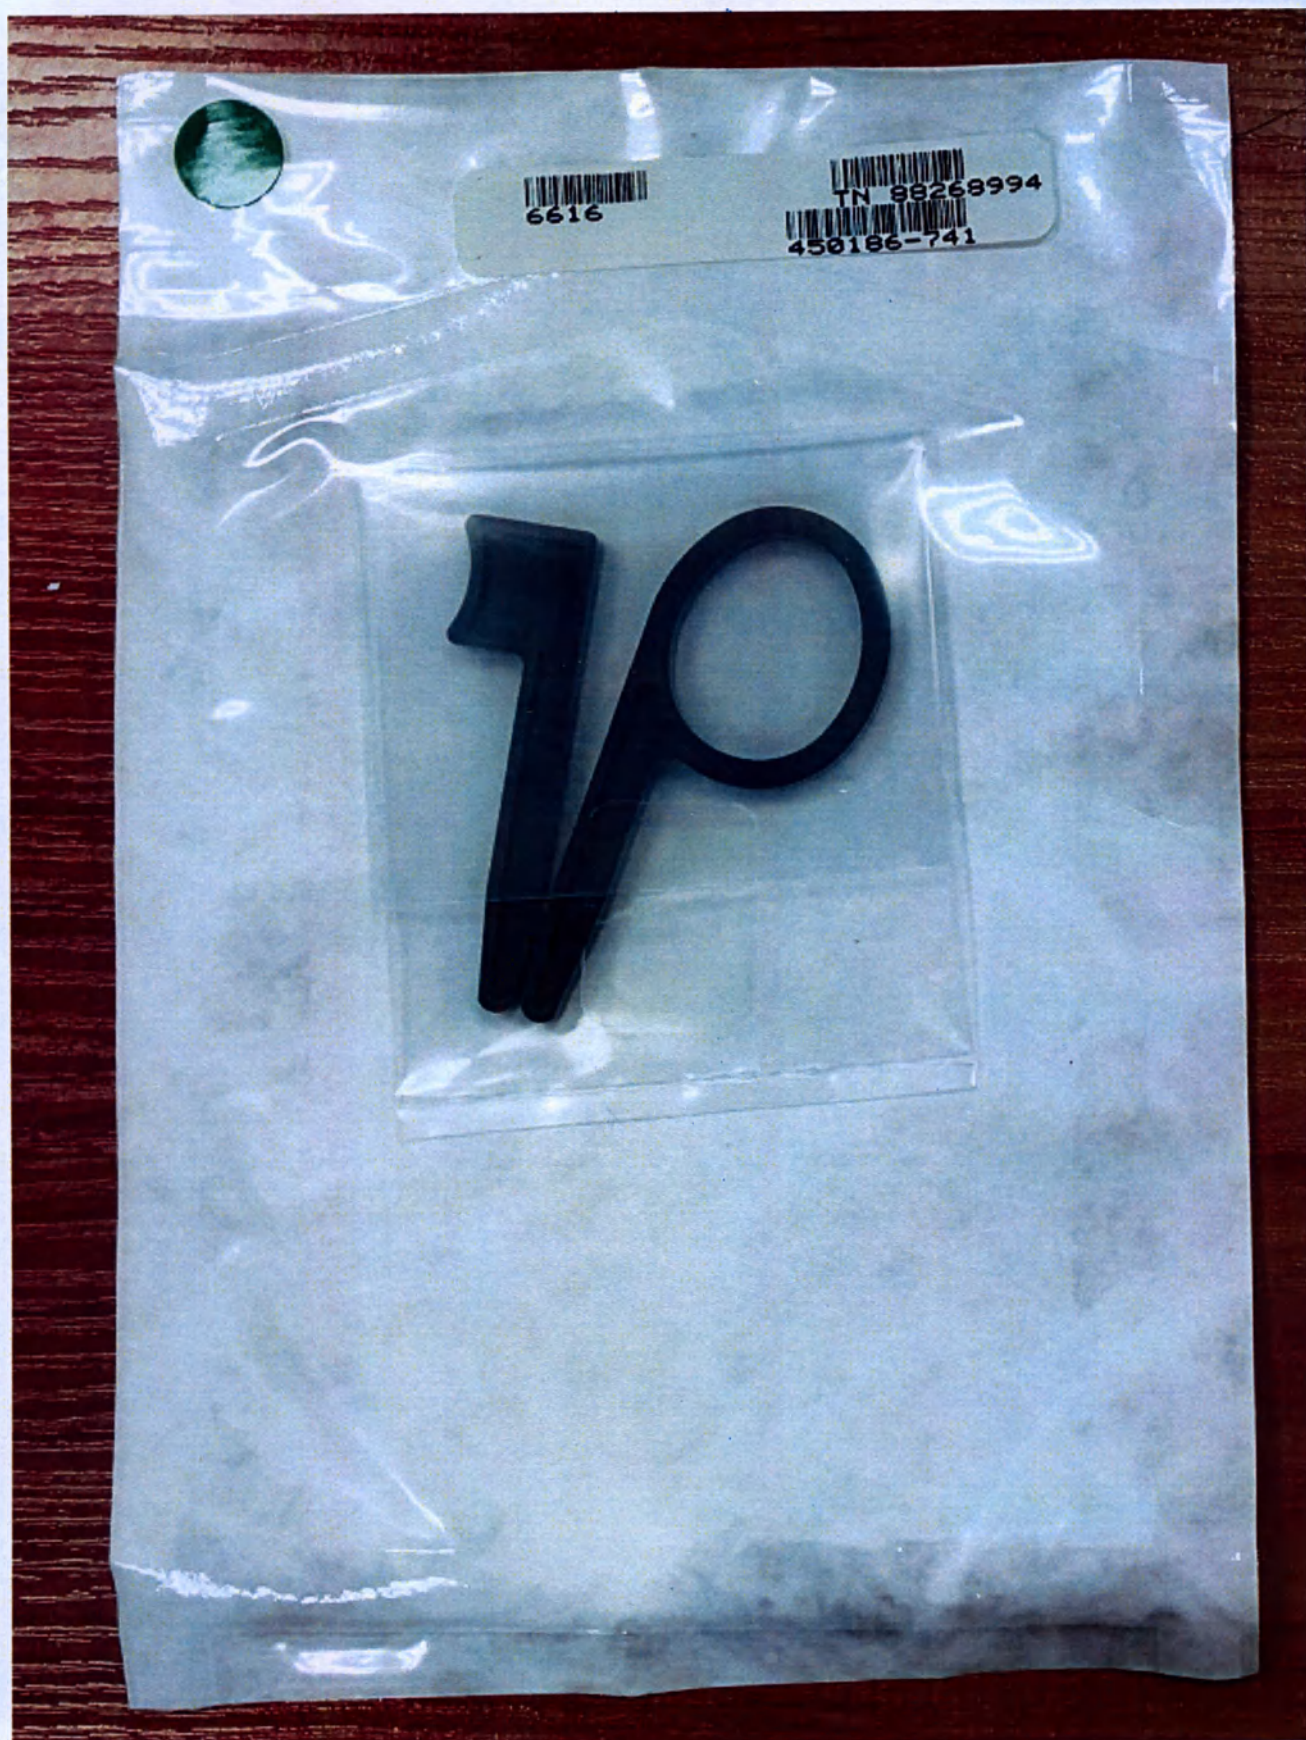

Общий вид принадлежности

Прошито, пронумеровано
(39 лист(ов))
скреплено печатью

