


Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PlGF) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PlGF cobas e analyzers/PLGF)

Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PIGF) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PIGF cobas e analyzers/PLGF)



Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PIGF) в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PIGF cobas e analyzers/PLGF)

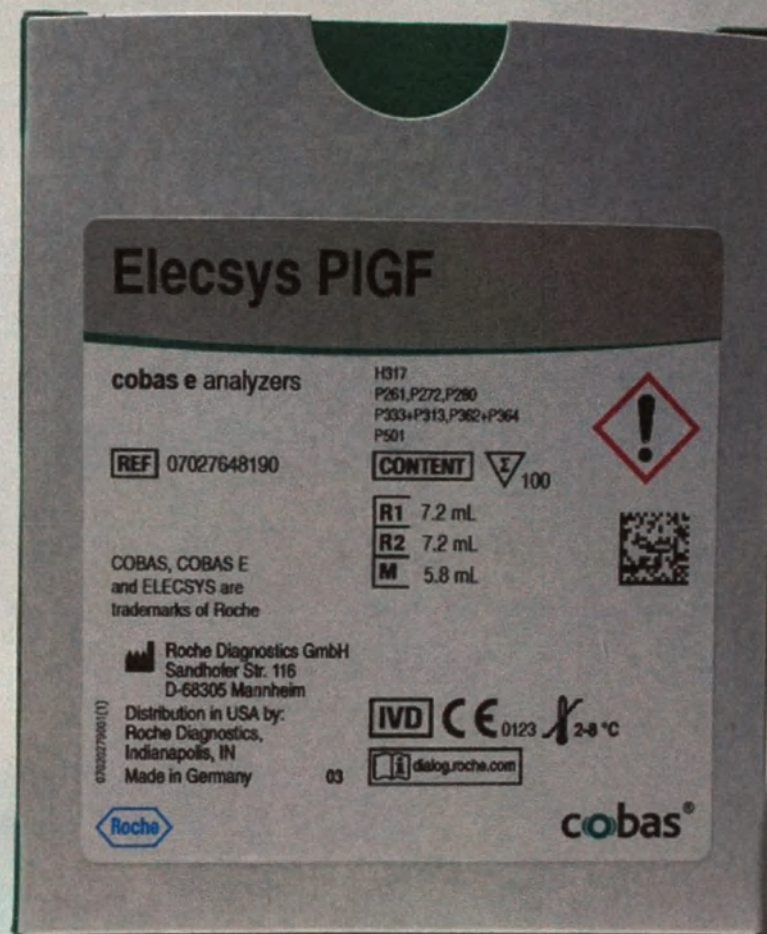

Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PLGF) в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PLGF cobas e analyzers/PLGF)



Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PIGF) в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PIGF cobas e analyzers/PLGF)

Elecsys PIGF

REF 07027648190

For **USA:** **CONTENT**

- R1** Biotinylated monoclonal anti-PIGF antibody (mouse) 0.6 mg/L
- R2** Monoclonal anti-PIGF antibody (mouse) labeled with ruthenium complex 4.0 mg/L
- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL



Rx only

001



Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PLGF) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PLGF cobas e analyzers/PLGF)



Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PLGF) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PLGF cobas e analyzers/PLGF)



Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PIGF) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PIGF cobas e analyzers/PLGF)

Реагенты в кассете для количественного определения плацентарного фактора роста (PIGF) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys PIGF cobas e analyzers/PLGF)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 07027648190

TOP

TOP

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
8 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.