



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Томограф рентгеновский компьютерный
с принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity**

129226, Москва, проспект Мира д.191, строение 1;

Тел. (499) 214-06-50;

E-mail: info@sm-labservice.ru

Интернет адрес: <http://www.sm-labservice.ru>



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Томограф рентгеновский компьютерный

с принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity

129226, Москва, проспект Мира д.191, строение 1;

Тел. (499) 214-06-50;

E-mail: info@sm-labservice.ru

Интернет адрес: <http://www.sm-labservice.ru>

СОДЕРЖАНИЕ


Общий вид томографа рентгеновского компьютерного с принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity(Вариант1).....	3	Панель управления гентри (Модель: P002010/ P002011)....	28	Фантом калибровочный с фиксатором.....	53
Общий вид томографа рентгеновского компьютерного с принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity (Вариант2).....	4	Панель управления гентри (Модель: 6-S22355/6-S22356)...	29	Стол для рабочей станции оператора, кресло для оператора/ Стол для рабочей станции врача, кресло для врача.....	54
Гентри в сборе.....	5	Кожухи для гентри (Модель: P001932).....	30	Рабочая станция врача для обработки цифровых изображений.....	55
Рама гентри.....	6	Кожухи для гентри (Модель: P002032).....	31	Персональный компьютер.....	56
Вращающийся диск гентри.....	7	Видеокамера (Только для Варианта 2).....	32	Программное обеспечение Anke ASG-340 V8.0 от 03.03.2021.....	57
Блок управления вращения гентри.....	8	Дека стола.....	33	Программное обеспечение ASG-600 V1.0 от 25.09.2019.....	58
Блок управления наклона гентри.....	9	Блок управления горизонтального движения стола.....	34	Программное обеспечение ANYTHINK ANKE CT Plus V4.2 от 24.09.2020.....	59
Контактное кольцо (Модель: E-Slip-Ring).....	10	Блок управления вертикального движения стола.....	35	LCD монитор/Дополнительный LCD монитор медицинский для рабочей станции врача.....	60
Контактное кольцо (Модель: 4C0000219).....	11	Блок педальный.....	36	Лазерный принтер.....	61
Рентгеновская трубка.....	12	Подставка (Только для варианта 1).....	37	Щит распределительный.....	62
Рентгеновская трубка (Модель: CTR2250 для модели ANATOM 64 Clarity).....	13	Кожухи для стола снимков (Только для Варианта 1).....	38	Фиксирующие ремни.....	63
Рентгеновская трубка (Модель: CTR2280 для модели ANATOM 64 Precision).....	14	Кожухи для стола снимков (Только для Варианта 2).....	39	Принадлежность для поддержки головы.....	64
Охлаждающее устройство рентгеновской трубки.....	15	Питающее устройство.....	40	Регулируемая опора головы (Модель: P001626).....	65
Коллиматор.....	16	Эксплуатационные и технические документы.....	41	Регулируемая опора головы (Модель: P002626).....	66
Генераторное устройство.....	17	Блок управления со встроенной системой интерком.....	42	Подкладка для головы.....	67
Генераторное устройство (Модель: CT70PN50X5112 HV CHASSIS ASSY для модели ANATOM 64 Clarity).....	18	Рабочая станция оператора для обработки цифровых изображений.....	43	Матрас для стола снимков (Модель: P002627).....	68
Генераторное устройство (Модель: CT70PN80X5113 HV CHASSIS ASSY для модели ANATOM 64 Precision).....	19	Персональный компьютер.....	44	Матрас для стола снимков (Модель: 6-S20039).....	69
Блок детекторов.....	20	Программное обеспечение Anke ANATOM ClearVIEW X Ray Computed Tomography System Software версии V1.0 201210 от 10.12.2020.....	45	Принадлежность для ног.....	70
Стационарный блок управления сканированием.....	21	Программное обеспечение ReconEngine версии V1.7.02 от 06.07.2021.....	46	Источник бесперебойного питания на всю систему с комплектом аккумуляторов.....	71
Устройство индикации дыхания пациента (Модель: P001882.....	22	Программное обеспечение MySQL версии 5.6.10 от 06.04.2013.....	47	Климатическая сплит система.....	72
Устройство индикации дыхания пациента (Модель: 10-S17713).....	23	LCD монитор.....	48	Рентгенозащитное окно.....	73
Лазерное устройство позиционирования.....	24	Клавиатура/Клавиатура для рабочей станции врача.....	49	Рентгенозащитная дверь.....	74
ЖК дисплей гентри (Модель: K6000+).....	25	Манипулятор типа «мышь»/ Манипулятор типа «мышь» для рабочей станции врача.....	50	Видеокамера.....	75
ЖК дисплей гентри (Модель: 10-S17712).....	26	Источник бесперебойного питания.....	51		
Панель управления гентри (Модель: P001910/P001911)...	27	Силовые и соединительные кабели.....	52		




Общий вид томографа рентгеновского компьютерного с принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity (Вариант 1)




Общий вид томографа рентгеновского компьютерного с принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity (Вариант 2)

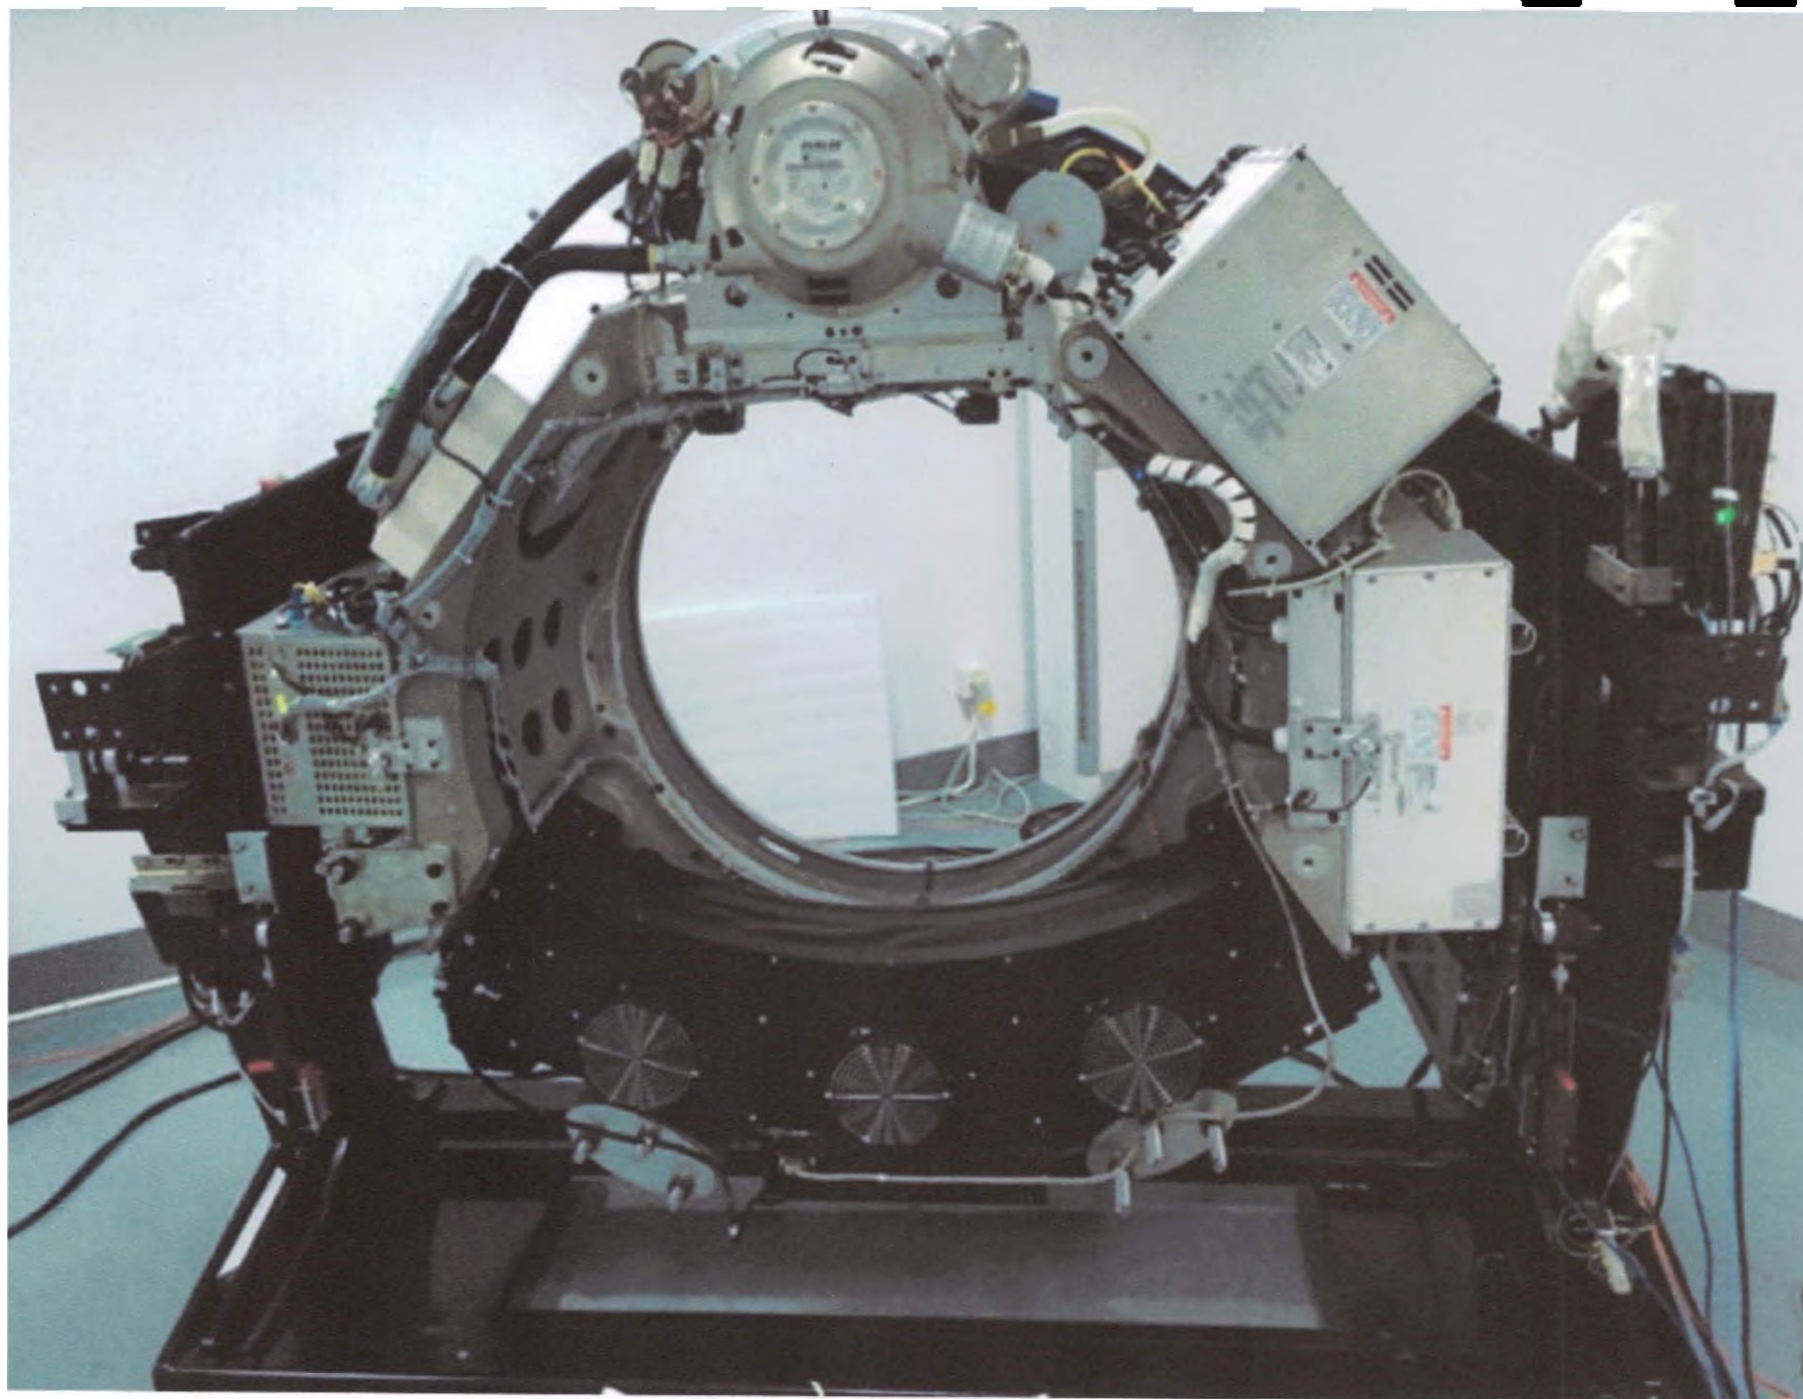


Гентри в сборе

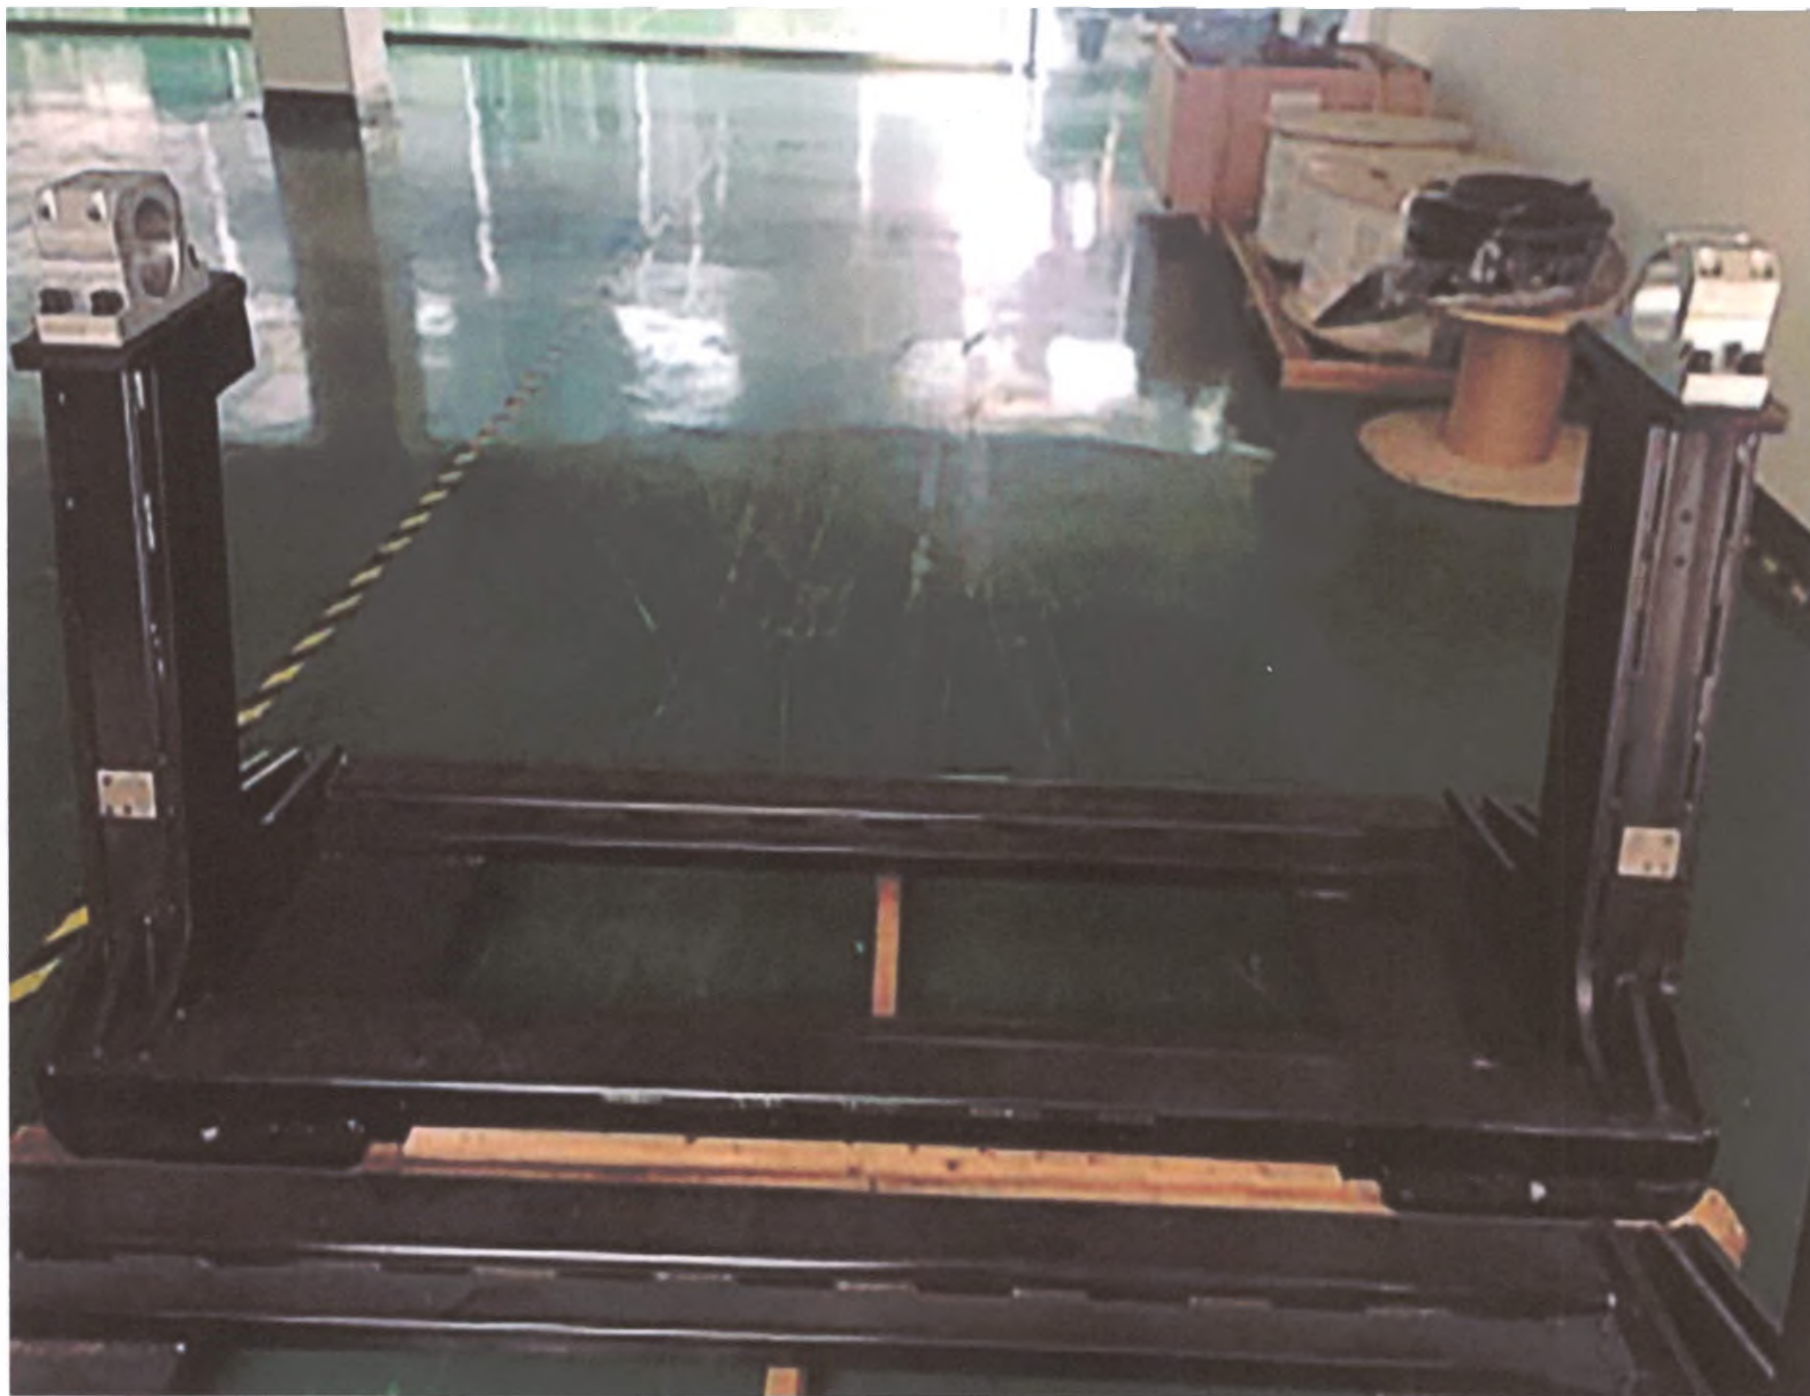

Рама гентри

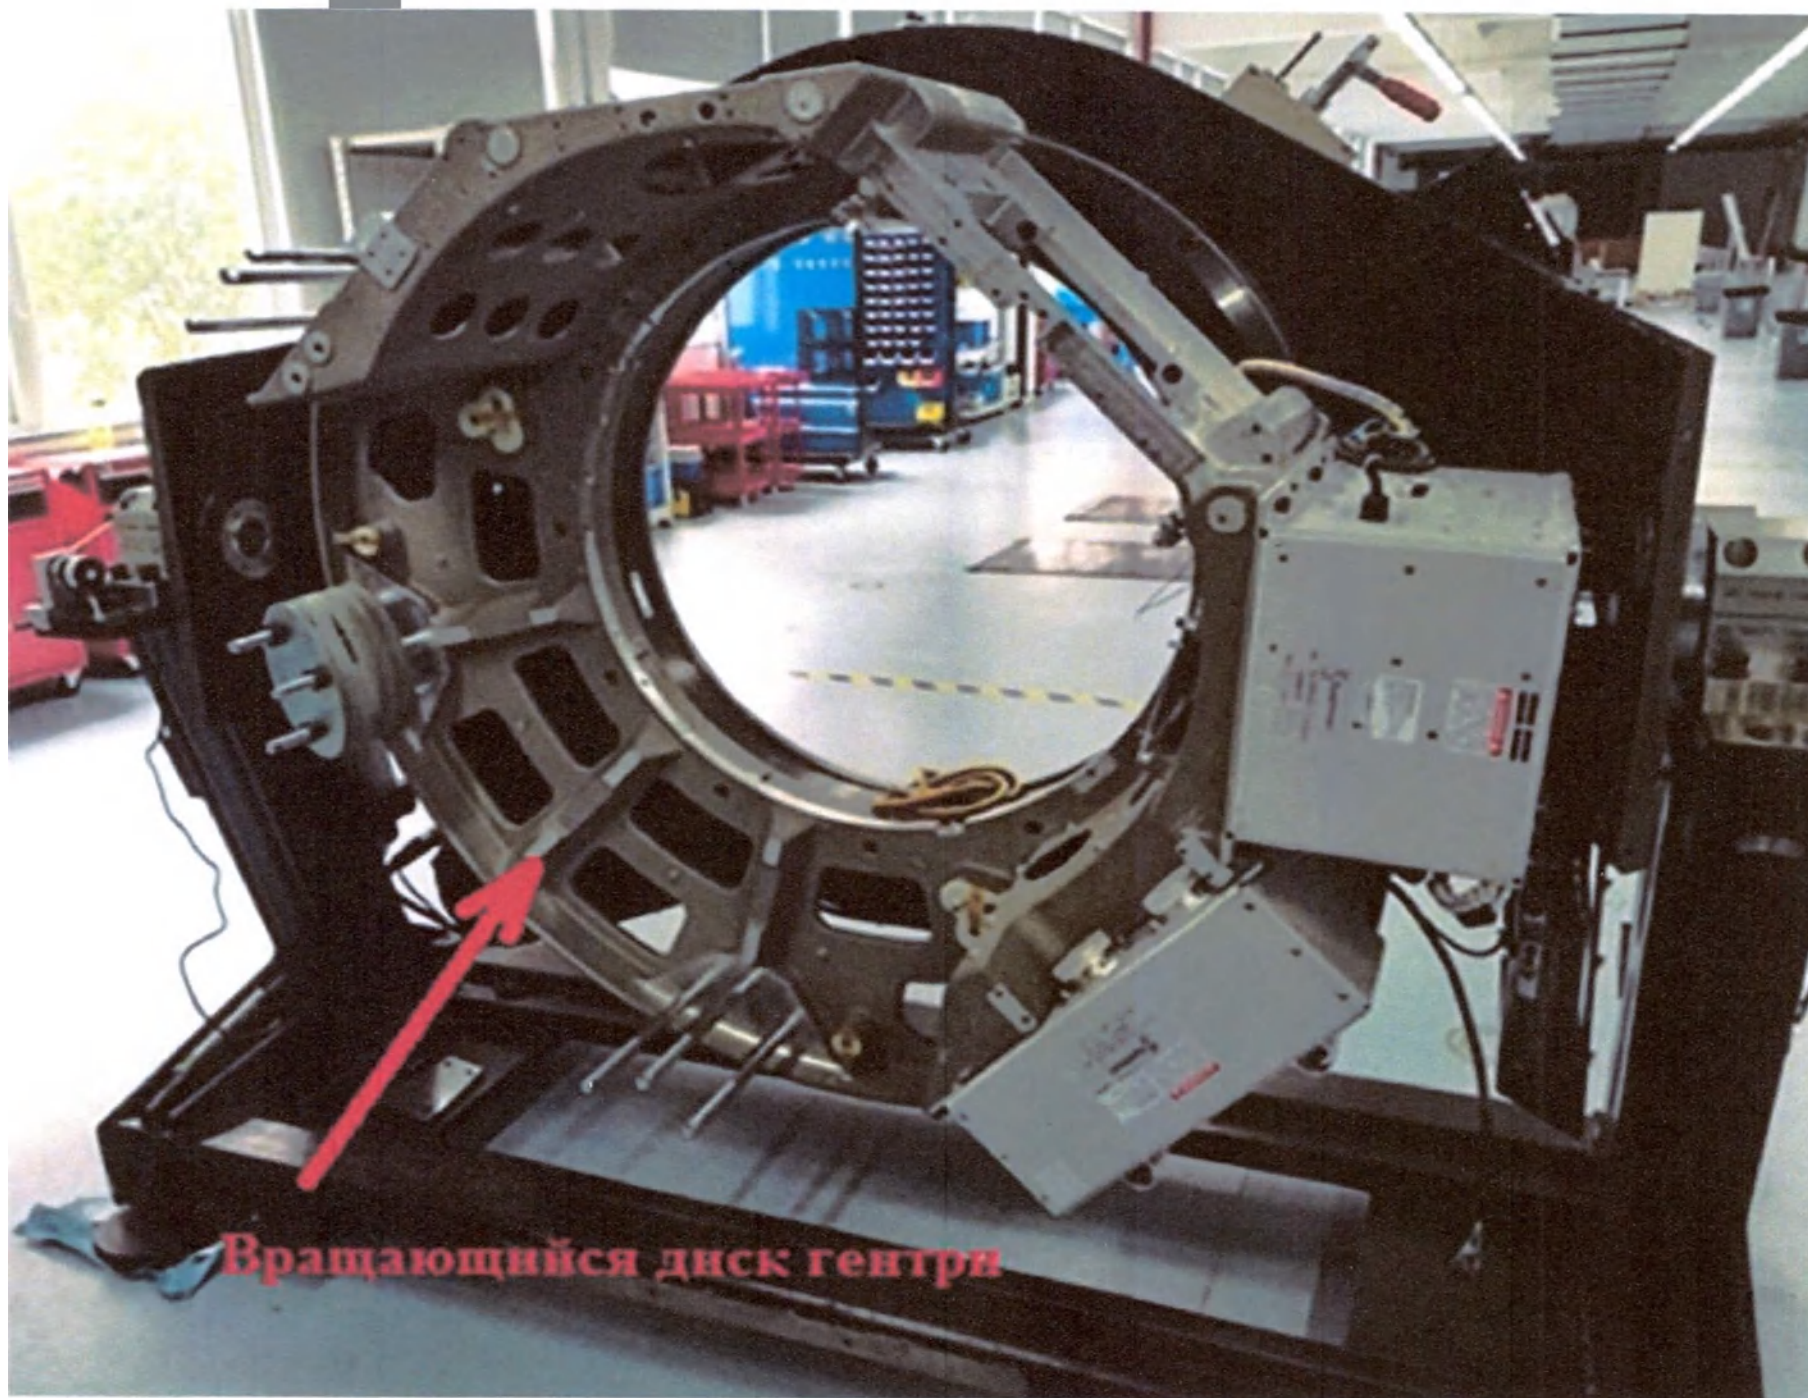


Вращающийся диск гентри

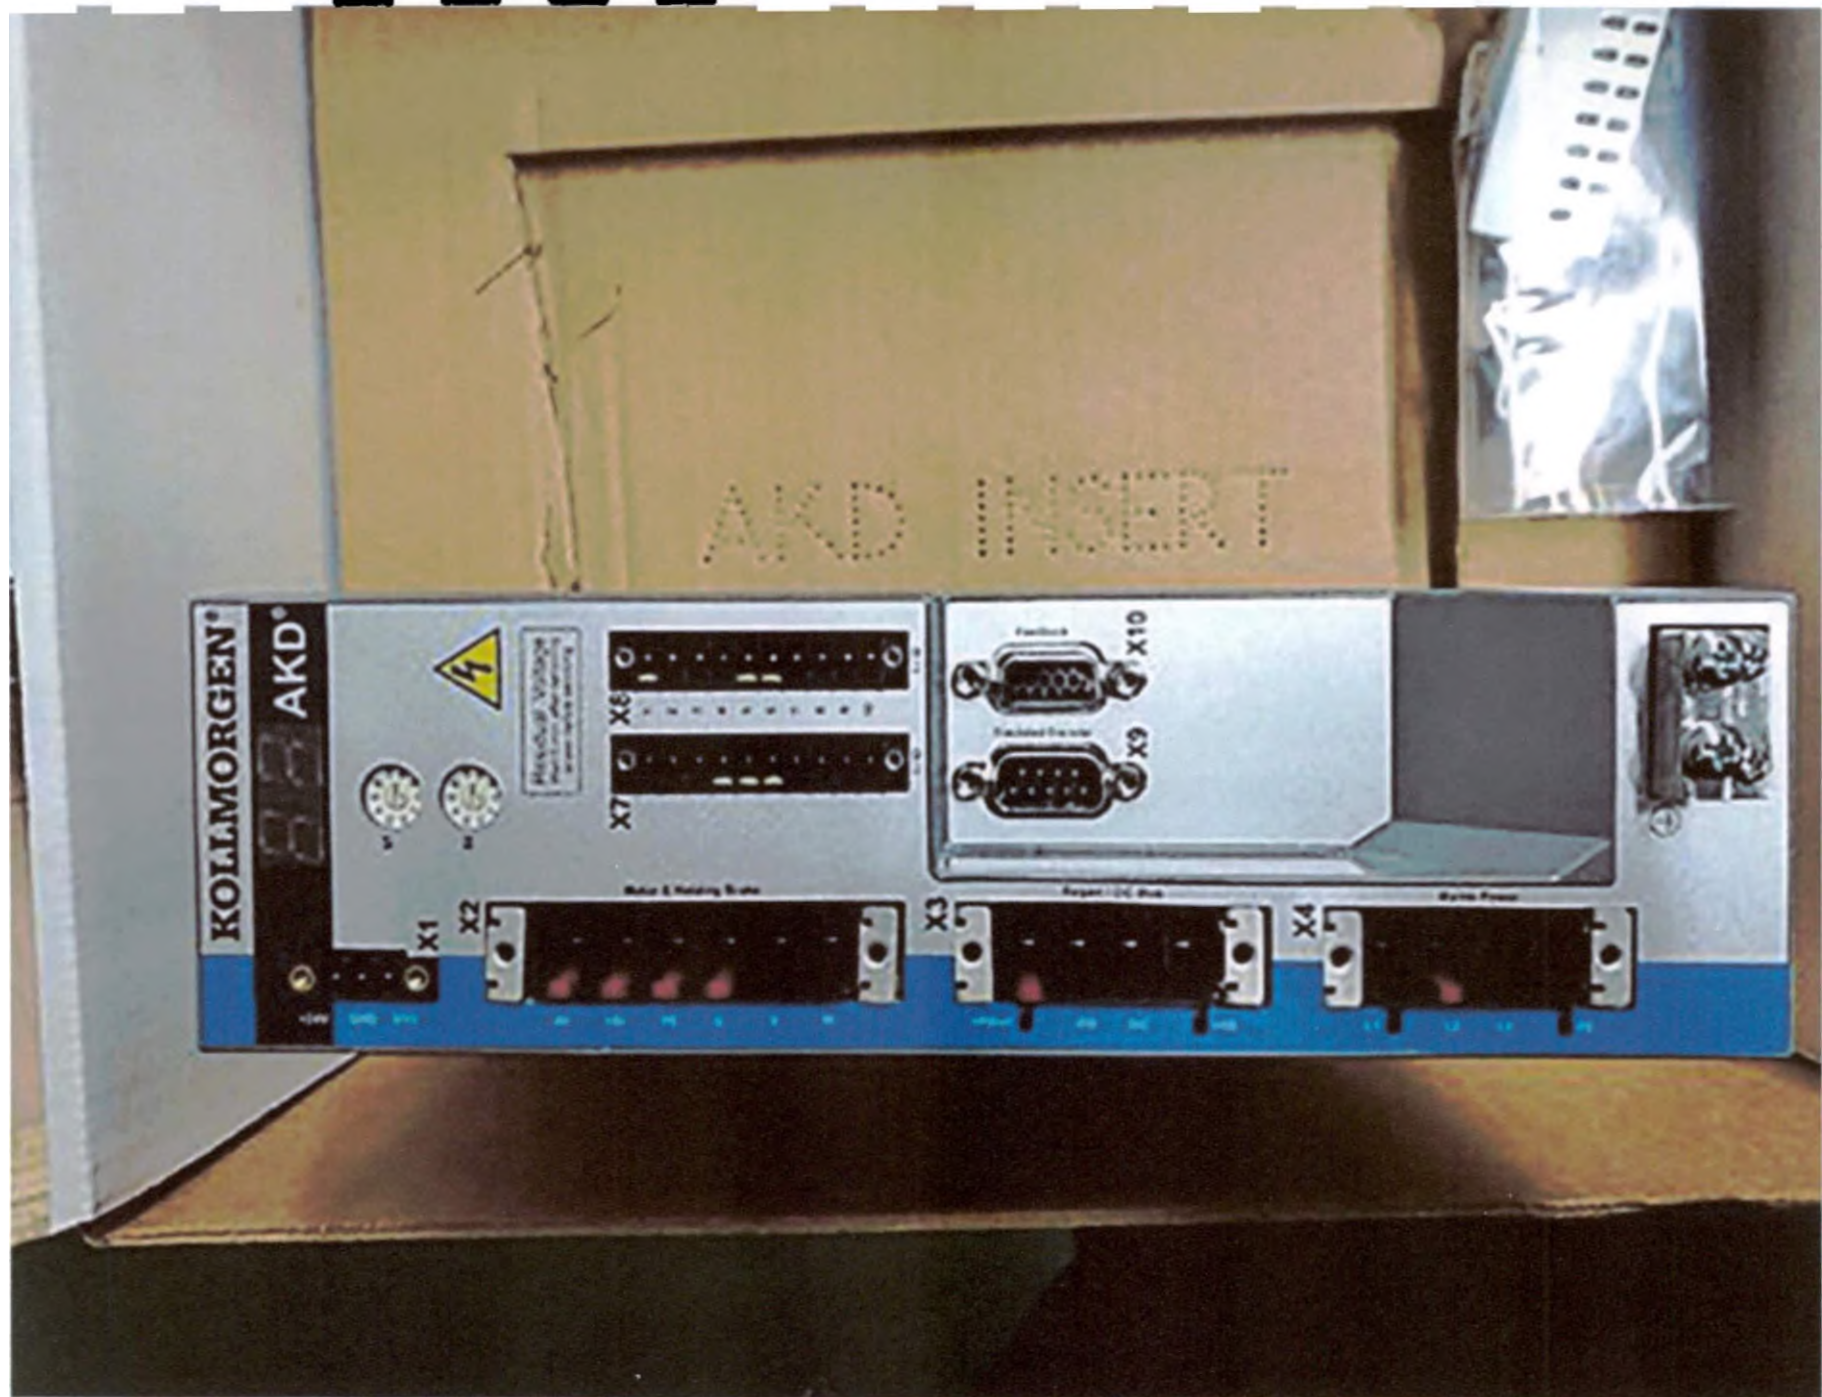


Блок управления вращения гентри




Блок управления наклона гентри

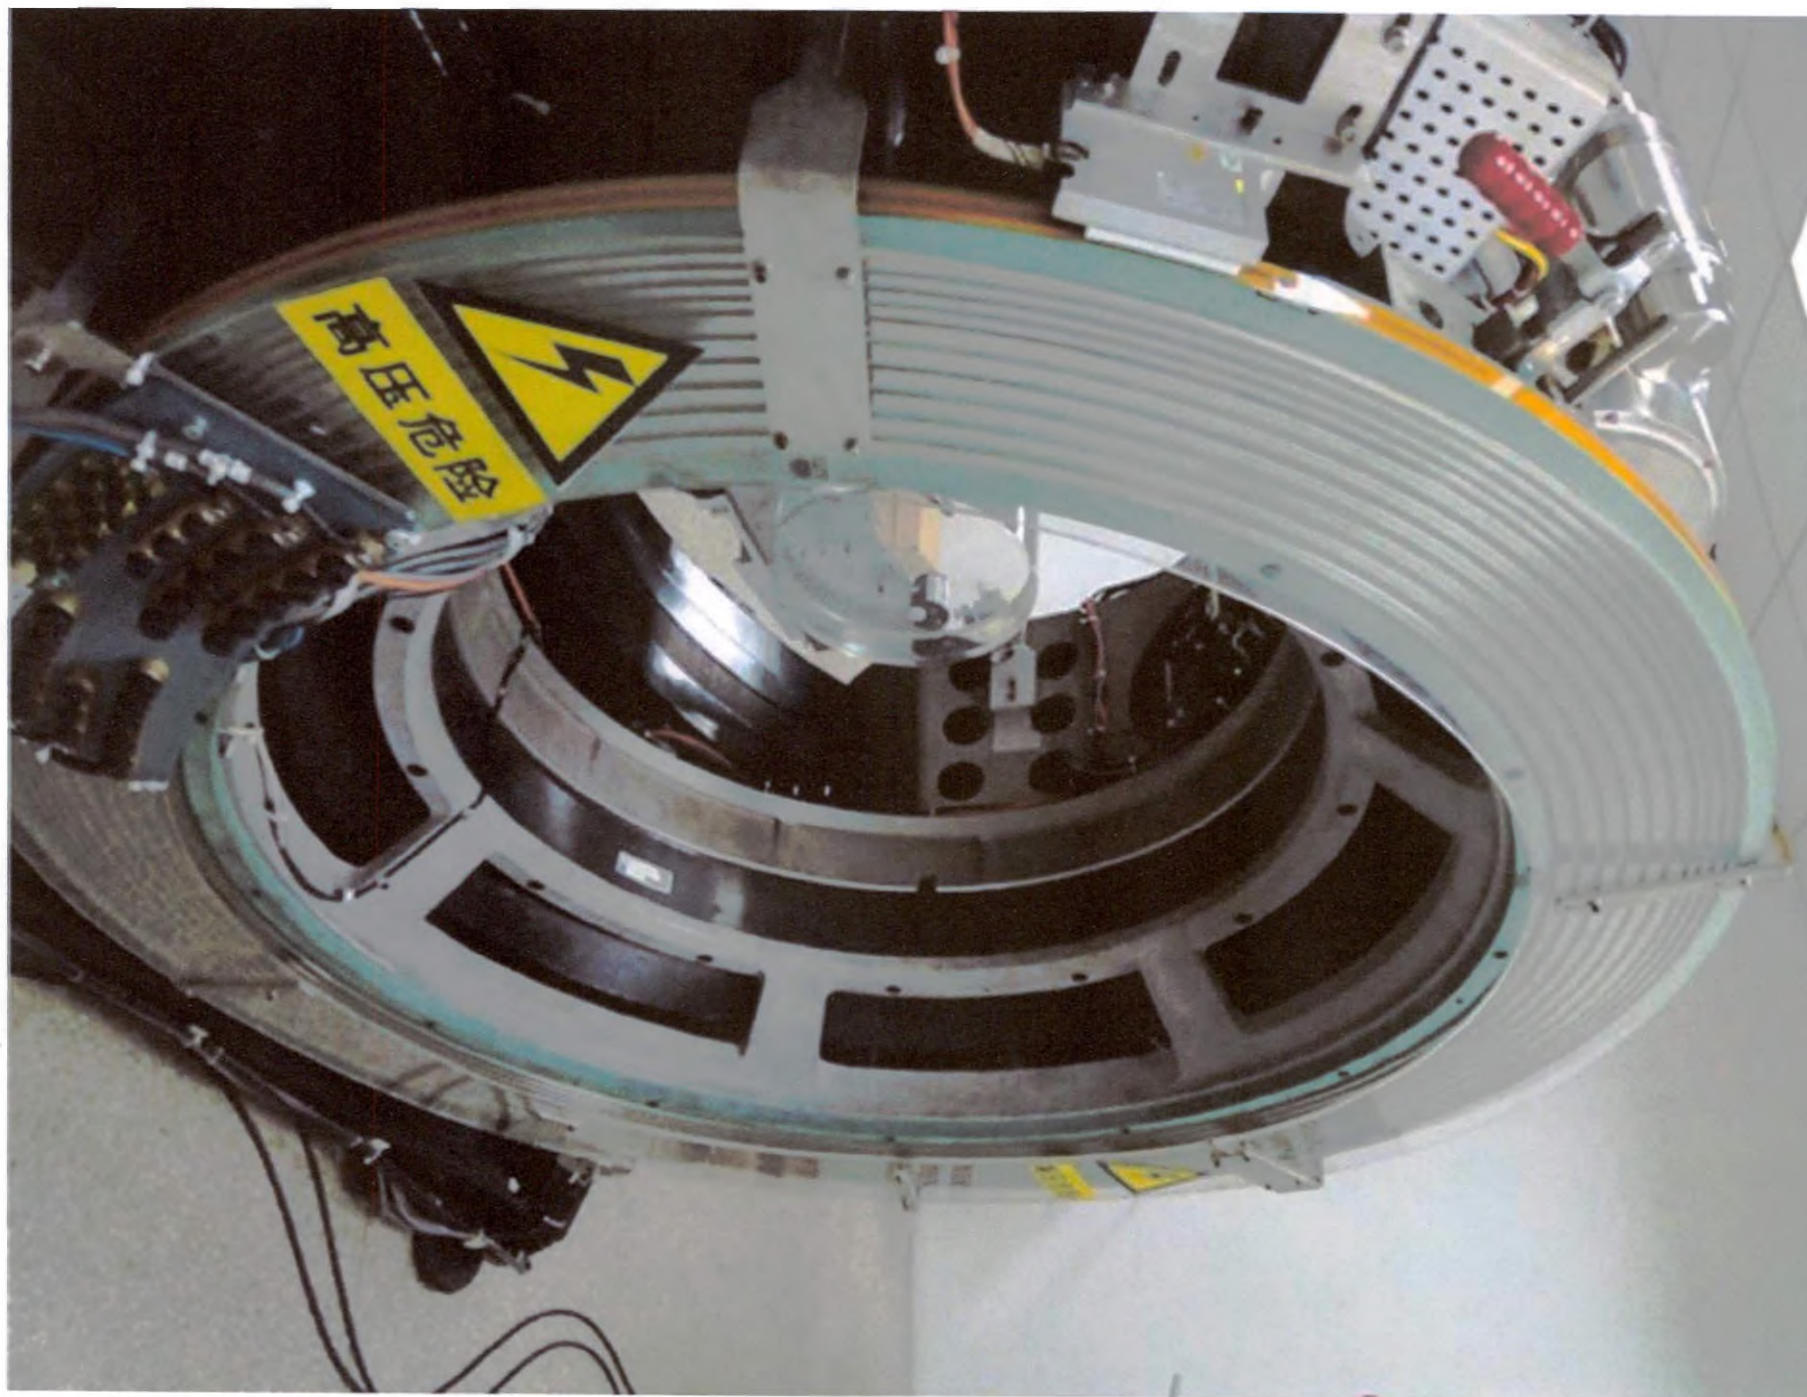

Контактное кольцо (Модель: E-Slip-Ring)

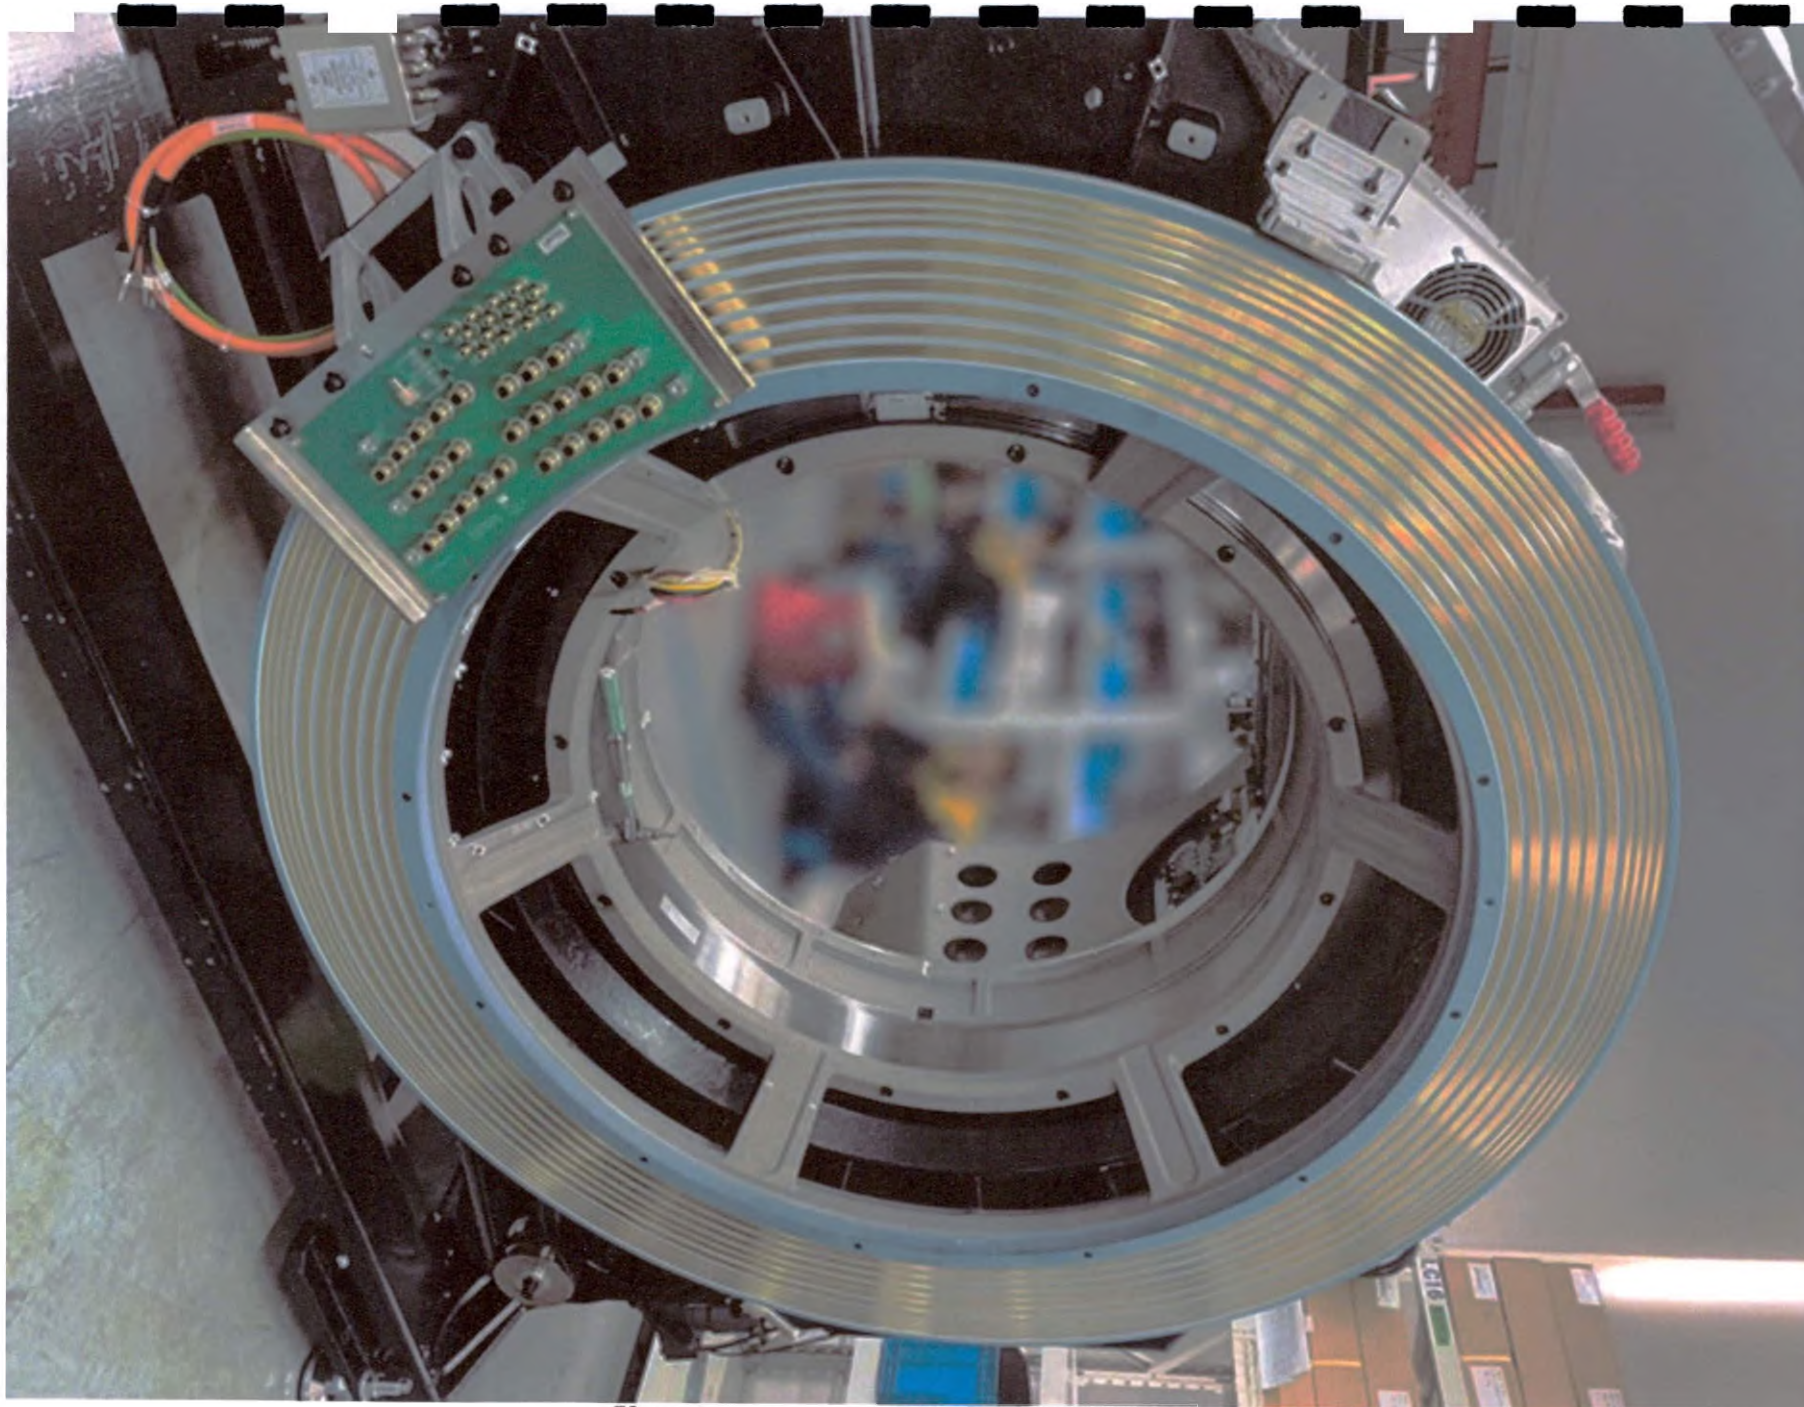

Контактное кольцо (Модель: 4C0000219)

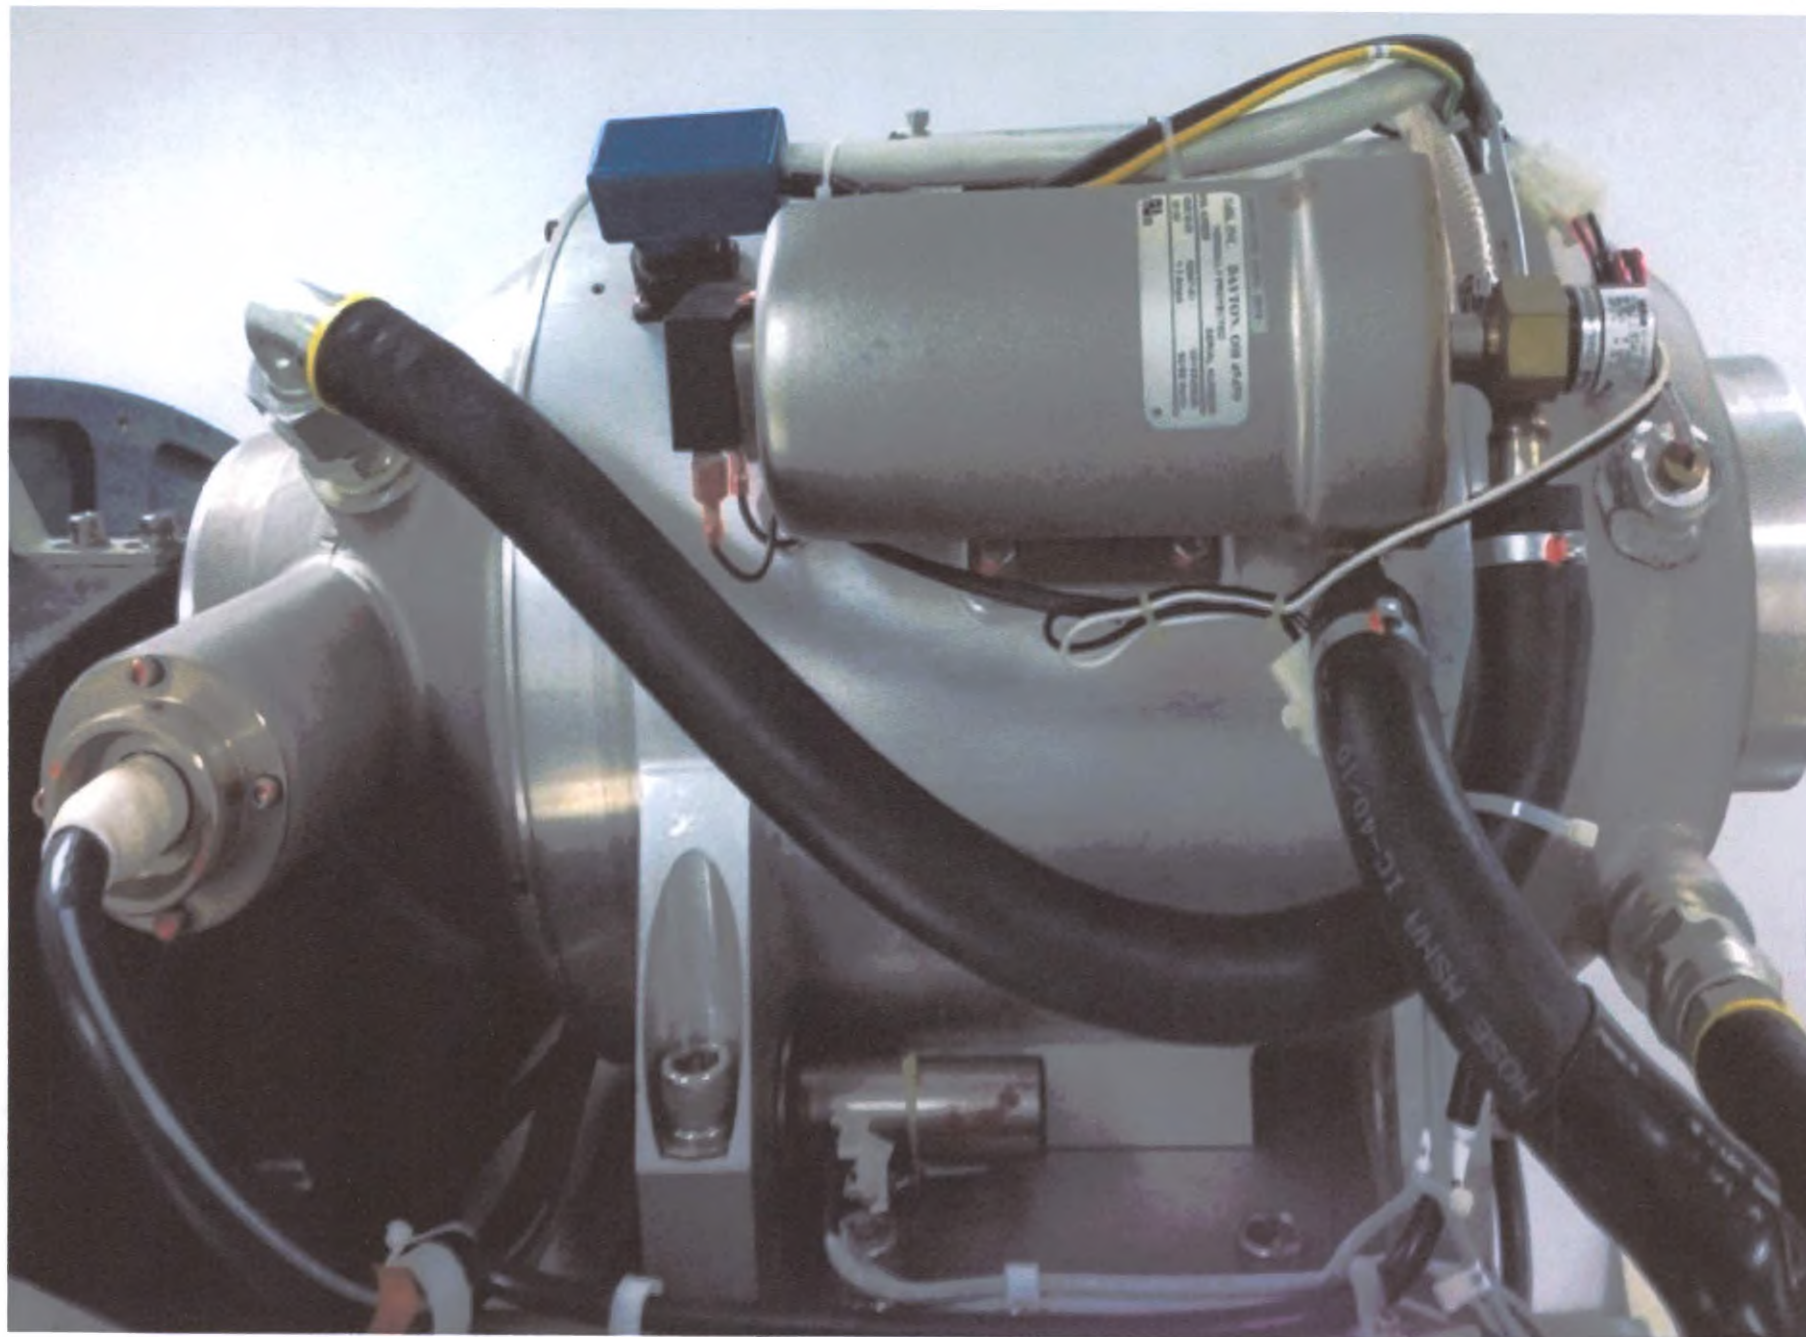


Рентгеновская трубка




Рентгеновская трубка (Модель: CTR2250 для модели Clarity)




Рентгеновская трубка (Модель: CTR2280 для модели Precision)

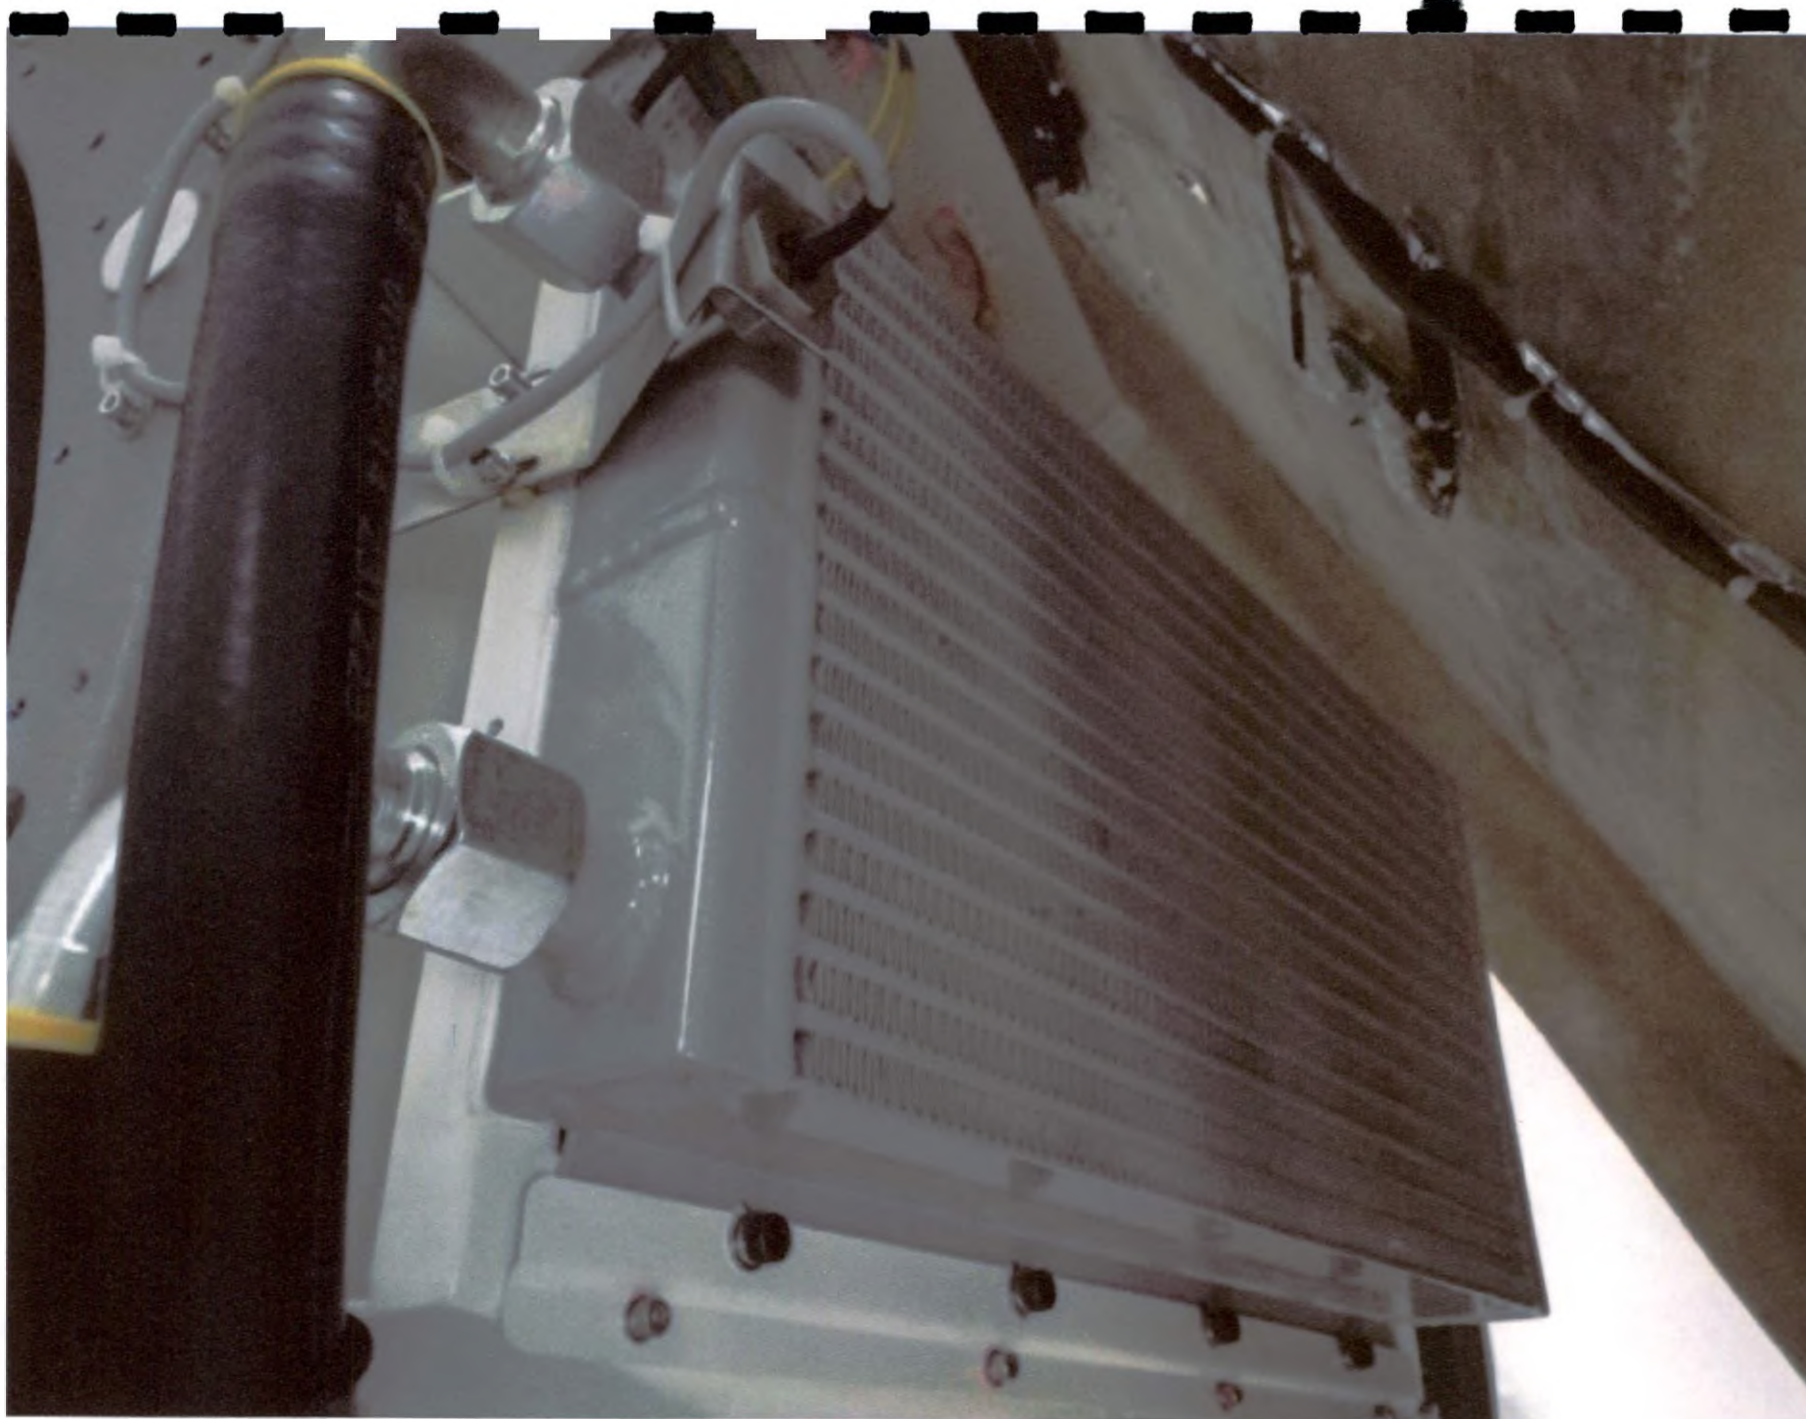

Охлаждающее устройство рентгеновской трубки

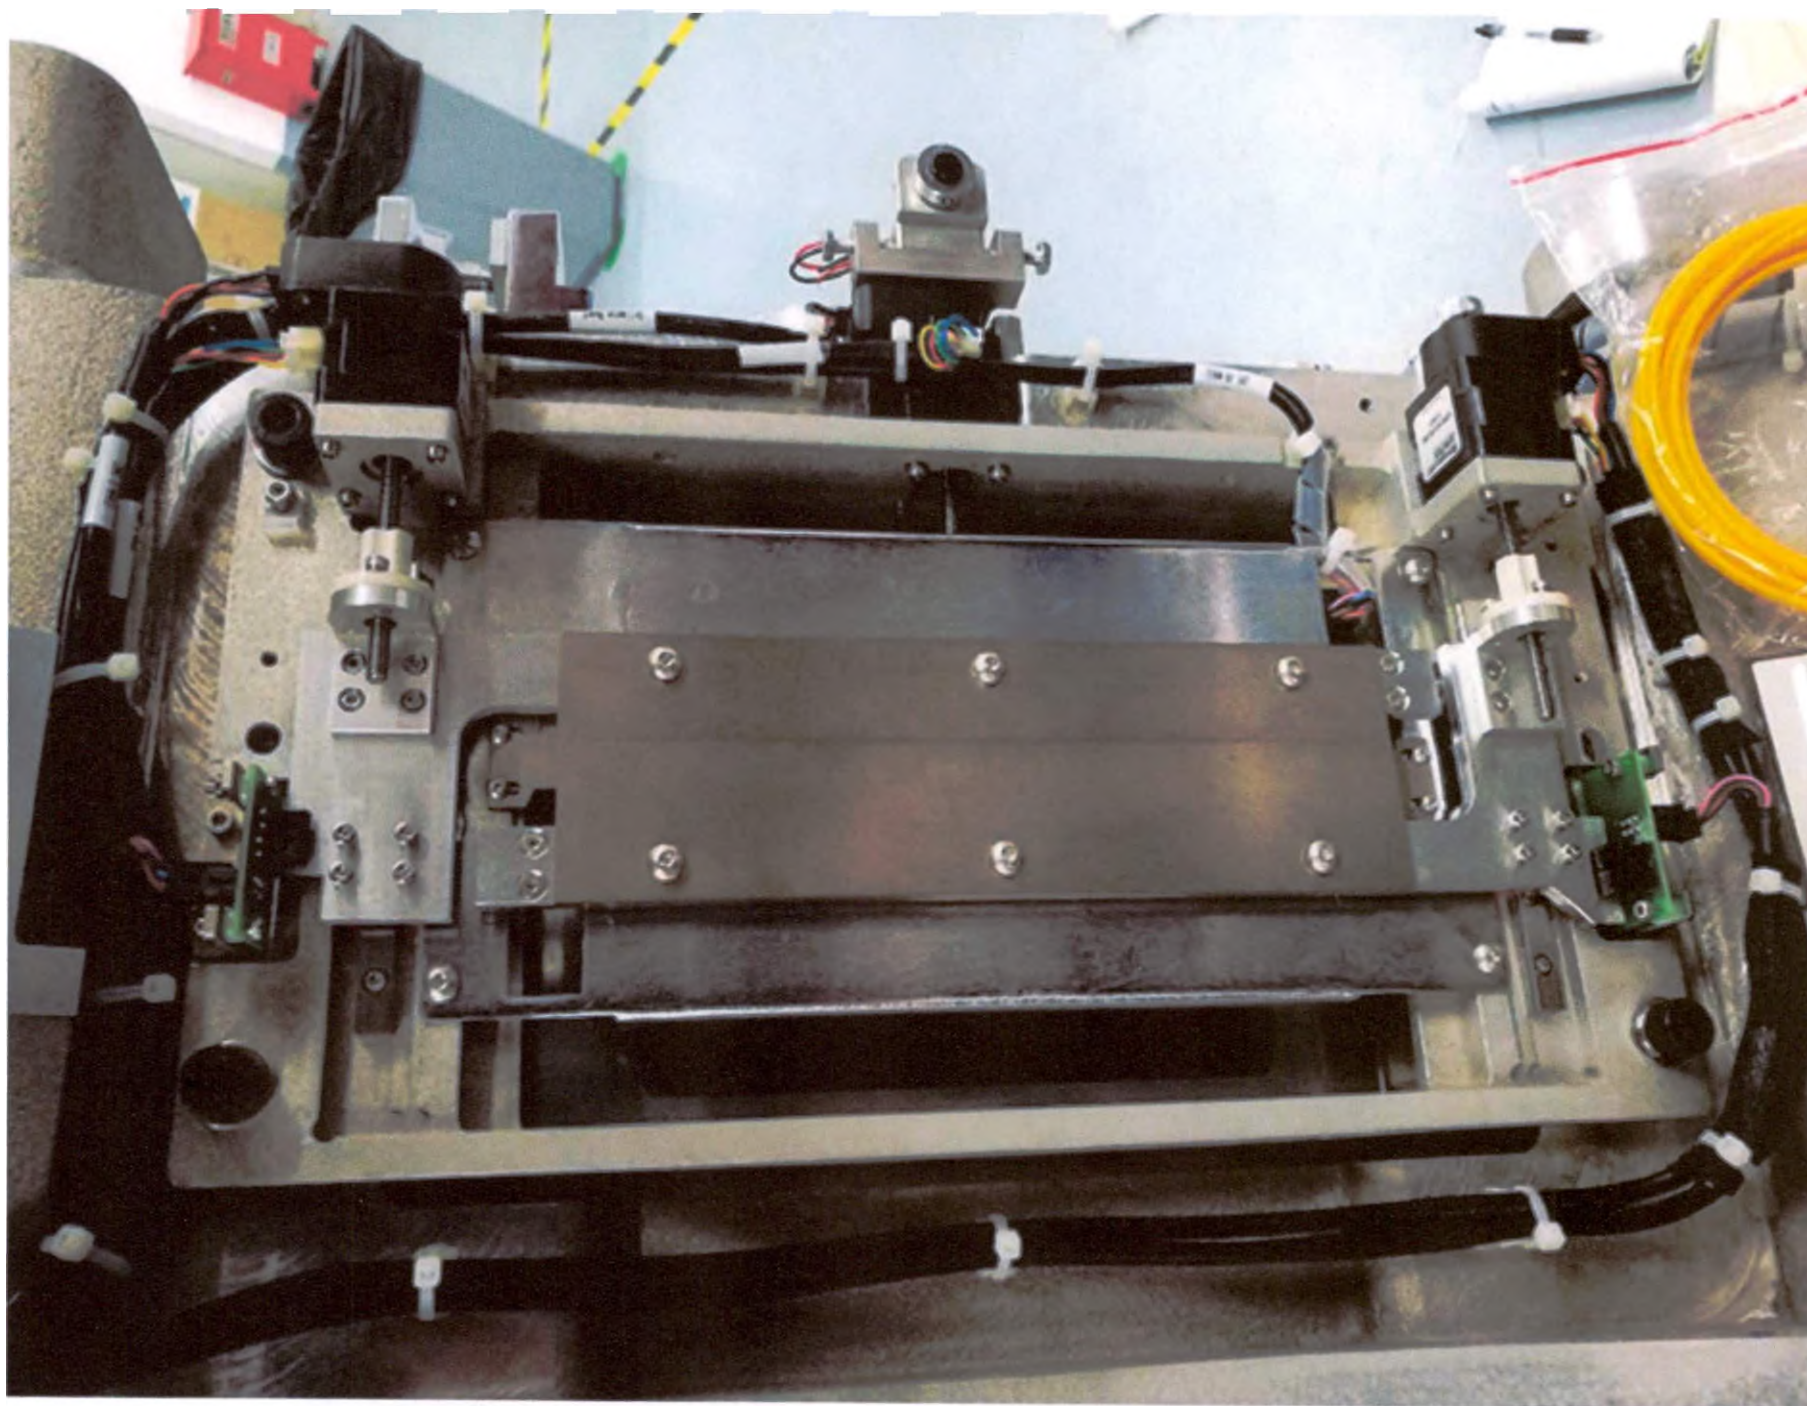

Коллиматор

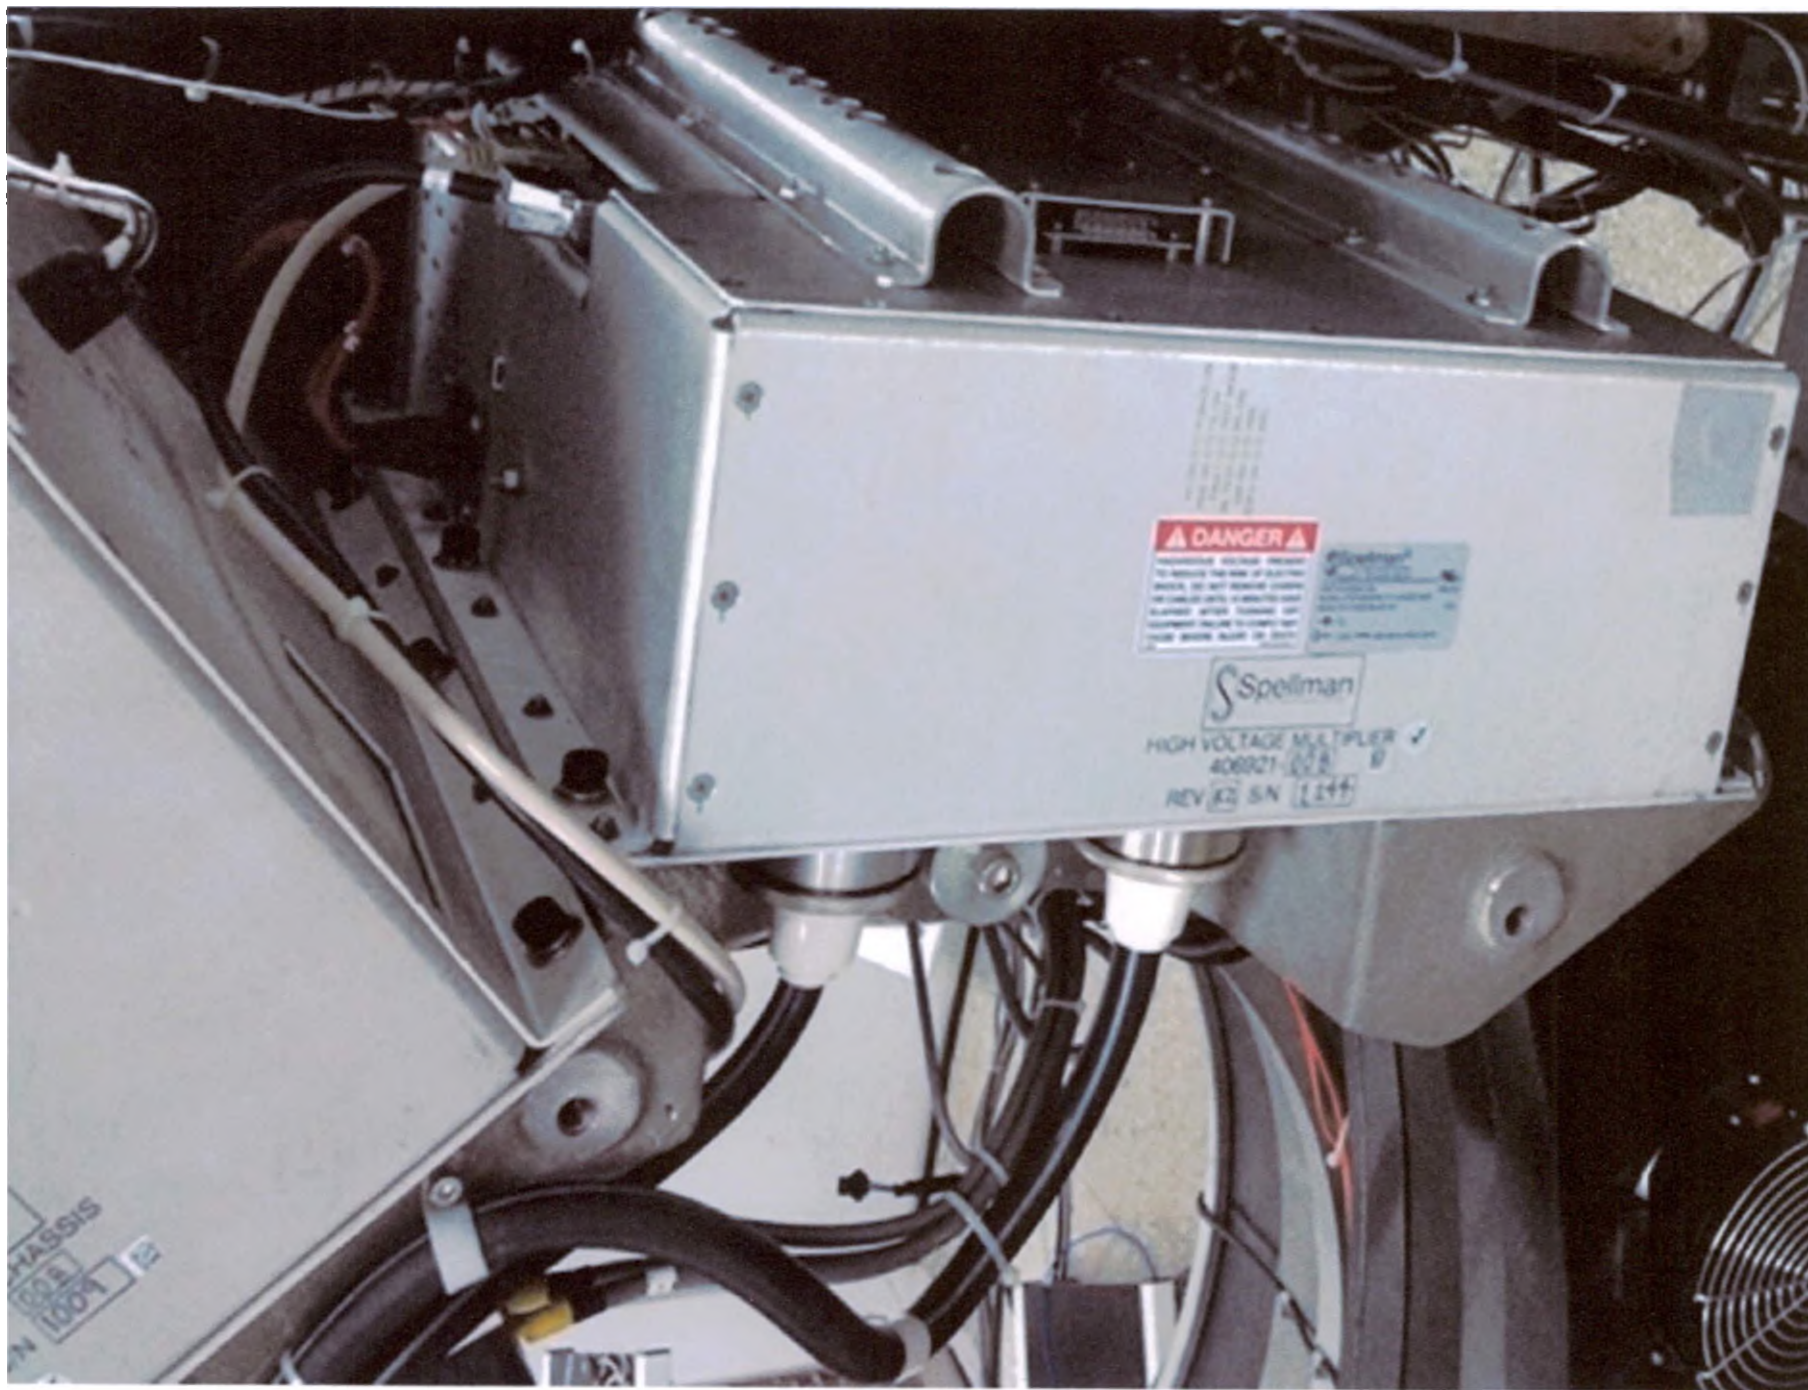

Генераторное устройство



Spellman®

High Voltage Electronics Corporation

Hauppauge, NY 11788 Assembled in Mexico P3



PART NO:406921-001

REV:K2

MODEL:CT70PN50X5112 HV CHASSIS ASSY

SERIAL NO:102548183-C01128

5/15



 $\pm 70\text{kV}$  MAX 420mA MAX $\pm 25\text{kW}$

Генераторное устройство (Модель: CT70PN50X5112 HV CHASSIS ASSY для модели ANATOM 64 Clarity)



High Voltage Electronics Corporation

Hanappauge, NY 11788 Assembled in Mexico P3




PART NO:406921-008


REV:K2

MODEL:CT70PN80X5113 HV CHASSIS ASSY


SERIAL NO:102548183-C01130

5/15

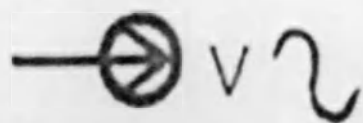


 $\pm 70\text{kV}$  MAX 667mA MAX $\pm 40\text{kW}$


Генераторное устройство (Модель: CT70PN80X5113 HV CHASSIS ASSY для модели ANATOM 64 Precision)

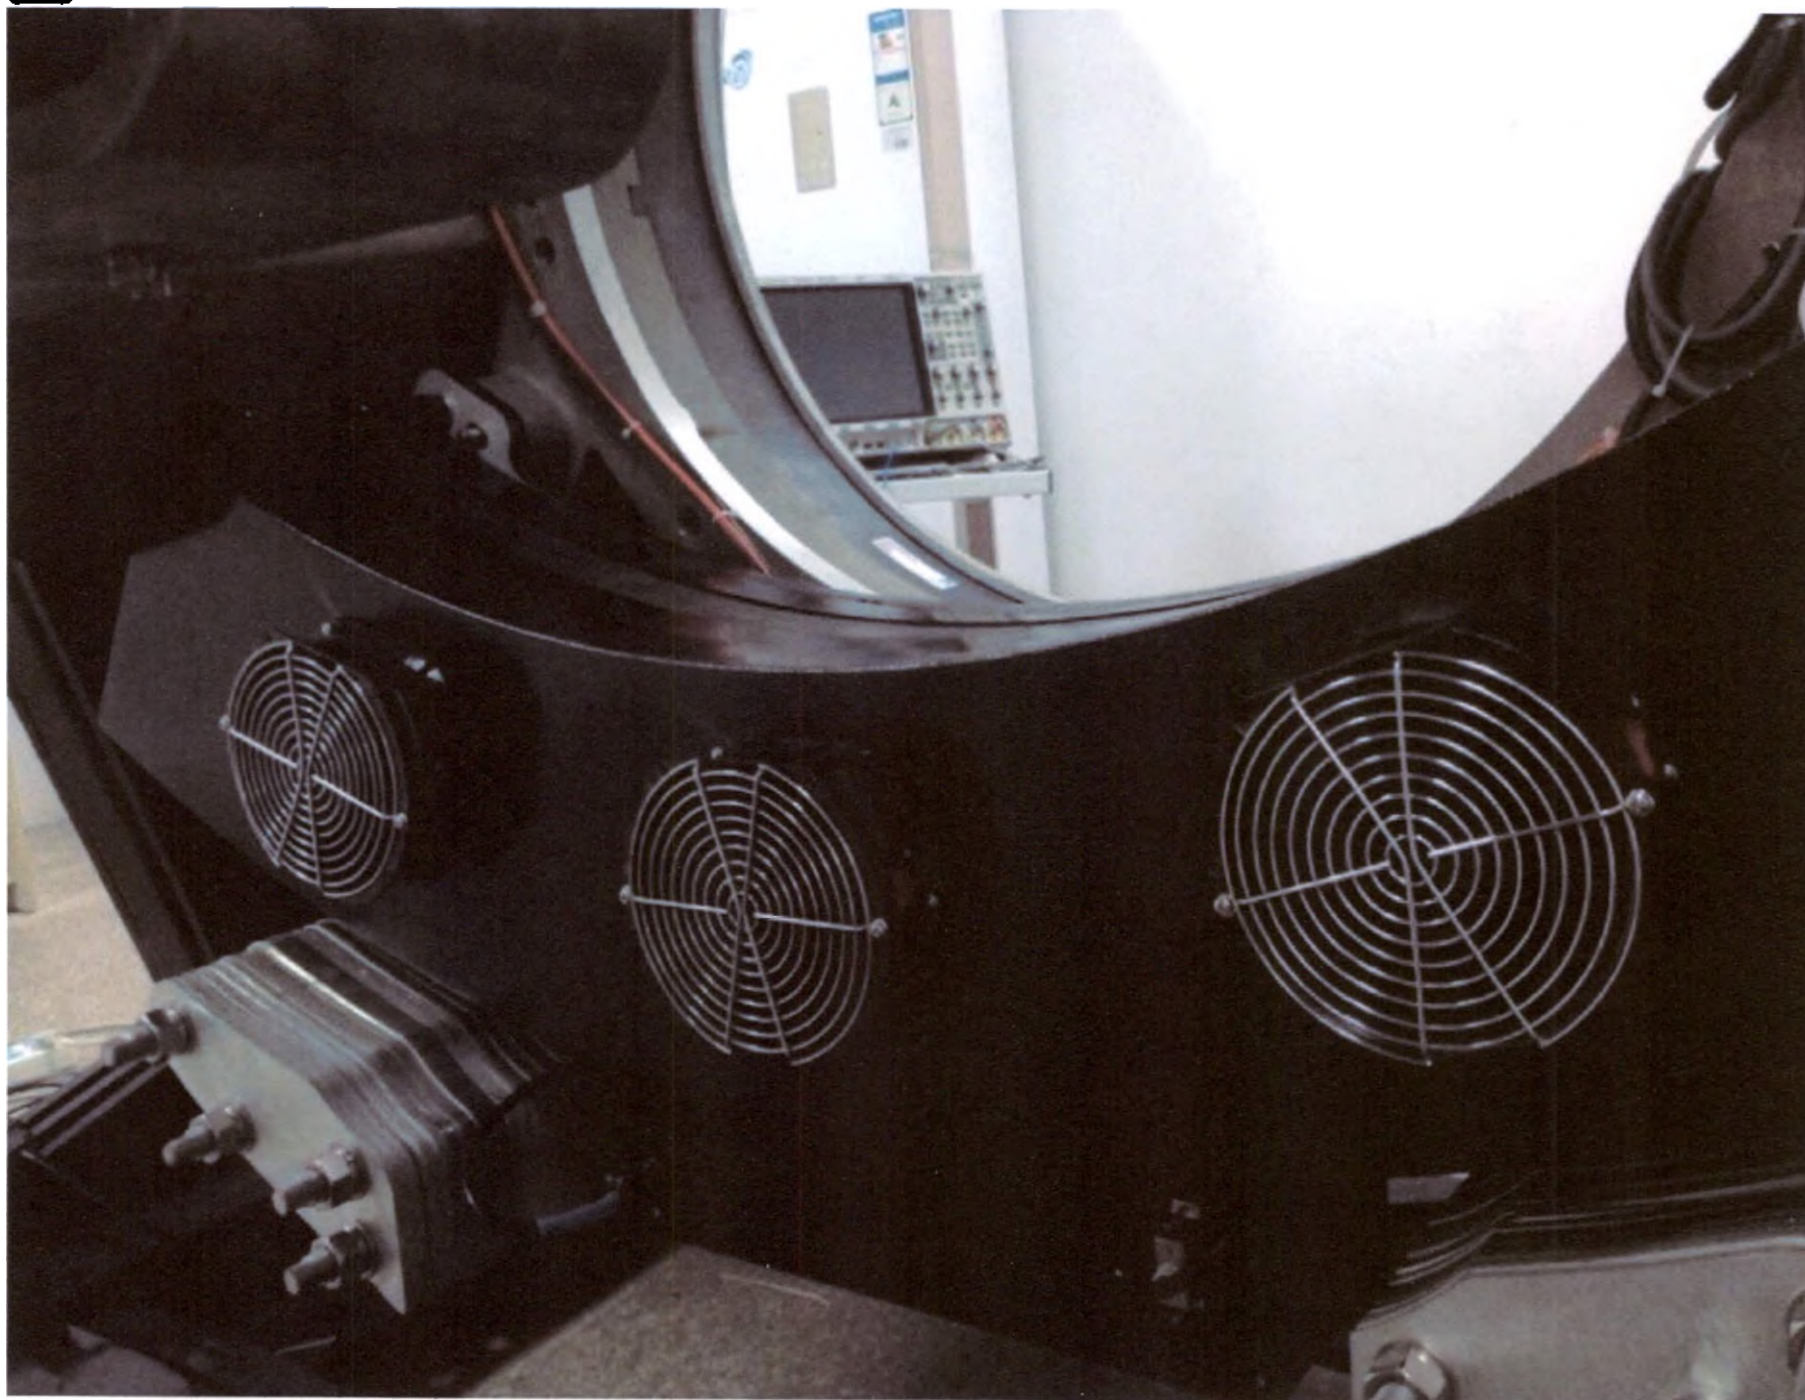

Блок детекторов

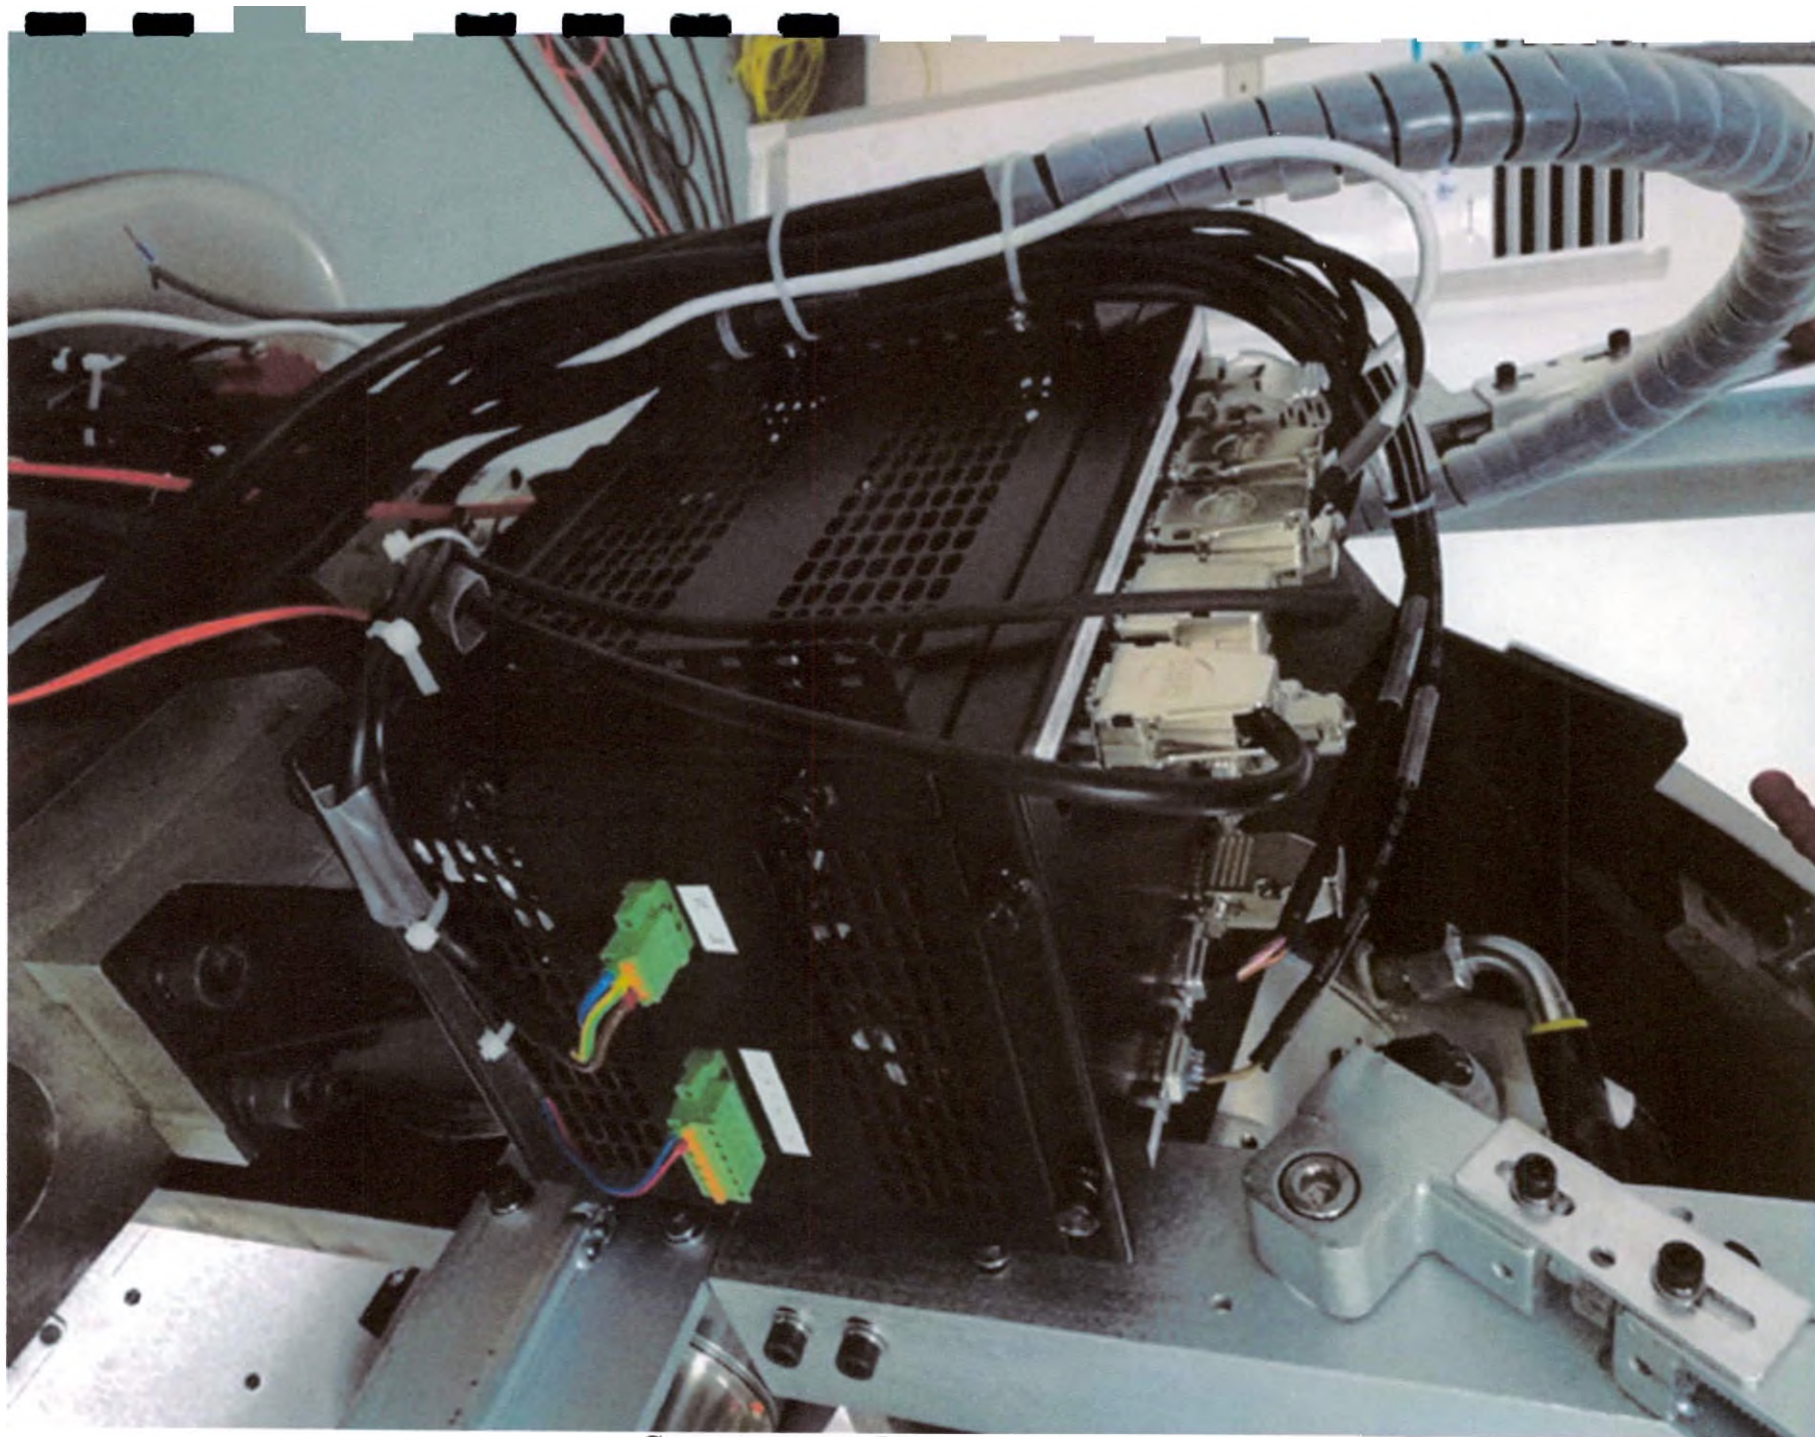


Стационарный блок управления сканированием

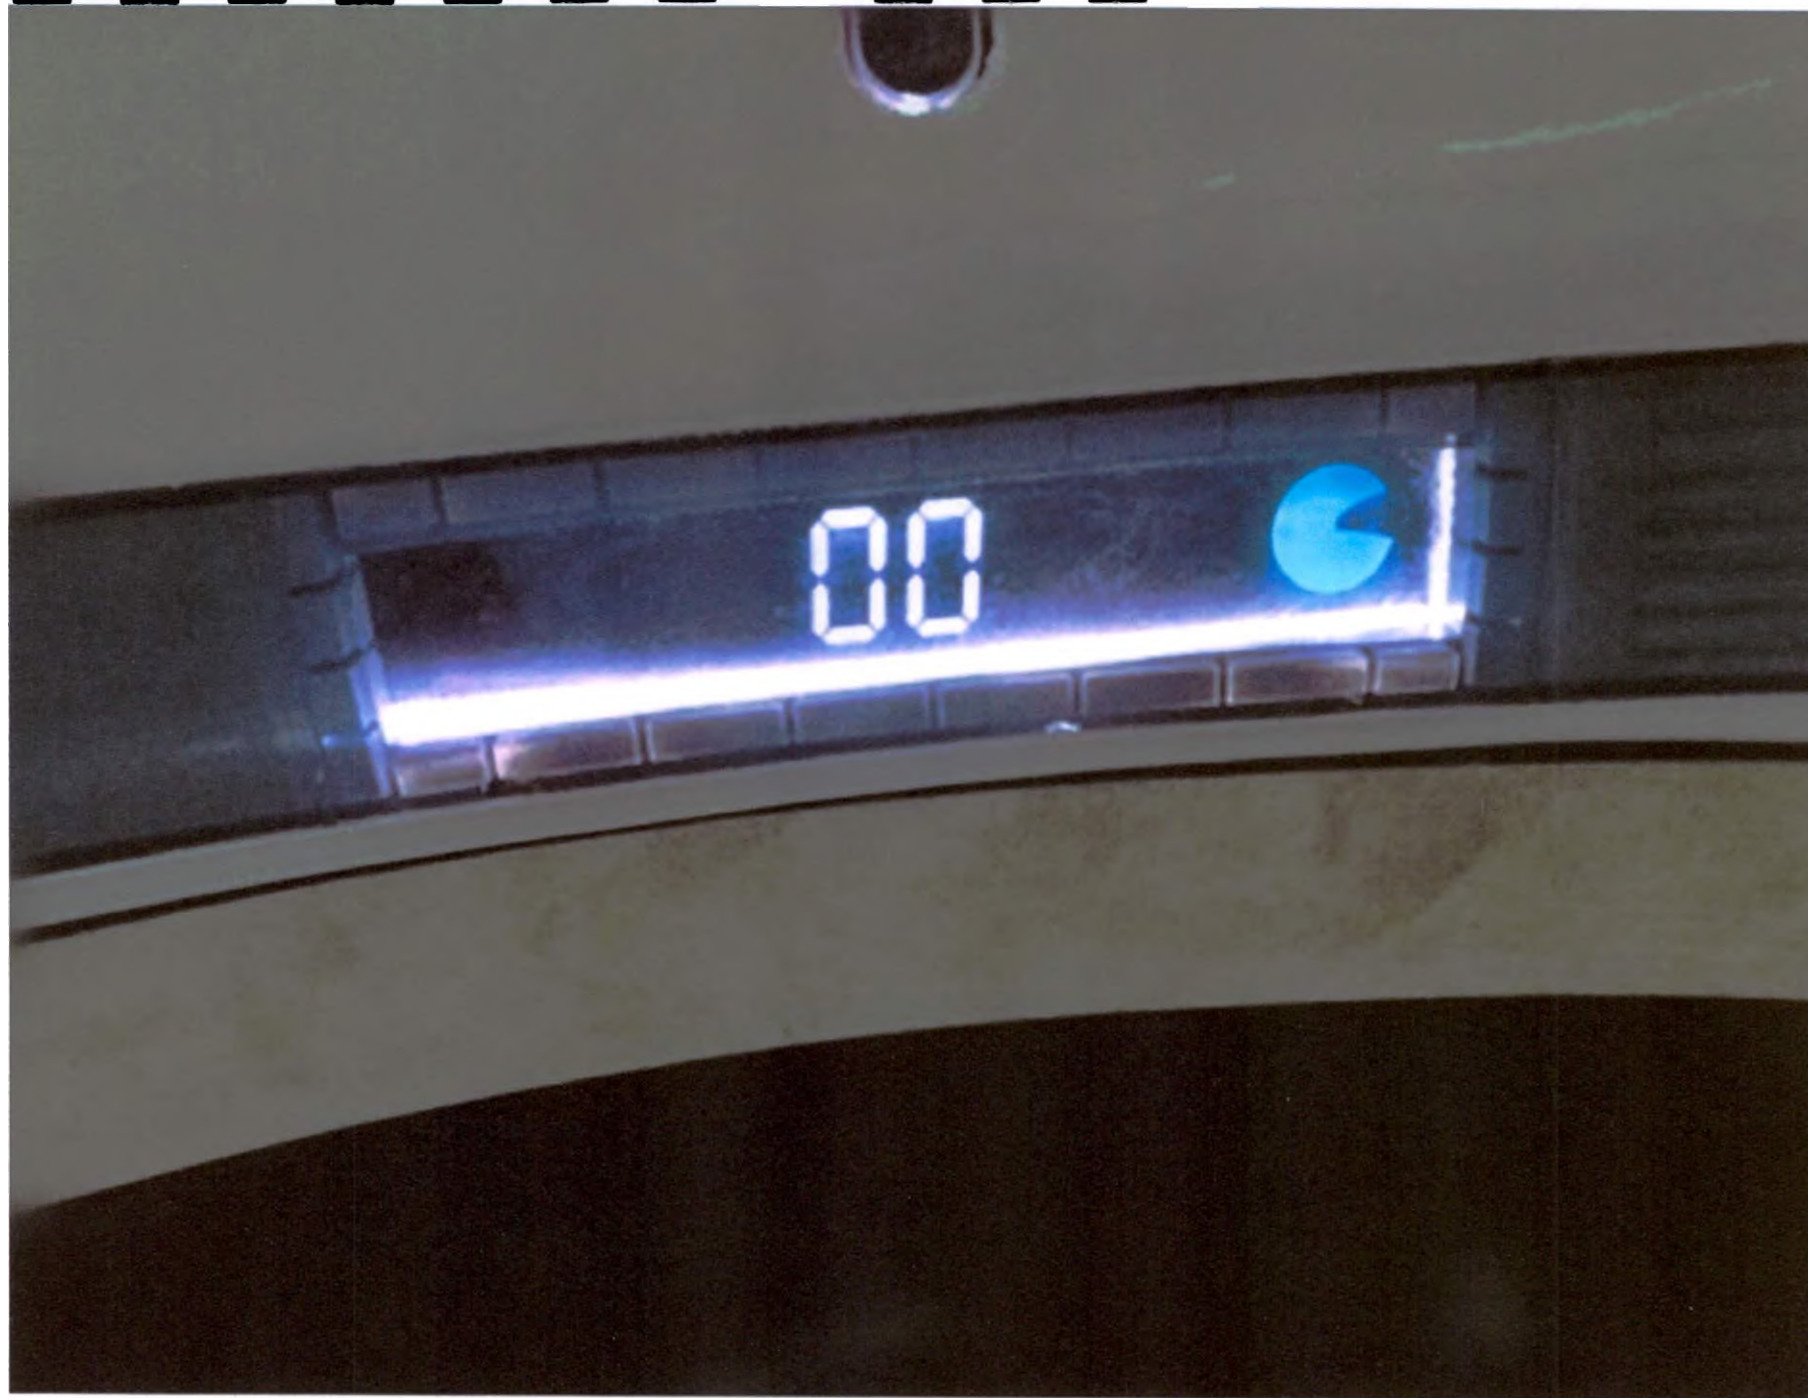

Устройство индикации дыхания пациента (Модель: P001882)



Устройство индикации дыхания пациента (Модель: 10-S17713)

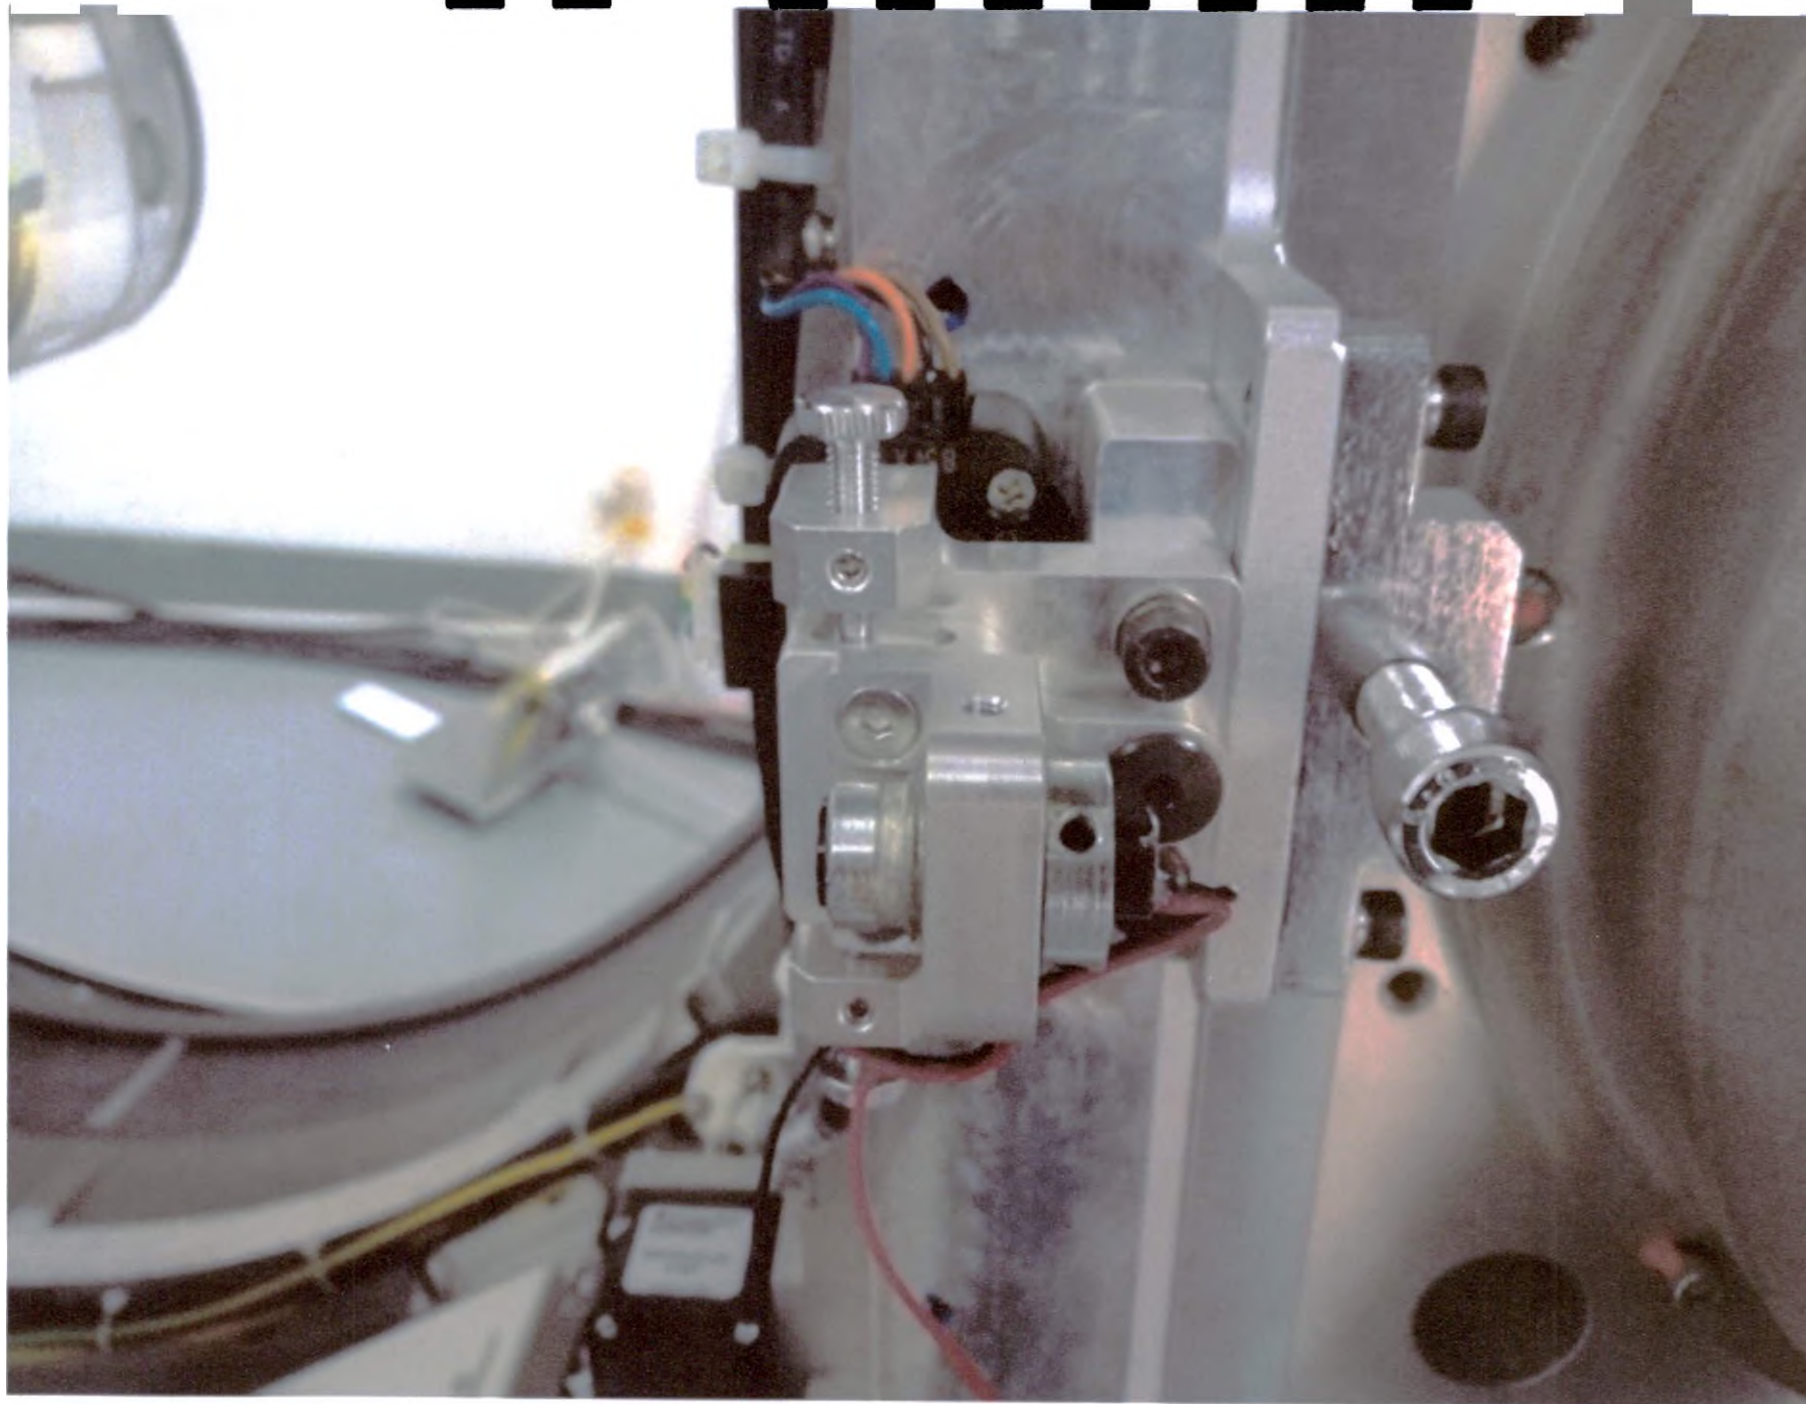

Лазерное устройство позиционирования



ЖК дисплей гентри (Модель: K6000+)



ЖК дисплей гентри (Модель: 10-S17712)




Панель управления гентри (Модель: P001910/ P001911)




Панель управления гентри (Модель: P002010/ P002011)



Панель управления гентри (Модель: 6-S22355/6-S22356)

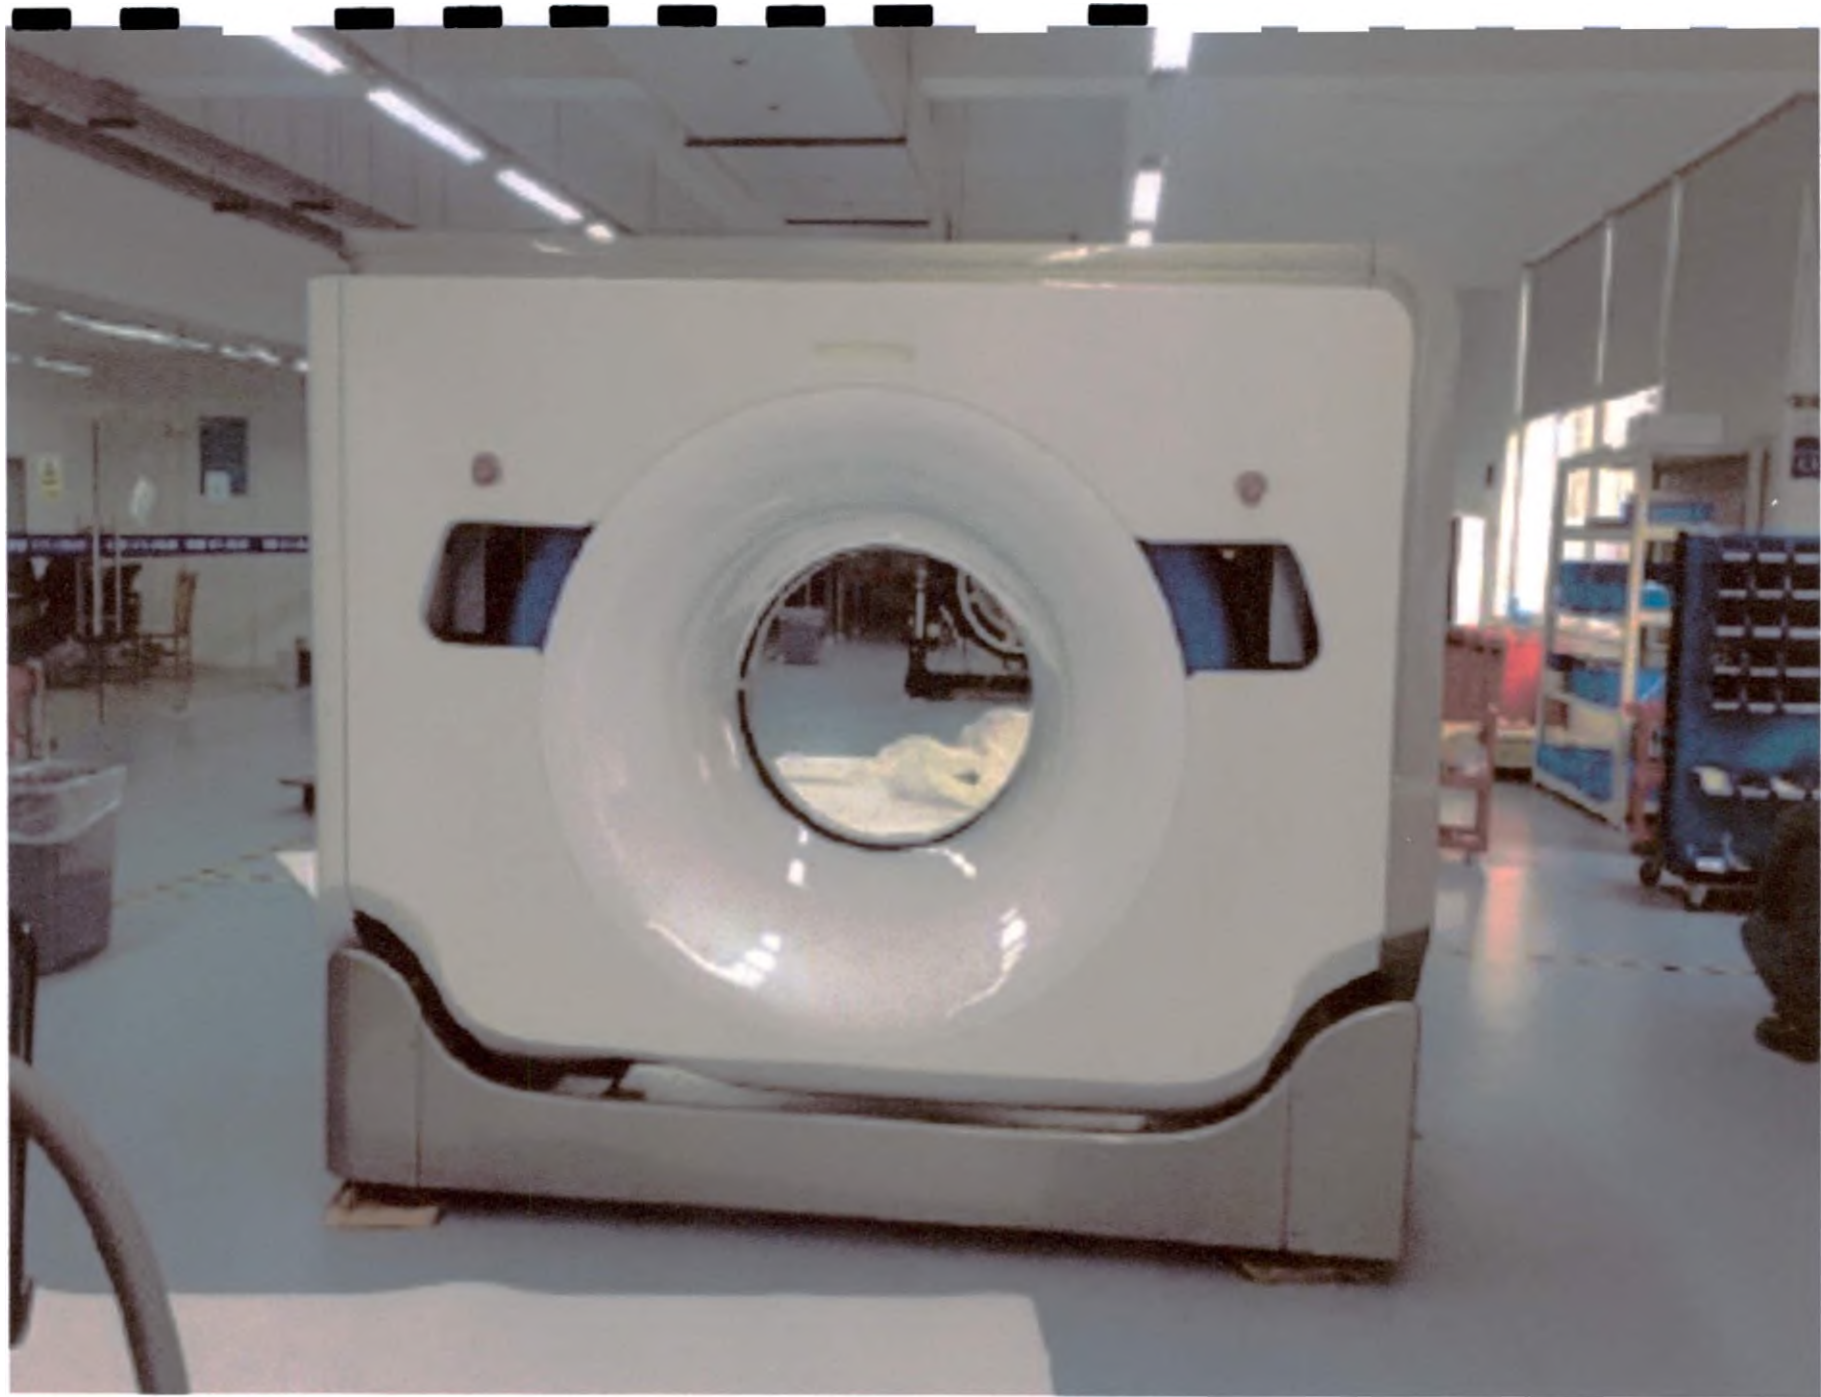

Кожухи для гентри (Модель: R001932)

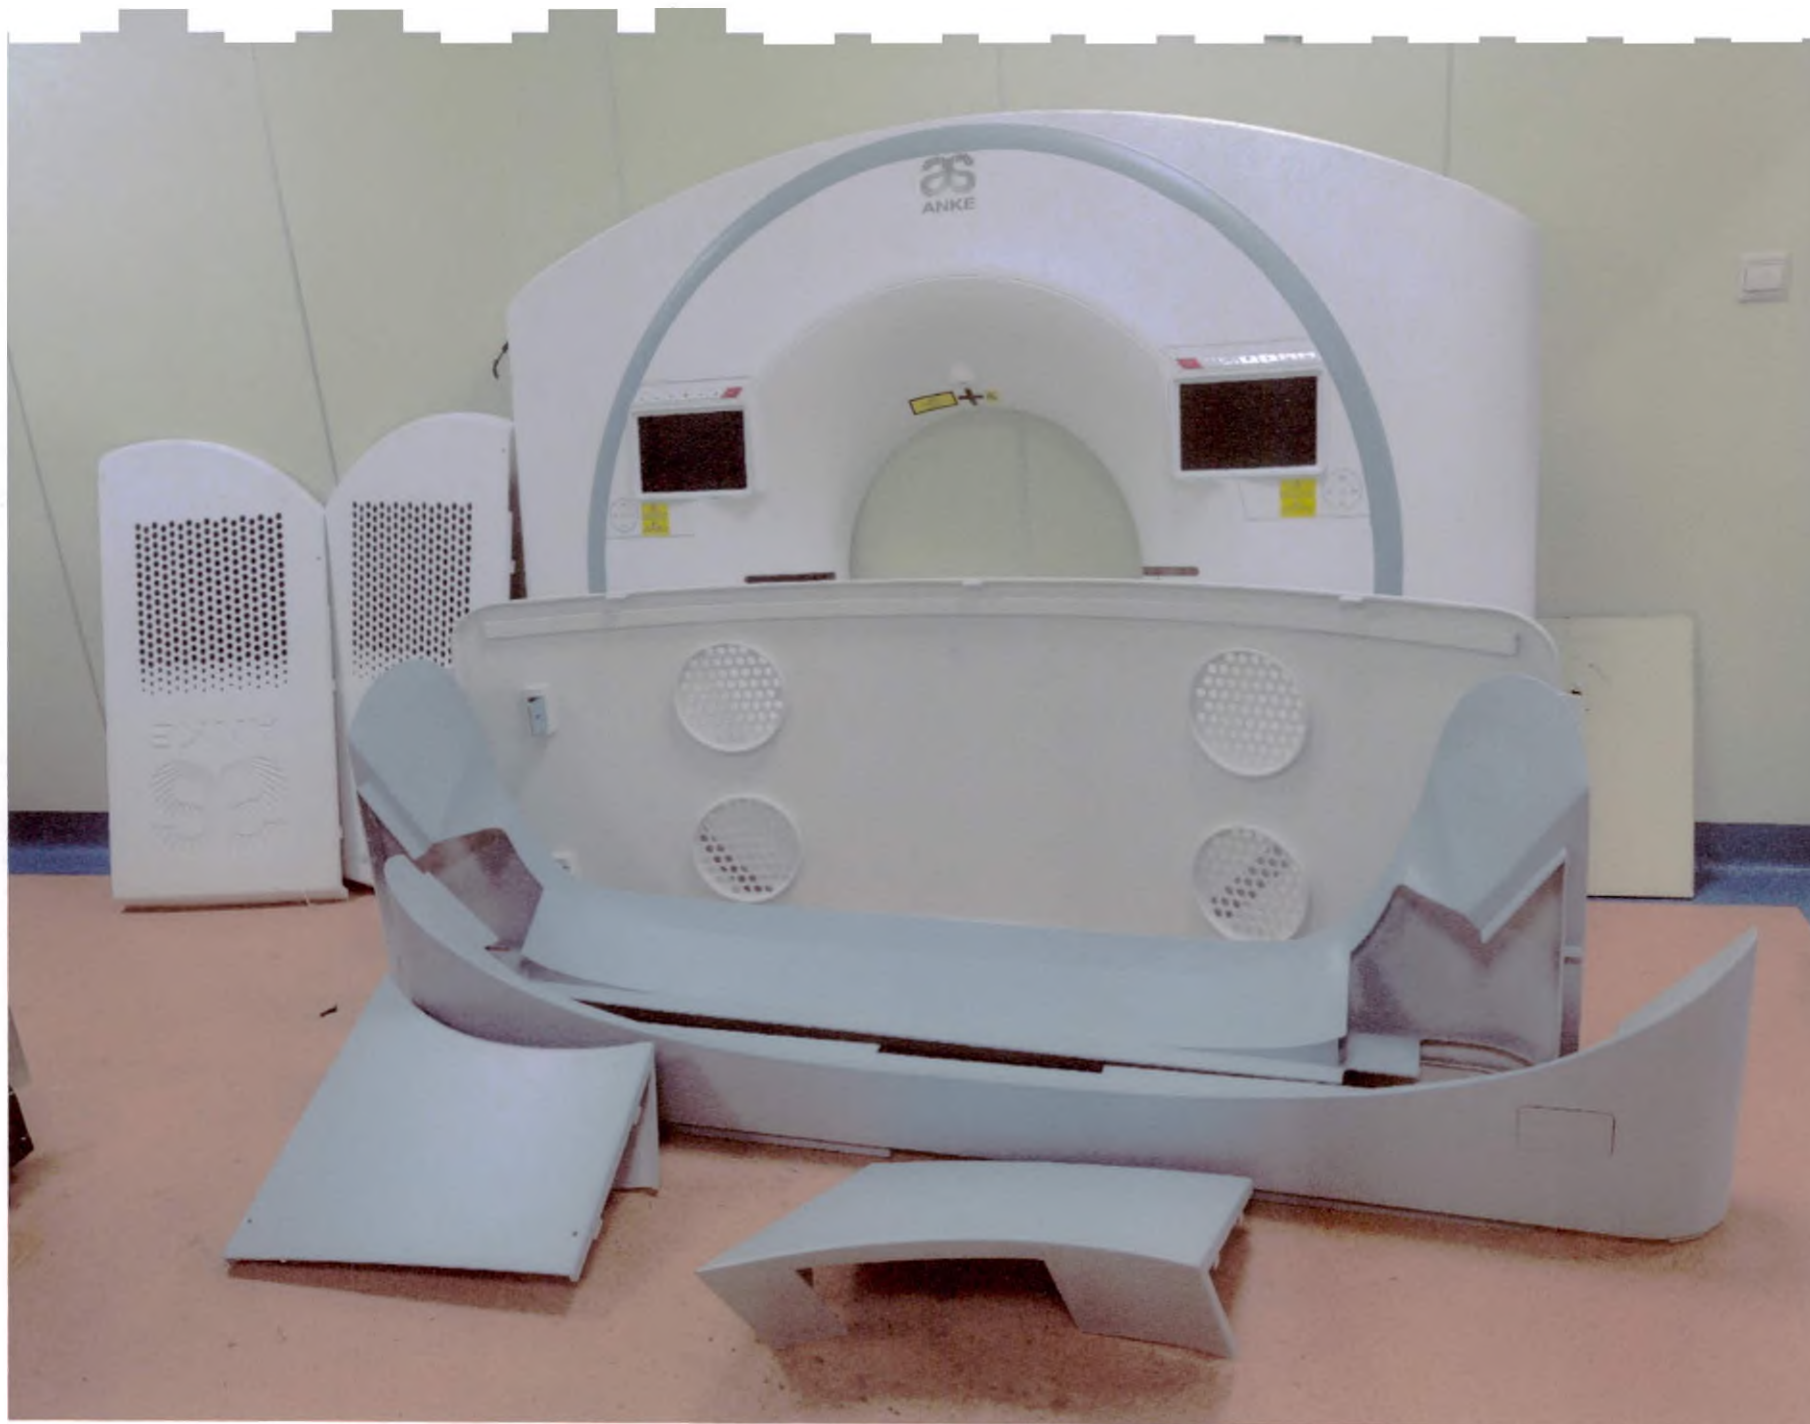


Кожухи для гентри (Модель: P002032)




Видеокамера (Только для Варианта 2)




Дека стола

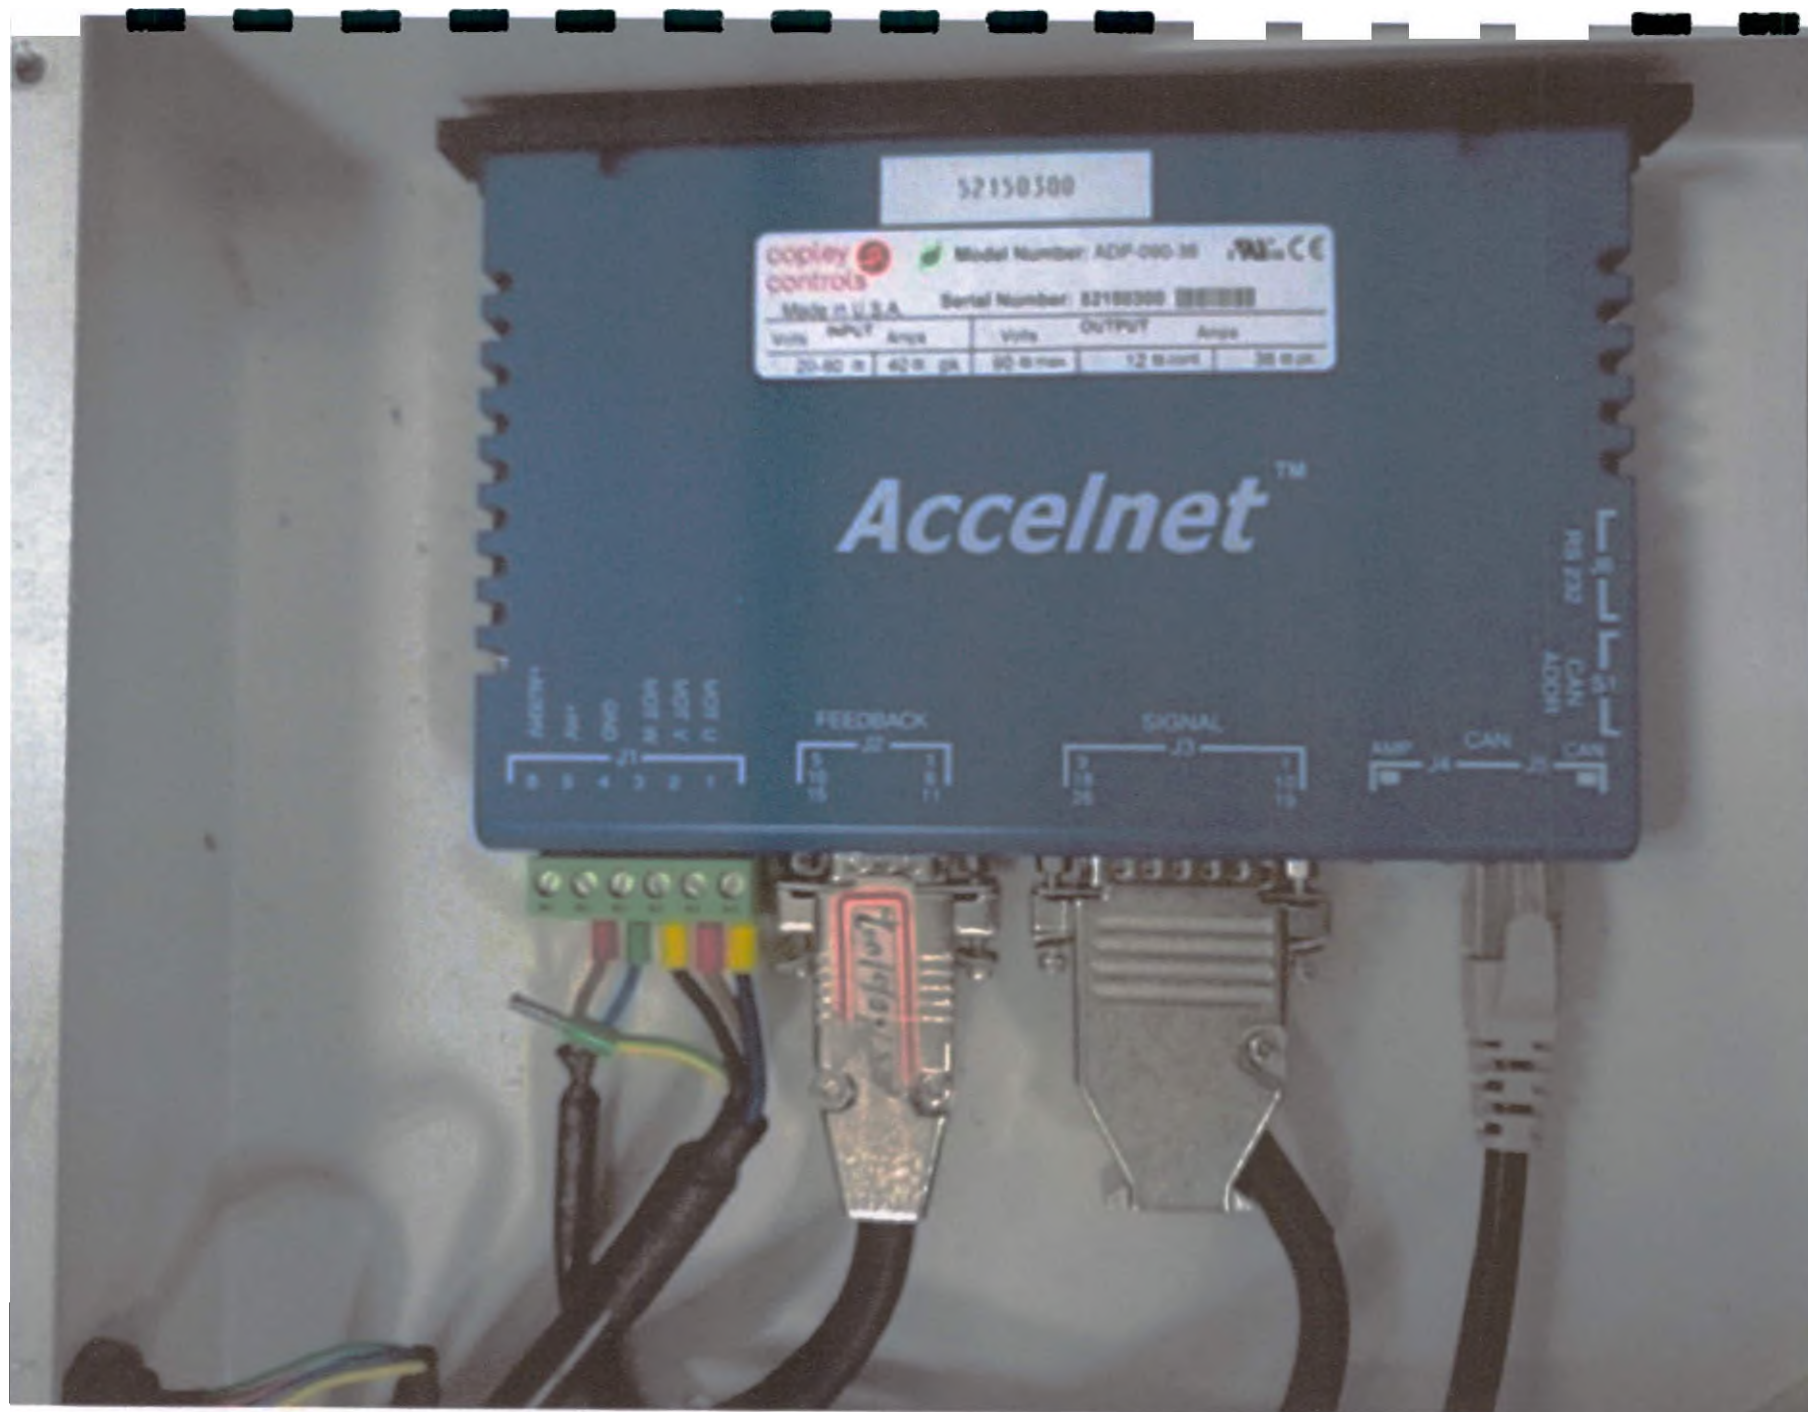


Блок управления горизонтального движения стола

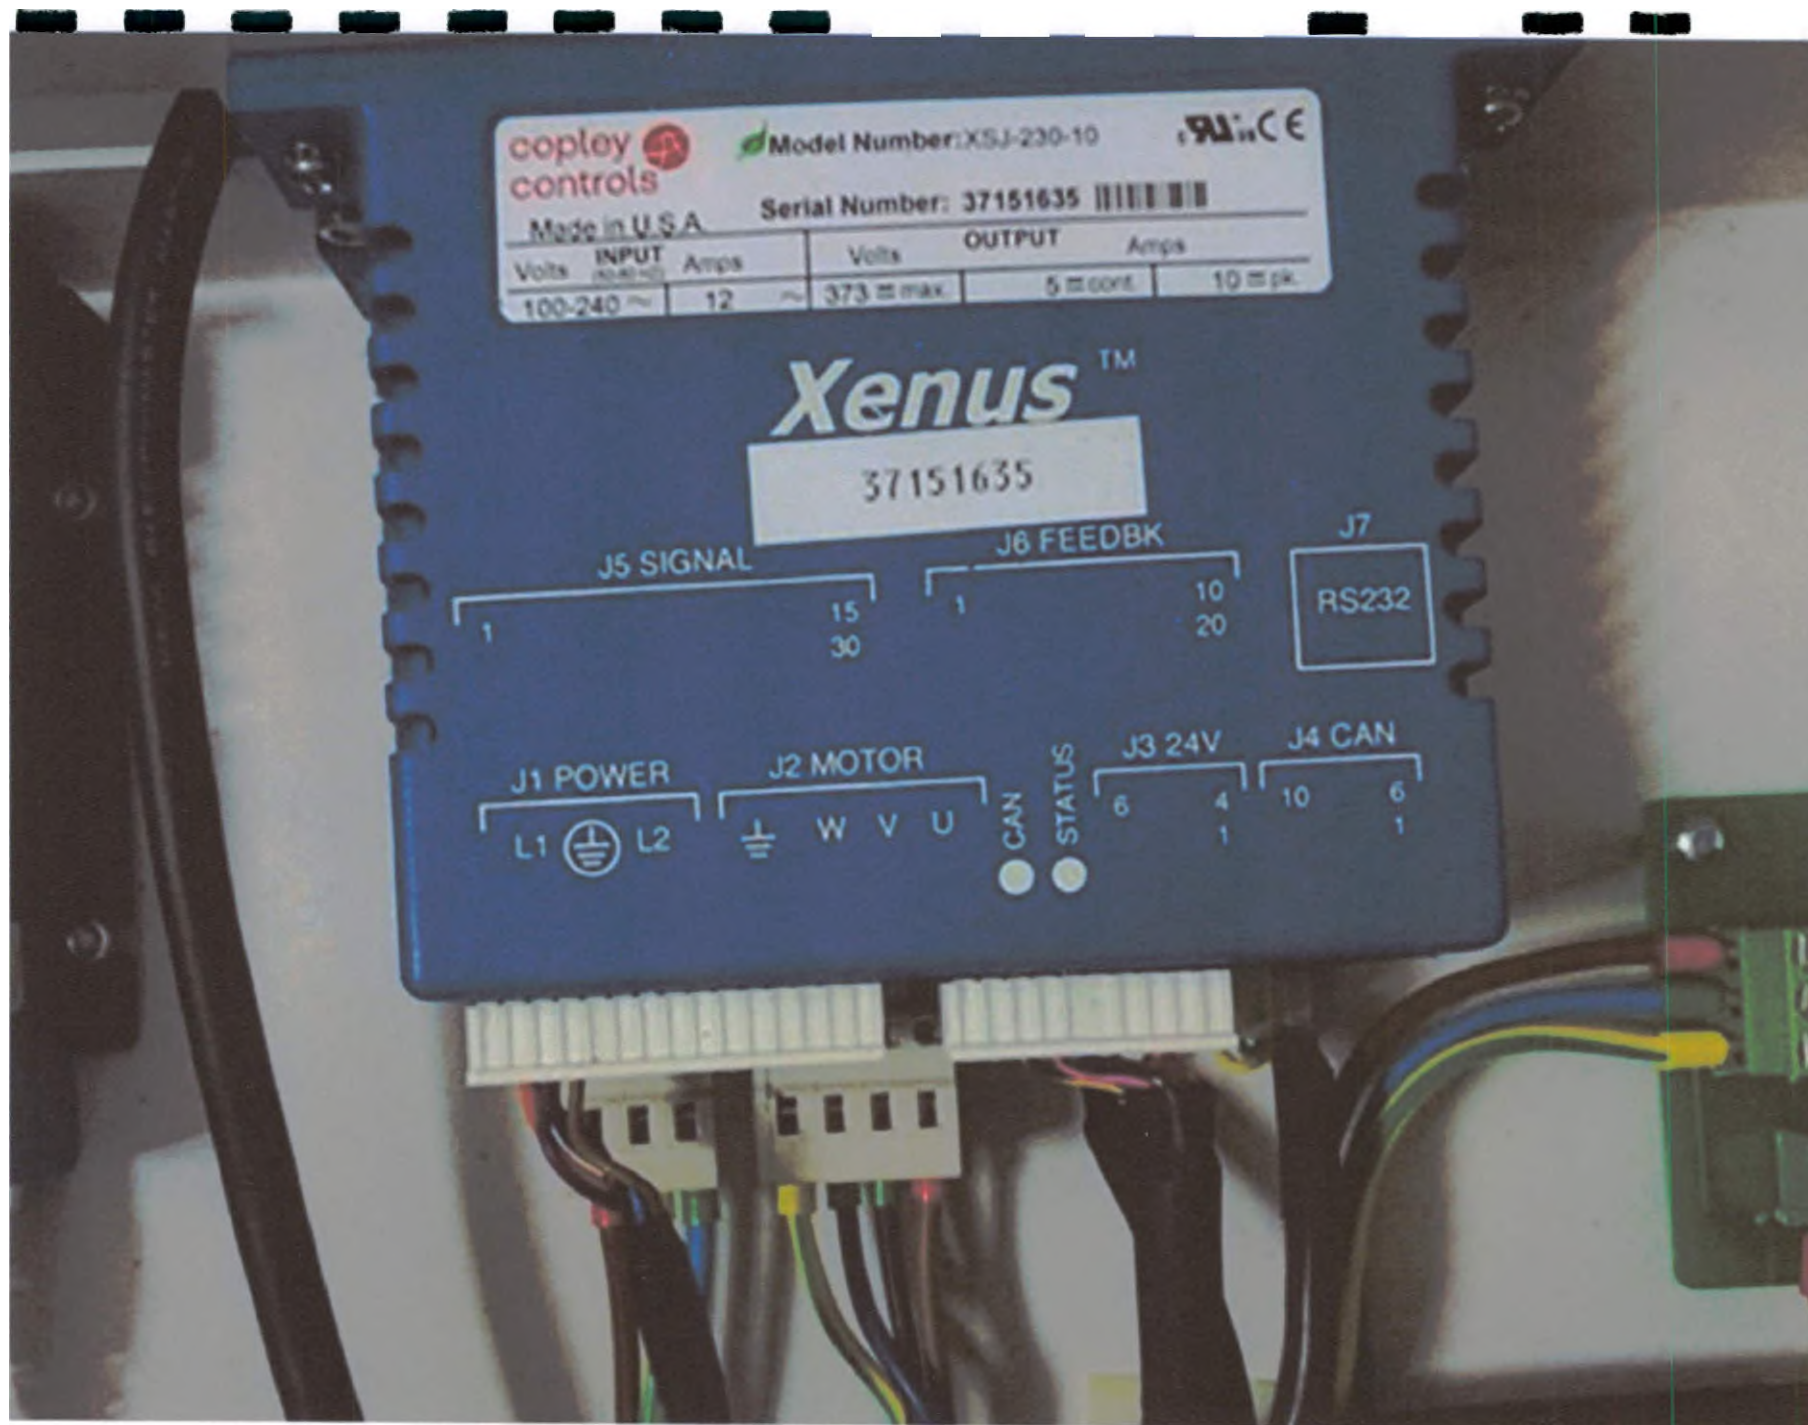

Блок управления вертикального движения стола

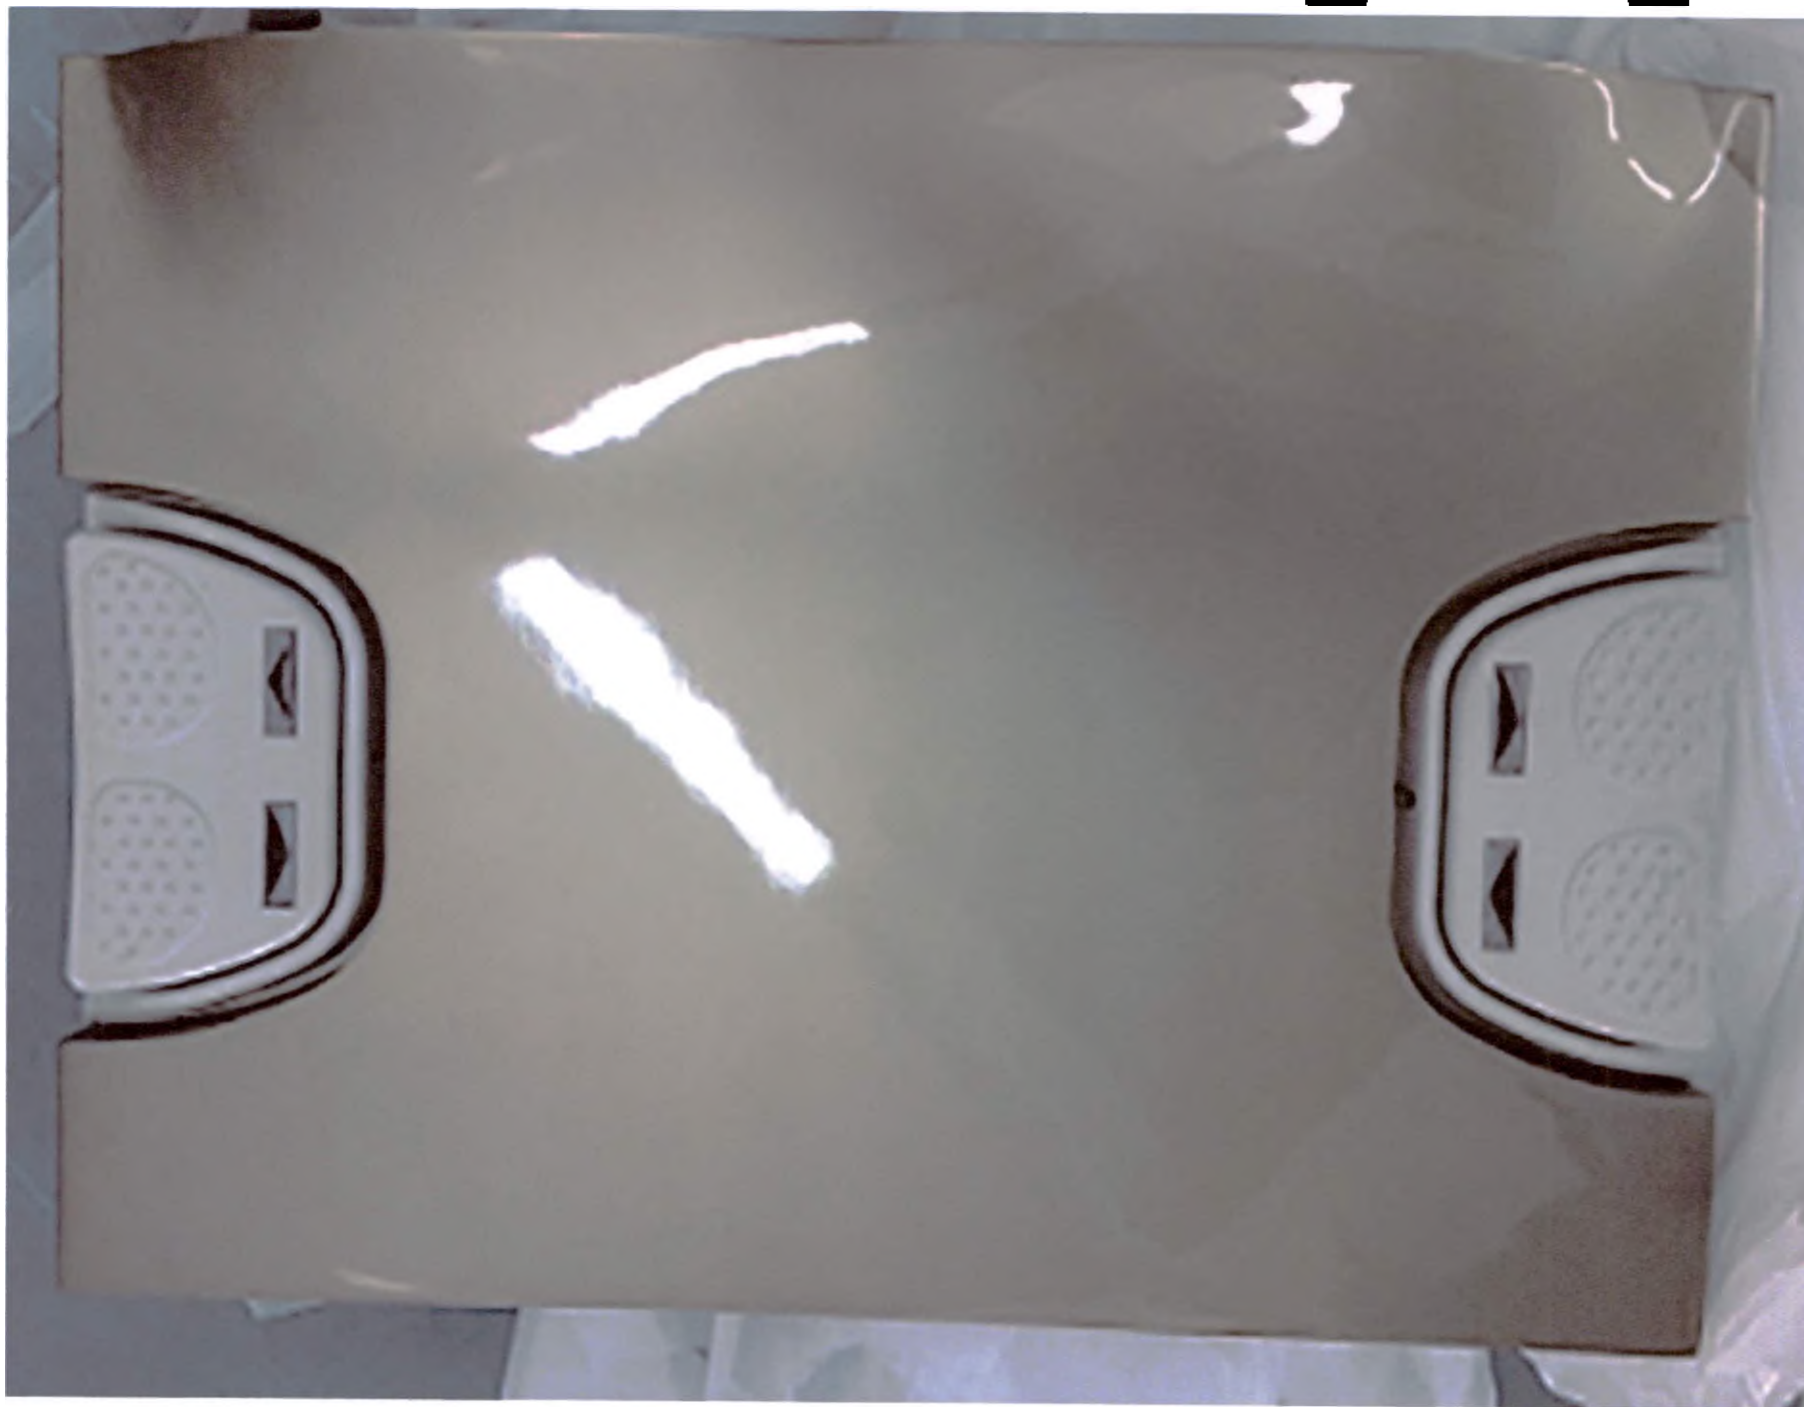

Блок педальный

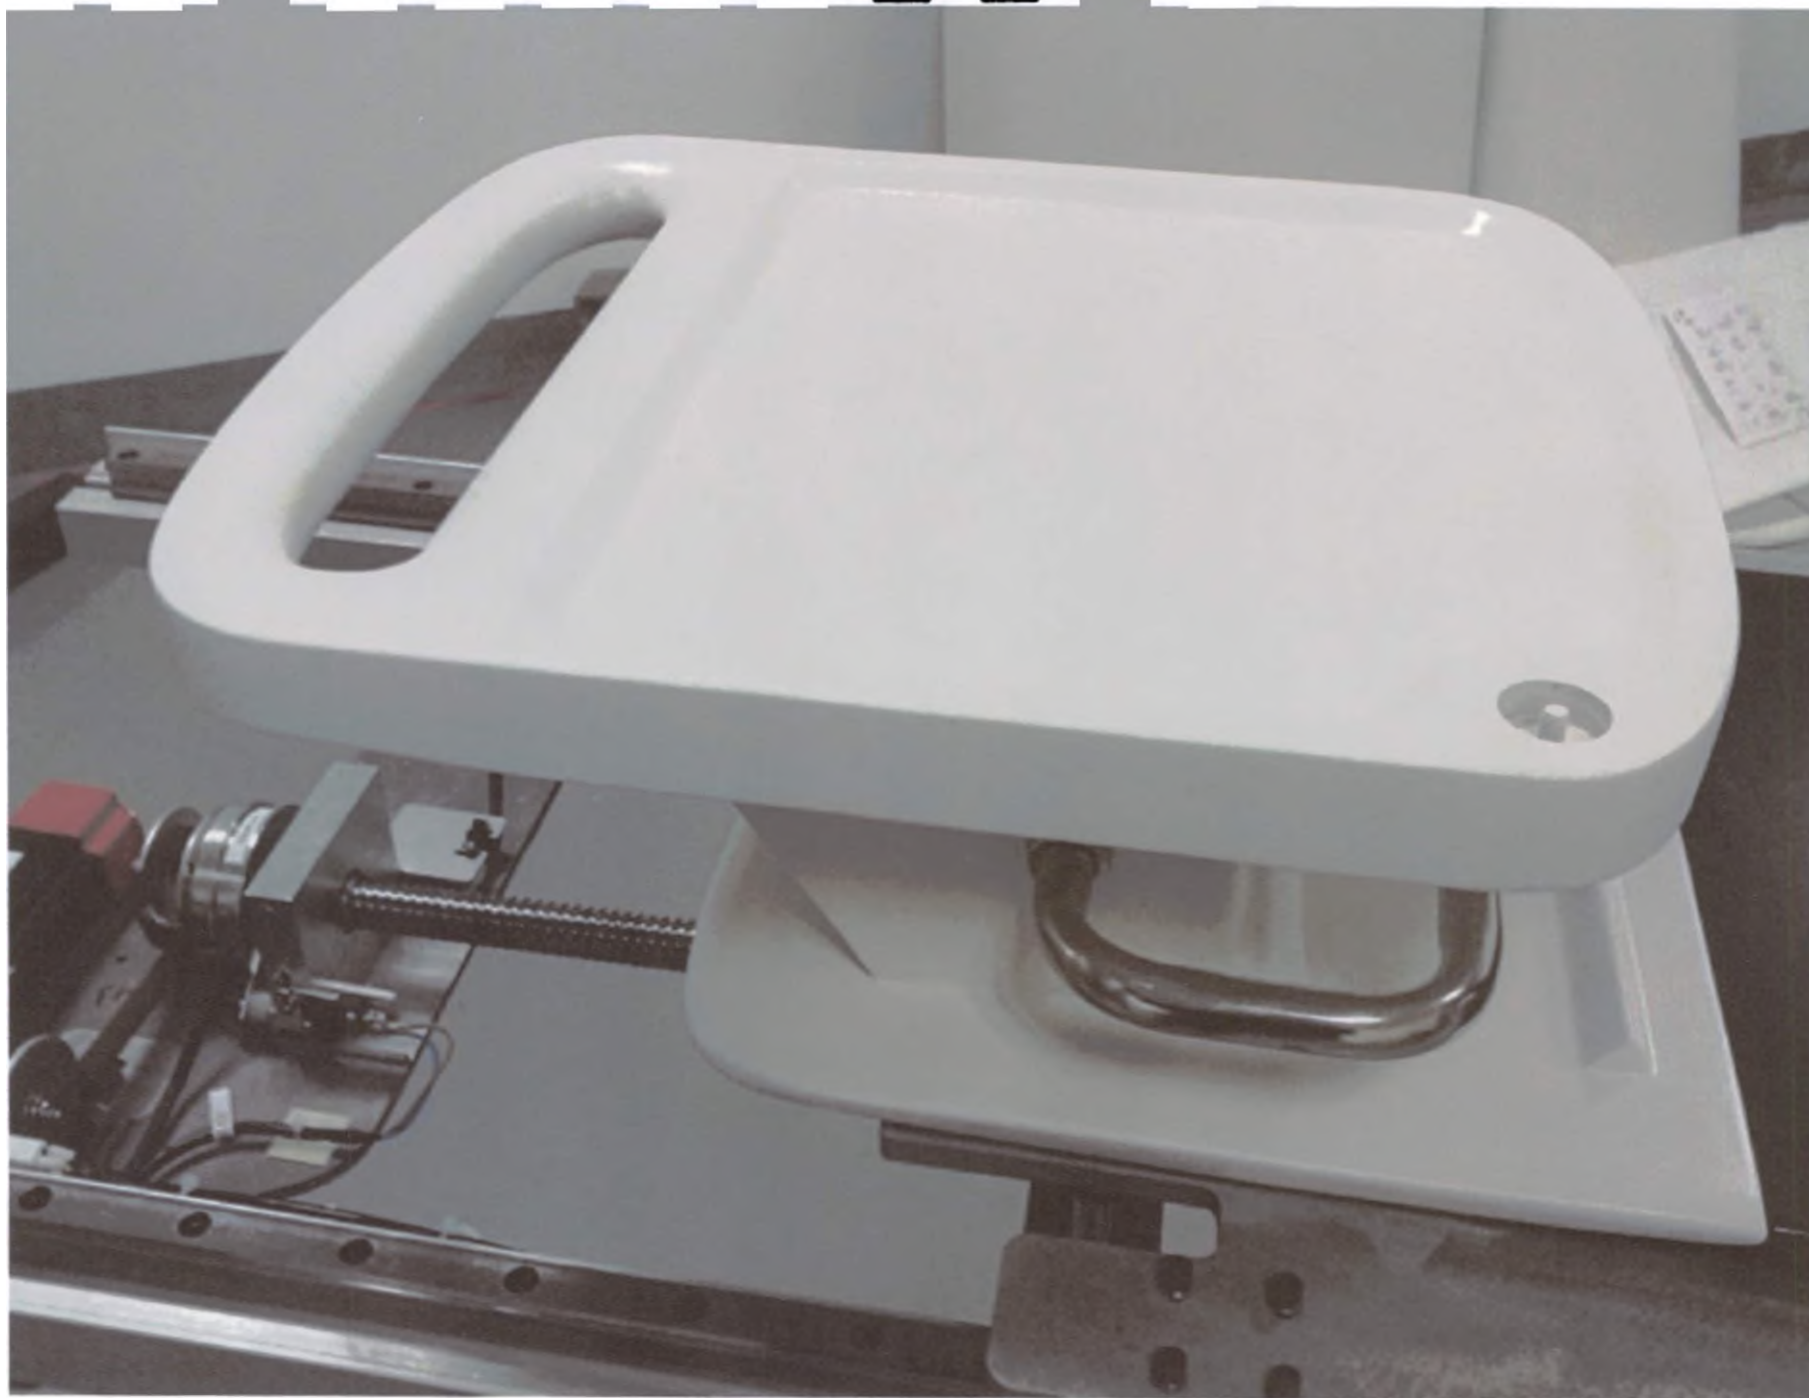

Подставка (Голько для варианта 1)



Кожухи для стола снимков (Только для Варианта 1)



Кожухи для стола снимков (Только для Варианта 2)



Питающее устройство



Томограф рентгеновский компьютерный
принадлежностями, модели ANATOM
64 Precision; ANATOM 64 Clarity

Руководство по эксплуатации
Русская версия R1.3



Shenzhen ANKE High-tech Co., Ltd.

Address: Block B, LingYe Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyao Sub-district
Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China

Tel: 86-755-21622518

Fax: 86-755-26695307

Сайт технической поддержки: <http://www.anke.com>

E-mail: service@anke.com



Томограф рентгеновский компьютерный
принадлежностями, модели ANATOM
64 Precision; ANATOM 64 Clarity

Выписка из технической документации
Русская версия R1.3



Shenzhen ANKE High-tech Co., Ltd.

Address: Block B, LingYe Industrial Zone, Tangtou No. 1 Road, Shiyao Sub-district
Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China

Tel: 86-755-21622518

Fax: 86-755-26695307

Сайт технической поддержки: <http://www.anke.com>

E-mail: service@anke.com



Блок управления со встроенной системой интерком



Рабочая станция оператора для обработки цифровых изображений



Персональный компьютер

About System



Name : Anke ANATOM ClearVIEW X Ray Computer Topography System Soft
Soft Version: V1.0 Full Version : V1.0.201210
Device Model: ANATOM 64 Precision
Image Save Path: d:\FsTaichi\Taichi64Data\
Current Language: English
Hospital Name:
Department Name:
Station Name: Anke-CT
Device ID: AJ009N00200232
Dog Valid Date: 2022-03-17
Code Valid Date: Permanent Code
Scanned Patients: 540

CopyRight(C) Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd. 2019


Run Time: 00:00:29

Update Code

Update Dog

OK

Программное обеспечение Anke ANATOM ClearVIEW X Ray Computed Tomography System Software версии V1.0 201210 от
10.12.2020



Enter password: *****

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 436

Server version: 5.6.10 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

LCD монитор






Клавиатура/Клавиатура для рабочей станции врача



Манипулятор типа «мышь»/ Манипулятор типа «мышь» для рабочей станции врача



Источник бесперебойного питания

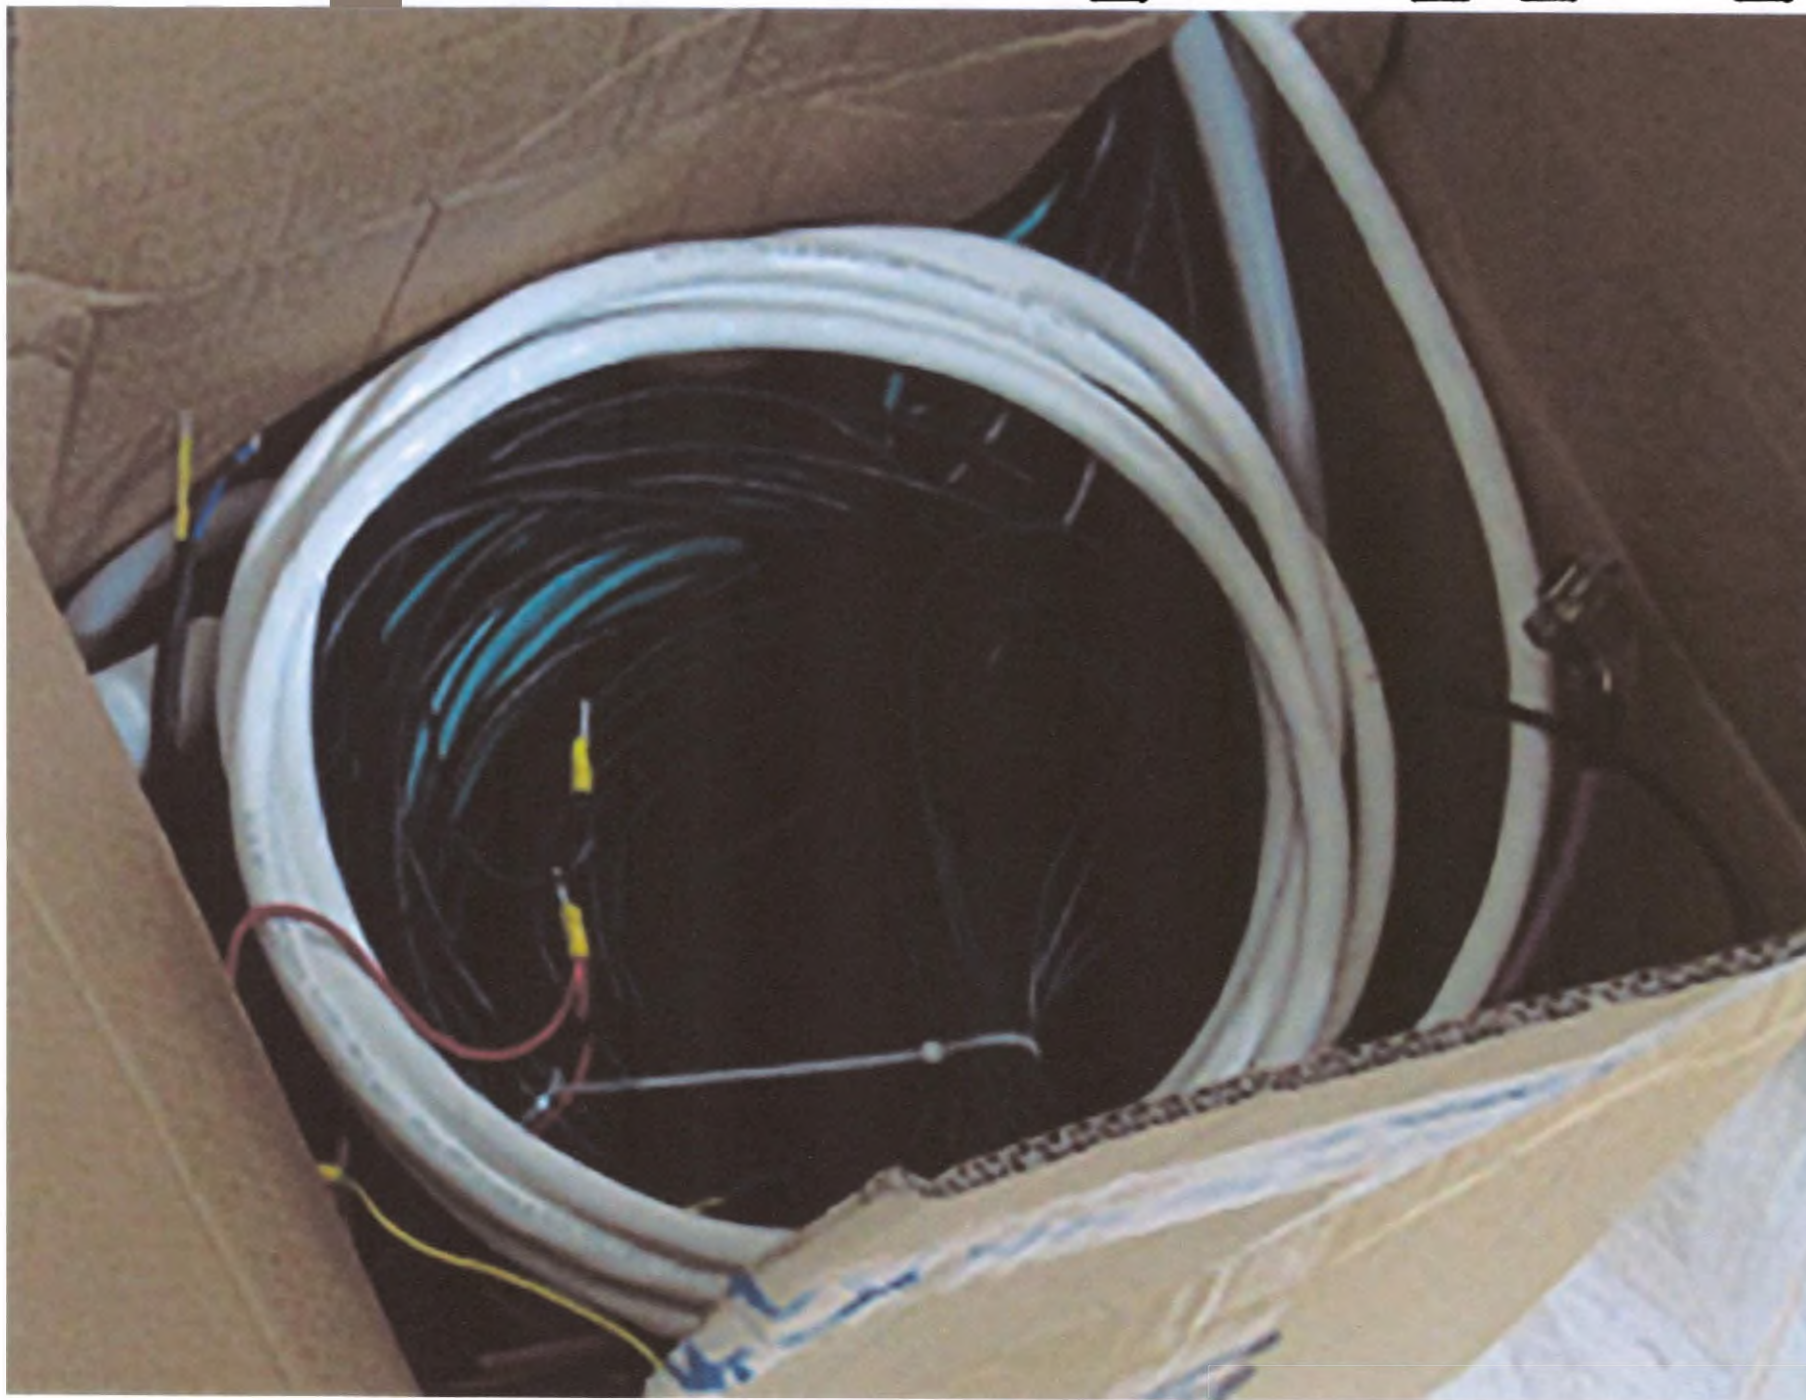

Силовые и соединительные кабели



Фантом калибровочный с фиксатором




Стол для рабочей станции оператора, кресло для оператора/ Стол для рабочей станции врача, кресло для врача




Рабочая станция врача для обработки цифровых изображений




Персональный компьютер

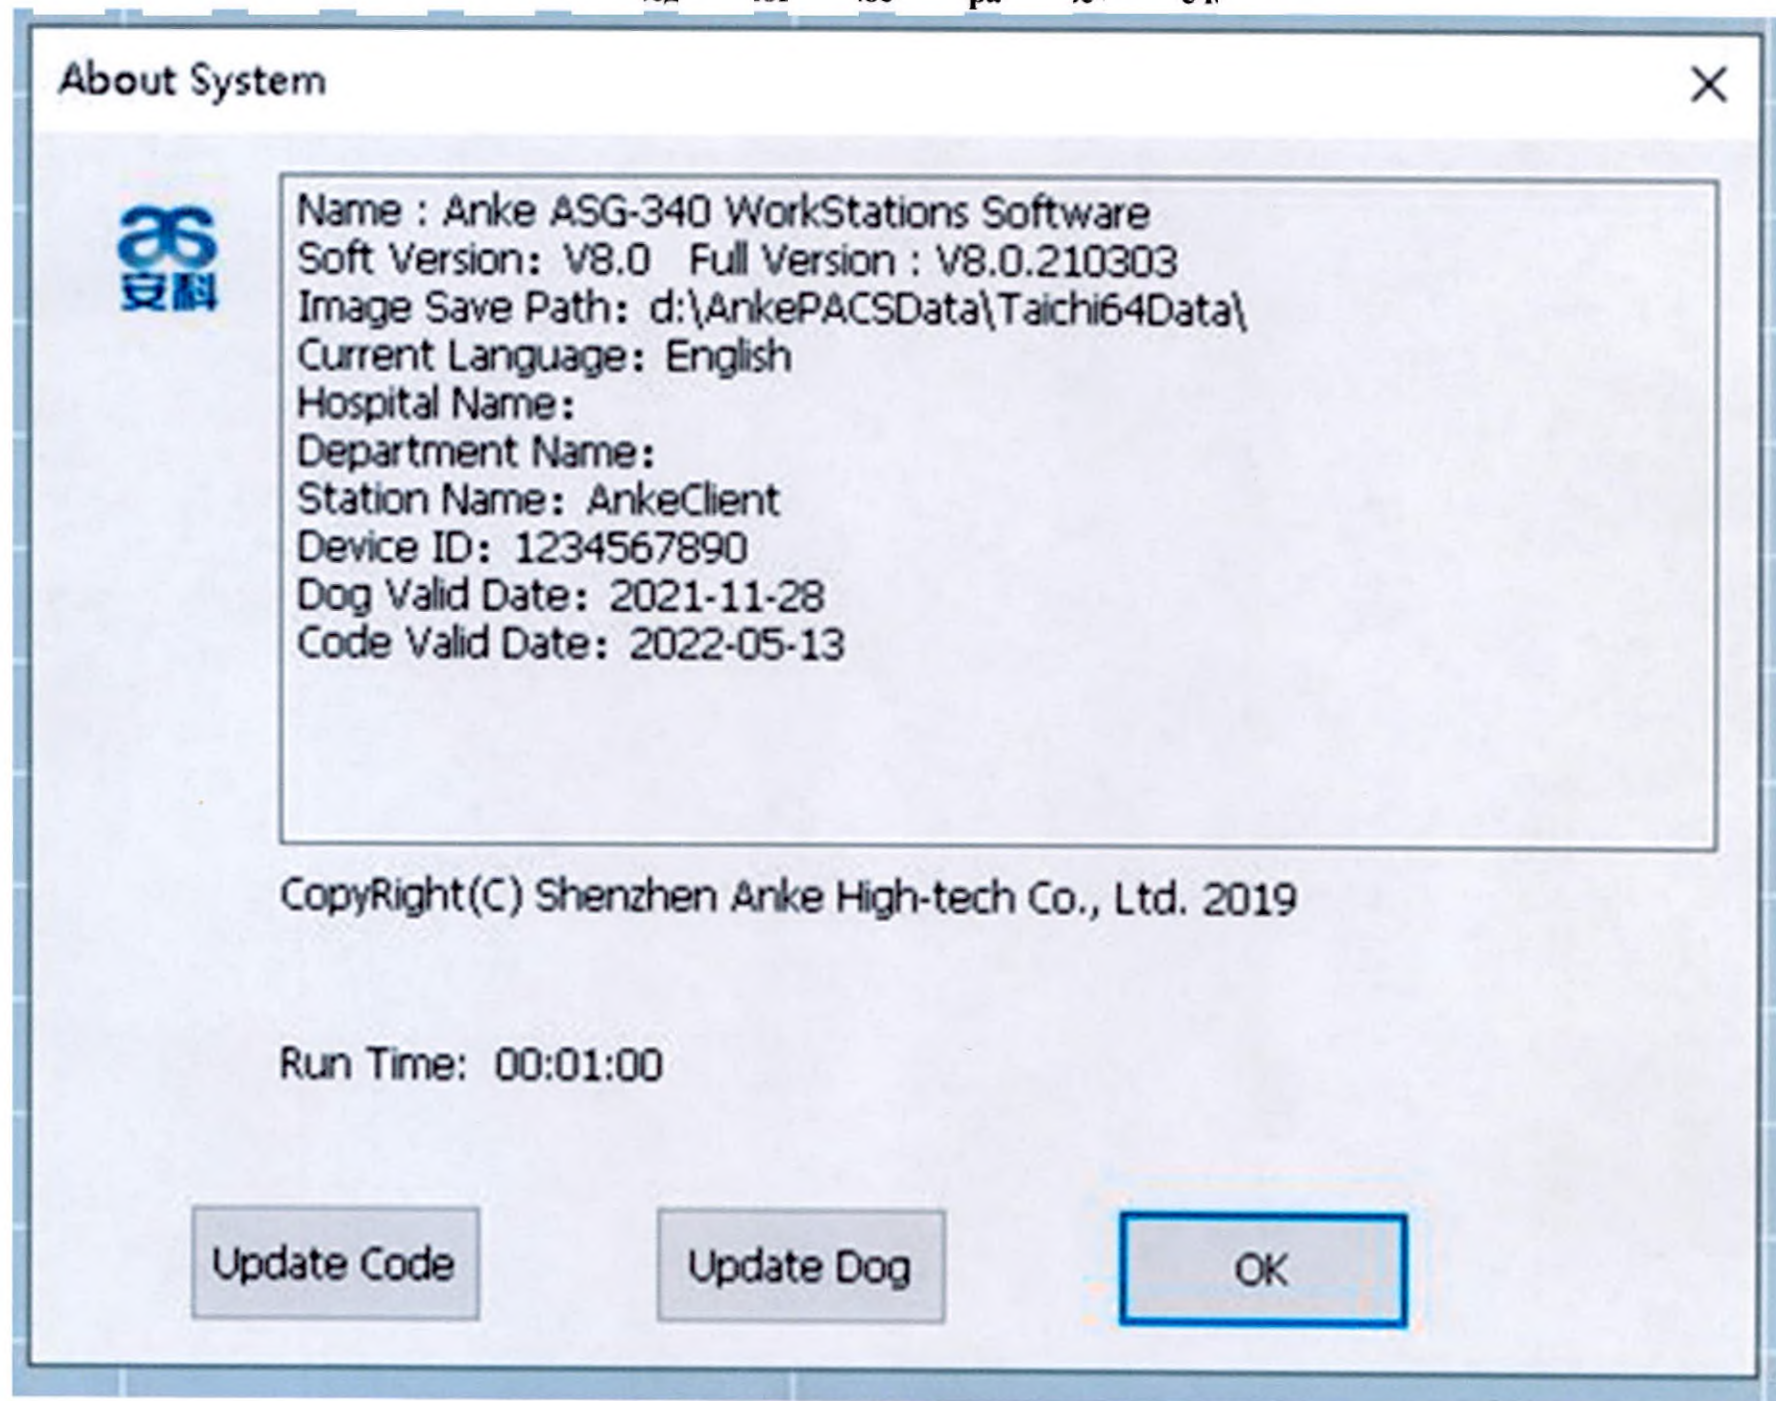


Программное обеспечение Anke ASG-340 V8.0 от 03.03.2021

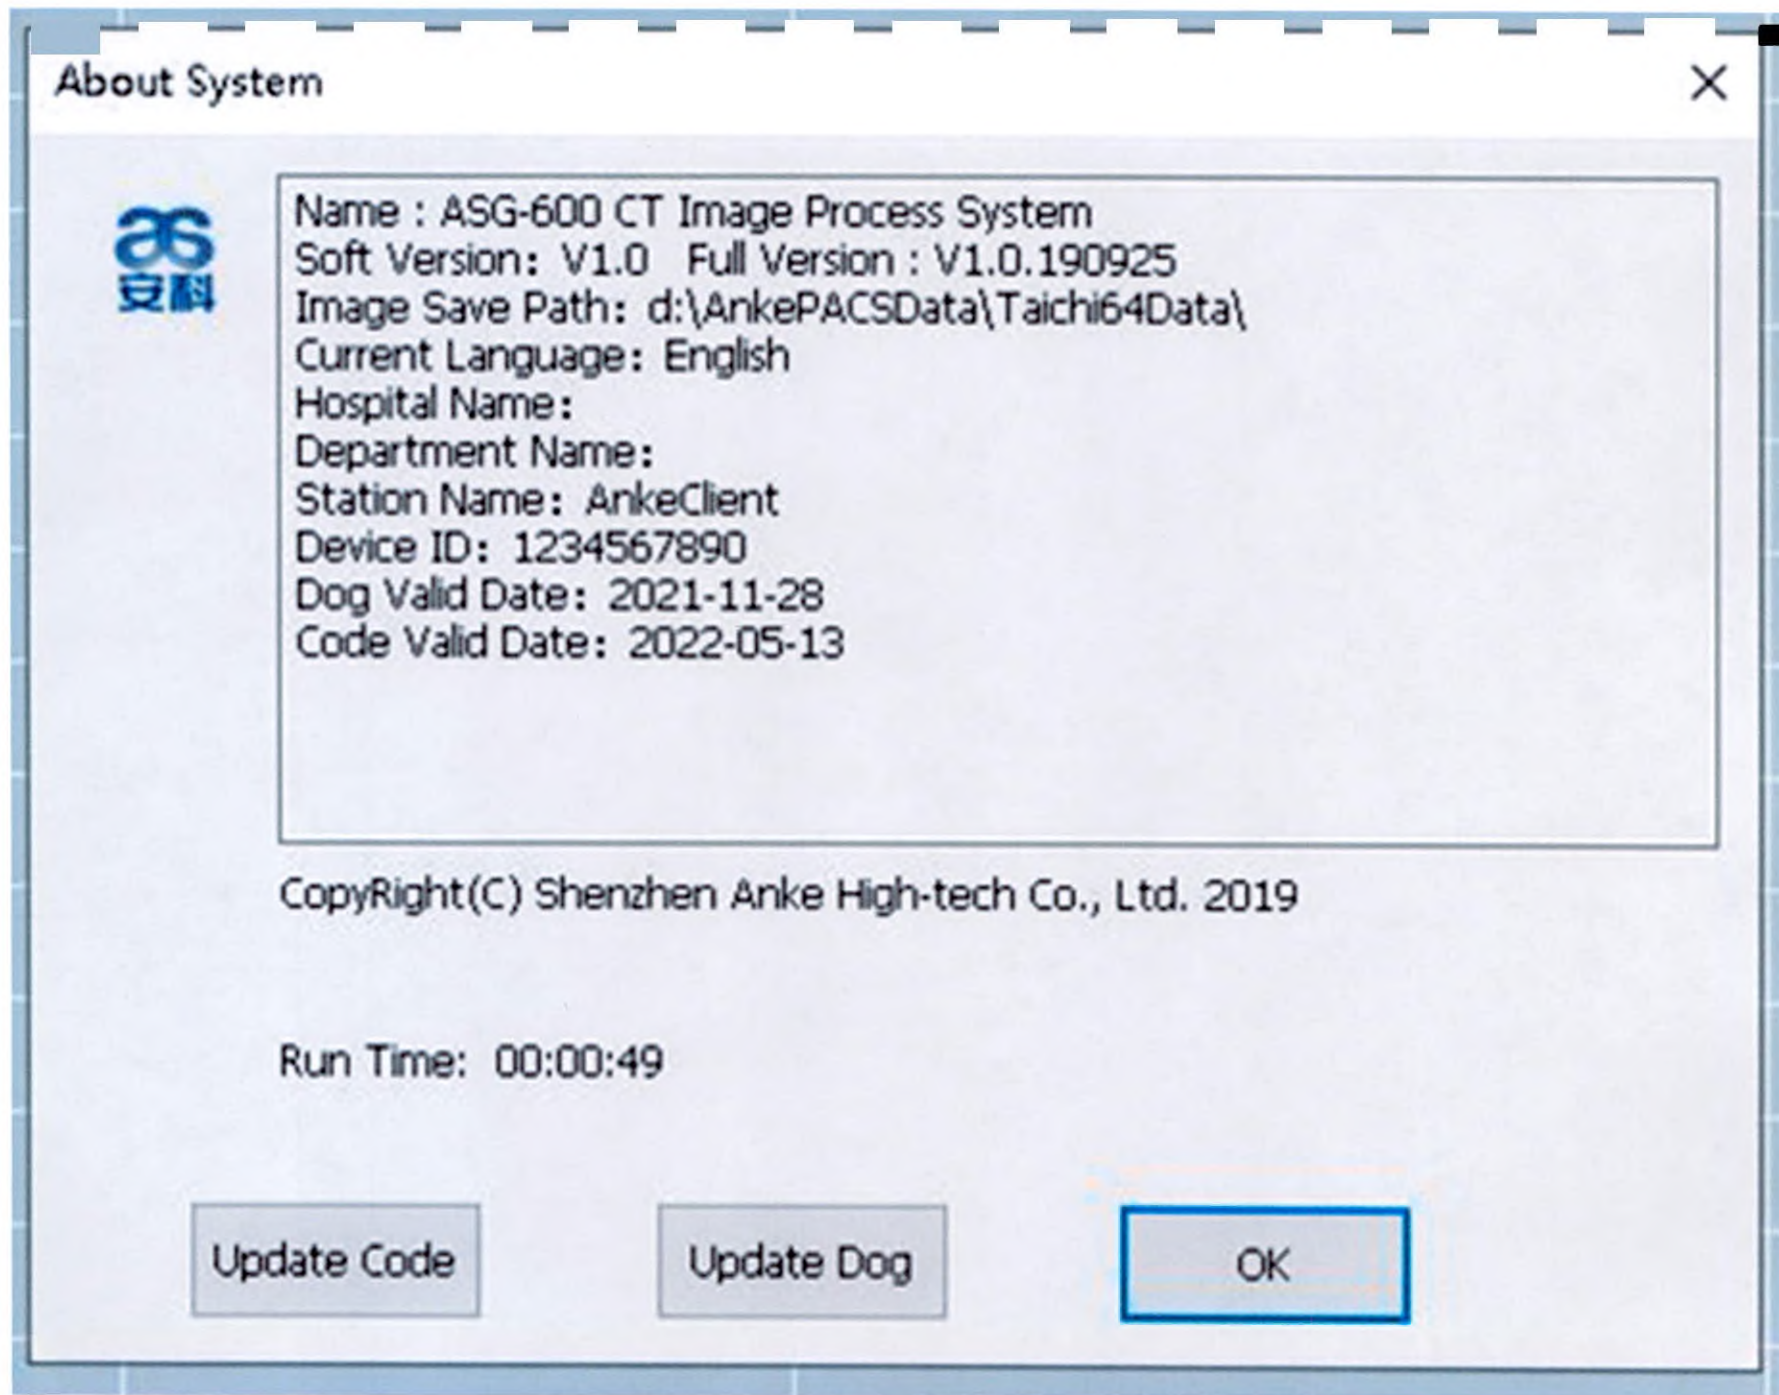

Программное обеспечение ASG-600 V1.0 от 25.09.2019

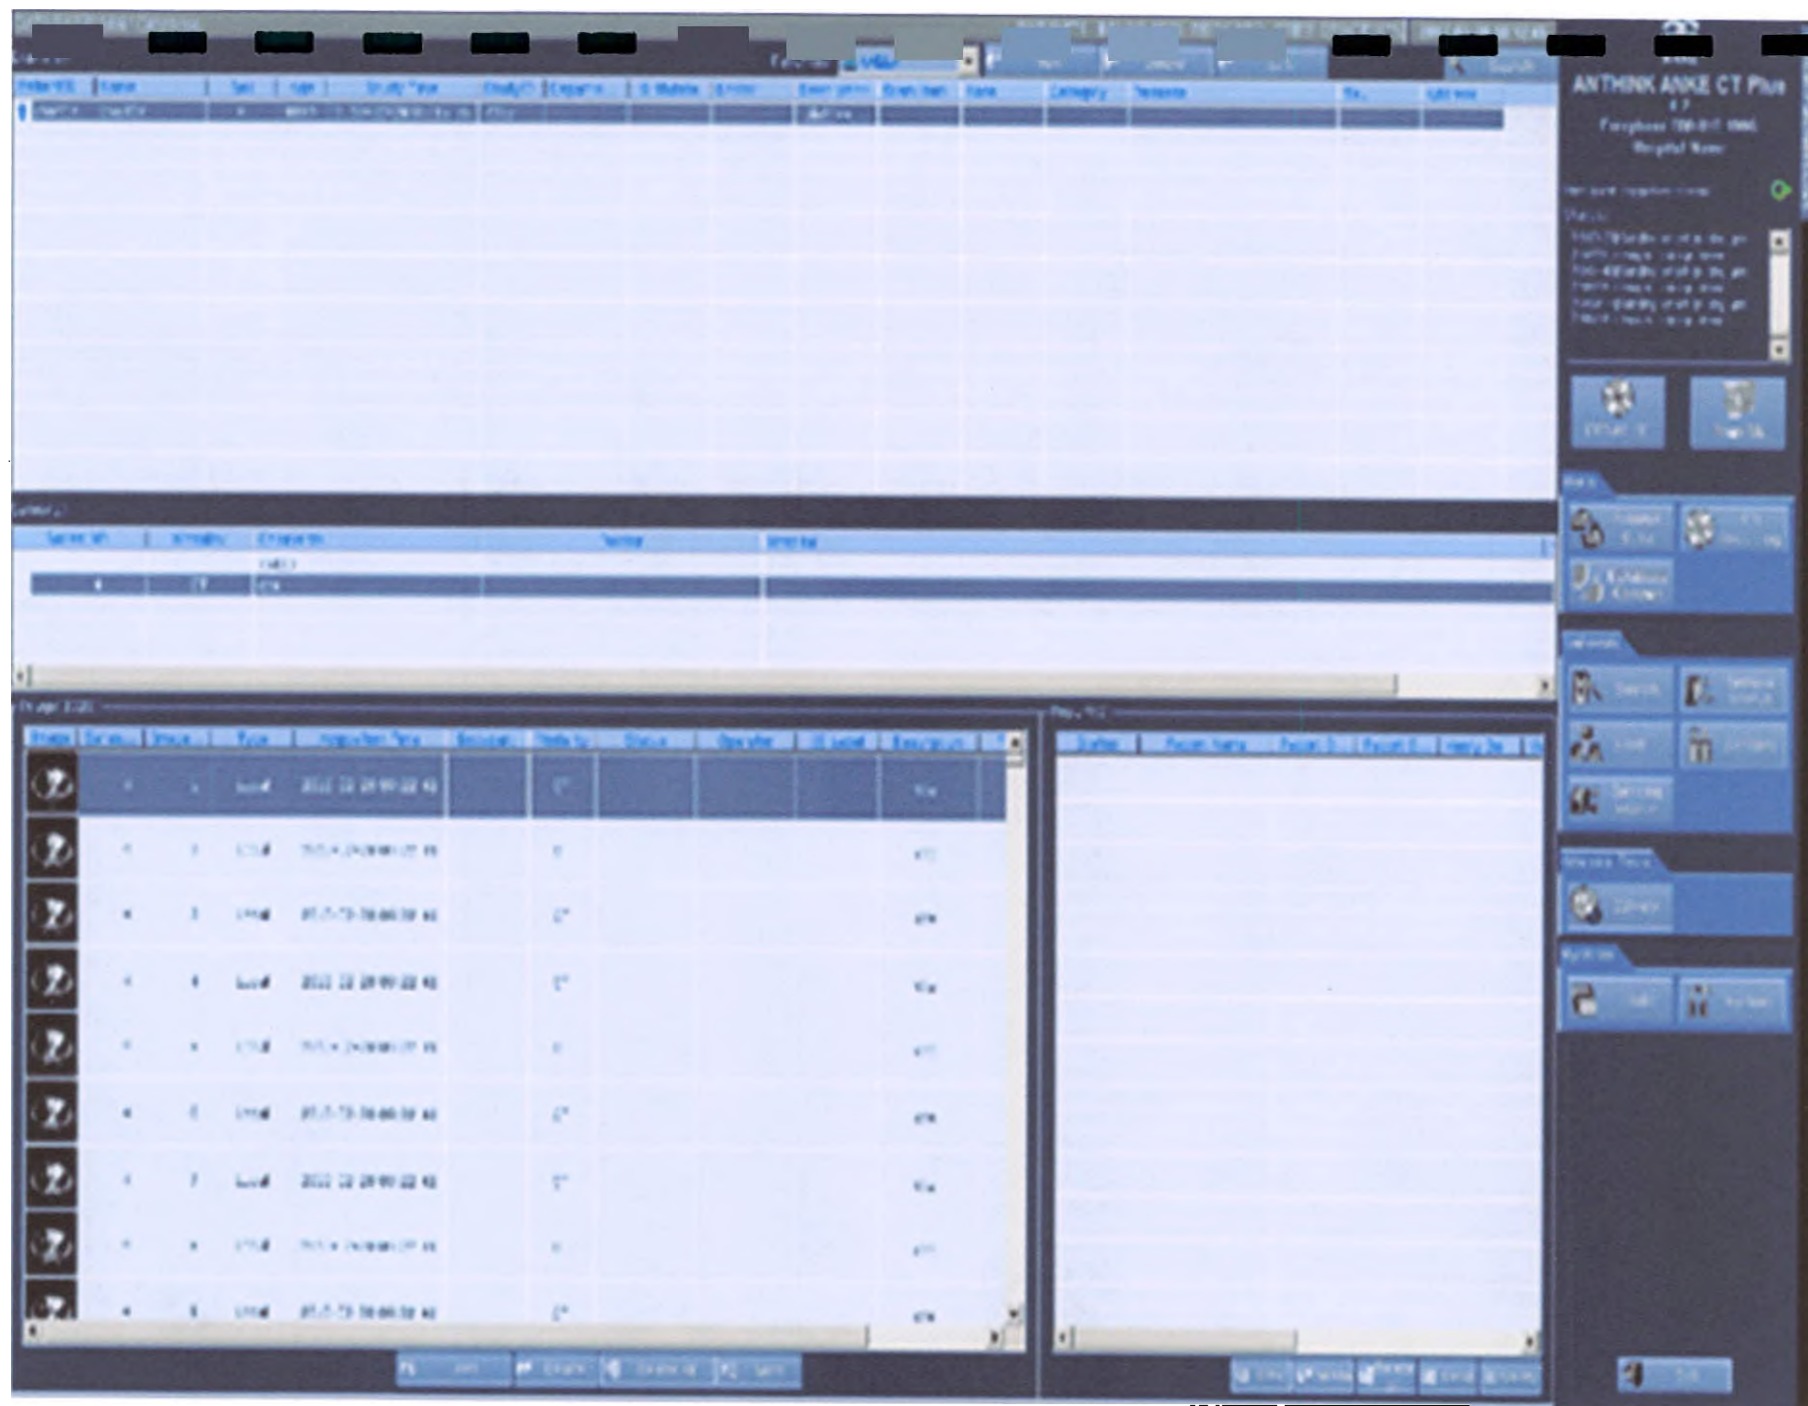

Программное обеспечение ANYTHINK ANKE CT Plus V4.2 от 24.09.2020

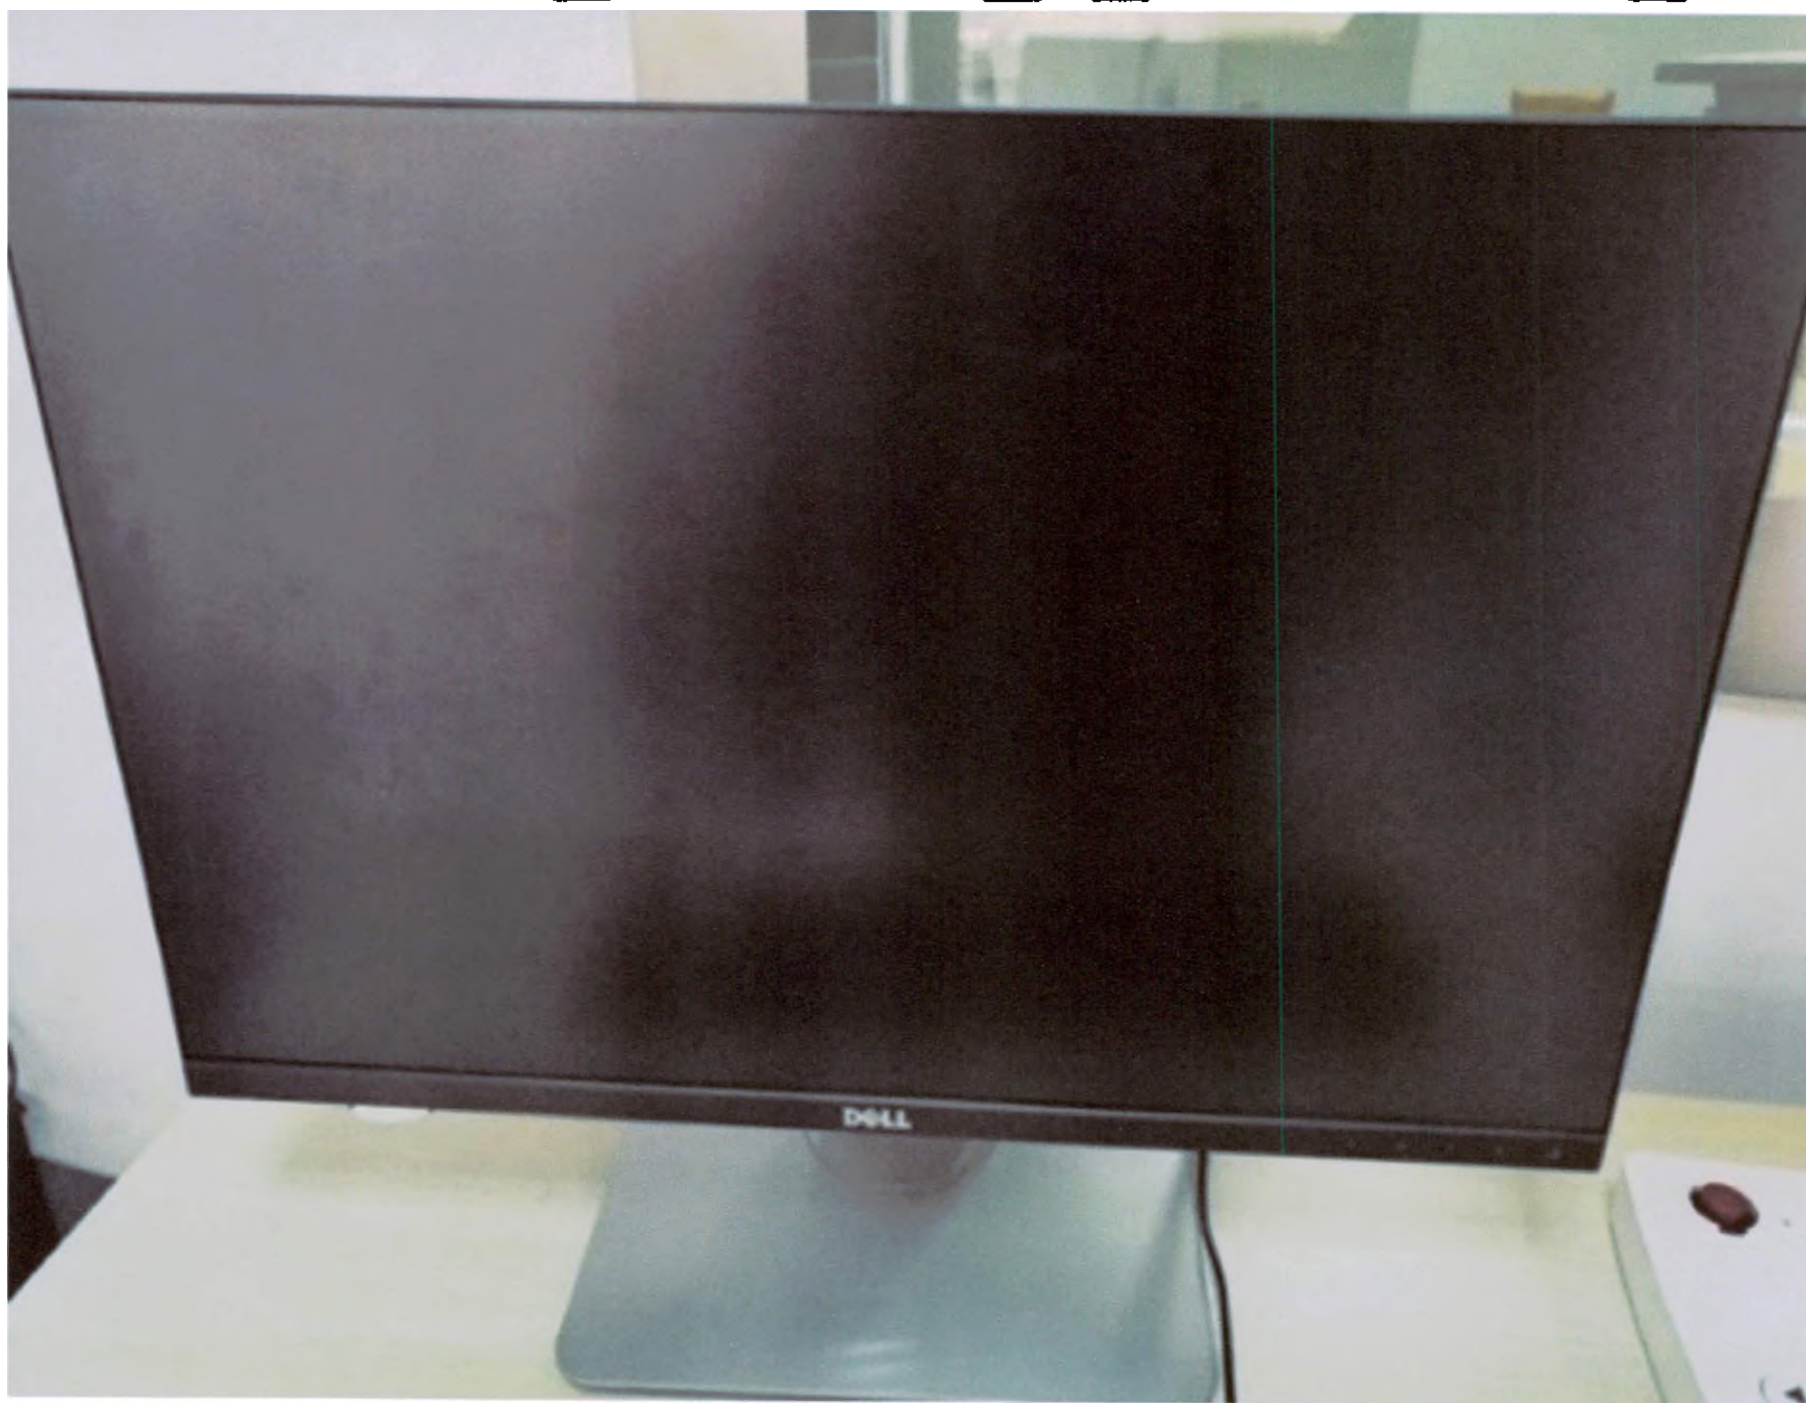


LCD монитор/Дополнительный LCD монитор медицинский для рабочей станции врача



Лазерный принтер



Щит распределительный

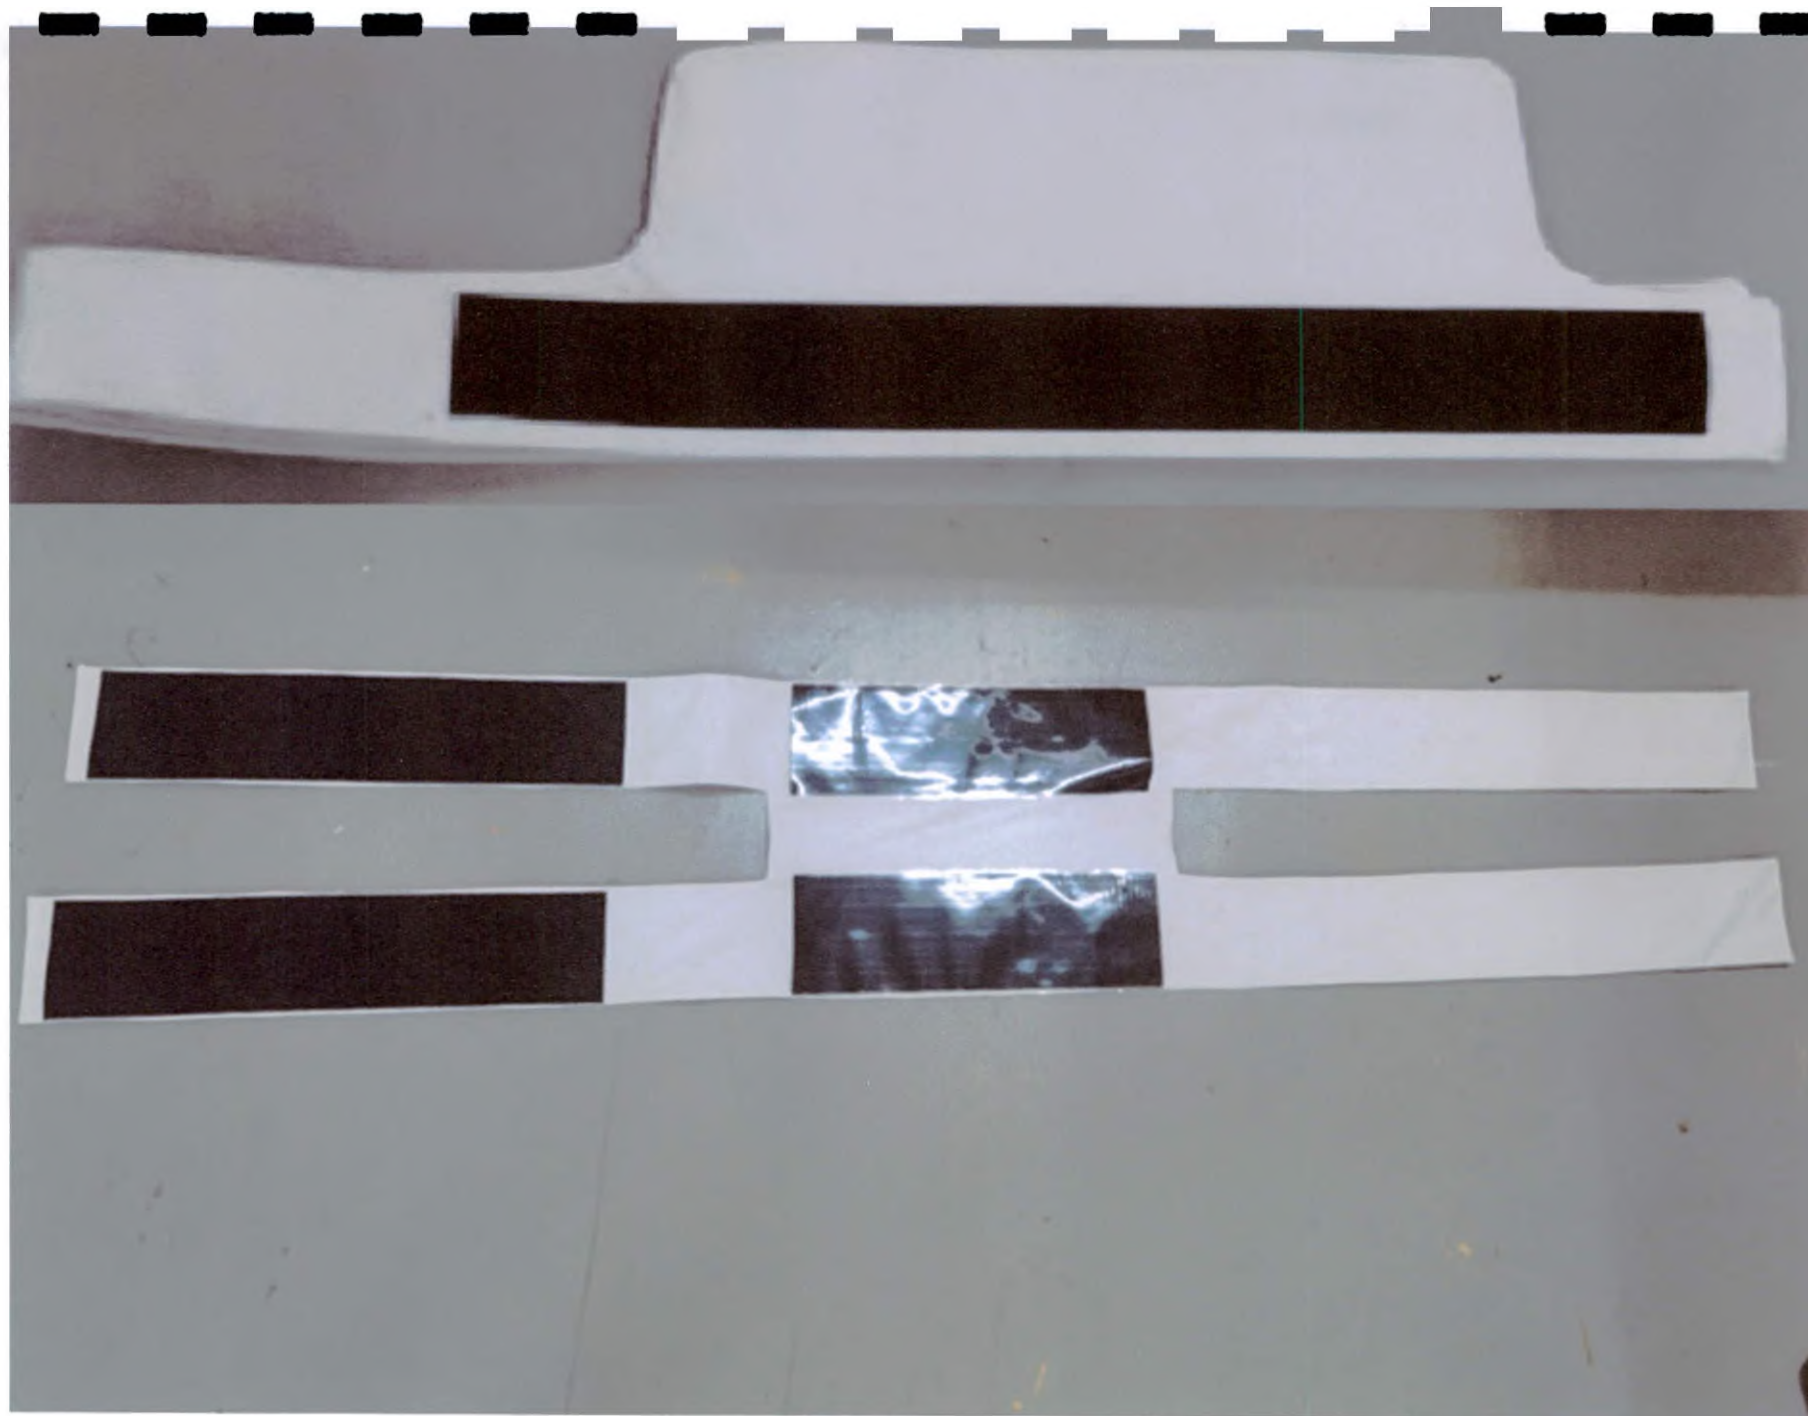

Фиксирующие ремни




Принадлежность для поддержки головы




Регулируемая опора головы (Модель: P001626)



Регулируемая опора головы (Модель: P002626)

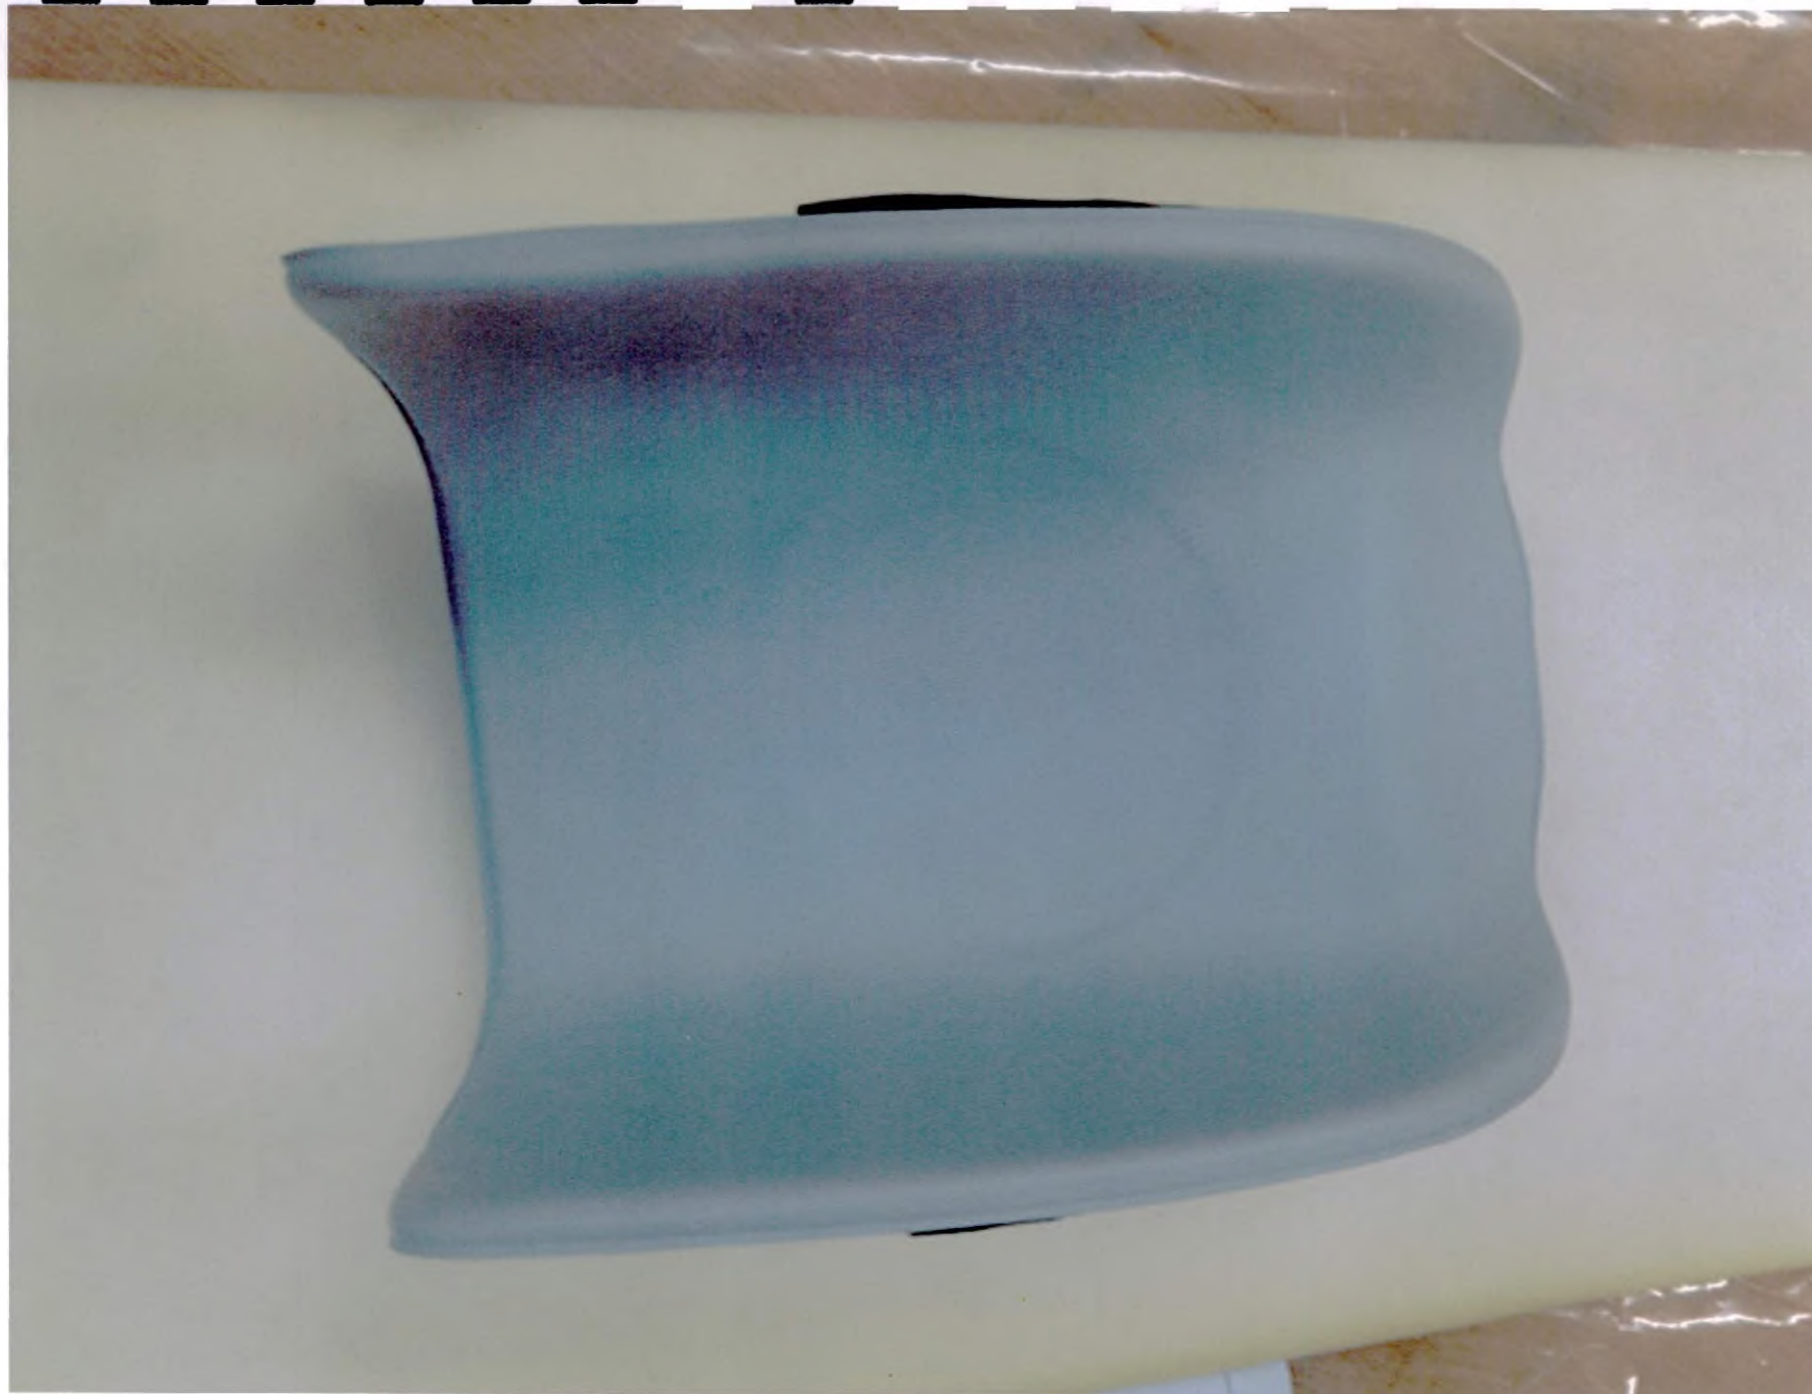


Подкладка для головы

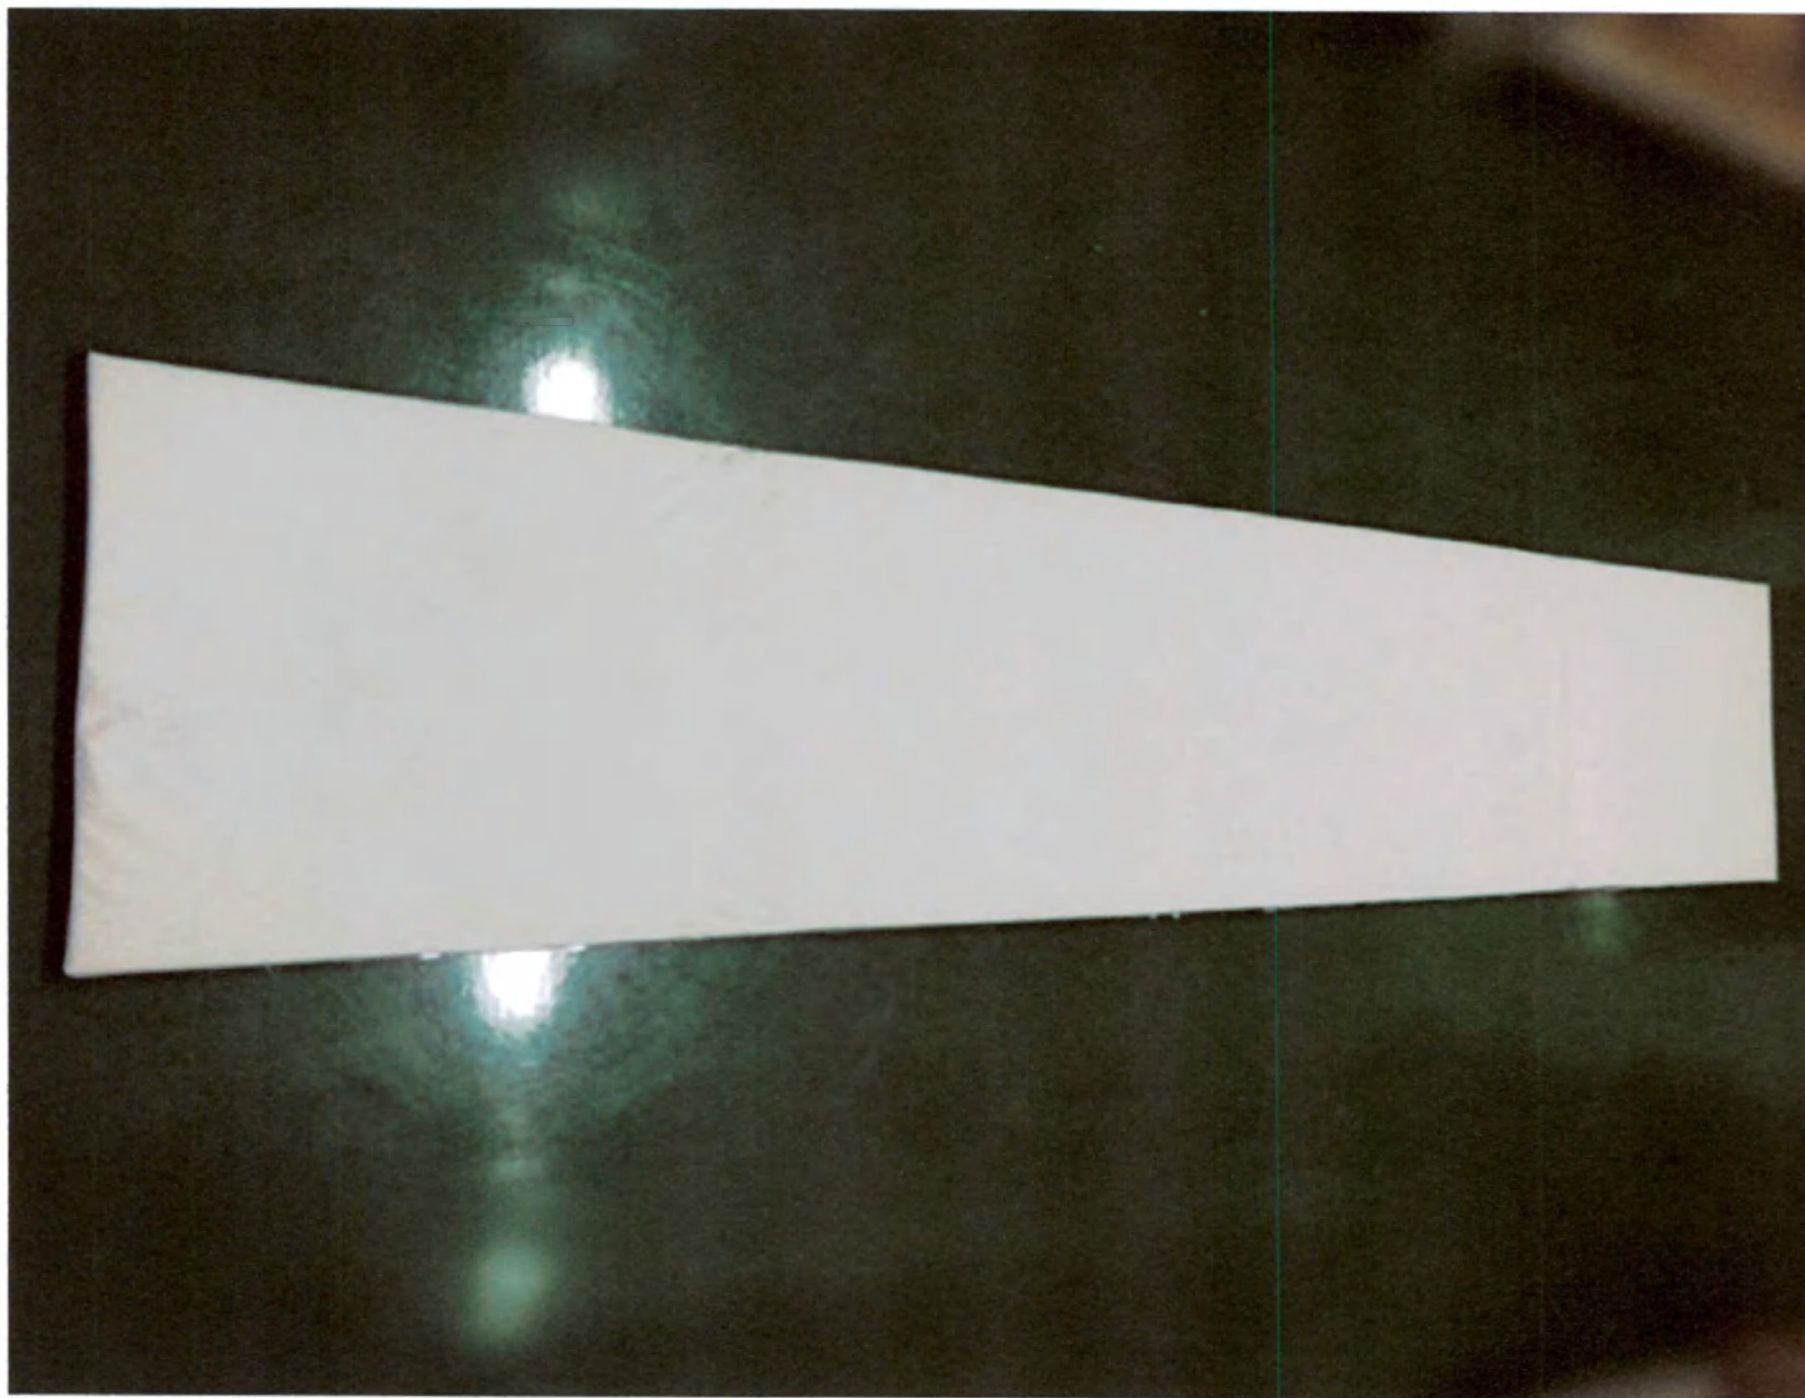

Матрас для стола снимков (Модель: P002627)



Матрас для стола снимков (Модель: 6-S20039)

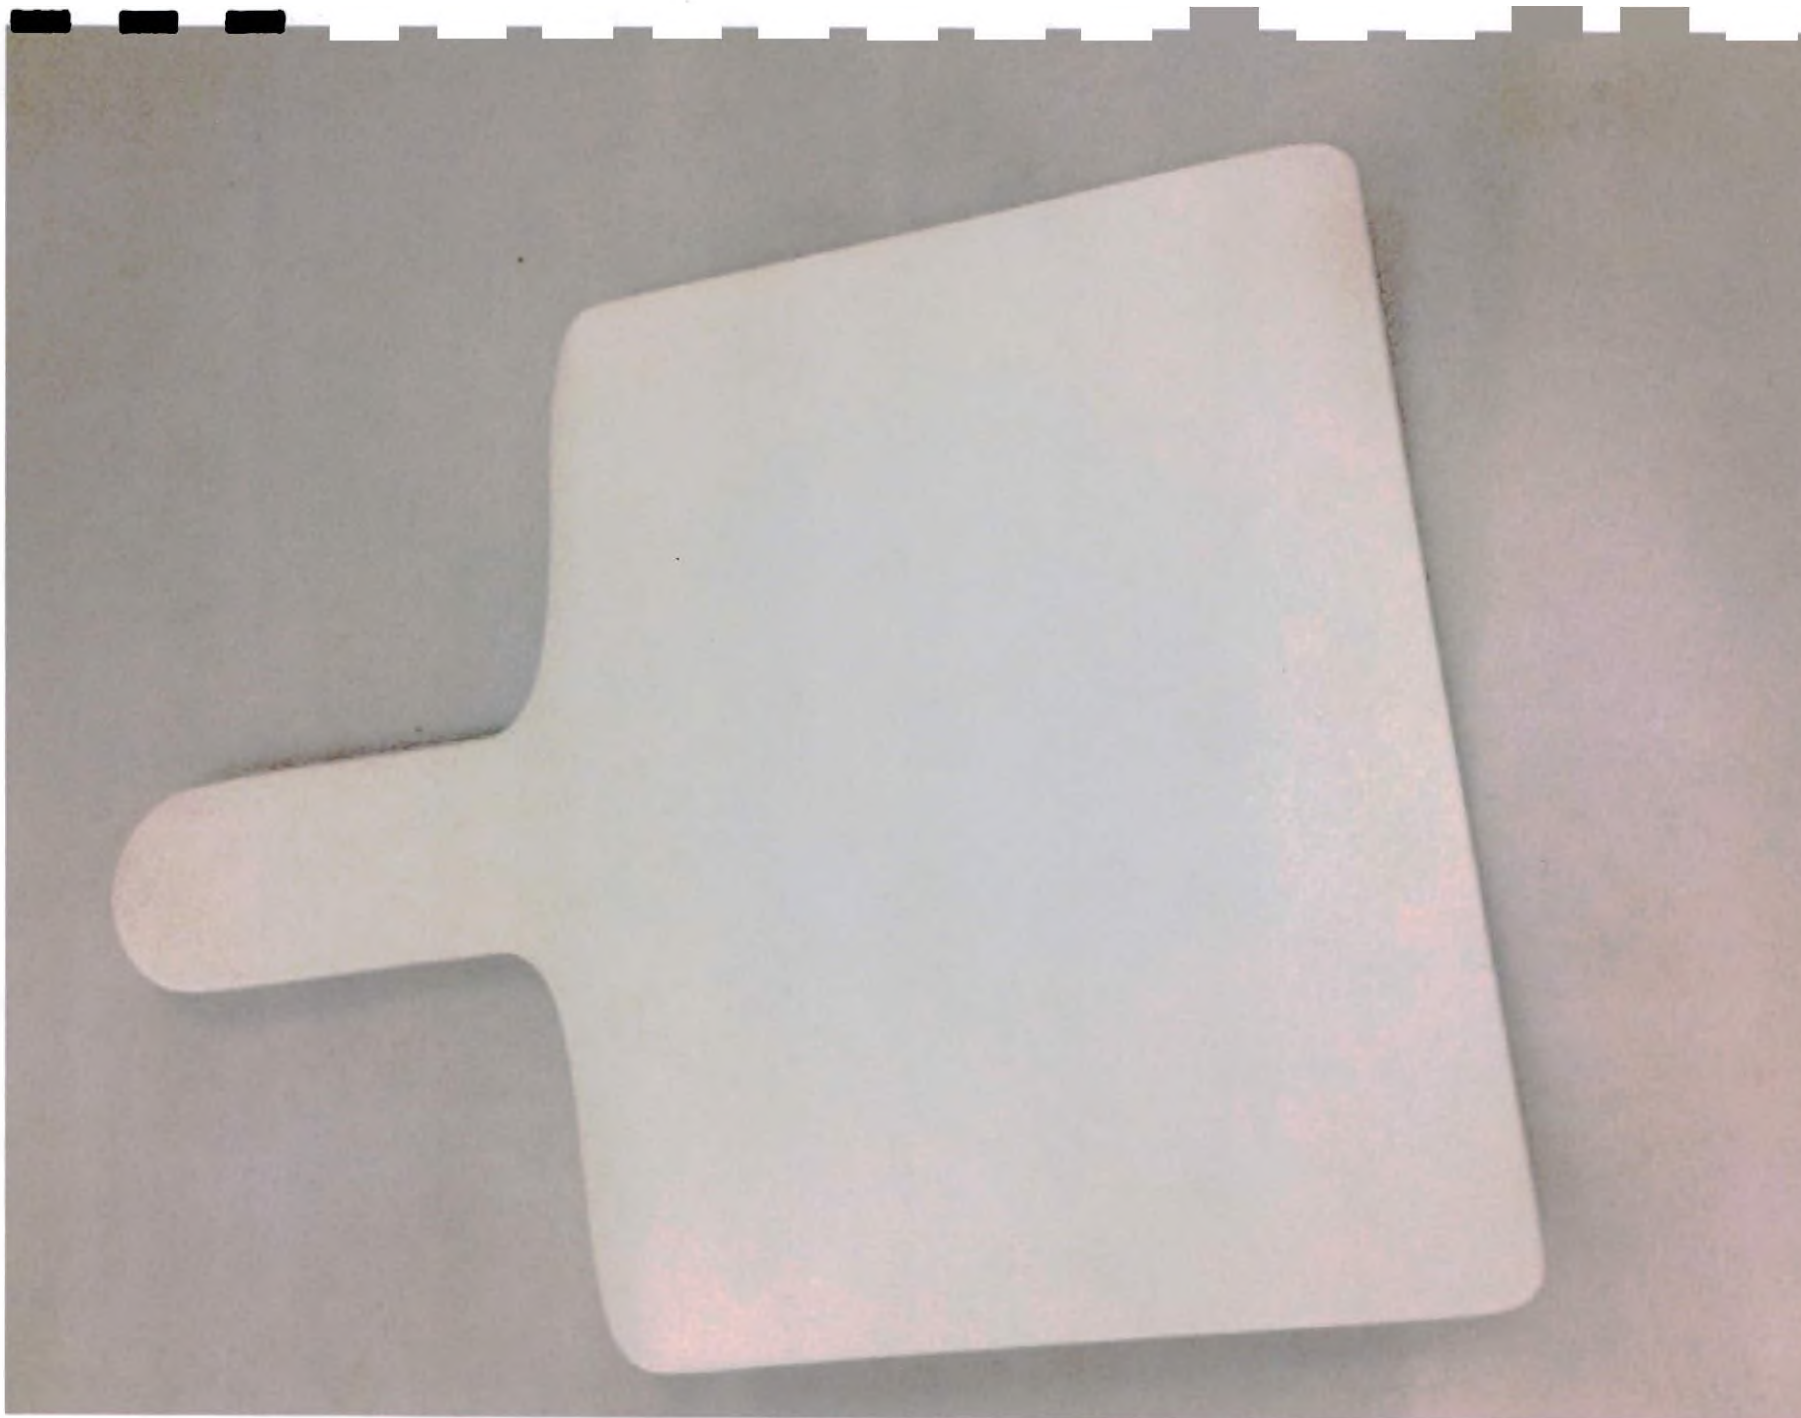

Принадлежность для ног




Источник бесперебойного питания на всю систему с комплектом аккумуляторов (на 60 кВА для модели ANATOM 64 Clarity, на 80 кВА для модели ANATOM 64 Precision)



Климатическая сплит система



Рентгенозащитное окно

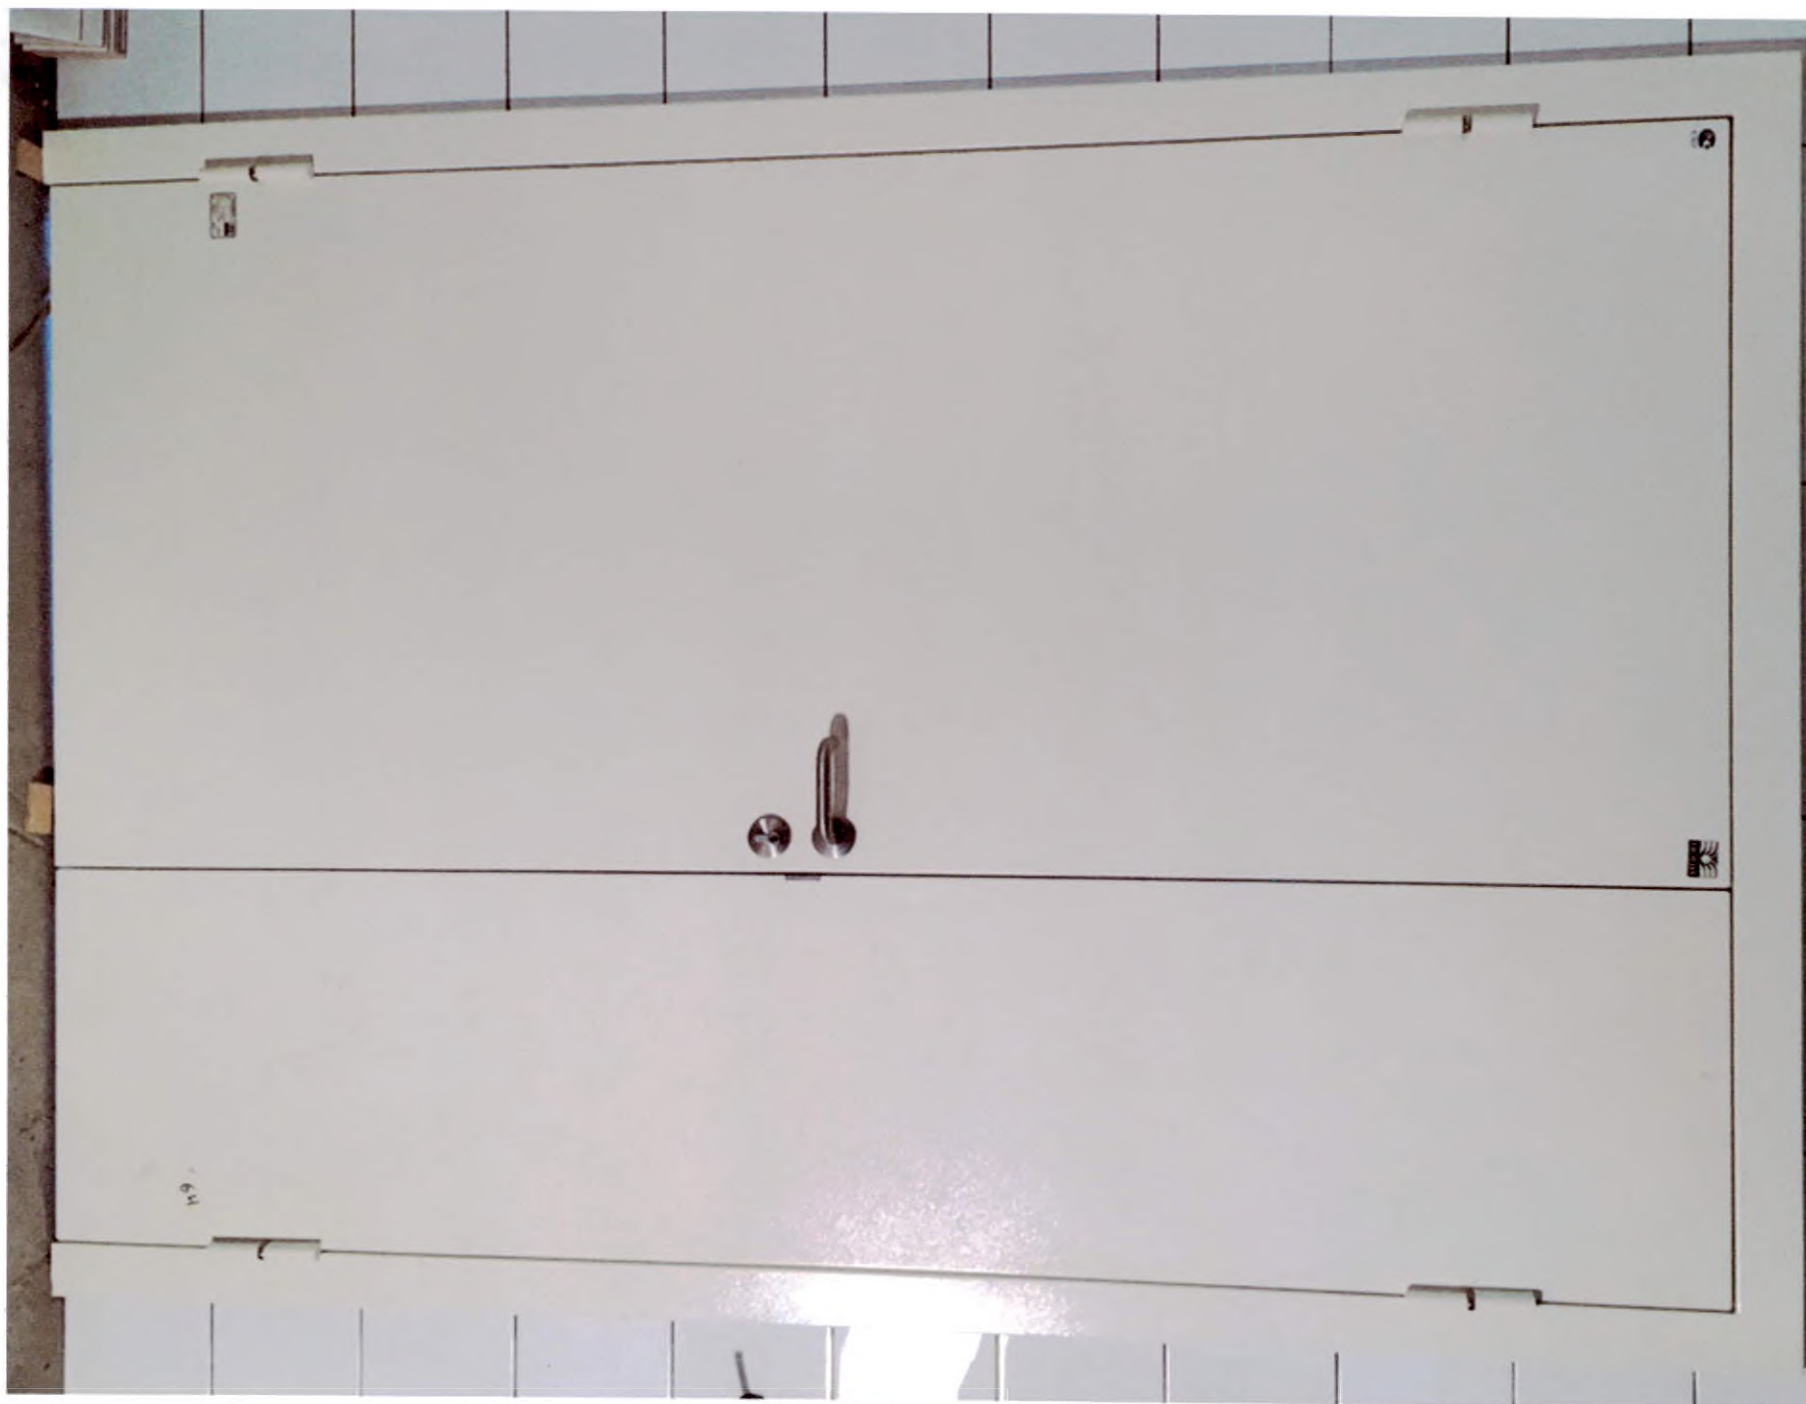

Рентгенозащитная дверь



Видеокамера

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ 75 (Семидесять пять) ЛИСТОВ



Генеральный директор
Кожемов
Эльдар Эдуардович



ООО «СМ-ЛАБСЕРВИС»

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Томограф рентгеновский компьютерный с
принадлежностями, модели ANATOM 64 Precision;
ANATOM 64 Clarity**

**129226, г. Москва, проспект Мира д.191, строение 1
Тел. (499) 214-06-50
E-mail: info@sm-labservice.ru**








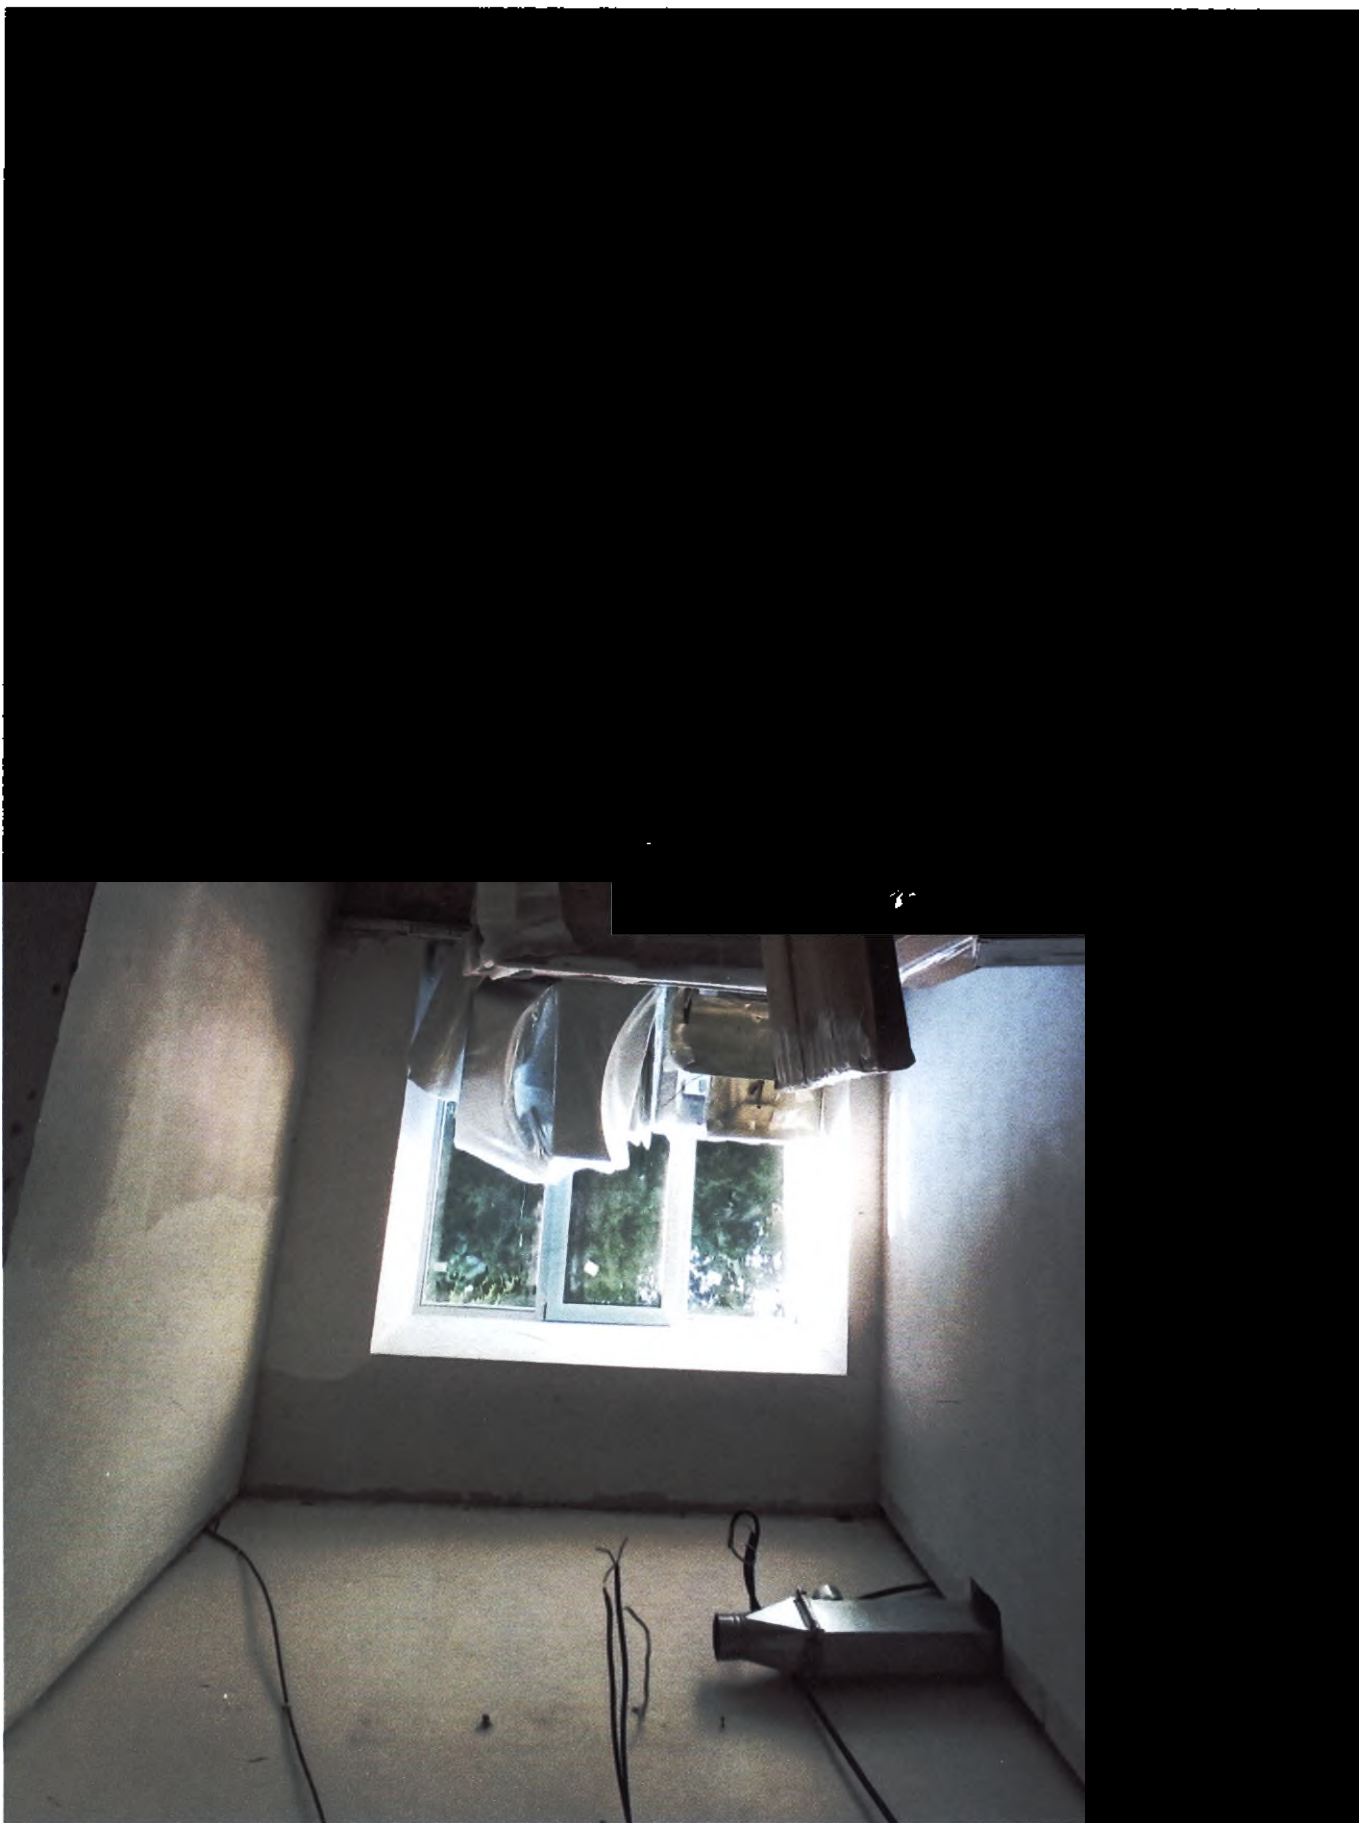



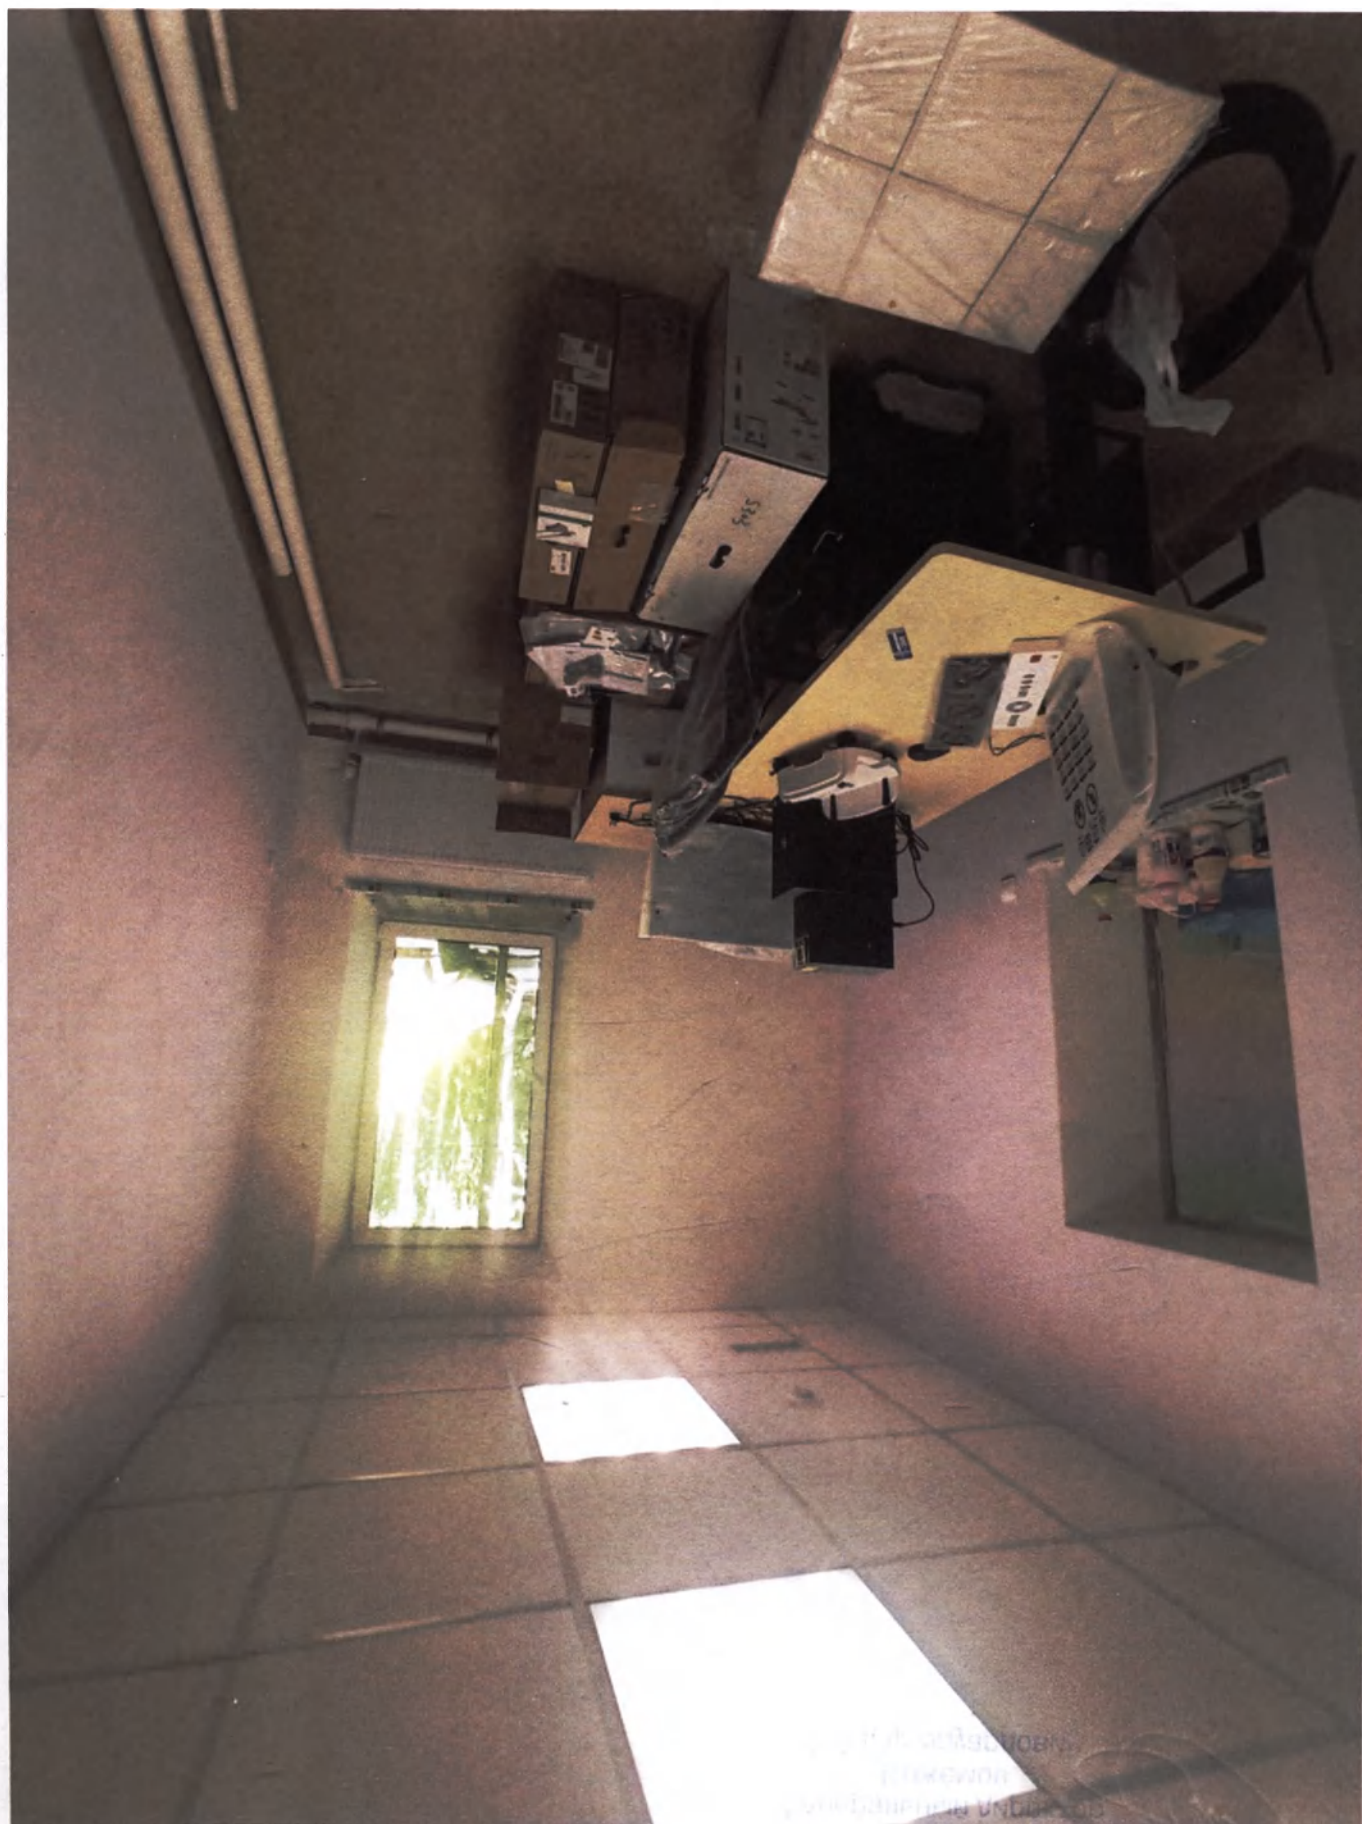



ООО «СМ-ЛАБСЕРВИС»

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

маркировки медицинского изделия

**Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями, модели
ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity**

129226, г. Москва, проспект Мира д.191, строение 1


Тел. (499) 214-06-50

E-mail: info@sm-labservice.ru




Name:Gantry

Type:10-S16637



AJ0011N00210604



2022.03



Nanjing Anke Medical Technology Co.,Ltd.
69 Feitian Road, Jiangning , Nanjing,Jiangsu 211113,P.R.China

Name:Detector

Type:10-S16638



AJ0012N00210604




2022.02



Nanjing Anke Medical Technology Co.,Ltd.
69 Feitian Road, Jiangning , Nanjing,Jiangsu 211113,P.R.China

Маркировка блока детекторов (для моделей ANATOM 64 Precision и ANATOM 64 Clarity)

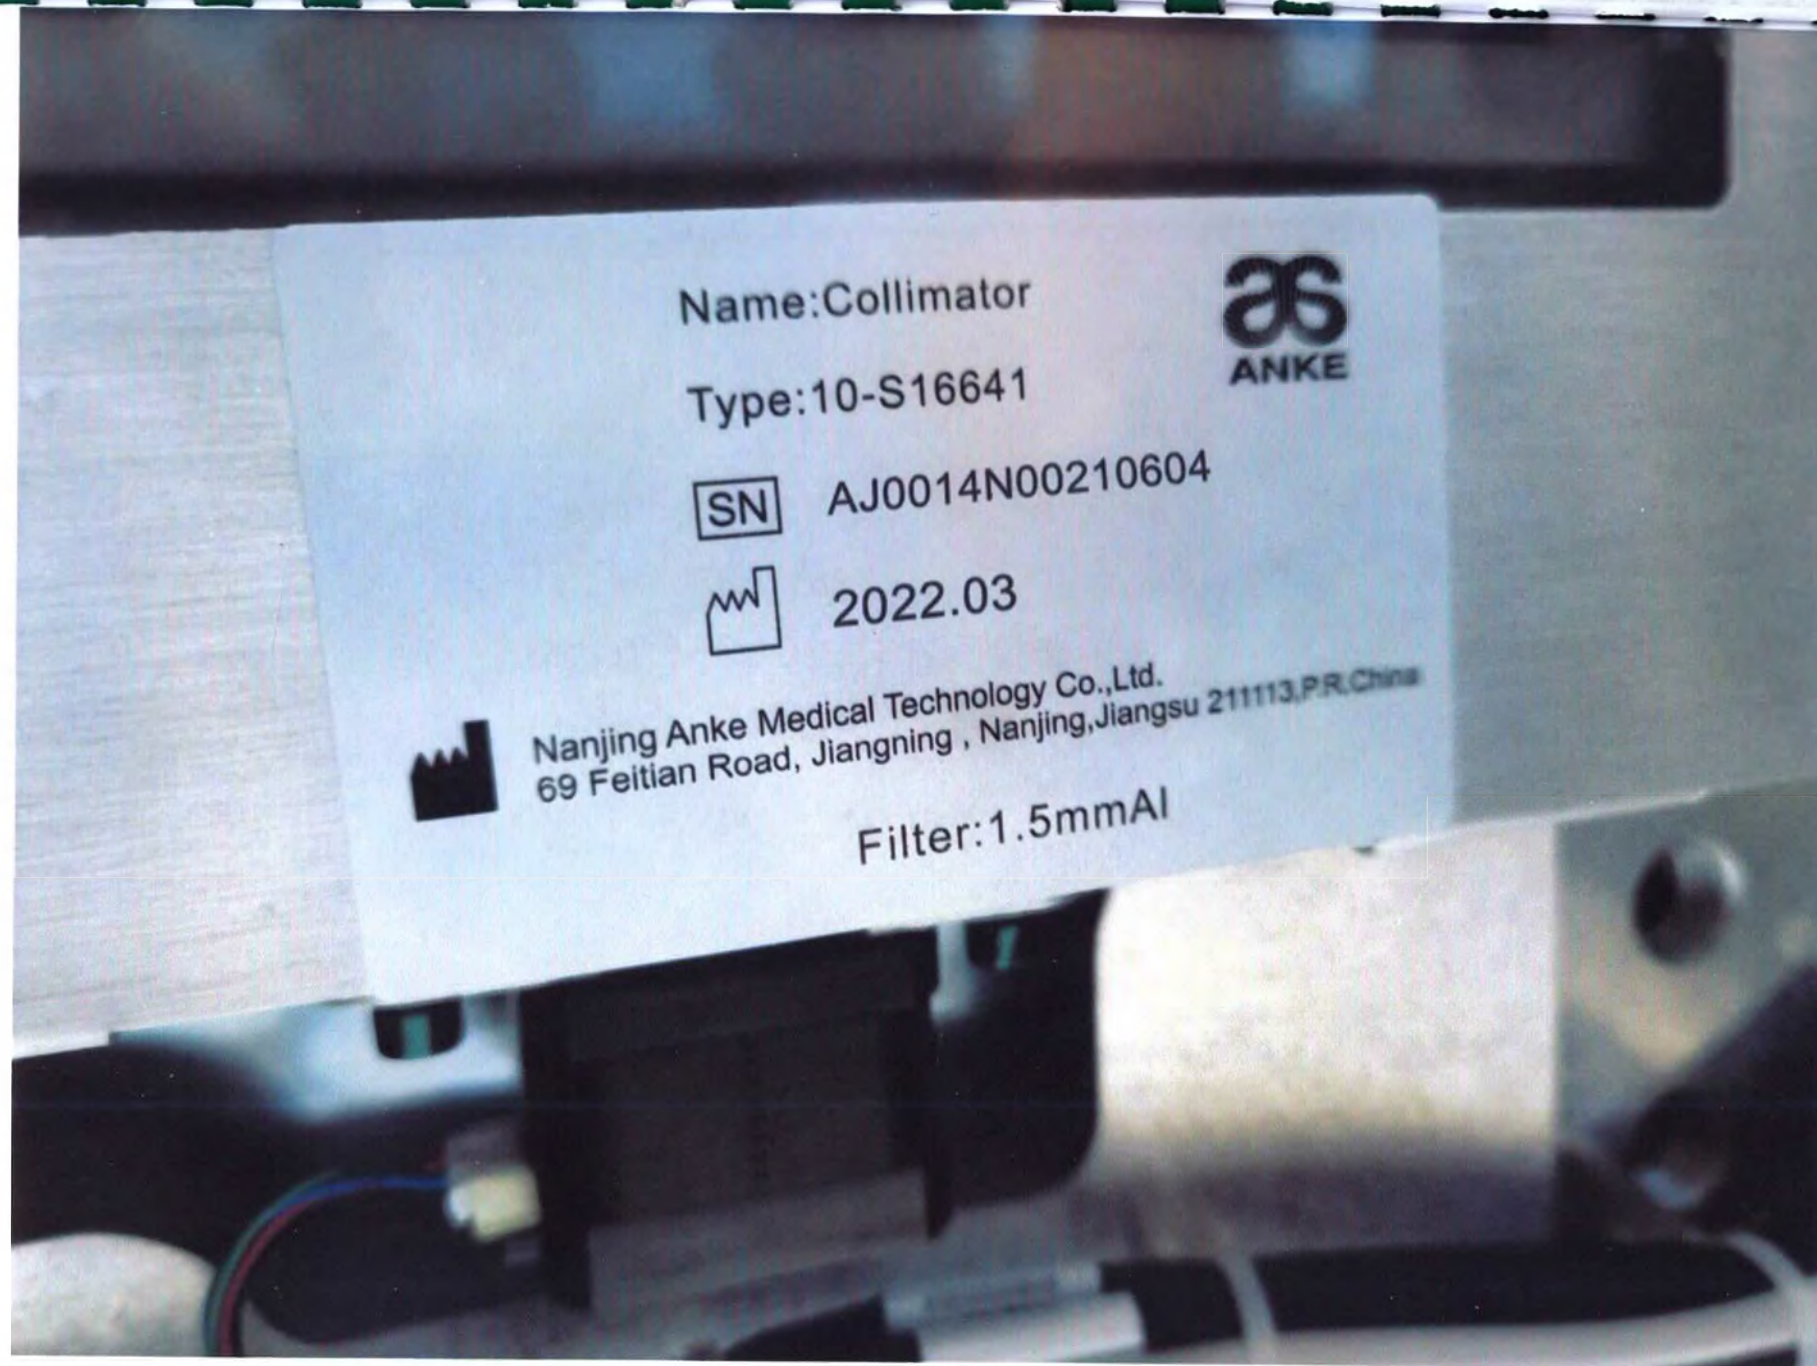

Маркировка коллиматора (для моделей ANATOM 64 Precision и ANATOM 64 Clarity)

Name: Power Distrution Unit

Type: 10-S16636

Input: 3~380V, 50Hz, 115kVA

Output: 3N~380V, ~220V, 50Hz



 SN 63P30110263

 2022.03




Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd.
Block B, LingYa Industrial Zone, Tangtou No.1 Road, Shiyan
Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, 518108, P.R. China

Маркировка питающего устройства (для моделей ANATOM 64 Precision и ANATOM 64 Clarity)


Name: Patient Table

Type: 10-S16639

Max.loading: 230Kg



63T30110687



2022.01



Nanjing Anke Medical Technology Co., Ltd.

69 Feitian Road, Jiangning, Nanjing, Jiangsu 211113, P.R.China

Bed Board Filter: 1.6mmAl@100kV


Маркировка стола снимков (для моделей ANATOM 64 Precision и ANATOM 64 Clarity)




Маркировка нагрузки на стол снимков (для моделей ANATOM 64 Precision и ANATOM 64 Clarity)

Name: Intercom Control Box

Type: 10-S16642



AJ0015N00210803



2022.02



Nanjing Anke Medical Technology Co., Ltd.
69 Feitian Road, Jiangning, Nanjing, Jiangsu 211113, P.R. China

Name: Console

Type: 10-S16640



 SN 63K30110263

 2022.03



Shenzhen Anke High-tech Co.,Ltd.
Block B,LingYa Industrial Zone,Tangtou No.1 Road,Shiyan
Sub-district,Bao'an District,Shenzhen,518108,P.R.China

ER
E PRESENT.
OF ELECTRIC
OVE COVERS
INUTES HAVE
RNING OFF
COMPLY MAY
Y OR DEATH
105740-250 REV. A



Spellman®

High Voltage Electronics Corporation

Hauppauge, NY 11788 Assembled in Mexico P3




PART NO: 406921-008


REV: K12

MODEL: CT70PN80X5113 HV CHASSIS ASSY

SERIAL NO: 134577476-C01663

28/20



 $\pm 70\text{kV} \text{ --- } \text{MAX } 667\text{mA MAX } \pm 40\text{kW}$

Spellman®
High Voltage Electronics Corporation

HS
NL
GM
ZDF

DANGER 

**HAZARDOUS VOLTAGE PRESENT.
REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT REMOVE COVERS
OR BLENDES UNTIL 10 MINUTES HAVE
ELAPSED AFTER TURNING OFF
EQUIPMENT. FAILURE TO COMPLY MAY
RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH**

105740-250 REV. A

 **Spellman®**
High Voltage Electronics Corporation
Suzhou, JS 215021 Made in China

PART NO: 406921-011

REV: WB

MODEL: CT70PN50X5112 HV CHASSIS ASSY

SERIAL NO: 137346154-A00091

2/22




 $\pm 70\text{kV} \text{ --- MAX, } 420\text{mA MAX } \pm 25\text{kW}$

 **Spellman®**
High Voltage Electronics Corporation



137346154-A00091

Batch No: 50131664

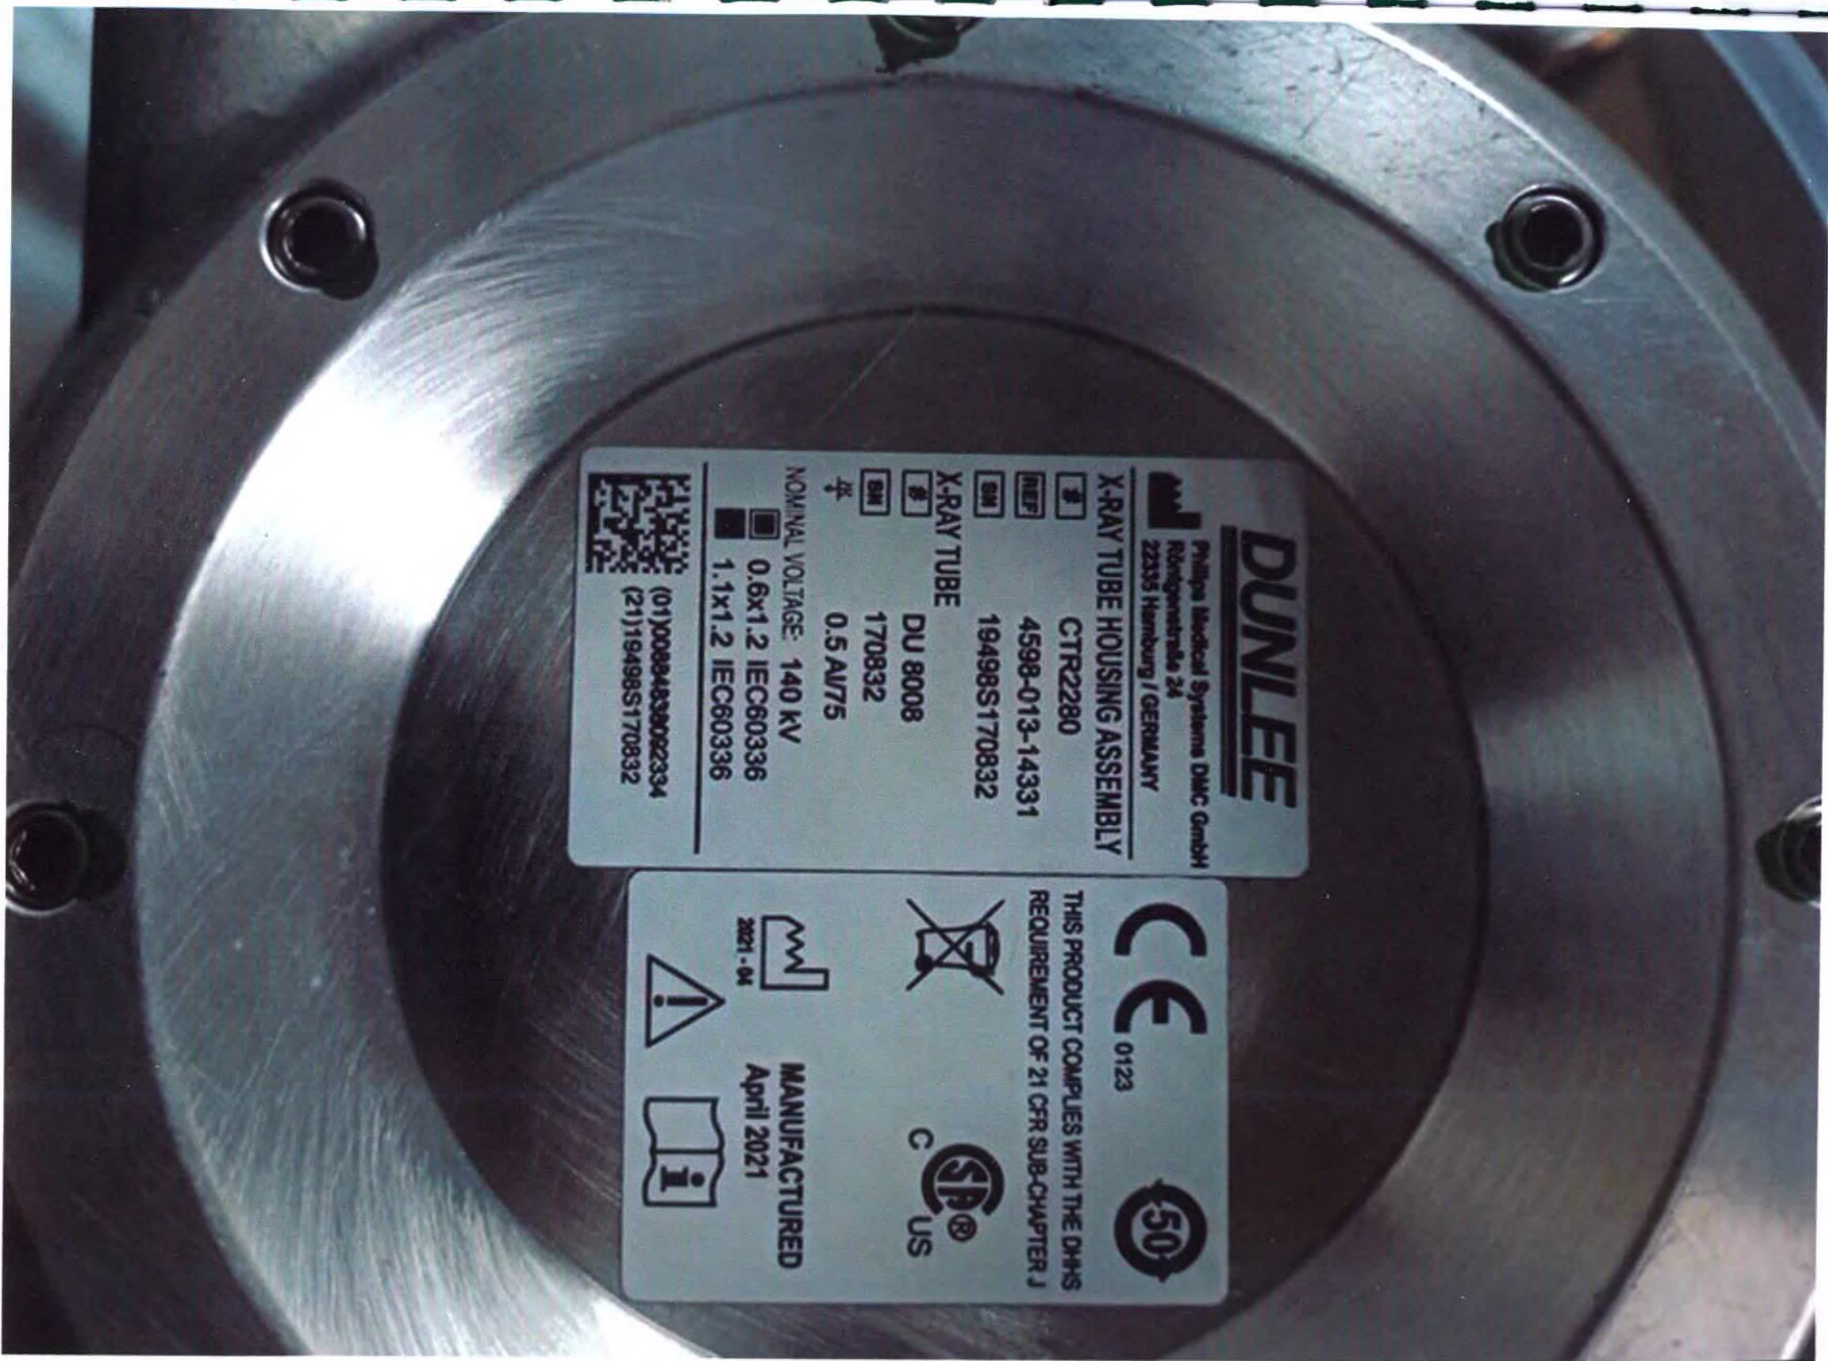

Маркировка рентгеновской трубки (для модели ANATOM 64 Precision)



ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 15 (Пятнадцать) ЛИСТОВ

Генеральный директор
Кожемов
Эльдар Эдуардович





ООО «СМ-ЛАБСЕРВИС»

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями, модели
ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity

129226, г. Москва, проспект Мира д.191, строение 1
Тел. (499) 214-06-50
E-mail: info@sm-labservice.ru

MD



UDI

Название: Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями

Модель: ANATOM 64 Precision

Эл./питание: 3~380В, 50Гц, 115кВА

Непрерывная работа с прерывистой нагрузкой

Жизненный цикл: 10 лет

SN

xxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxx



Шэньчжэнь Анке Хай-тек Ко., Лтд.

Блок В, Линг Ия-Промышленная зона, Танг Тоу

1-я улица, Шиян Суб-район, округ Баоань,

Шэньчжэнь, 518108, Китай

EC

REP

Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГьбХ (Европа)

Эйфештрассе 80, 20537 Гамбург, ГЕРМАНИЯ

Сделано в Китае

QR-код

(01)xxxxxxxxxxxx

(11)xxxxxx

(21)xxxxxxxxxxxx



Макет маркировка для модели ANATOM 64 Precision

MD



UDI

Название: Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями

Модель: ANATOM 64 Clarity

Эл./питание: 3~380В, 50Гц, 115кВА

Непрерывная работа с прерывистой нагрузкой

Жизненный цикл: 10 лет

SN

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Шэньчжэнь Анке Хай-тек Ко., Лтд.

Блок В, Линг Ия-Промышленная зона, Танг Тоу

1-я улица, Шиян Суб-район, округ Баоань,

Шэньчжэнь, 518108, Китай

EC

REP

Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГьбХ (Европа)

Эйфештрассе 80, 20537 Гамбург, ГЕРМАНИЯ

Сделано в Китае

QR-код

(01)xxxxxxxxxxxxx

(11)xxxxxx

(21)xxxxxxxxxxxxx



Макет маркировки для модели ANATOM 64 Clarity

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 3 (ТРИ) ЛИСТОВ

Генеральный директор
Кожемов
Эльдар Эдуардович





**ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями, модели
ANATOM 64 Precision; ANATOM 64 Clarity**

129226, Москва, проспект Мира д.191, строение 1;

Тел. (499) 214-06-50;

E-mail: info@sm-labservice.ru

Интернет адрес: <http://www.sm-labservice.ru>



Томограф рентгеновский компьютерный
с принадлежностями, модели
ANATOM 64 Precision;
ANATOM 64 Clarity
Выписка из технической документации
Русская версия R1.4



Shenzhen ANKE High-tech Co., Ltd.
A-pex, Block B, LongYa Industrial Zone, Langtou No. 1 Road, Shiyao Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen, 518109, P. R. China
Tel: 86-755-21622518
Fax: 86-755-26695307
Call / technical assistance: <http://www.anke.com>
E-mail: service@anke.com



Томограф рентгеновский компьютерный
с принадлежностями, модели
ANATOM 64 Precision;
ANATOM 64 Clarity
Руководство по эксплуатации
Русская версия R1.4



Shenzhen ANKE High-tech Co., Ltd.
A-pex, Block B, LongYa Industrial Zone, Langtou No. 1 Road, Shiyao Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen, 518109, P. R. China
Tel: 86-755-21622518
Fax: 86-755-26695307
Call / technical assistance: <http://www.anke.com>
E-mail: service@anke.com

Эксплуатационные и технические документы

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листов

Генеральный директор
Кожемов
Эльдар Эдуардович

