


Фотографические изображения и
макеты маркировки медицинского изделия
«Линза интраокулярная»

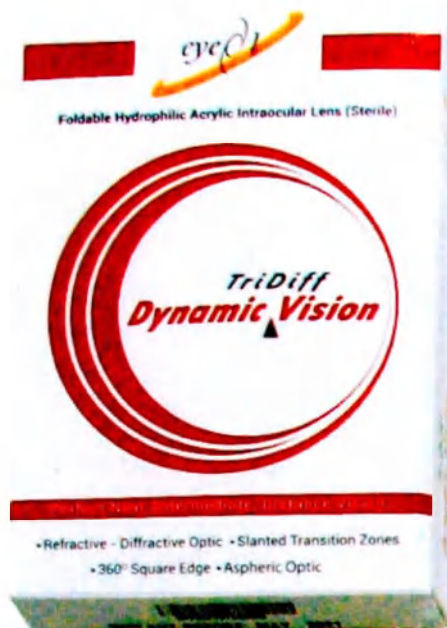

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055

Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: () R () L

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp: 2021 - 05
CP42CF79TE00055



Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» TriDiff Dynamic Vision

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

TriDiff Dynamic Vision, в составе:

- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: TDIFF-P, TDIFF-P1, TDIFF-P2, TDIFF-P3, TDIFF-R, TDIFF-R1, TDIFF-R2, TDIFF-R3 -1 контейнер.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **TriDiff Dynamic Vision**, в составе:


Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: TDIFF-P, TDIFF-P1, TDIFF-P2, TDIFF-P3, TDIFF-R, TDIFF-R1, TDIFF-R2, TDIFF-R3 -1 контейнер.



- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке -1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт.
- Инструкция по использованию - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения **TriDiff Dynamic Vision**,
...этикеточная упаковка

**Линза интраокулярная TriDiff Dynamic Vision, модель TDIFFP1.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере).**

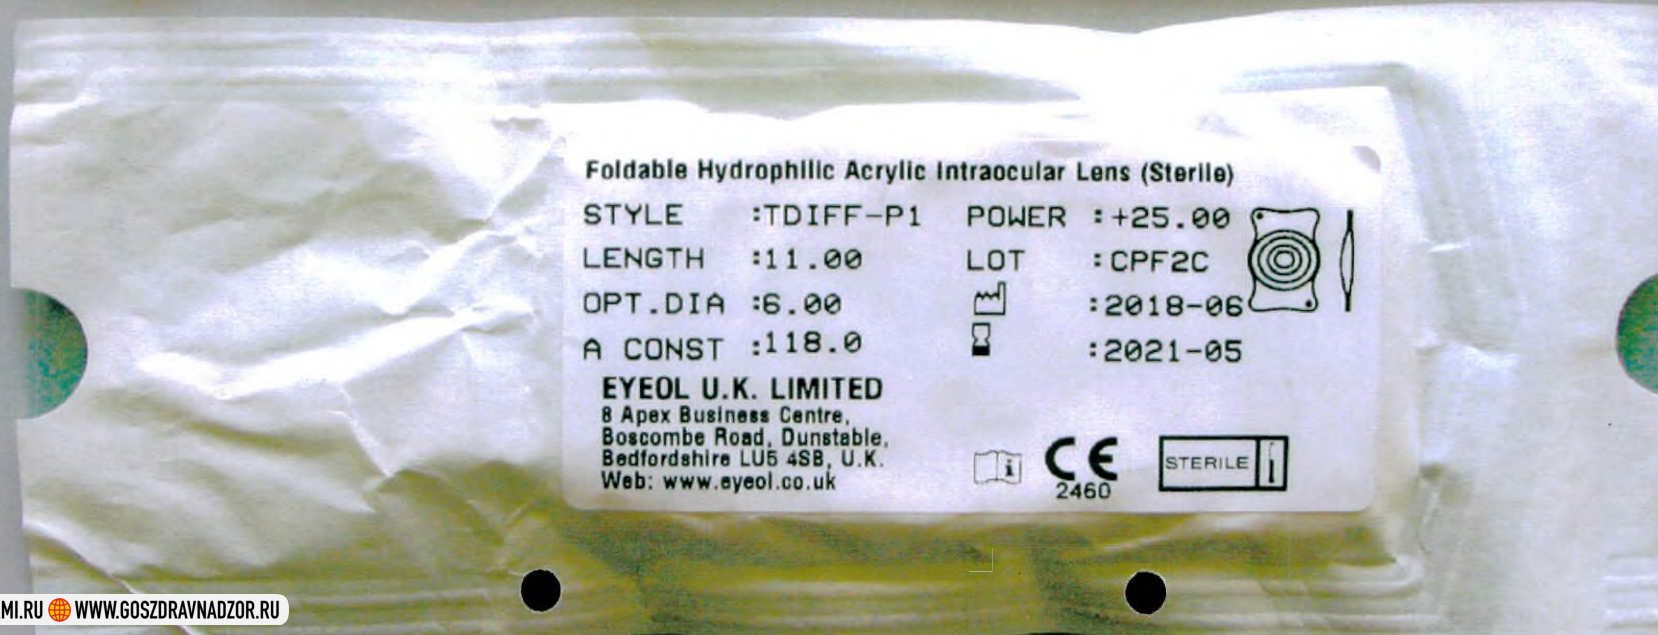

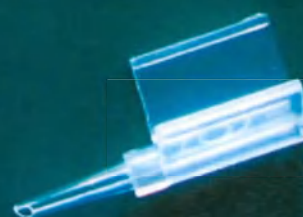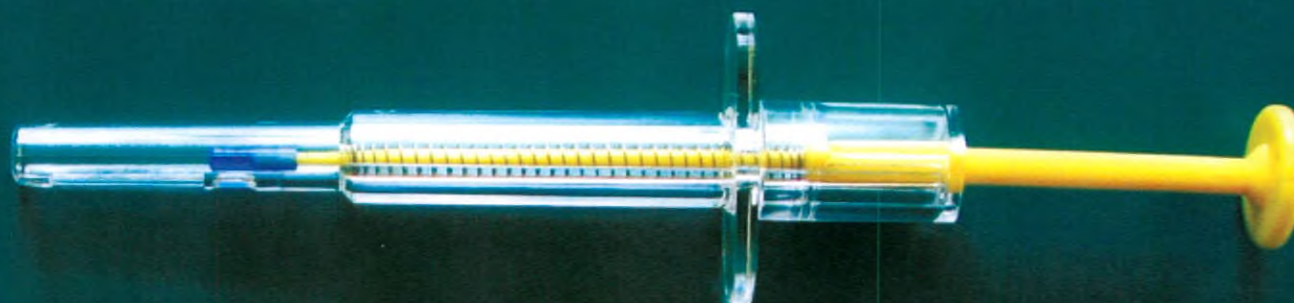

**Линза интраокулярная TriDiff Dynamic Vision, модель TDIFFP1.
Контейнер с линзой, инжектор и картридж.**

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055


TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: ()R ()L
TDIFF - P1 Power : + 25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
Exp:2021-05
CPF2CF79TE00055

Наклейка пациента

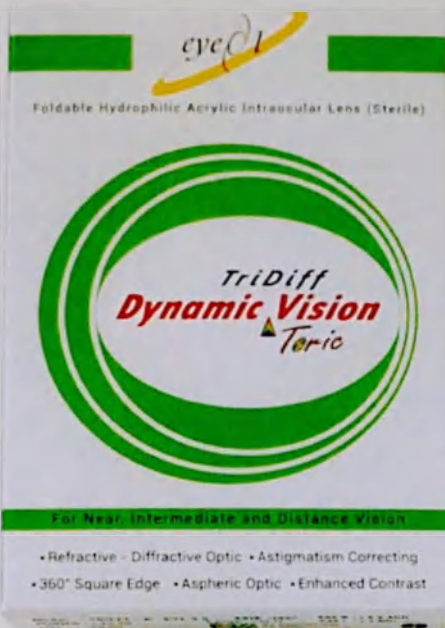

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004



MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004

Patient's Name _____
 Implant Surgeon's Name _____
 Date of Surgery _____
 Implanted Eye () R () L
 MODEL TDIFFT-R CYL 3.0
 POWER +22.00 LOT CSJ61 Add N +3.5 ADD
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-04 Add I +1.800
 LENGTH 12.50 EXP 2025-03
 SN CTFASYSLJE000004
 CE

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
TriDiff Dynamic Vision Toric

Назначение:



Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

TriDiff Dynamic Vision Toric, в составе:

- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: TDIFFT-P, TDIFFT-PI, TDIFFT-P2, TDIFFT-P3, TDIFFT-R, TDIFFT-R1, TDIFFT-R2, TDIFFT-

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения TriDiff Dynamic Vision Toric, в составе:

- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: TDIFFT-P, TDIFFT-PI, TDIFFT-P2, TDIFFT-P3, TDIFFT-R, TDIFFT-R1, TDIFFT-R2, TDIFFT-R3 -1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке -1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт.
- Инструкция по использованию - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

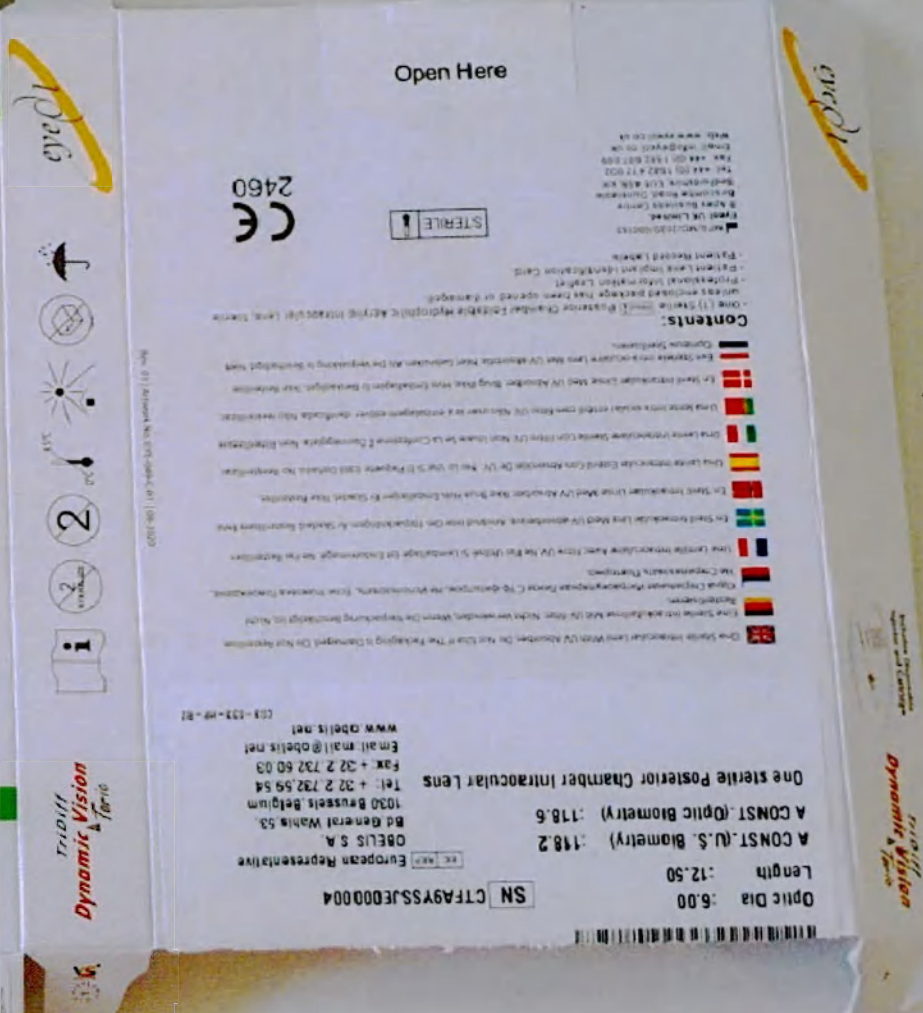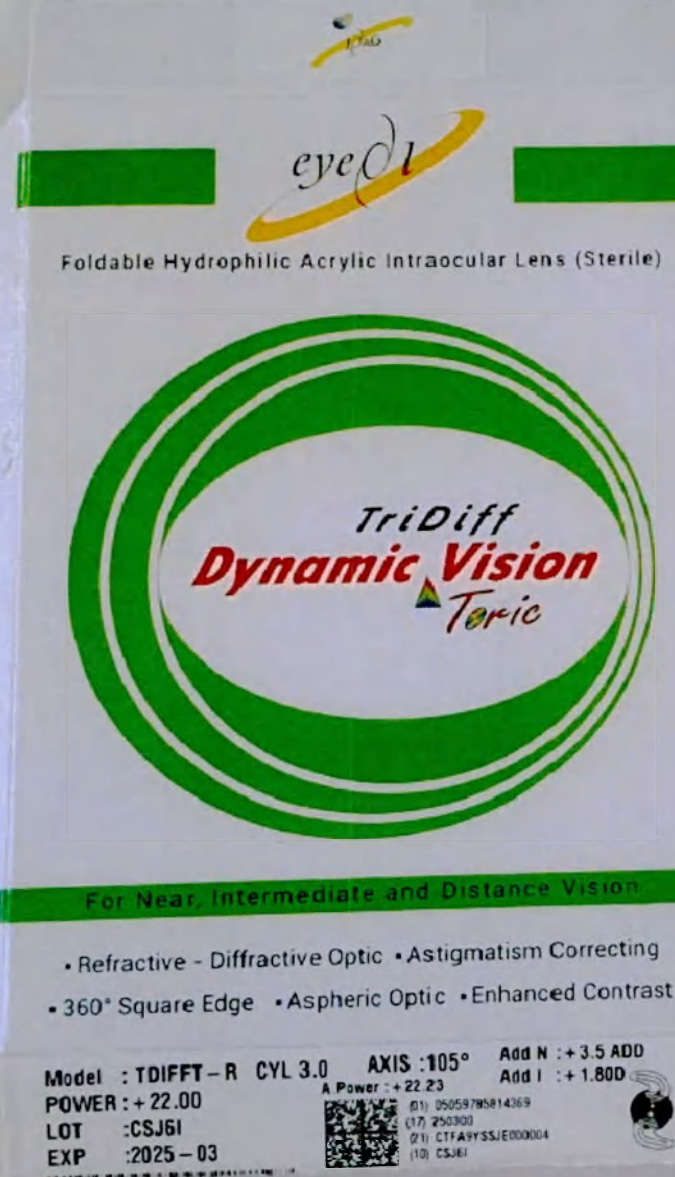

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения TriDiff **Dynamic Vision Toric**,
 потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004

MODEL : TDIFFT-R TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
[SN] CTFASYSSJE000004


TRIDIFF TORIC

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L

MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03

[SN] CTFASYSSJE000004

CE
2460

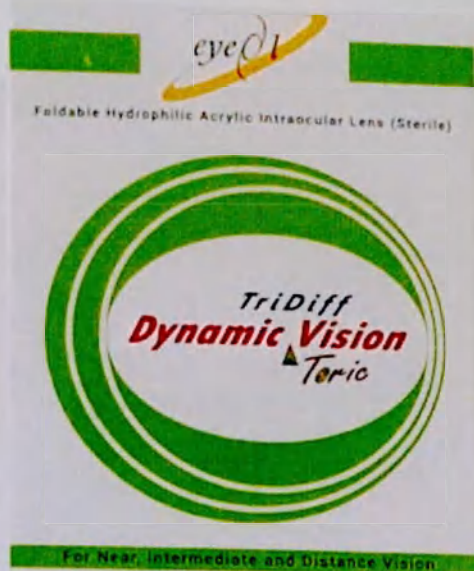

- Refractive - Diffractive Optic • Astigmatism Correcting
- 360° Square Edge • Aspheric Optic • Enhanced Contrast



TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
MODEL : TRIDIFF - P
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 11.25
LOT : CSJ61
MFG: 2022 - 04
EXP: 2025 - 03
Add N : +3.50
Add I : +1.800
EN: CTFAP15SJJE000018

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» TriDiff Dynamic Vision Toric



Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения: офтальмохирургия.


TriDiff Dynamic Vision Toric, в составе:

- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: TRIDIFF-P, TRIDIFF-P1, TRIDIFF-P2, TRIDIFF-P3, TRIDIFF-R, TRIDIFF-R1, TRIDIFF-R2, TRIDIFF-R3 - 1 контейнер.

- Медицинское изделие «Линза интраокулярная», вариант исполнения TriDiff Dynamic Vision Toric, в составе:
- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: TRIDIFF-P, TRIDIFF-P1, TRIDIFF-P2, TRIDIFF-P3, TRIDIFF-R, TRIDIFF-R1, TRIDIFF-R2, TRIDIFF-R3 - 1 контейнер.
 - Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
 - Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
 - Наклейка пациента - 1 шт.
 - Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт.
 - Инструкция по использованию - 1 шт.

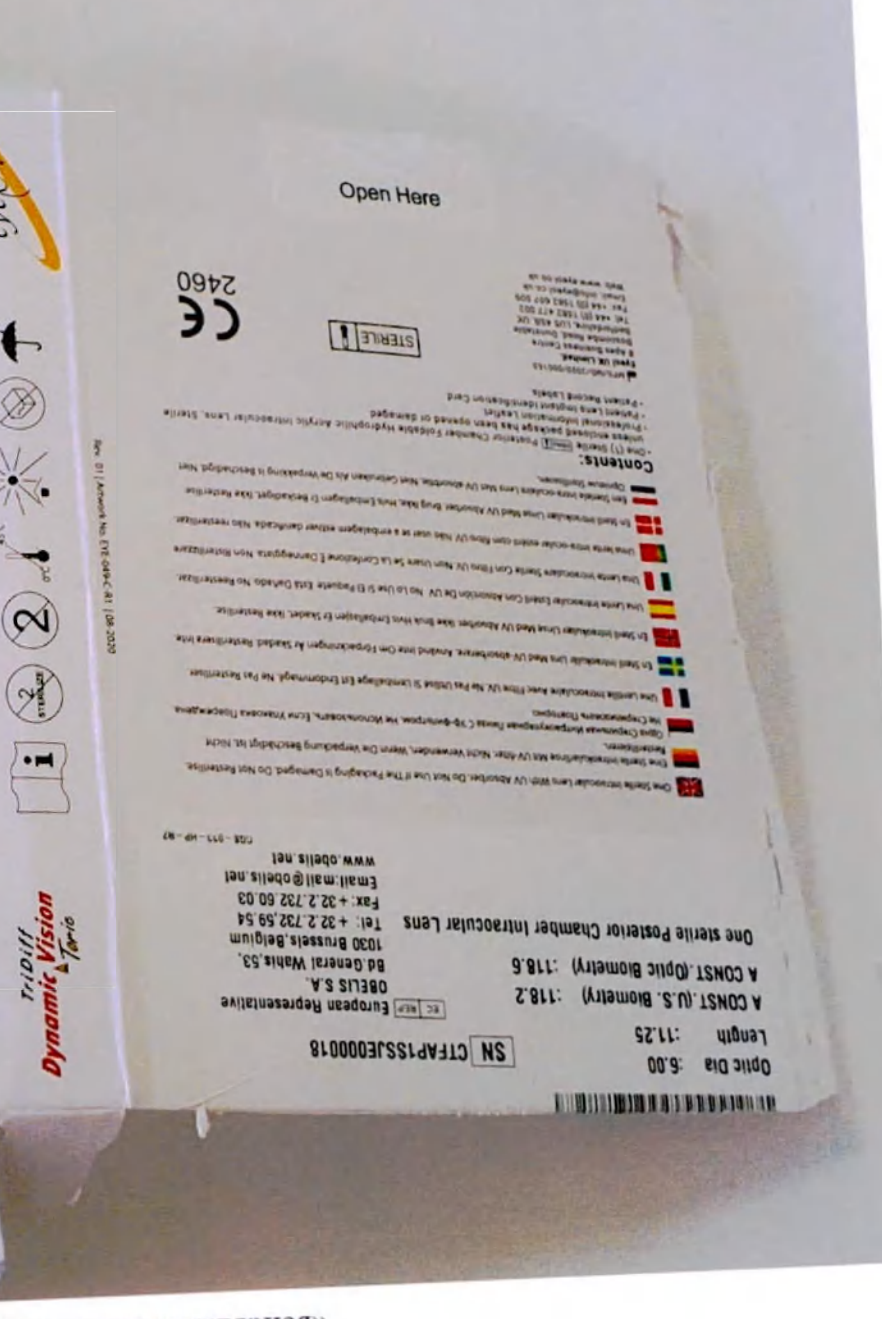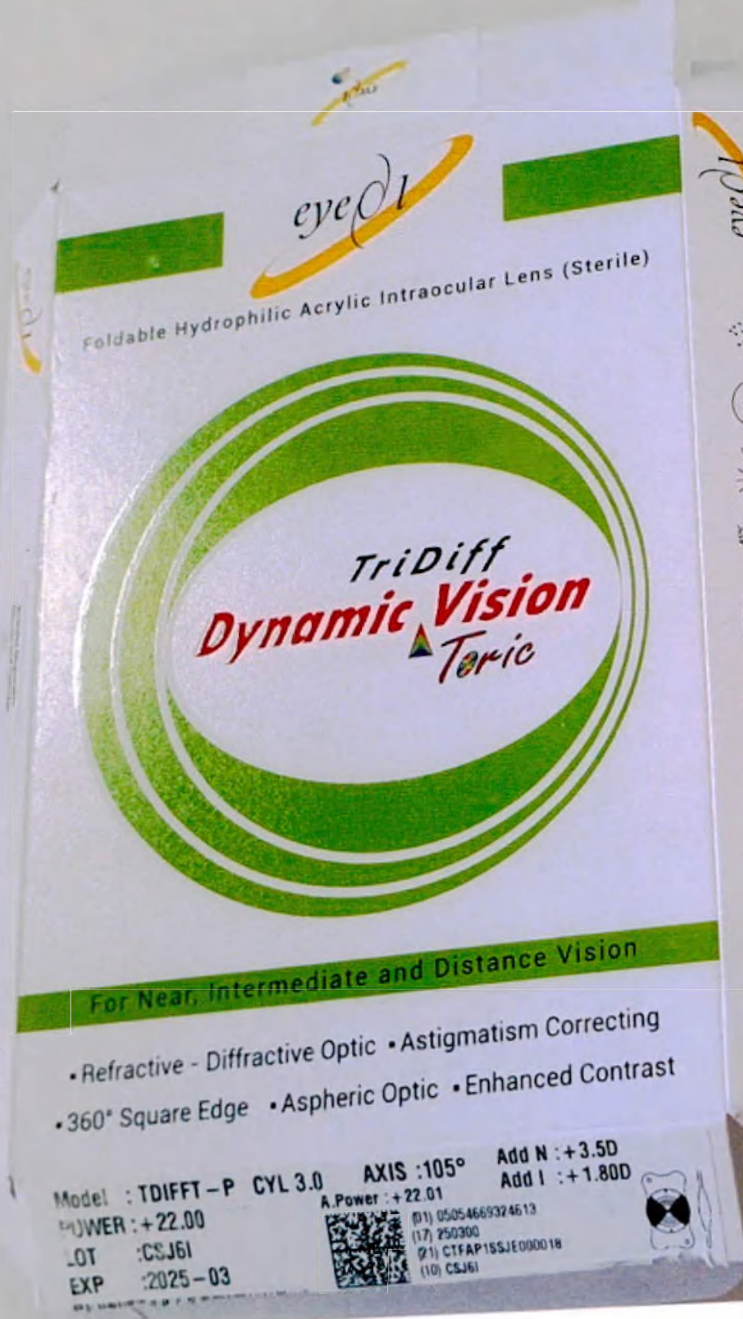

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения TriDiff Dynamic Vision Toric,
 потребительская упаковка

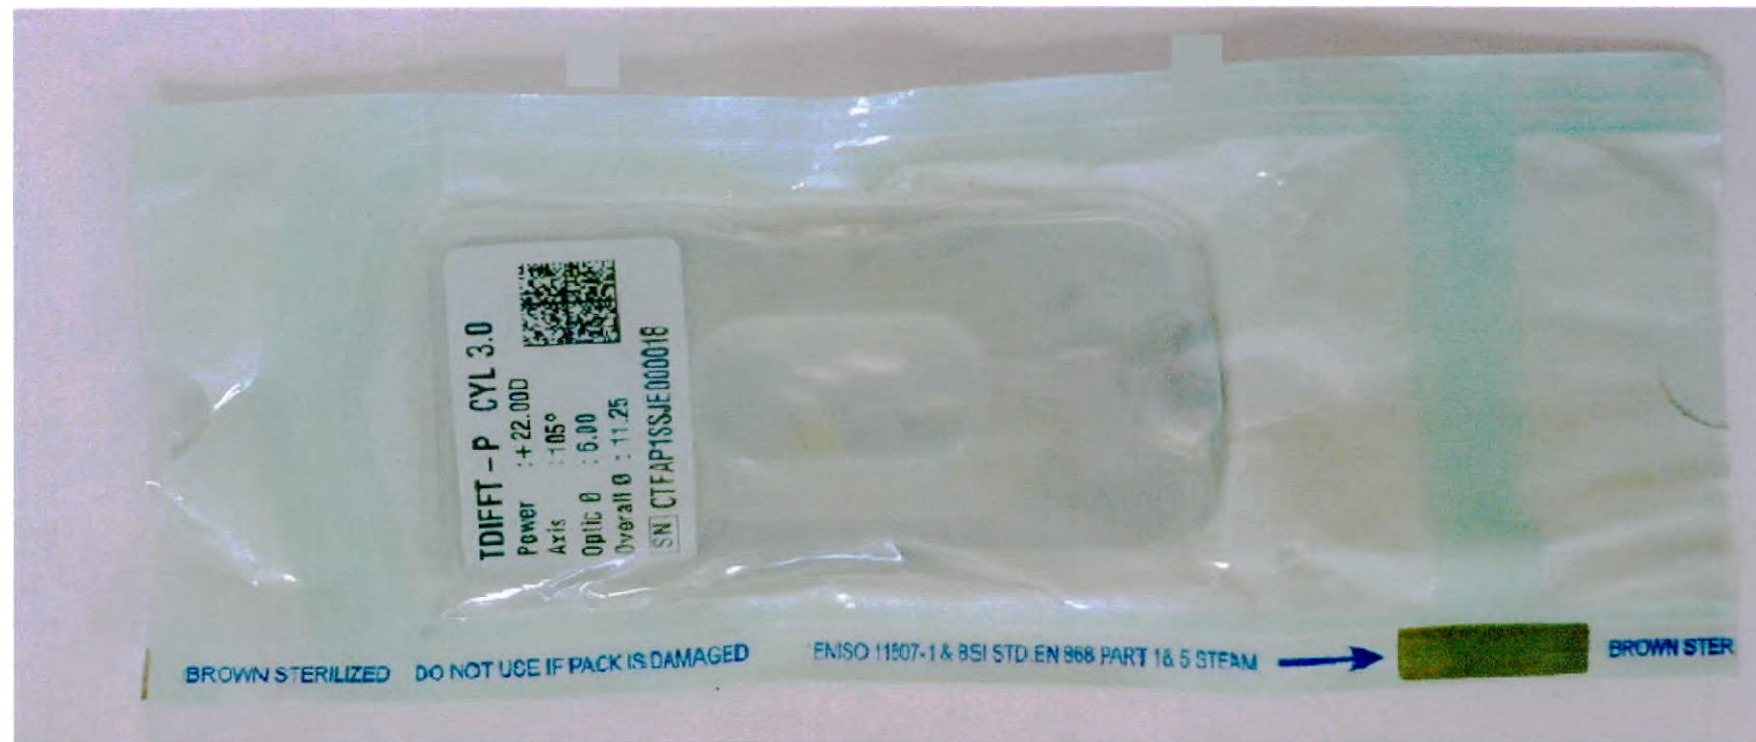

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

MODEL : TDIFFT-P TRIDIFF TORIC
CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03
SN CTFAP1SSJE000018

Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Implanted Eye : () R () L

MODEL : TDIFFT-P CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CSJ61 Add N : +3.5D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 11.25 EXP : 2025-03

SN CTFAP1SSJE000018

CE
2460



STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH 11.50 POWER +12.50
OPT.DIA 6.00 Exp:2021-04

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : UST CYLINDER 8.5
LENGTH : 11.50 POWER : +12.50
OPT.DIA : 6.00 Exp:2021-04
CPE1KF5FRG0001



Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
Ultima SmartToric

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием. (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Ultima SmartToric, в составе:

- Линза интраокулярная, модель UST - 1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения
Ultima SmartToric, в составе:

- Линза интраокулярная, модель UST - 1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт.
- Инструкция по использованию - 1 шт.



Линза интраокулярная Ultima Smart Toric, модель UST.
Потребительская упаковка (коробка)

**Линза интраокулярная Ultima Smart Toric, модель UST.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере).**

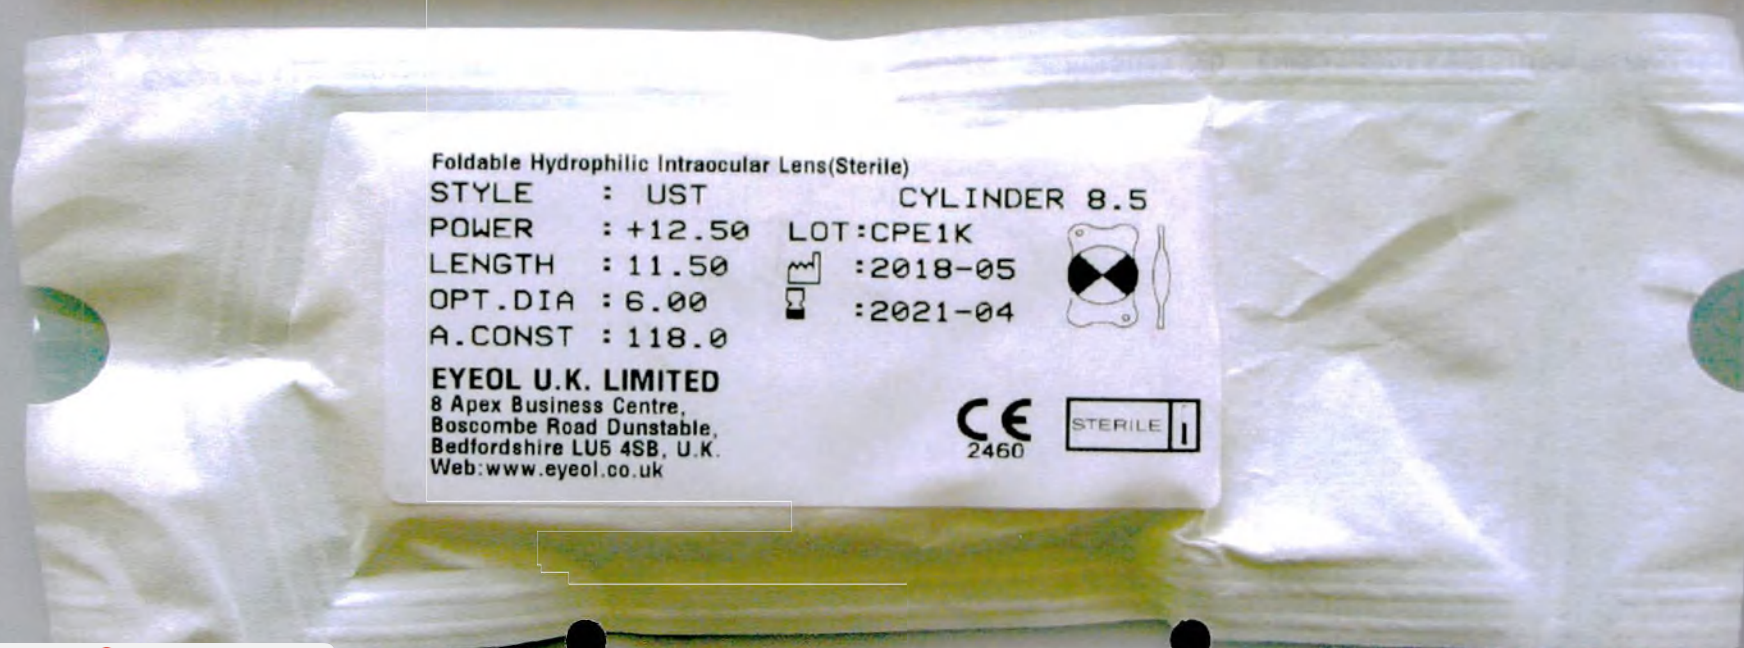




**Линза интраокулярная Ultima Smart Toric, модель UST.
Контейнер с линзой, инжектор и картридж.**

STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04




STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04




STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04




STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE: UST CYLINDER 8.5
LENGTH :11.50 POWER :+12.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04





Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : UST CYLINDER 8.5
LENGTH : 11.50 POWER : +12.50
OPT.DIA : 6.00 Exp:2021-04



Наклейка пациента

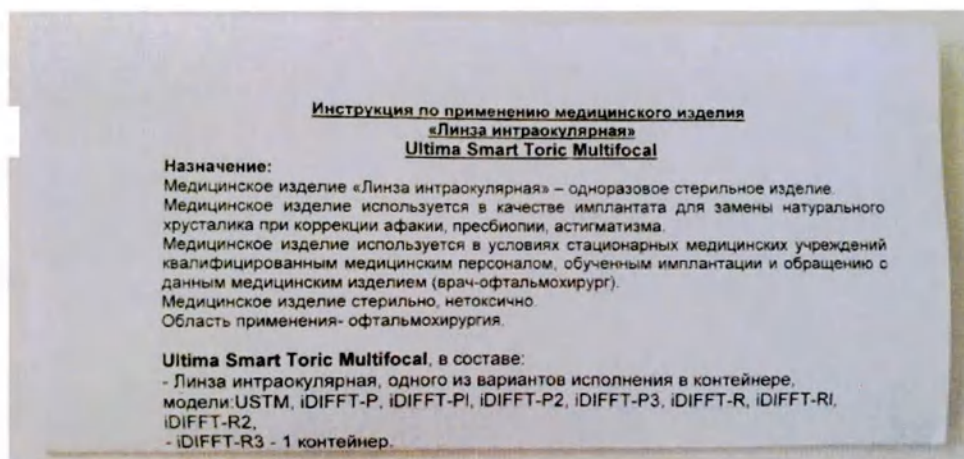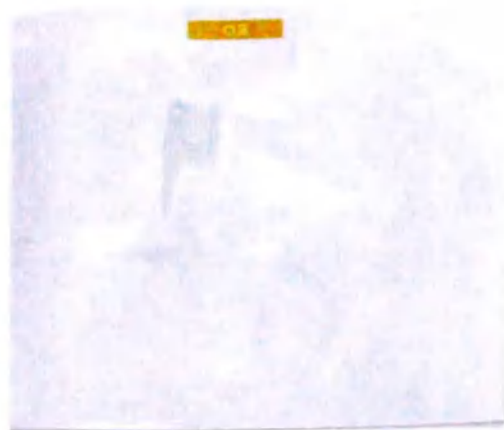

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Ultima Smart Toric Multifocal, в составе:**


- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели: USTM, iDIFFT-P, iDIFFT-P1, iDIFFT-P2, iDIFFT-P3, iDIFFT-R, iDIFFT-R1, iDIFFT-R2, iDIFFT-R3 - 1 контейнер.
- Инjekтор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантаций - не более 10 шт.
- Инструкция по использованию - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.





Линза интраокулярная Ultima Smart Toric Multifocal, модель iDIFFT-R1.

Потребительская упаковка (коробка).

**Линза интраокулярная Ultima Smart Toric Multifocal, модель iDIFFT-R1.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере).**

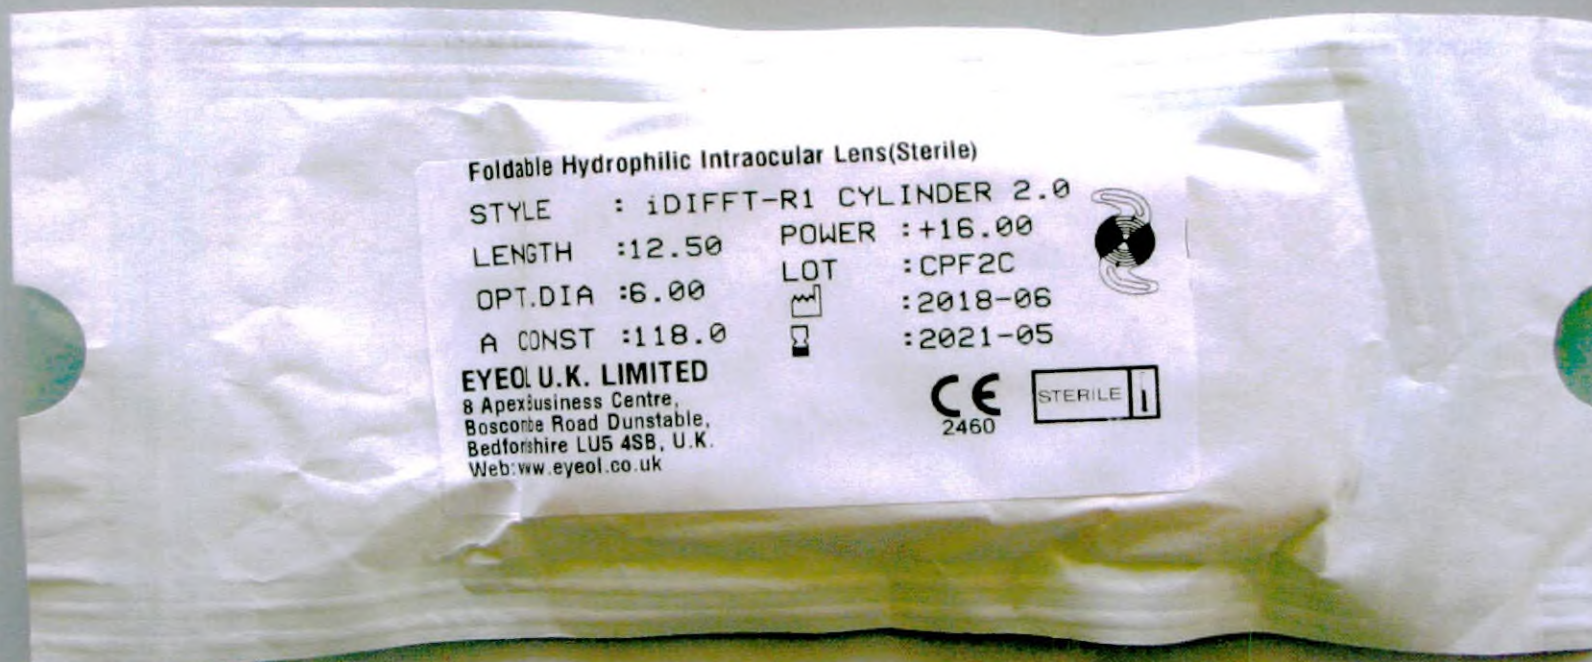

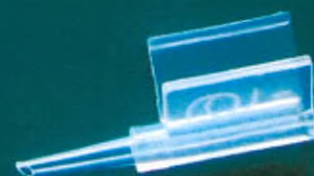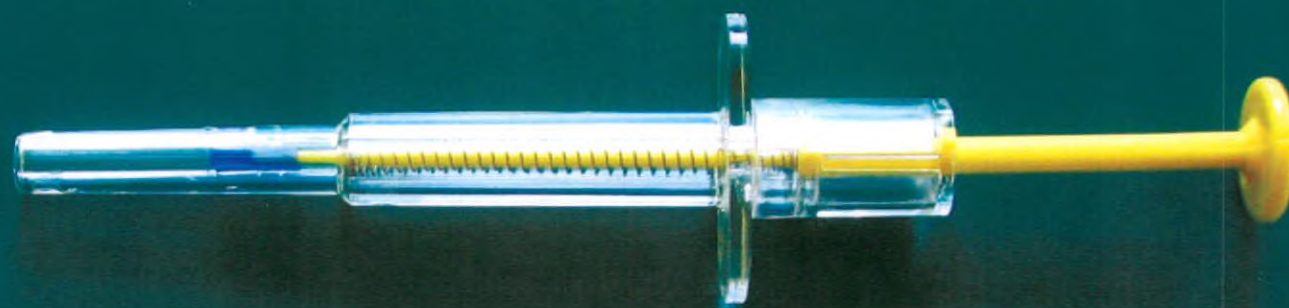

**Линза интраокулярная Ultima Smart Toric Multifocal, модель iDIFFT-R1.
Контейнер с линзой, инжектор и картридж.**

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05



IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: () R () L

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0
Length : 12.50 Power : +16.00
 Opt.Dia : 6.00
CPF2CFSTRU00003 EXP:2021-05

Наклейка пациента

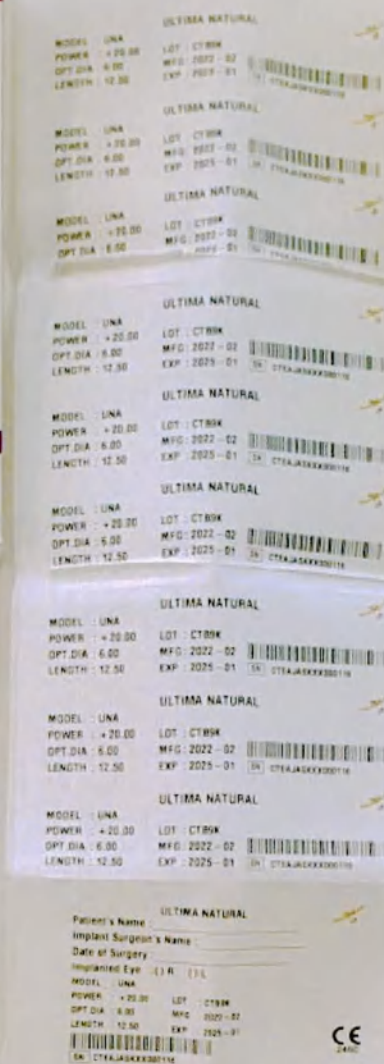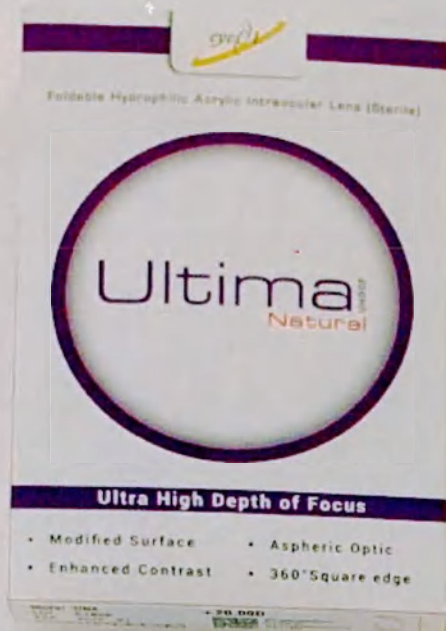

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Ultima Natural

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Ultima Natural в составе:

- Линза интраокулярная: модель UNA, в контейнере - 1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Ultima Natural** в составе:

- Линза интраокулярная : модель UNA, в контейнере - 1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.

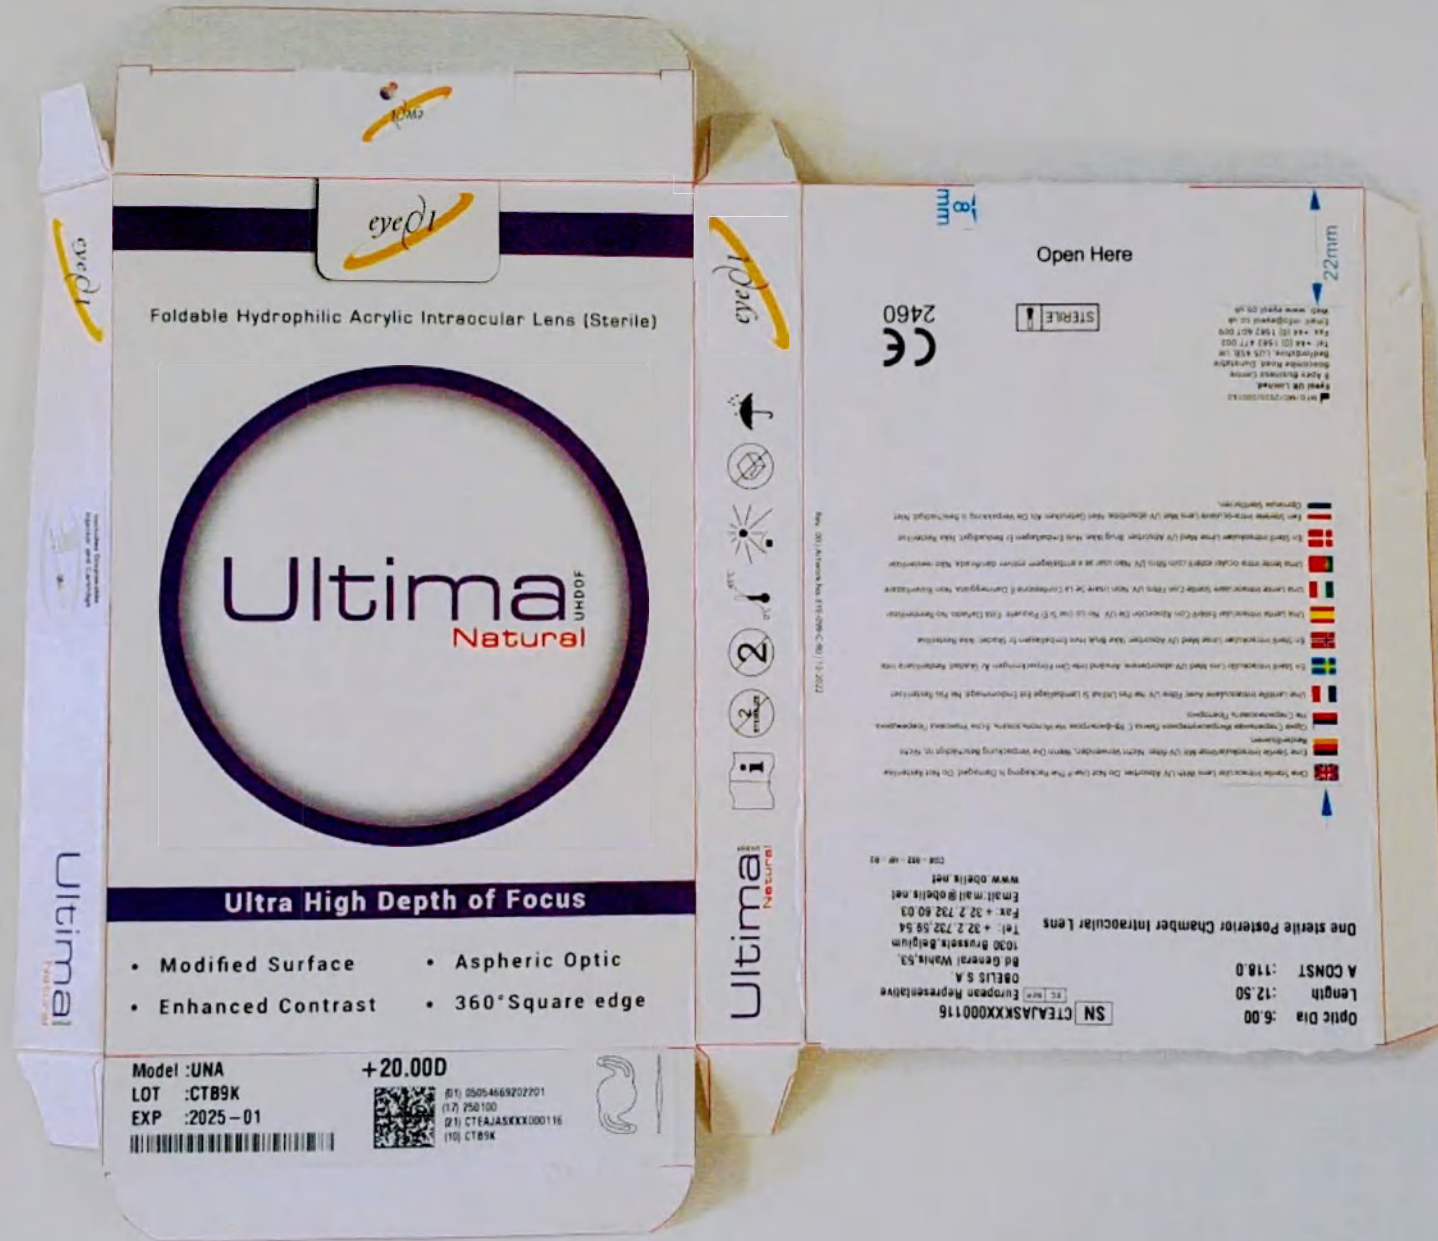

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения **Ultima Natural**,
 потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

ULTIMA NATURAL
Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50
LOT : CTB9K
MFG: 2022-02
EXP: 2025-01
[SN] CTEAJASXXX000116

CE
2460

Наклейки для контроля имплантации и наклейка пациента



TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT: C5J21
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02
ADD N +3.50
ADD I +1.800
SN: CTHA/55YX200073

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» TriPhobic

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

TriPhobic в составе:

-Линза интраокулярная, модель AS-6TD, в контейнере-1 контейнер.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения TriPhobic в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6TD -1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт
- Инструкция по использованию - 1 шт.
- Коробка -1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения **TriPhobic**,
 потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800



SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBIC

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800




SN CTHAP68YXX000073

TRIPHOBIC

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00
LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02
SN CTHAP68YXX000073

Add N : +3.50
Add I : +1.800

CE
2460

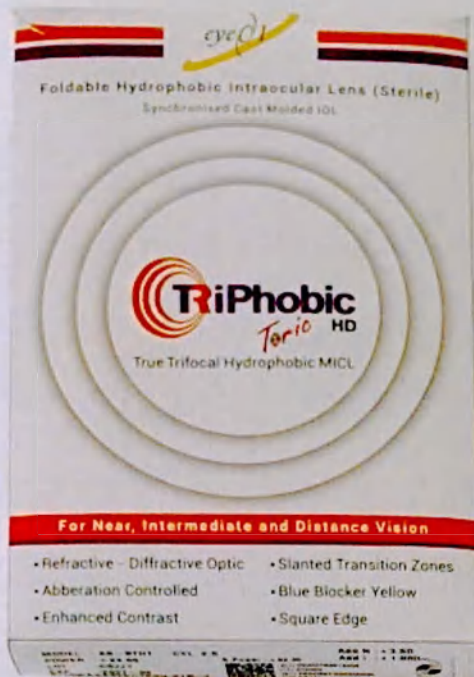

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 Add N +3.50
POWER +24.00 LOT: CSJJ1 Add I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSKD85TAXX000008

Инструкция по применению медицинского изделия **«Линза интраокулярная»** **TriPhobic Toric**

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

TriPhobic Toric в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6TDT, в контейнере-1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **TriPhobic Toric**

в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6TDT -1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт
- Инструкция по использованию - 1 шт.



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02

MODEL : AS-6TDT
POWER : +24.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOIC HD TORIC
CYL 2.5
LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02


TRIPHOIC HD TORIC

Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Implanted Eye : () R () L
MODEL : AS-6TDT CYL 2.5
POWER : +24.00 LOT : CSJJ1
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

Add N : +3.50
Add I : +1.800

SN CSXD85TAXX000006

CE
2460

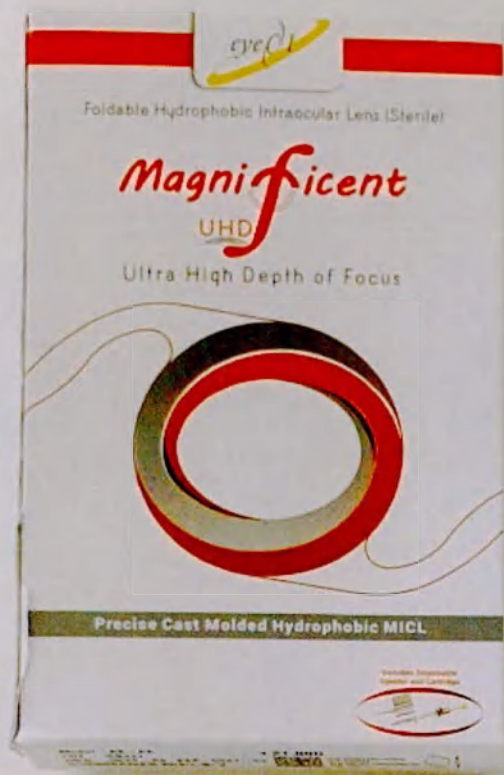

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

MAGNIFICENT UHDOF

Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: () R () L

MODEL AS-6A
POWER +21.00
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00

LOT: CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP: 2027-02

CE

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
Magnificent

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Magnificent в составе:

- Линза интраокулярная, модели AS-6A, AS-6CA, AS-7, в контейнере- 1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

- Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Magnificent в составе:**
- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели AS-6A, AS-6CA, AS-7 -1 контейнер.
 - Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
 - Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
 - Наклейка пациента- 1шт.
 - Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
 - Инструкция по использованию- 1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения **Magnificent**,
потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка




Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF


LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF


LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF


LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF


LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF


LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF

LOT : CSJJ1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



MAGNIFICENT UHDOF



Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

LOT : CSJJ1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



CE
2460

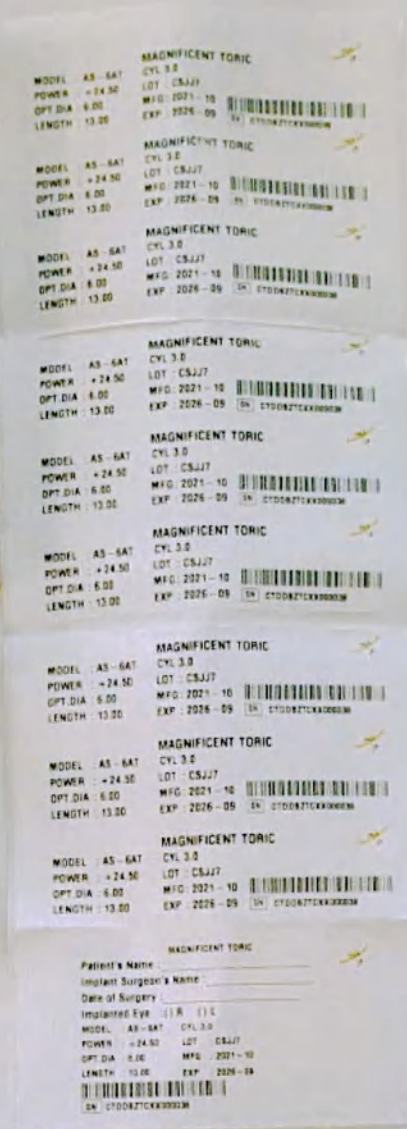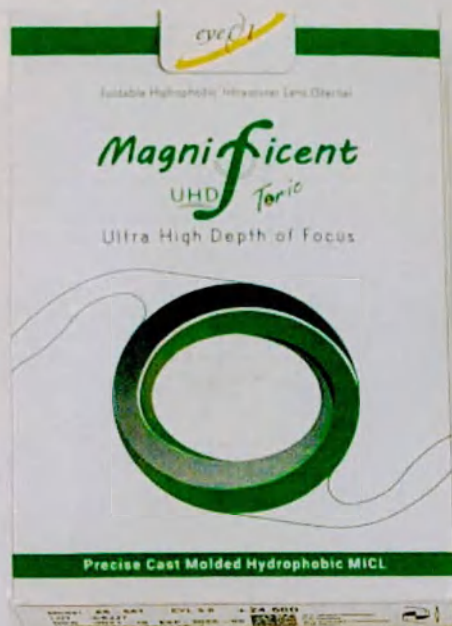

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Magnificent Toric

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.


Magnificent Toric в составе:

- Линза интраокулярная, модели AS-6AT, AS-6CAT, AS-7T, в контейнере-1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

- Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Magnificent Toric**, в составе:
- Линза интраокулярная, одного из вариантов исполнения в контейнере, модели:AS-6AT, AS-6CAT, AS-7T-1 контейнер
 - Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп. - Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
 - Наклейка пациента- 1шт.
 - Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
 - Инструкция по использованию - 1 шт.
 - Коробка - 1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения Magnificent Toric,
 потребительская упаковка

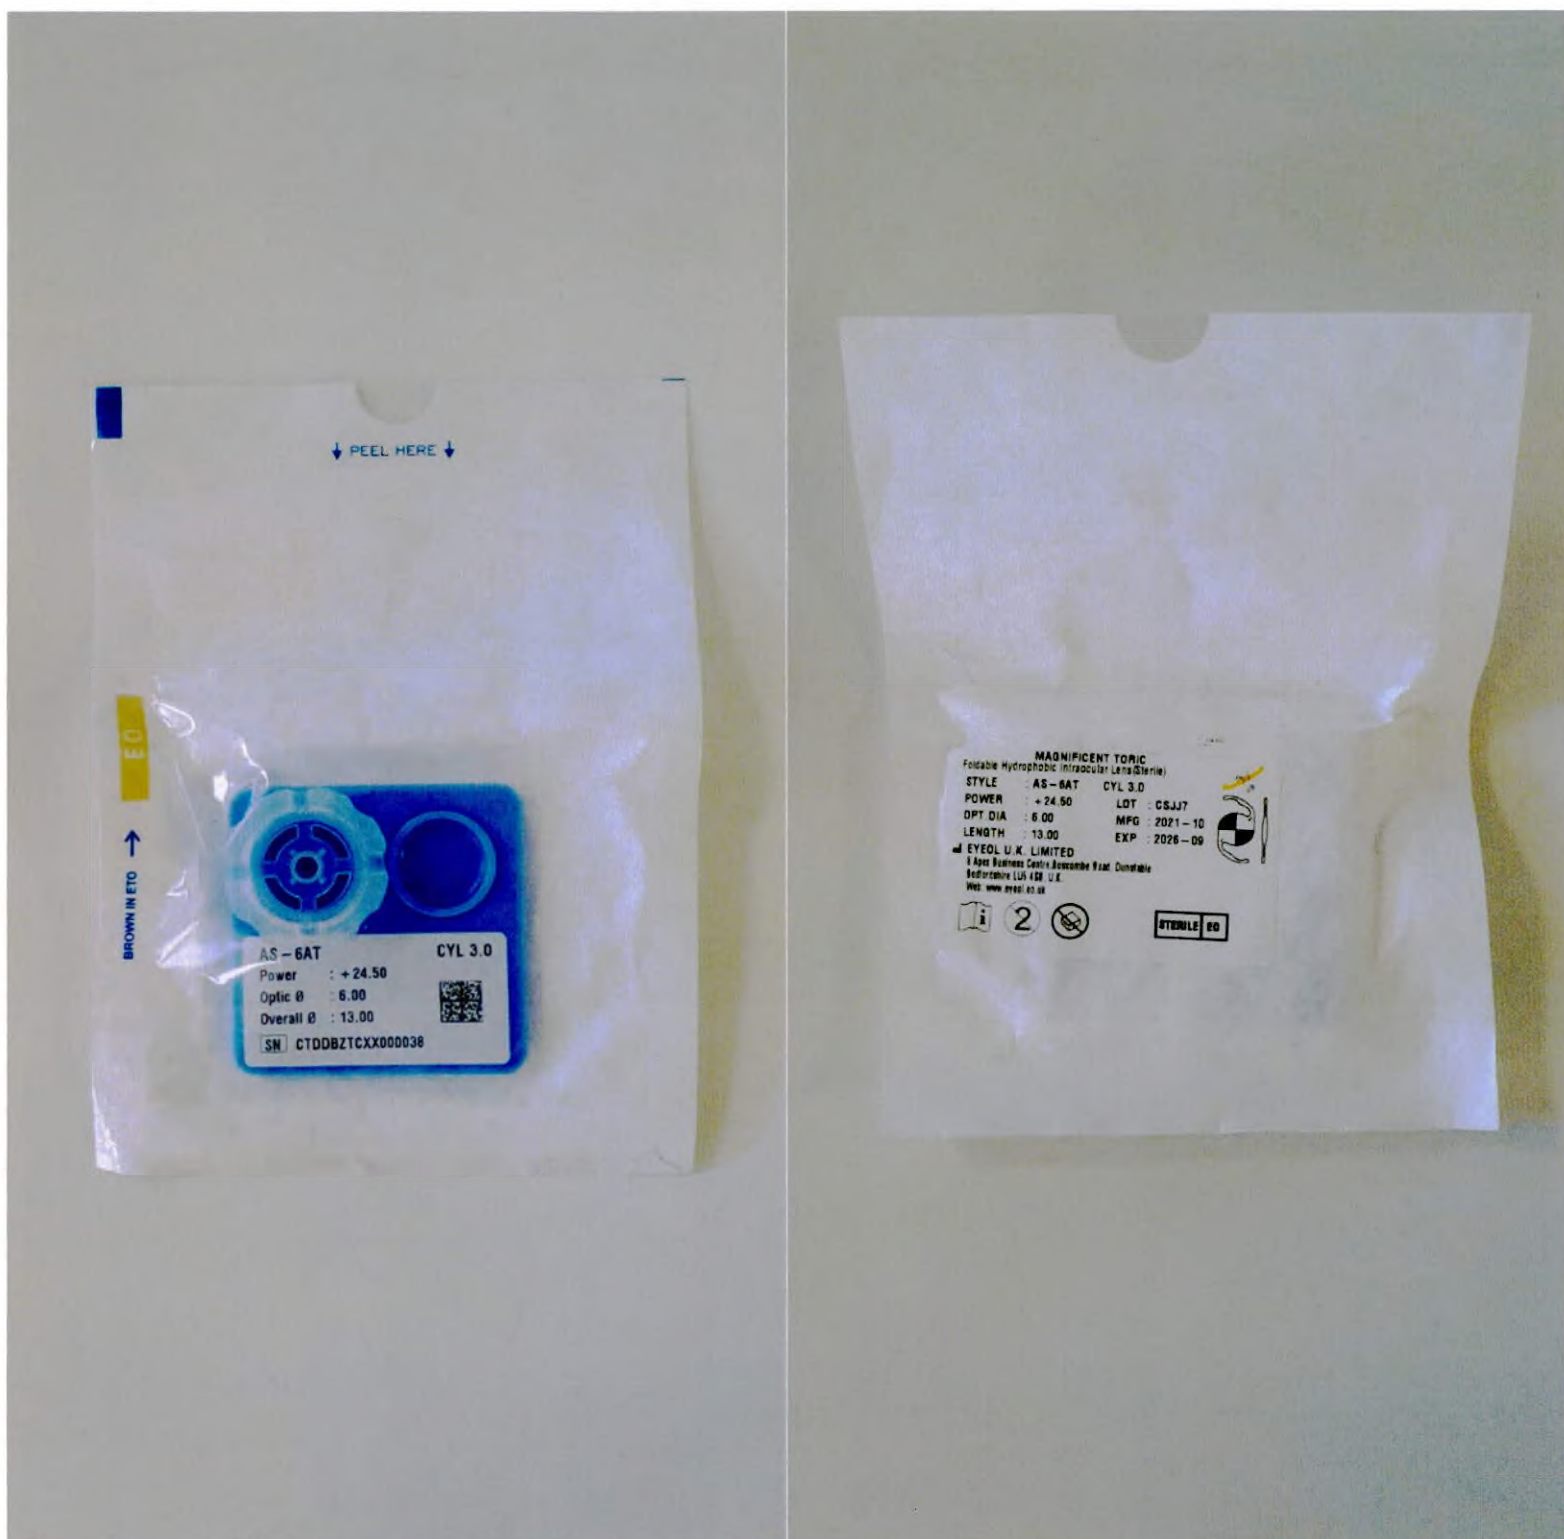

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



AS - bAT

CYL 3.0

Power : +24.50

Optic Ø : 6.00

Overall Ø : 13.00



SN CTDDBZTCXX000038

Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CSJJ7
MFG : 2021-10
EXP : 2026-09


SN CT008ZTCXX000038

MAGNIFICENT TORIC

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6AT CYL 3.0
POWER : +24.50 LOT : CSJJ7
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2021-10
LENGTH : 13.00 EXP : 2026-09

SN CT008ZTCXX000038

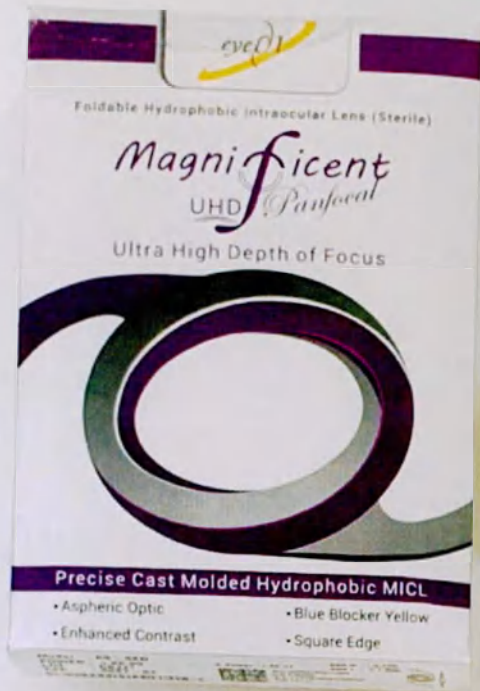

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02 SN CTKAD955XK000020

MODEL AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL

Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Implanted Eye : () R () L
MODEL AS-6ED
POWER +22.00 LOT CSJJ1 Add N +3.000
OPT DIA 6.00 MFG 2022-03 Add I +1.600
LENGTH 13.00 EXP 2027-02
SN CTKAD955XK000020

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
Magnificent Panfocal

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия..

Magnificent Panfocal в составе:

-Линза интраокулярная- модель AS-6ED, в контейнере-1 контейнер.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Magnificent Panfocal** в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6ED -1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

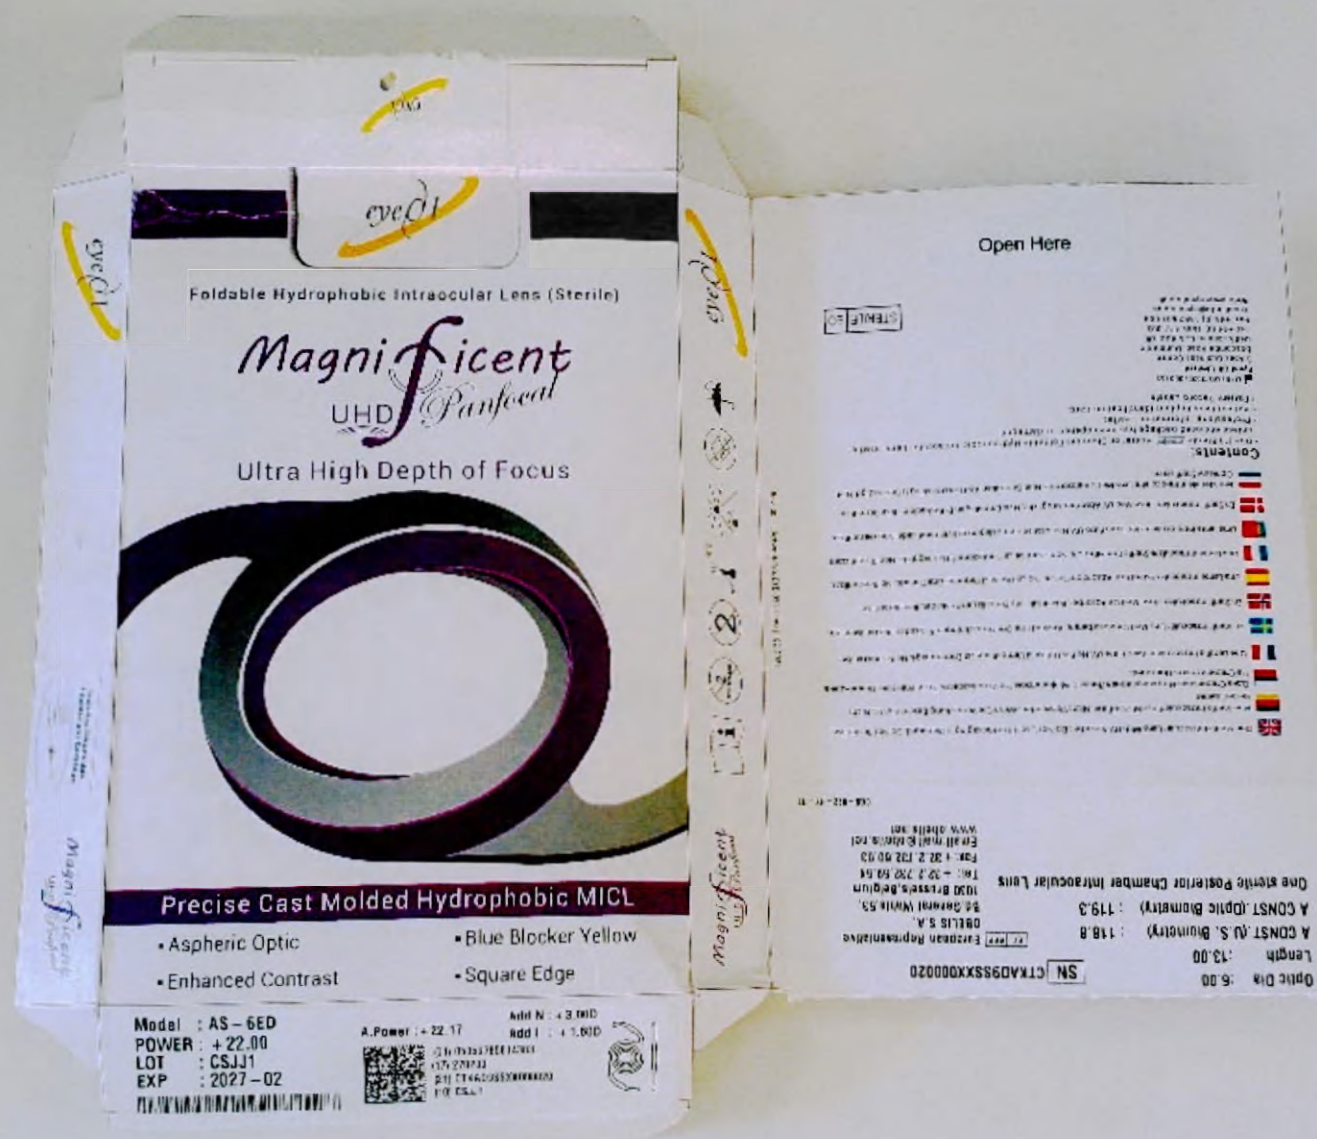

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения **Magnificent Panfocal**,
потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MODEL : AS-6ED MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL
POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SSXX000020

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____

Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6ED

POWER : +22.00 LOT : CSJJ1 Add N : +3.00D

OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03 Add I : +1.60D

LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CTKAD9SSXX000020





MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CTKADSWKX00000

MAGNIFICENT UHDF PANFOCAL TORIC
Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: () R () L
MODEL AS-6EDT CYL 2.0 Add N: +3.000
POWER +23.00 LOT: CSJJ1 Add I: +1.600
OPT.DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02
SN: CTKADSWKX00000

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Magnificent Panfocal Toric

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.


Magnificent Panfocal Toric в составе:
- Линза интраокулярная: модель AS-6EDT, в контейнере-1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения **Magnificent Panfocal Toric** в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6EDT, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения **Magnificent Panfocal Toric**,
 потребительская упаковка

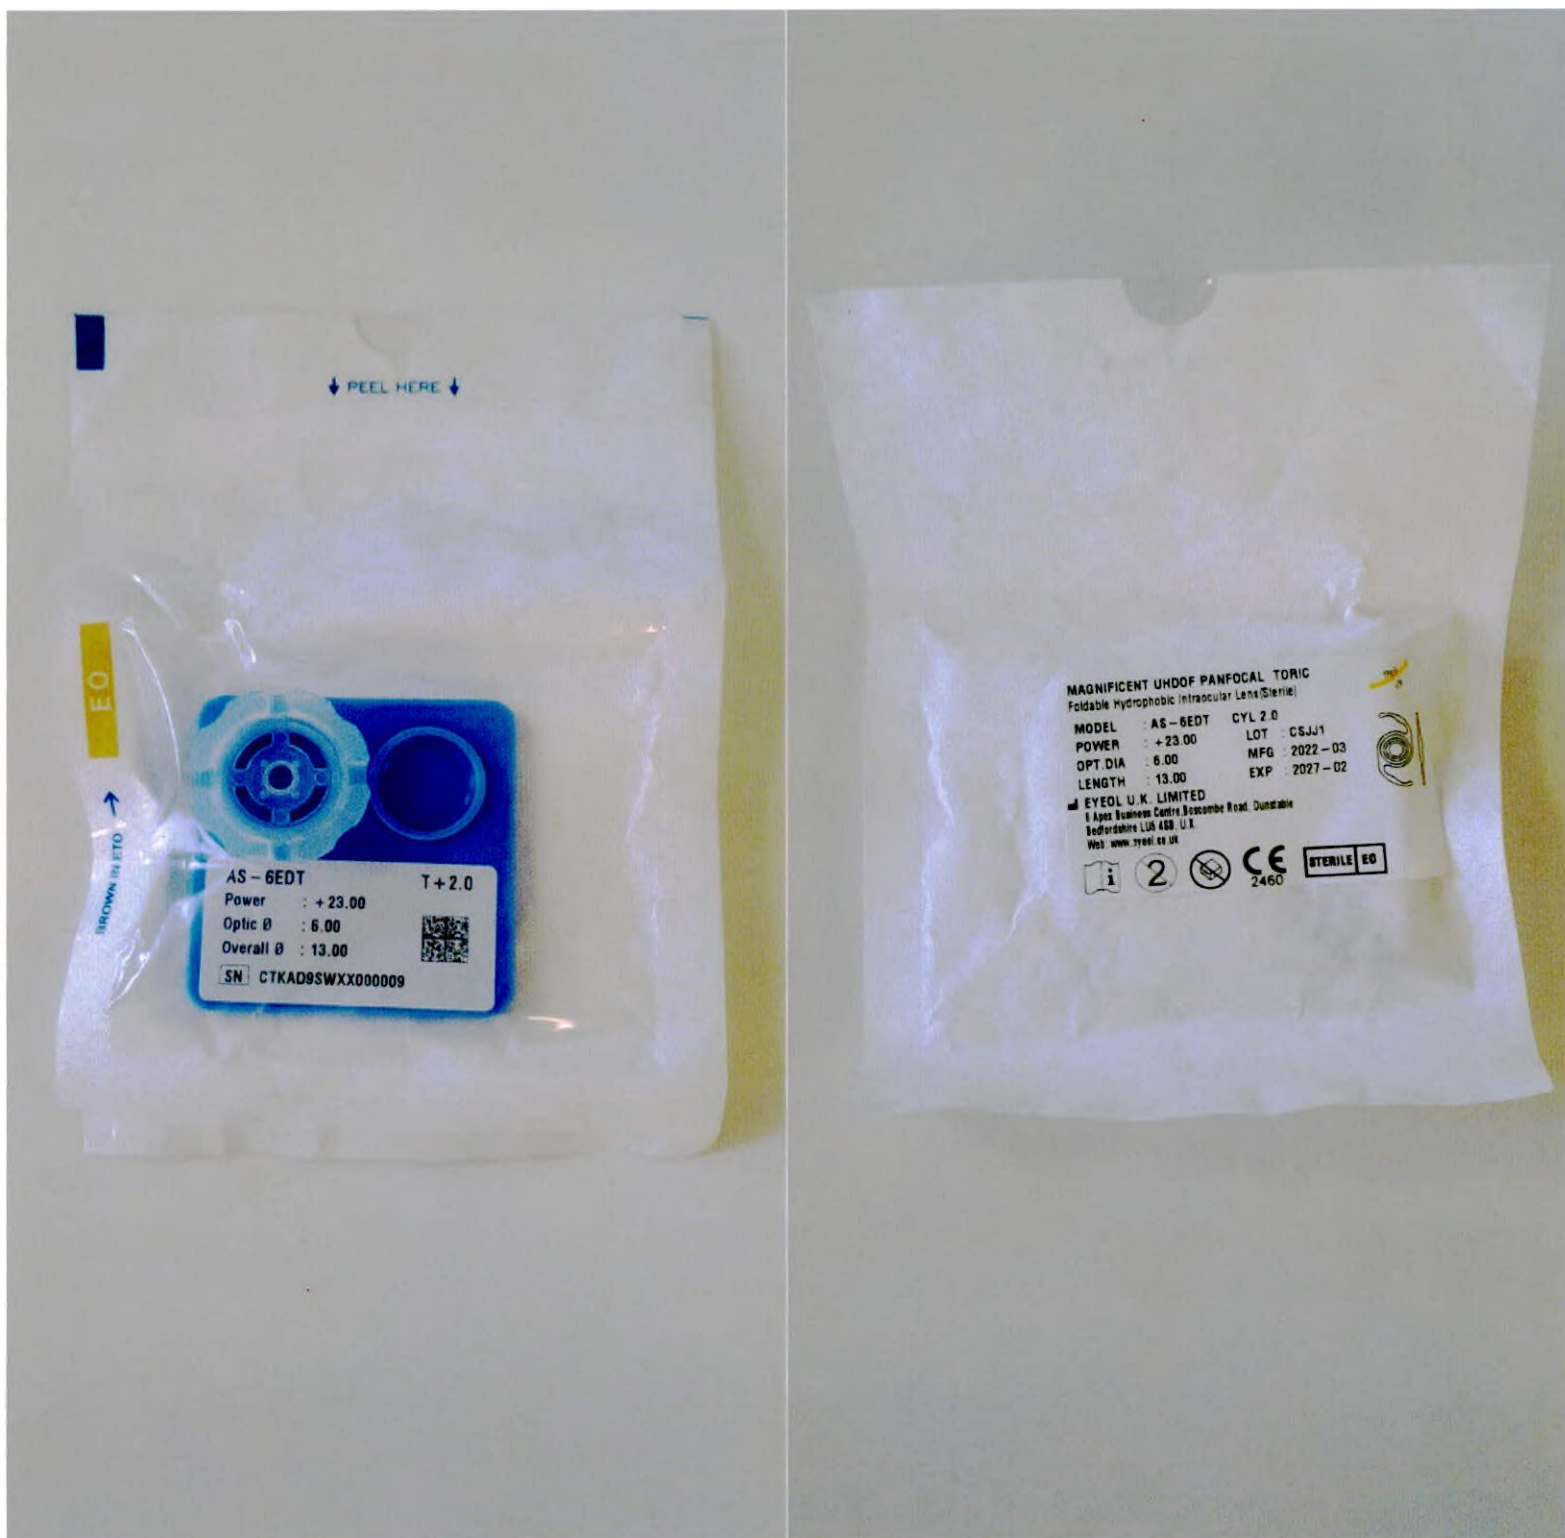

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
 SN CTKAD95WXX000009


MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

Patient's Name :
 Implant Surgeon's Name :
 Date of Surgery :
 Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.000
 POWER : +23.00 LOT : CSJJ1 Add I : +1.600
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CTKAD95WXX000009

CE
 2460

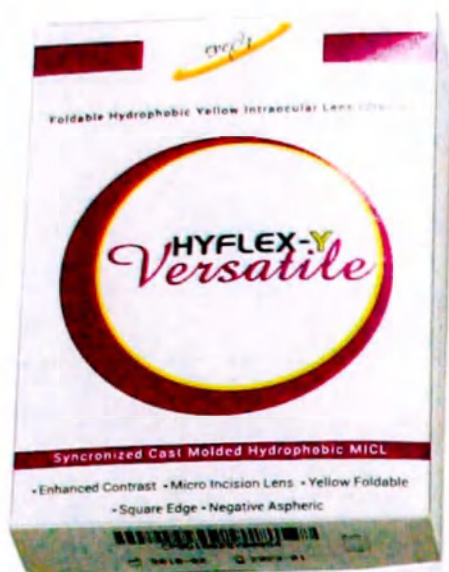

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

Refill to Name: _____
English Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: () R () L

STYLE: AS-6V POWER: +23.50
LENGTH: 11.00 OPT. DIA: 6.00 Exp: 2023-01

CPBD1825Y00054



Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Hyflex-Y Versatile

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма.

Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург).

Медицинское изделие стерильно, нетоксично.


Область применения: офтальмохирургия.

Hyflex-Y Versatile, в составе:


- Линза интраокулярная, модель AS-6V - 1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения
Hyflex-Y Versatile, в составе:


- Линза интраокулярная, модель AS-6V - 1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке - 1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации - не более 10 шт.
- Инструкция по использованию - 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

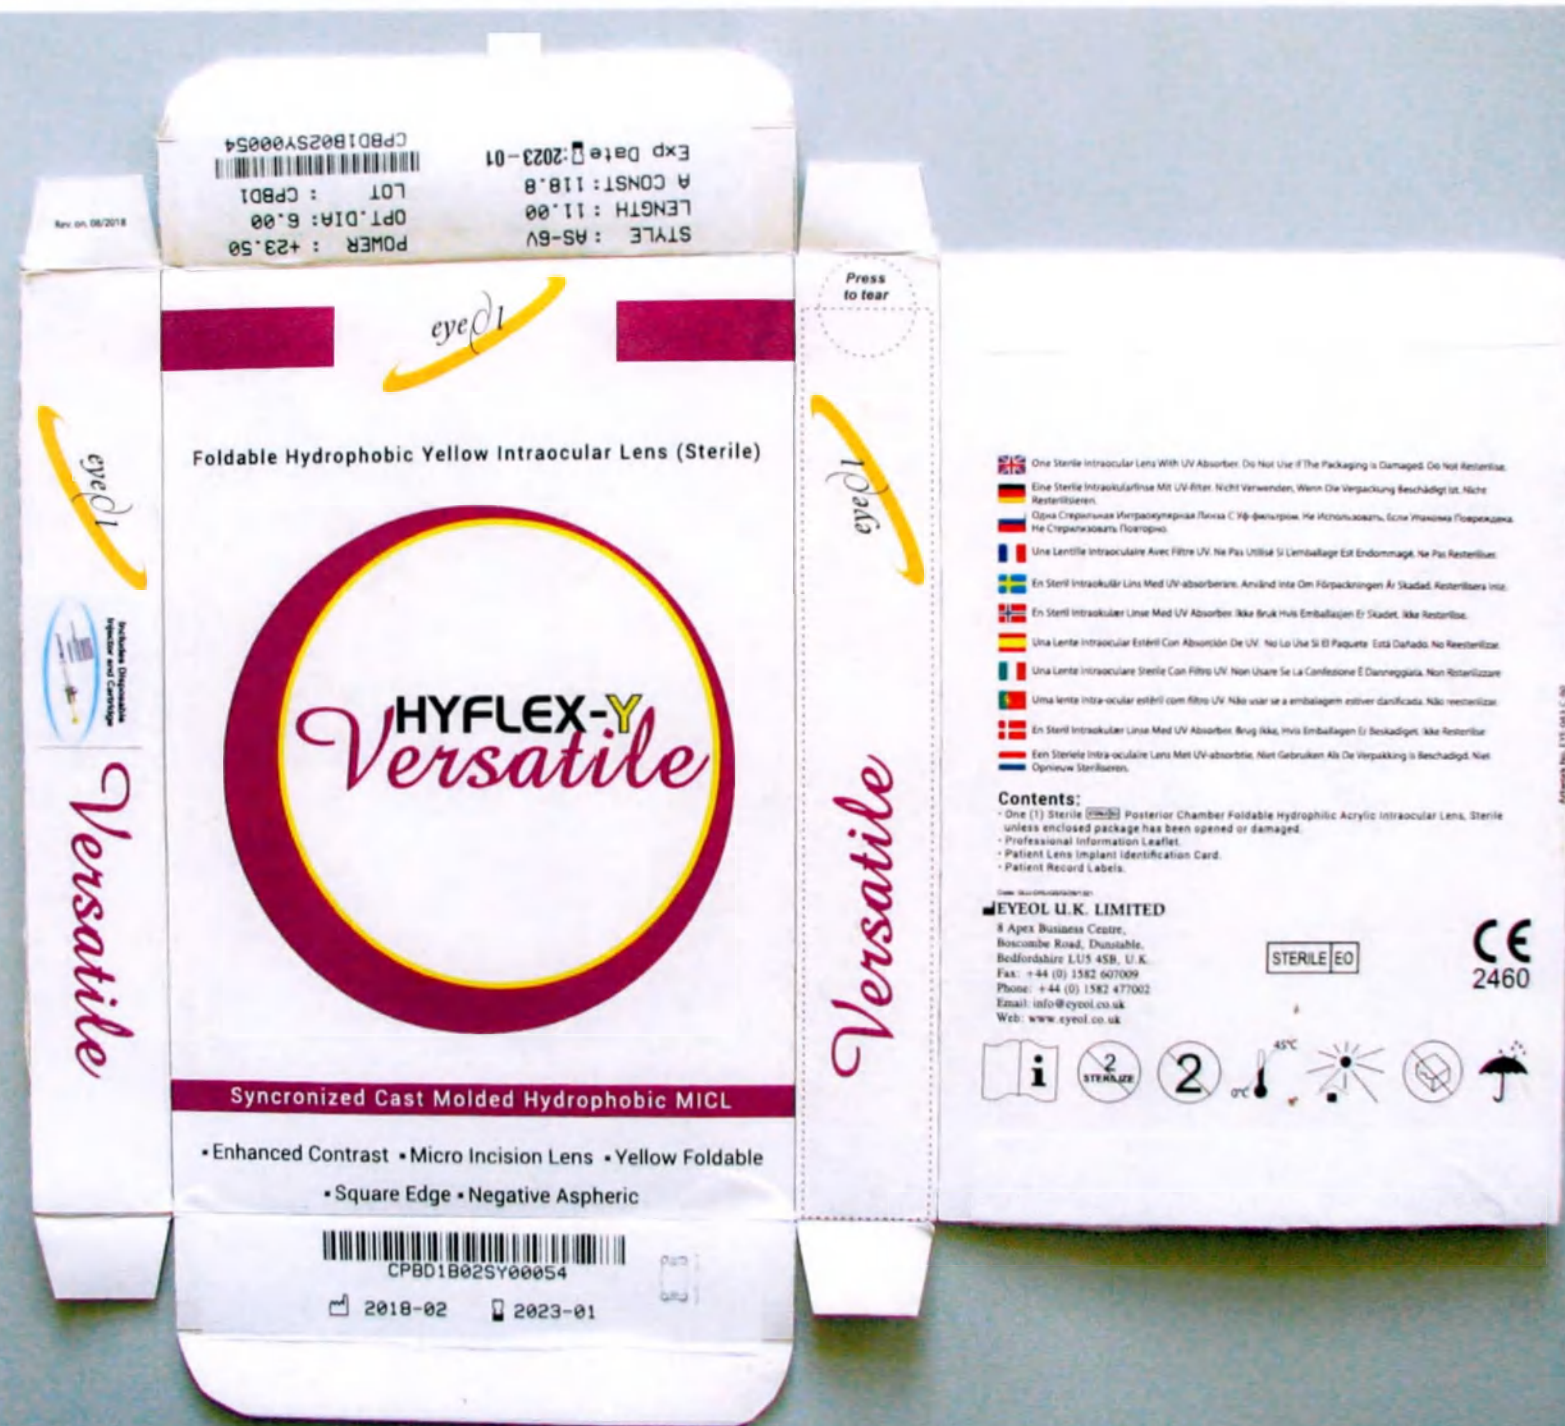

Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile, модель AS-6V.
Потребительская упаковка (коробка)

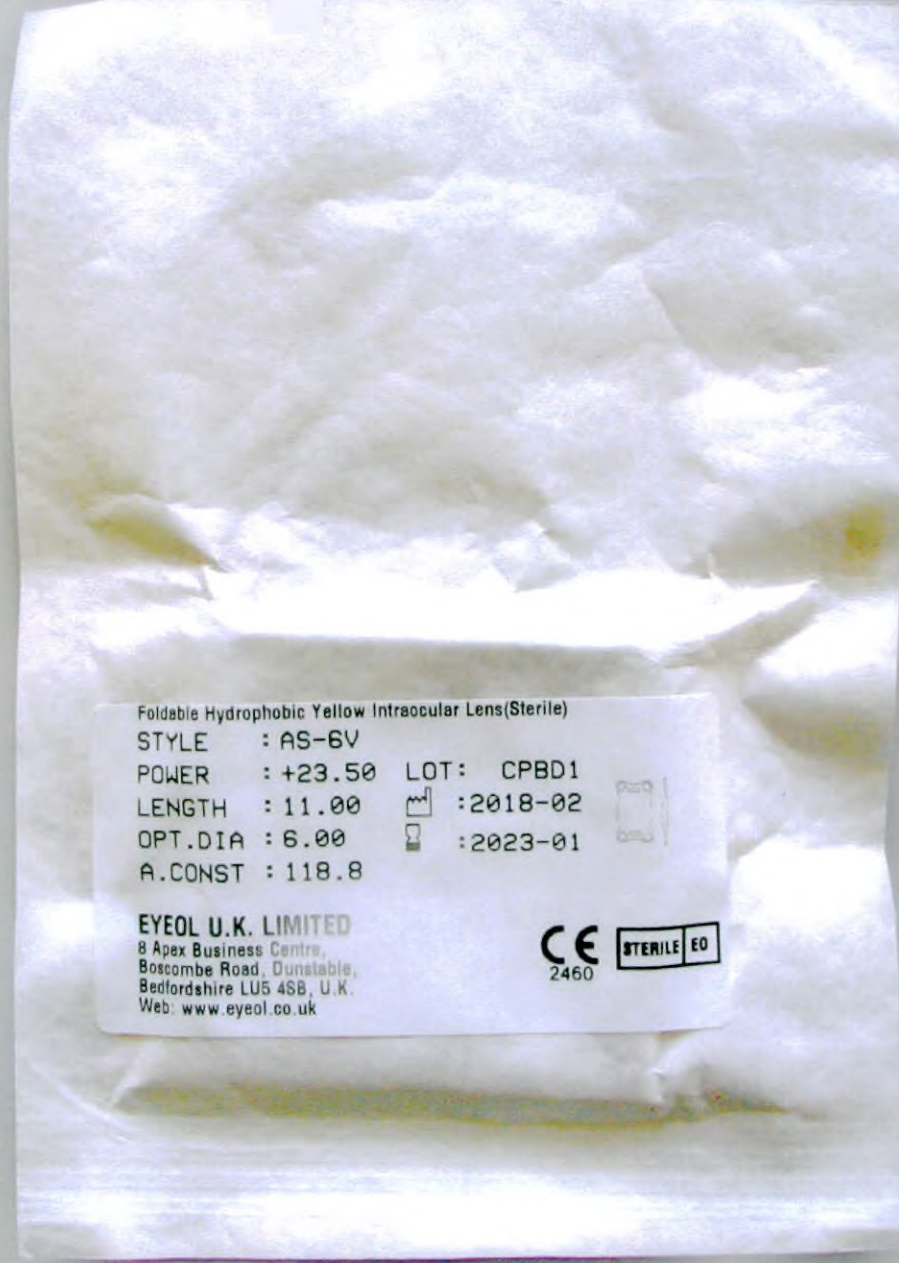

Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile, модель AS-6V.
Контейнер с линзой в индивидуальной упаковке (блистере)

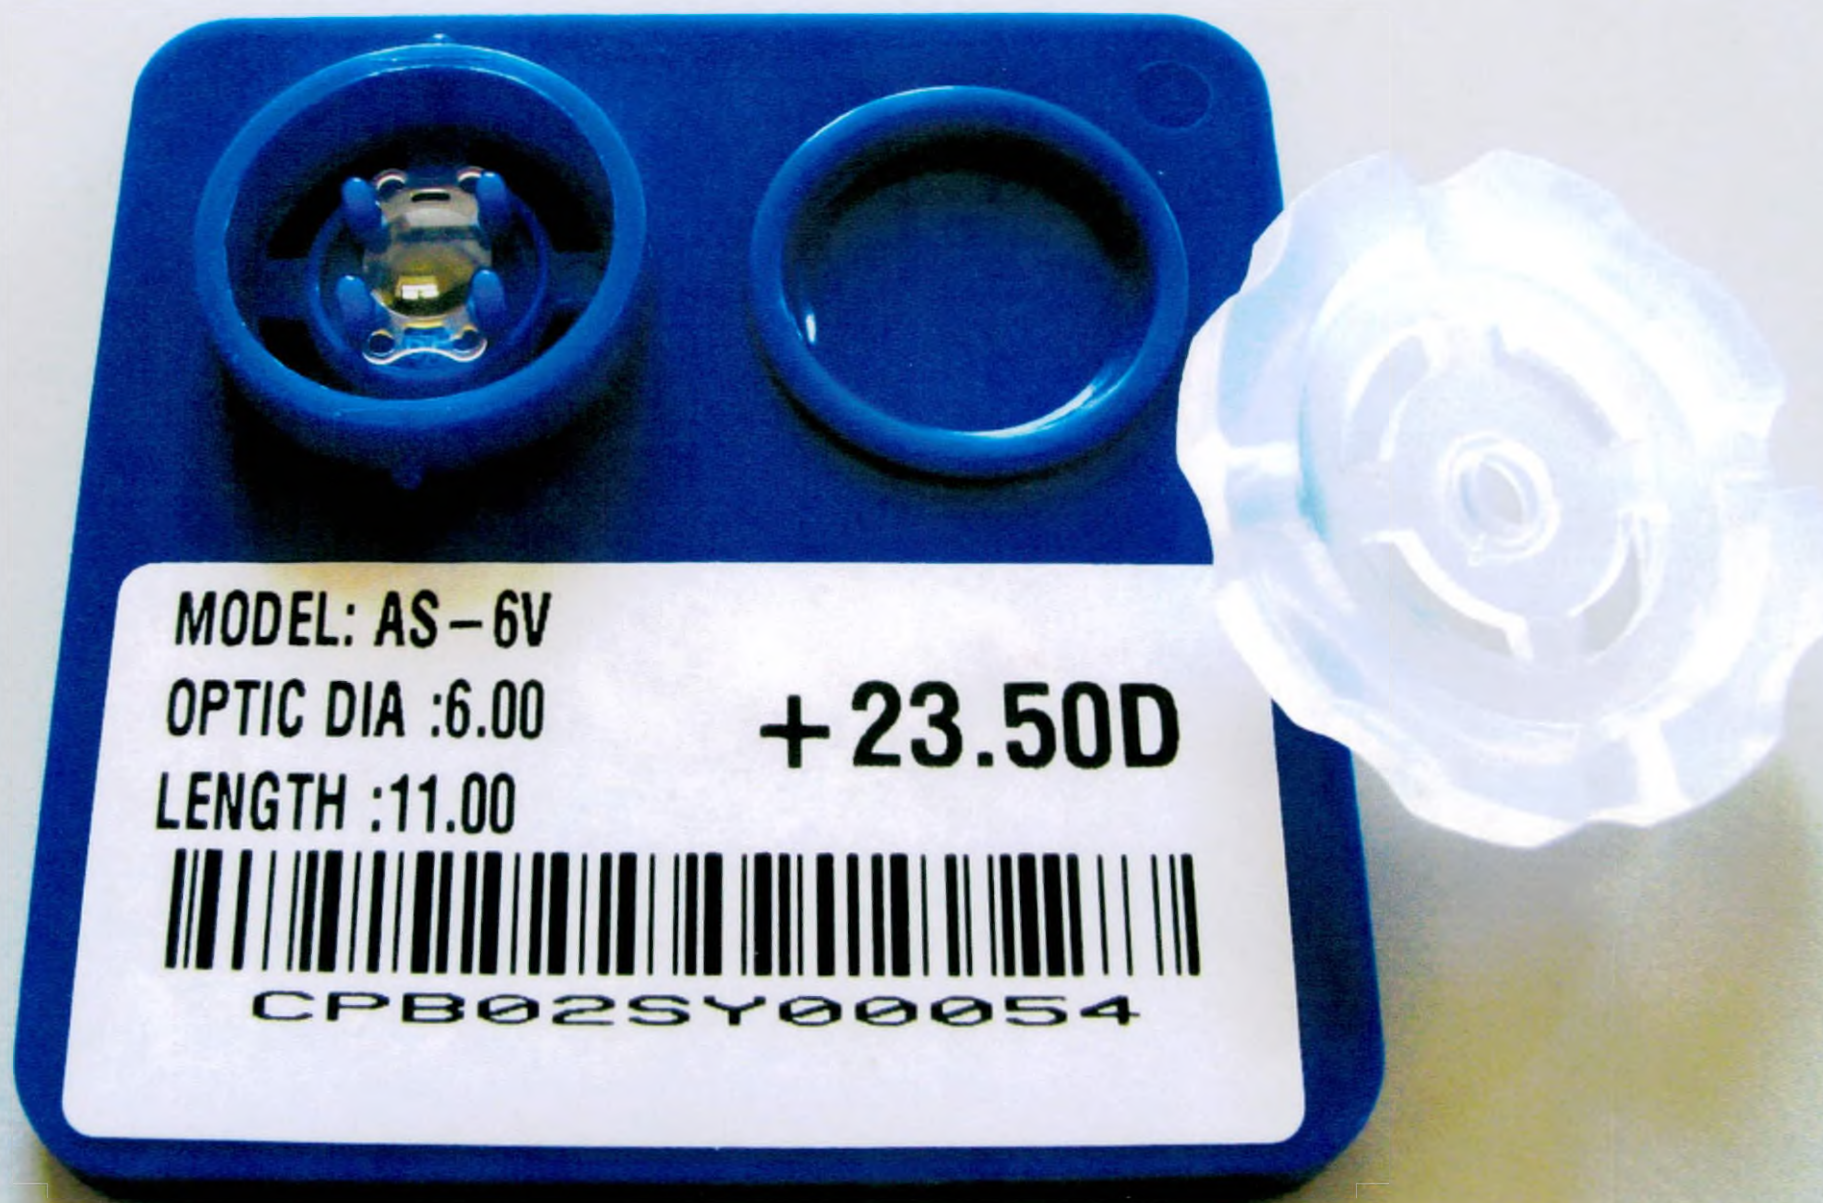

**Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile, модель AS-6V.
Линза в контейнере.**



**Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile , модель AS-6V.
Инжектор и картридж (без упаковки)**

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01




CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01




CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054

STYLE: AS-6V
LENGTH :11.00 POWER :+23.50
OPT.DIA :6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054


Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name : _____
Implant Surgeon's Name : _____
Date of Surgery : _____
Implanted Eye : () R () L
STYLE : AS-6V
LENGTH : 11.00 POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00 Exp:2023-01



CPBD1B02SY00054


Наклейка пациента

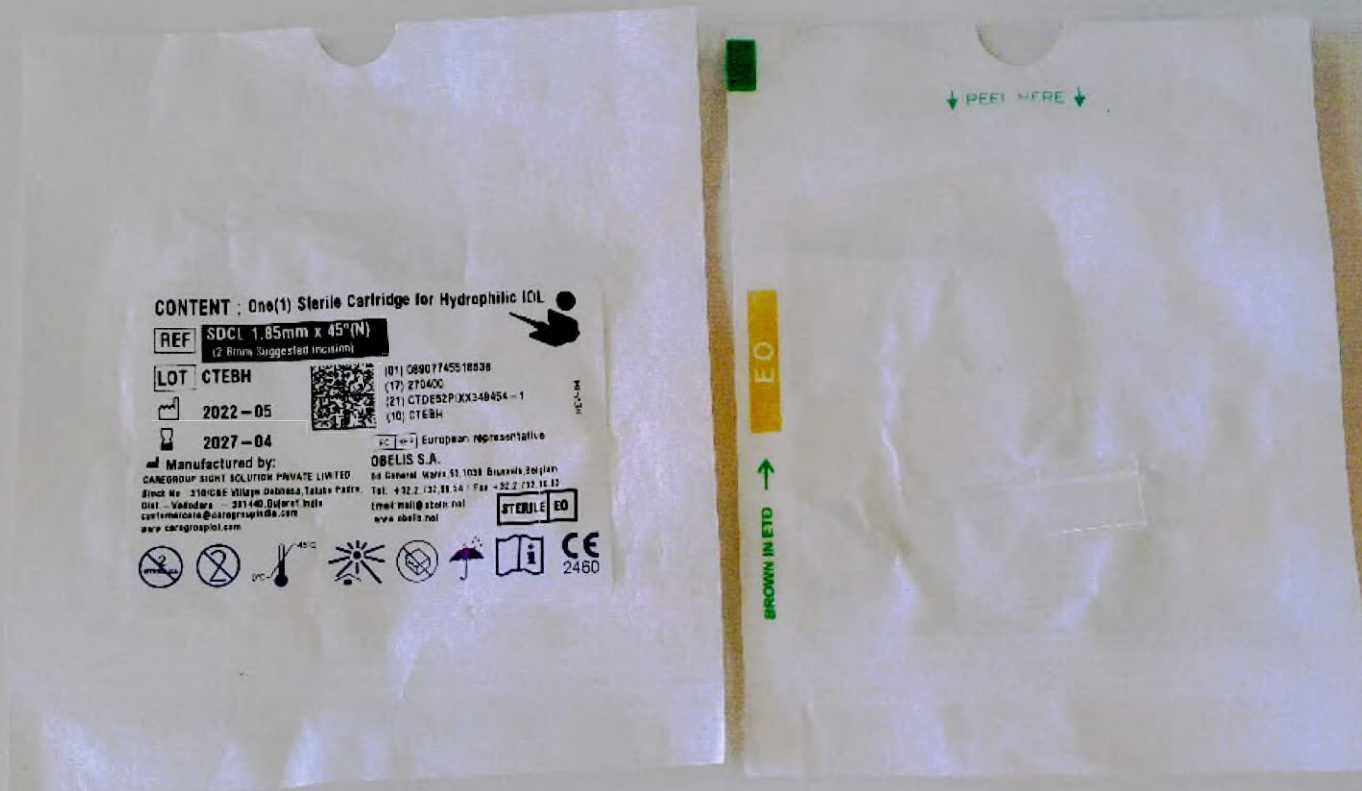

Картридж в блистерной упаковке



Инжектор, блистерная упаковка

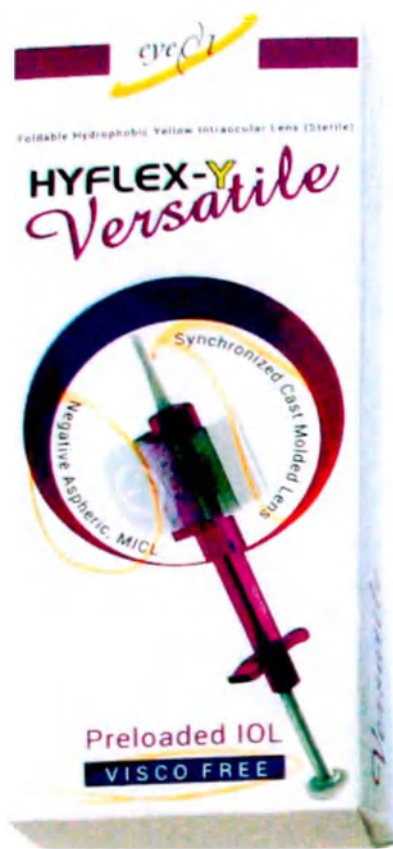

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Style : AS - 6VP
Power : +25.50
Length : 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia. 6.00
Serial No: CPEJ2C1YT000131

Patient's Name: _____
Surgeon's Name: _____
Surgery Date: _____
Eye: () R () L
Style: AS - 6VP
Power: +25.50



CPEJ2C1YT000131

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Hyflex-Y Versatile Preloaded

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Hyflex-Y Versatile Preloaded, в составе:

- Линза интраокулярная, модель AS-6VP (предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор) -1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации- не более 10 шт


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения
Hyflex-Y Versatile Preloaded, в составе:

- Линза интраокулярная, модель AS-6VP (предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор) -1 уп.
- Наклейка пациента - 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации- не более 10 шт
- Инструкция по использованию - 1 шт.
- Коробка -1 шт.




Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile Preloaded, модель AS-6VP.
Потребительская упаковка (коробка)

Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile Preloaded, модель AS-6VP.
Изделие без упаковки.

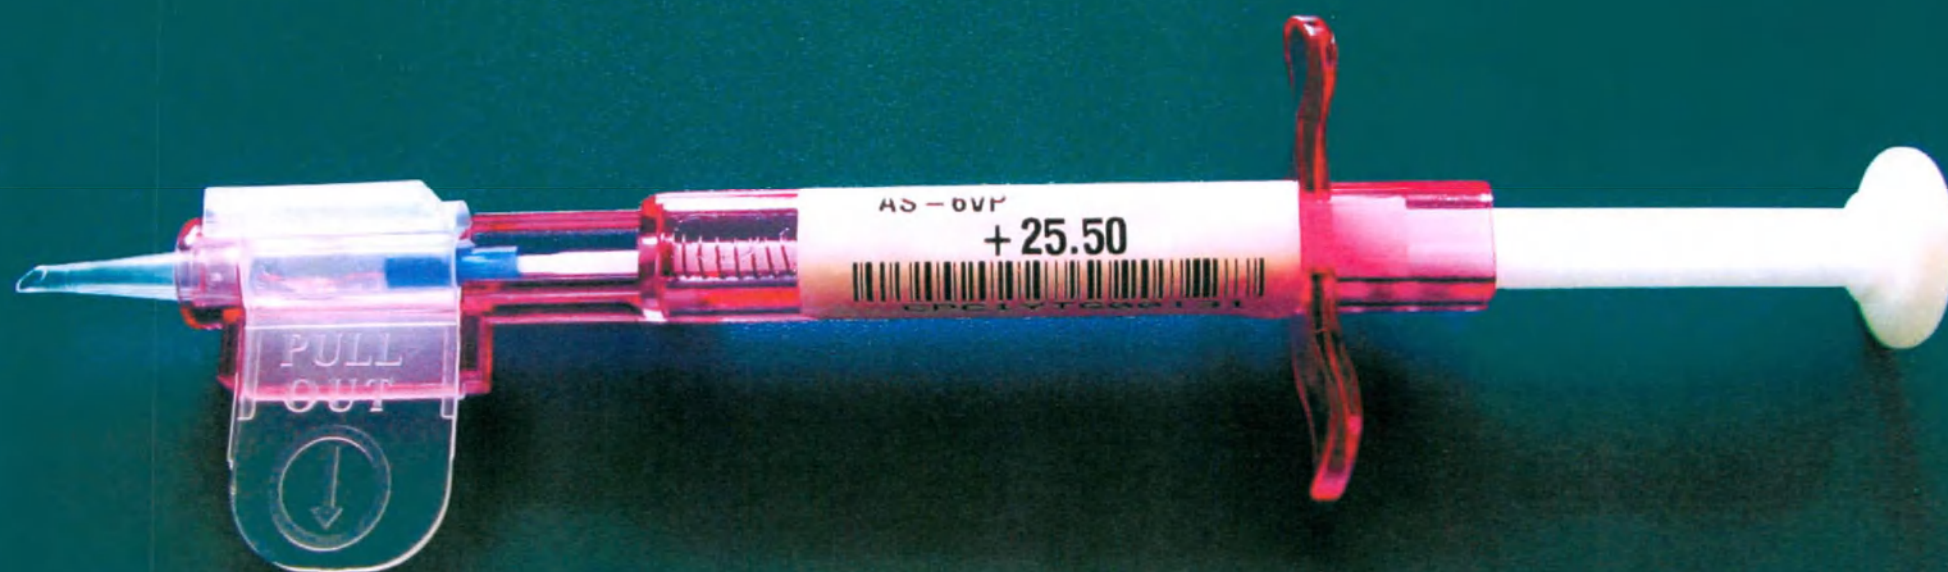

Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile Preloaded, модель AS-6VP.
Линза, предустановленная в картридж,
который заправлен в инжектор, в блистерной упаковке

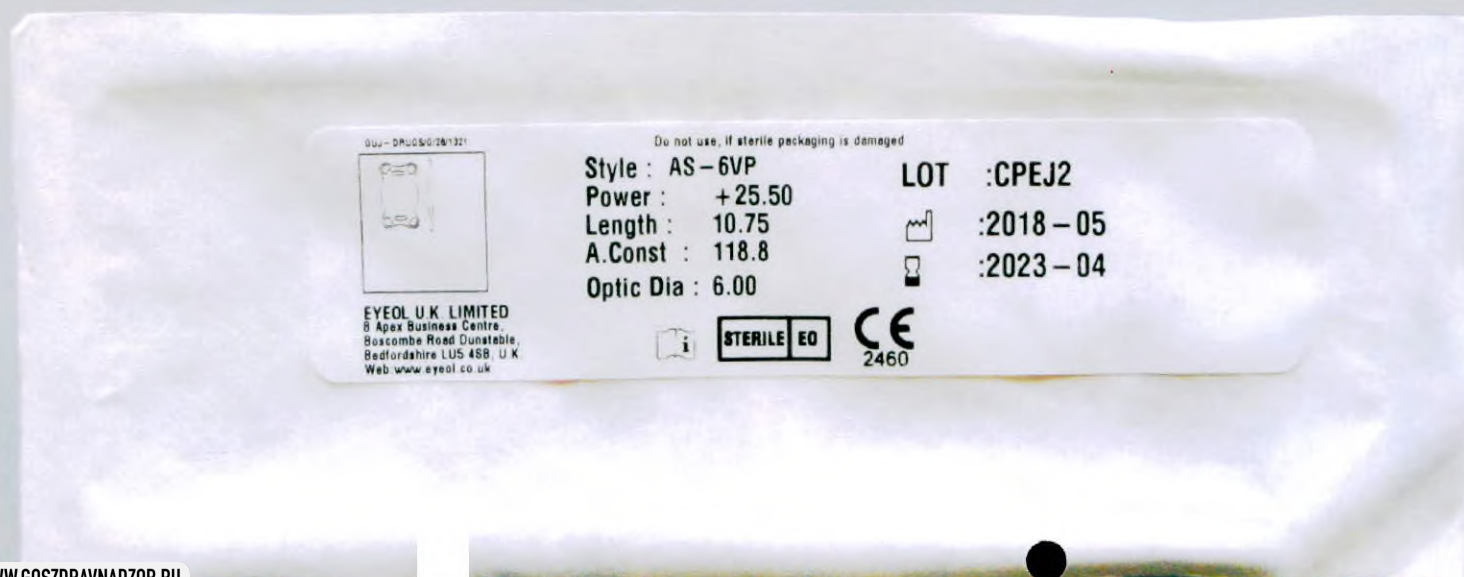

Patient's Name:
Surgeon's Name:
Surgery Date:
Eye: () R () L
Style: AS-6VP
Power: +25.50



CPEJ2C1YTG00131

Наклейка пациента

Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Style : AS-6VP
Power : +25.50 Length: 10.75
EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00
Serial No: CPEJ2C1YTG00131



Наклейки для контроля имплантации

Линза интраокулярная Вариант исполнения: _____		Схематическое изображение	
Модель Диоптрийность Общий диаметр Диаметр оптики А-константа Цилиндрическая сила	LOT REF  	ШТРИХ-КОД	
 2460 STERILE STERILE EO NON-TOXIC  45°C  0°C        SN			
 Производитель EYEOL UK LIMITED , 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom. www.eyel.co.uk Адреса мест производства: - EYEOL UK LIMITED ,8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom. - Caregroup Sight Solution Private Limited, Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India. Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО "КОМ СПАН", Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2. Тел./ факс: (495) 434 45 06			

Макет маркировки индивидуальной упаковки линзы (блистера).

Схематическое изображение	Наименование изделия Стерильный картридж для Линзы интраокулярной/ Стерильный инжектор для Линзы интраокулярной		РУ _____
	LOT  SN REF 		
	ШТРИХ-КОД		

 2460

STERILE EO

NON-TOXIC


 0°C
  45°C




SN






 70 %


Производитель
 EYEOL UK LIMITED , 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom.
 Web: www.eyeol.co.uk
Адреса мест производства:
 1. EYEOL UK LIMITED ,8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom.
 2. Caregroup Sight Solution Private Limited, Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India.
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:
 ООО "КОМ СПАН", Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2.
 Тел./ факс: (495) 434 45 06

Макет маркировки индивидуальной упаковки инжектора и картриджа (блистера).

Наименование изделия Линза интраокулярная		PY _____	Схематическое изображение медицинского изделия
Модель Общий диаметр А-константа Цилиндрическая сила Диоптрийность Диаметр оптики	   	Штрих-код	
  STERILE  STERILE ISO NON-TOXIC  ^{45°C} ^{0°C} $\neq$ $\neq$     			
Медицинское изделие (одного из вариантов исполнения TriDiff Dynamic Vision, TriDiff Dynamic Vision Toric, Ultima Smart Toric, Ultima Smart Toric Multifocal, Ultima Natural, TriPhobic, TriPhobic Toric, Magnificent, Magnificent Toric, Magnificent Panfocal, Magnificent Panfocal Toric, Hyflex-Y Versatile) в составе: Линза одного из вариантов исполнения в контейнере - 1 контейнер. Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп. Картридж в блистерной упаковке- 1 уп. Наклейка для пациента- 1шт. Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт. Инструкция по использованию- 1 шт. Коробка - 1 шт.			
 Производитель EYEOL UK LIMITED, 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom. www.eycol.co.uk Адреса мест производства: 1. EYEOL UK LIMITED, 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom. 2. Caregroup Sight Solution Private Limited, Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India. Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО "КОМ СПАН" Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2. Тел./ факс: (495) 434 45 06			

Макет маркировки потребительской упаковки для вариантов исполнения

TriDiff Dynamic Vision, TriDiff Dynamic Vision Toric, Ultima Smart Toric, Ultima Smart Toric Multifocal, Ultima Natural,

TriPhobic, TriPhobic Toric, Magnificent, Magnificent Toric, Magnificent Panfocal, Magnificent Panfocal Toric, Hyflex-Y Versatile

Наименование изделия Линза интраокулярная		РУ	Схематическое изображение
Hyflex-Y Versatile Preloaded, в составе: -Линза интраокулярная, модель AS-6VP (предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор) -1 уп. - Наклейка пациента - 1 шт. - Наклейки для контроля имплантации- не более 10 шт - Инструкция по использованию - 1 шт. -Коробка -1 шт.			
Модель Ось общий диаметр А-константа Цилиндрическая сила Сила Диаметр оптики	REF LOT  	Штрих-код	
 2460 STERILE EO NON-TOXIC 0°C 45°C        			
 Производитель EYEOL UK LIMITED 8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom. Web: www.eyeol.co.uk Адреса мест производства: 1. EYEOL UK LIMITED ,8 Apex Business Centre, Boscombe Road, Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom. 2. Caregroup Sight Solution Private Limited, Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India. Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО "КОМ СПАН" Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2. Тел./ факс: (495) 434 45 06			

Макет маркировки потребительской упаковки.
Линза интраокулярная Hyflex-Y Versatile Preloaded.

Макет маркировки наклейки пациента.

Данные пациента _____

(фамилия, имя)

- модель _____

- дата имплантации _____

- Какой глаз имплантировали () правый

() левый

общий диаметр / диаметр оптики / диоптрийность / цилиндрическая сила

Макет маркировки наклейки врача.

-модель, общий диаметр, диаметр оптики, диоптрийность,

цилиндрическая сила (для торических линз)

-штрих-код

Макет маркировки наклейки контейнера с линзой

-модель, общий диаметр, диаметр оптики, диоптрийность

-штрих-код

Наименование изделия, вариант исполнения



Производитель

EYEOL UK LIMITED,

**8 Apex Business Centre, Boscombe Road,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 4SB, United Kingdom.**

Web: www.eyeol.co.uk

XX шт

брутто XX кг/нетто XX кг

ШТРИХ-КОД



Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО "КОМ СПАН"

**Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3,
эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2.**

Тел./ факс: (495) 434 45 06

Макет маркировки транспортной упаковки

Всё прочитано и скреплено печатью

82 (расширено)

Телефонно

Росс. С. К.

