

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Инфомед»

О.Н. Вязьмин

«28» декабря 2023 г.



Фотографии медицинского изделия:

«Система мониторинга импеданс-рН рефлюксов alрHaFLEX, модель JSIpS-1»

производства «Чунцин Жиньшан Сайнс энд Технолоджи (Груп), Ко., Лтд»,
Китай /"Chongqing Jinshan Science & Technology (Group) Co., Ltd"

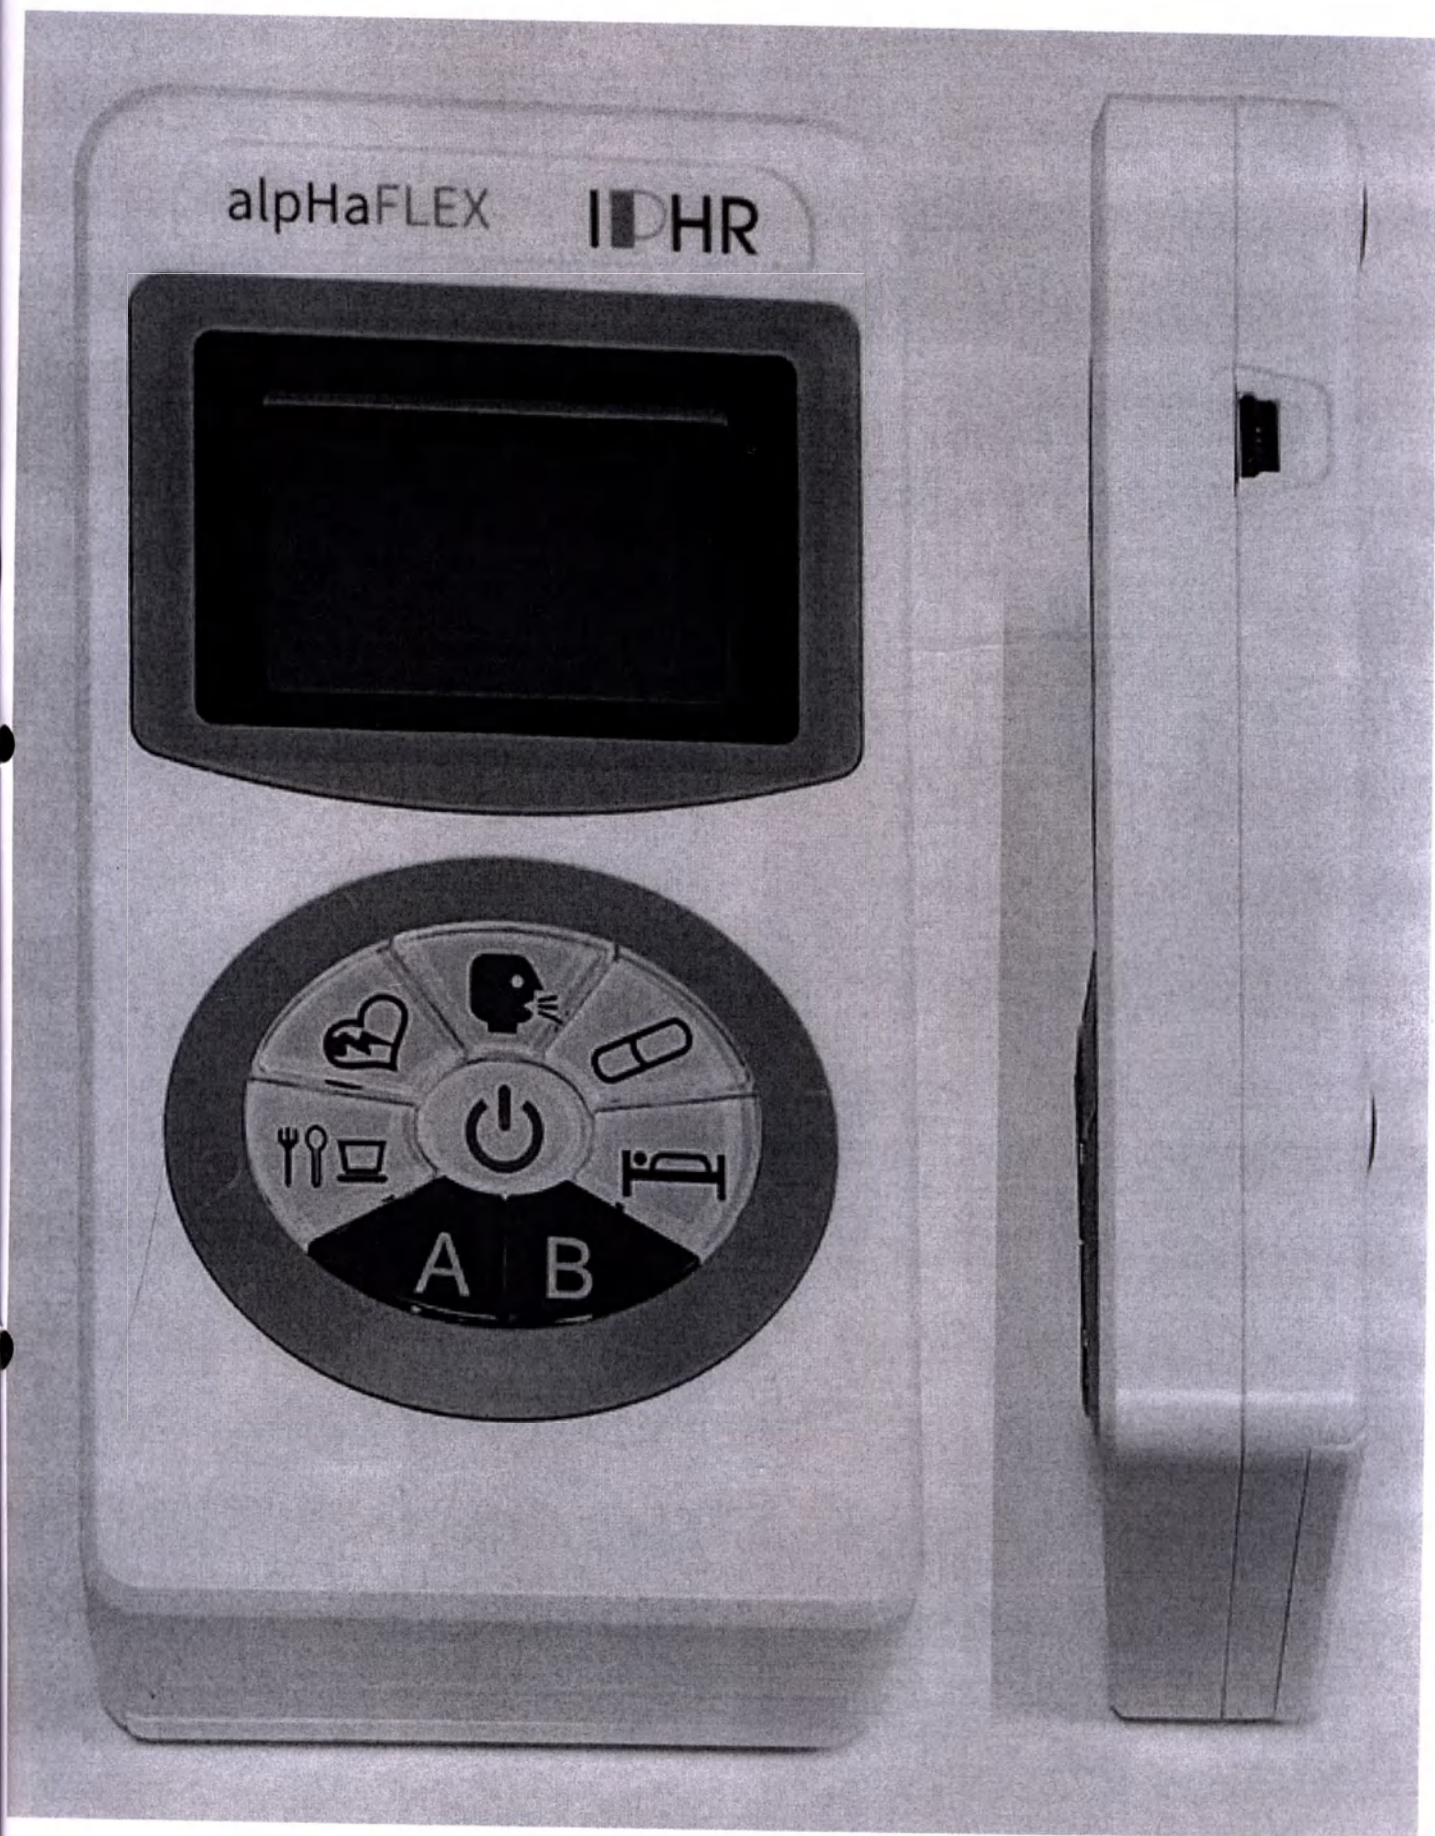


Фото 1. Рекордер импеданс-рН, модель JSIpR-1 (вид спереди и сбоку).

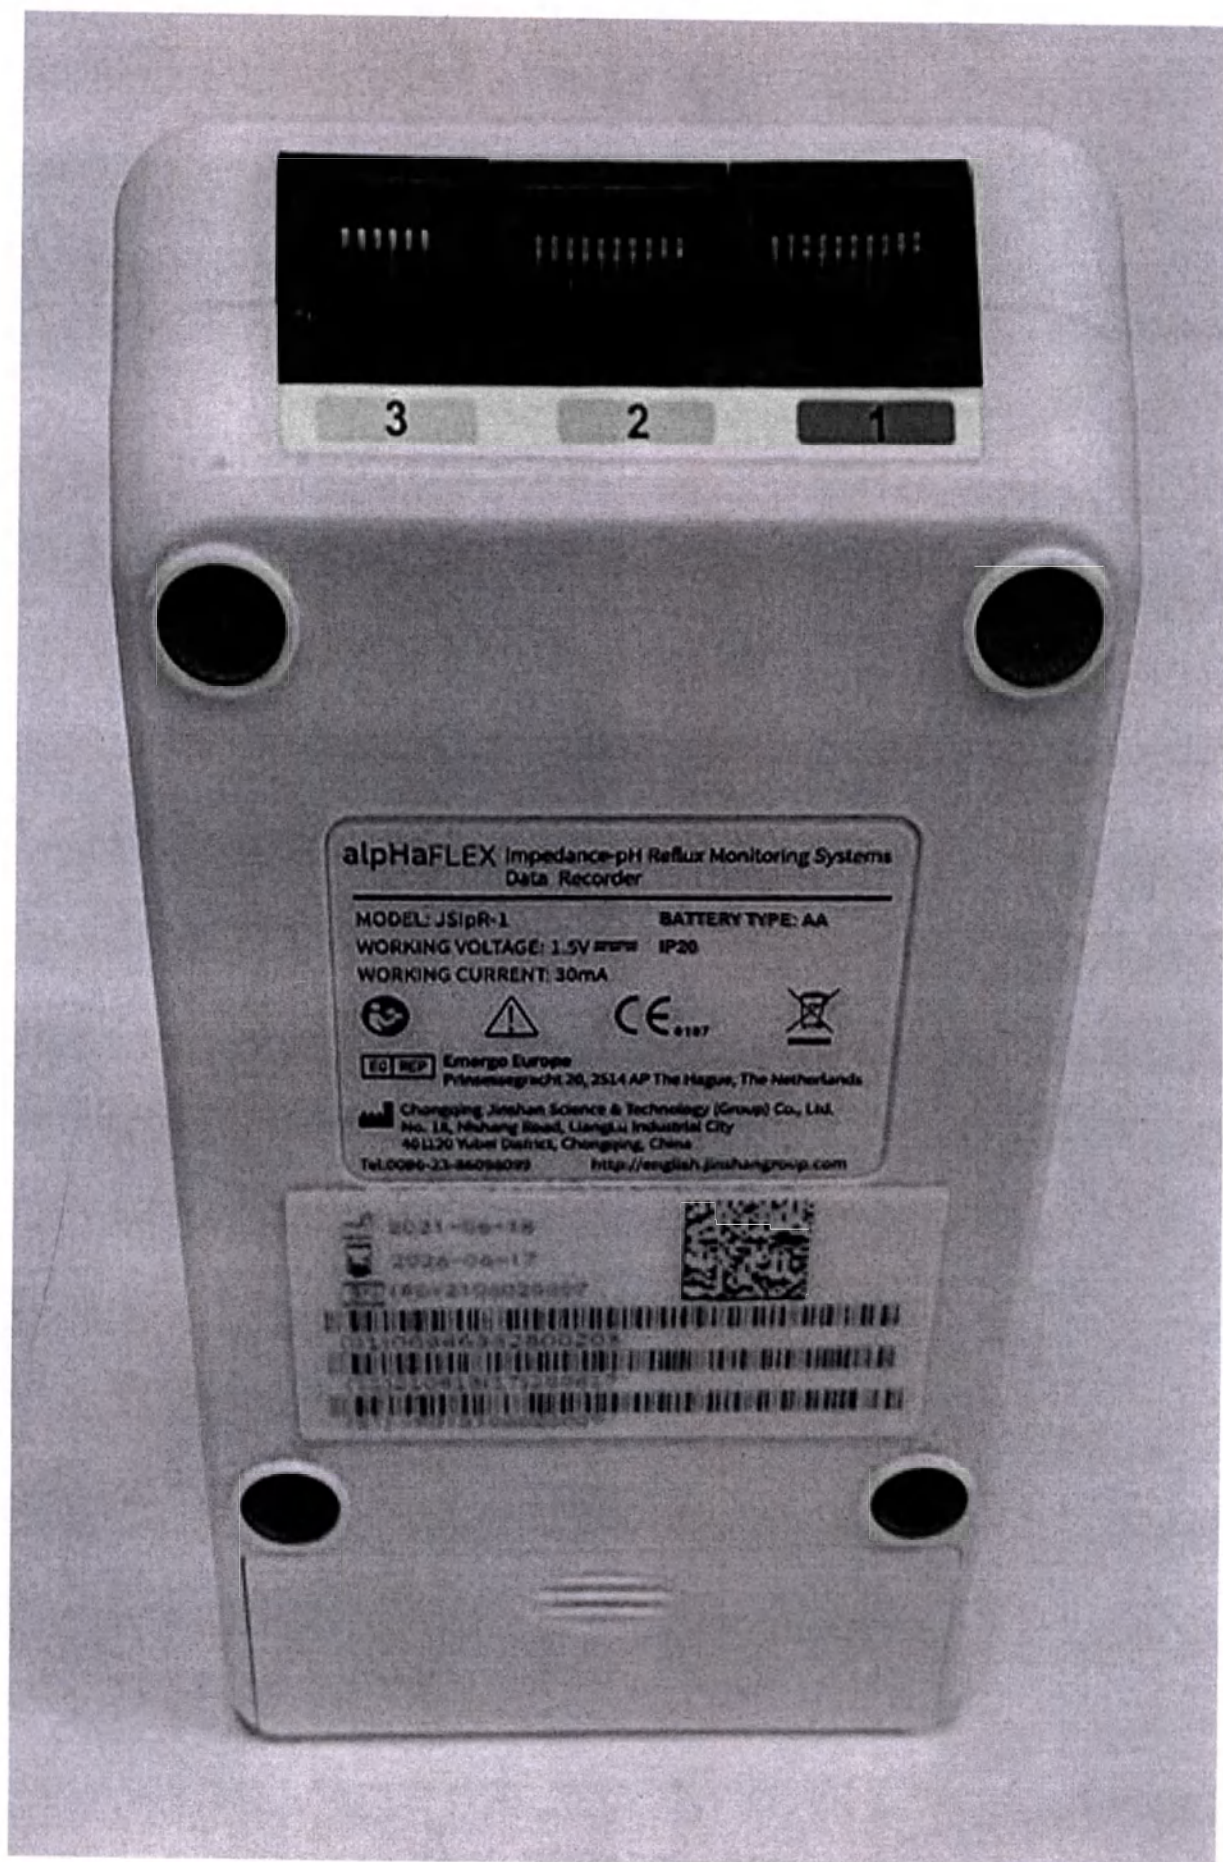


Фото 2. Рекордер импеданс-рН, модель JSipR-1 (вид сзади).

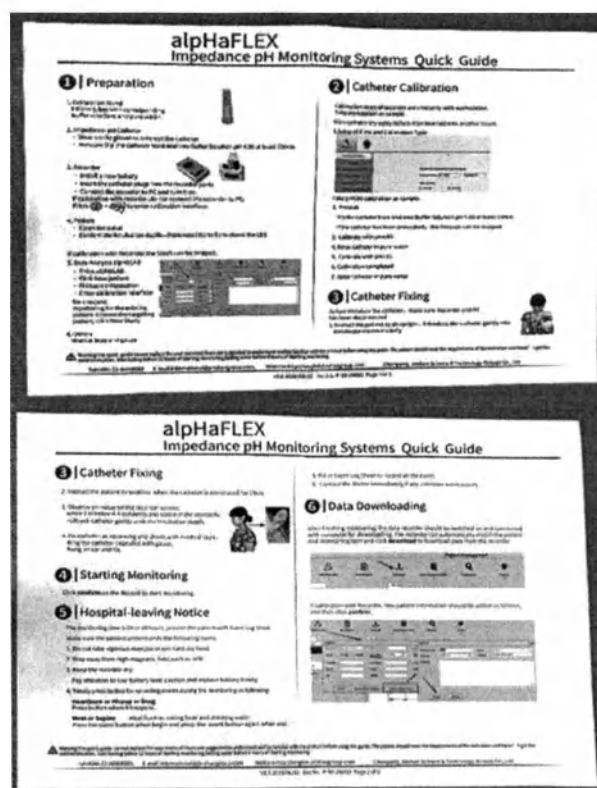
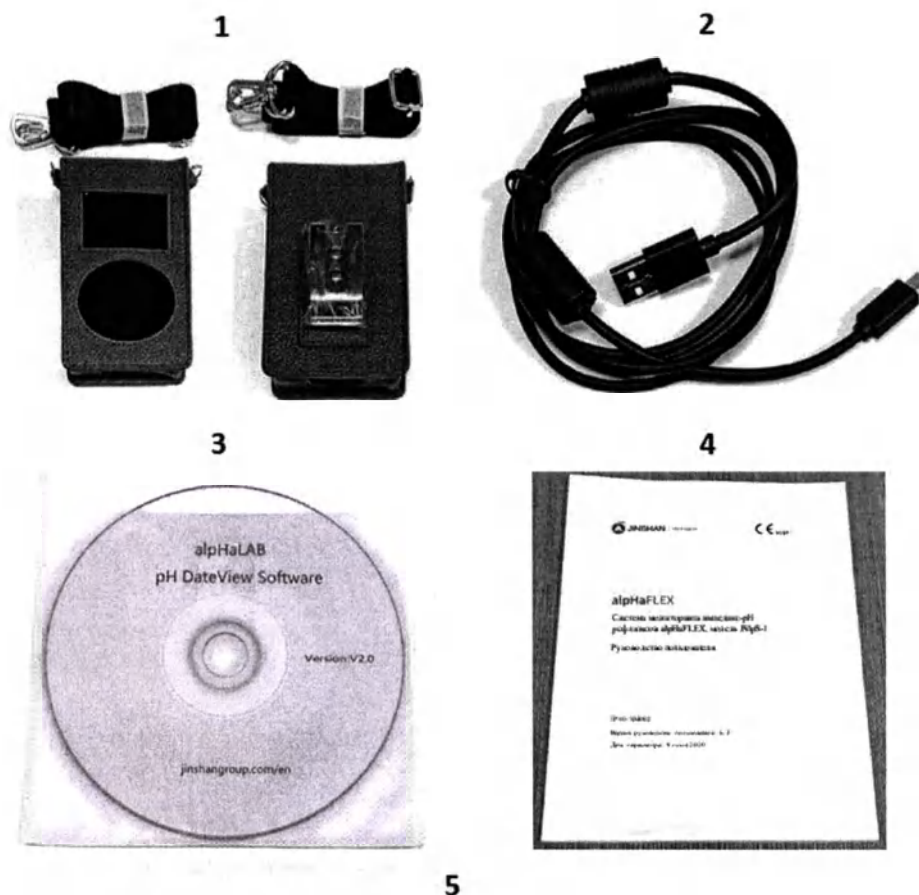


Фото 3. Компоненты медицинского изделия, часть 1.

1 – чехол с плечевым ремнём; 2 – USB-кабель для подключения тип A- miniUSB; 3 – установочный диск программного обеспечения; 4 – руководство пользователя; 5 – руководство по быстрому запуску.

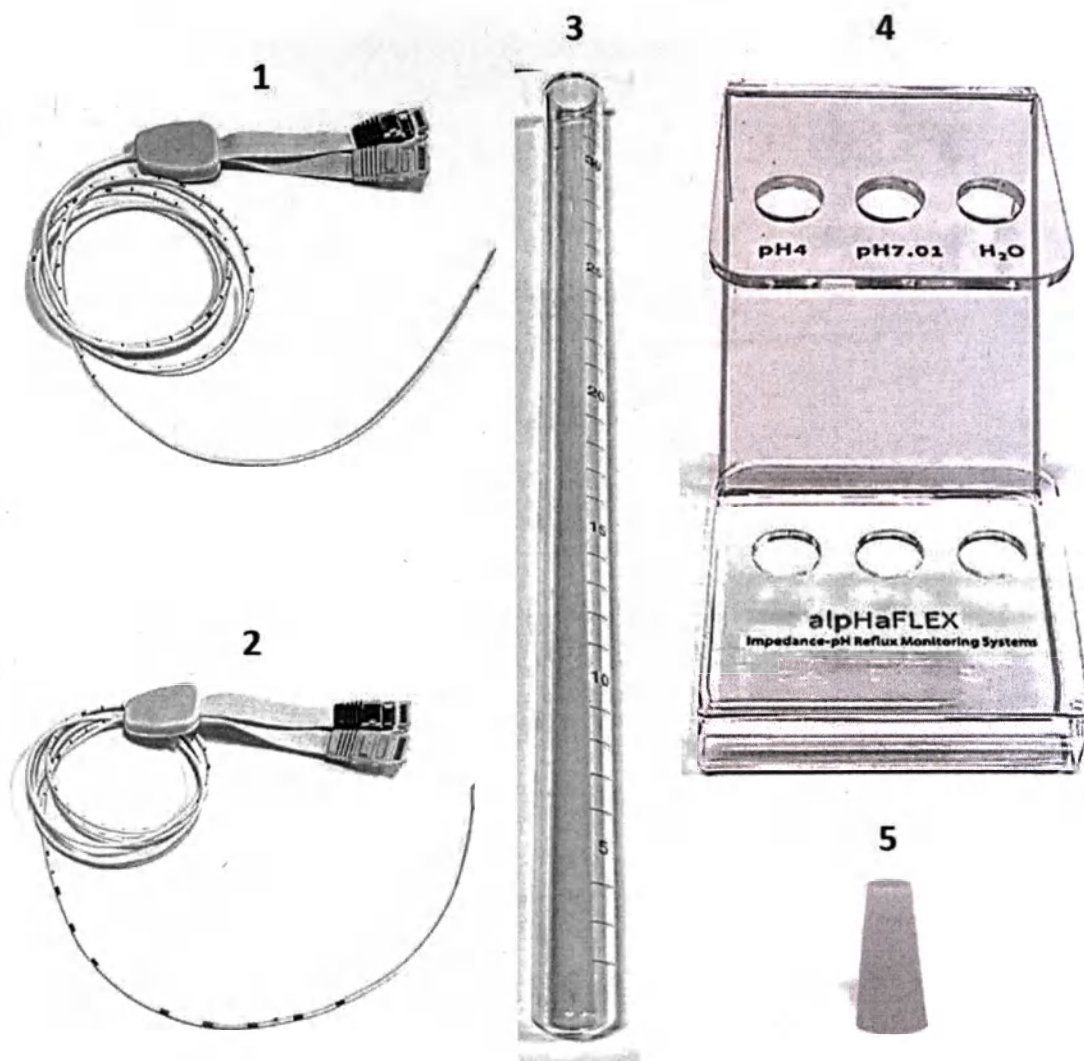


Фото 4. Компоненты медицинского изделия, часть 2.

1 – Одноразовые pH катетеры, модели: JSIpC-0Z2P-21, JSIpC-0Z2P-22, JSIpC-0Z2P-27, JSIpC-0Z2P-24, JSIpC-0Z2P-23, JSIpC-0Z1PT-20, JSIpC-0Z2PT-22, JSIpC-0Z2PT-27; 2 - Одноразовые импеданс-pH катетеры, модели: JSIpC-8Z2P-55, JSIpC-8Z2P-21, JSIpC-7Z2P-59, JSIpC-7Z2P-15, JSIpC-7Z1P-54, JSIpC-7Z1P-13, JSIpC-7Z1P-53, JSIpC-7Z1P-14, JSIpC-8Z1P-21, JSIpC-8Z2P-22, JSIpC-8Z2P-23, JSIpC-8Z2P-25; 3 – калибровочные трубки для alphaHaFLEX; 4 - консоль калибровки pH для alphaHaFLEX; 5 – заглушки для трубок.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись В.А. Дерюгин

« 28 » сентября 20 23 г. М. П.

