

Руководитель группы
ООО «Сименс Здравоохранение»



Левитский И.И.
» ноября 2023

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Система ангиографическая Artis one с принадлежностями



Система ангиографическая Artis one с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Китай

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3/N/PE~ 380/400/420/440/460/480 В

50/60 Гц

8 кВА

Базовый состав.

1. Напольный штатив с С-образной дугой




2. Блок рентгеновской трубки с первичным коллиматором.



3. Плоский детектор.



4. Генератор.

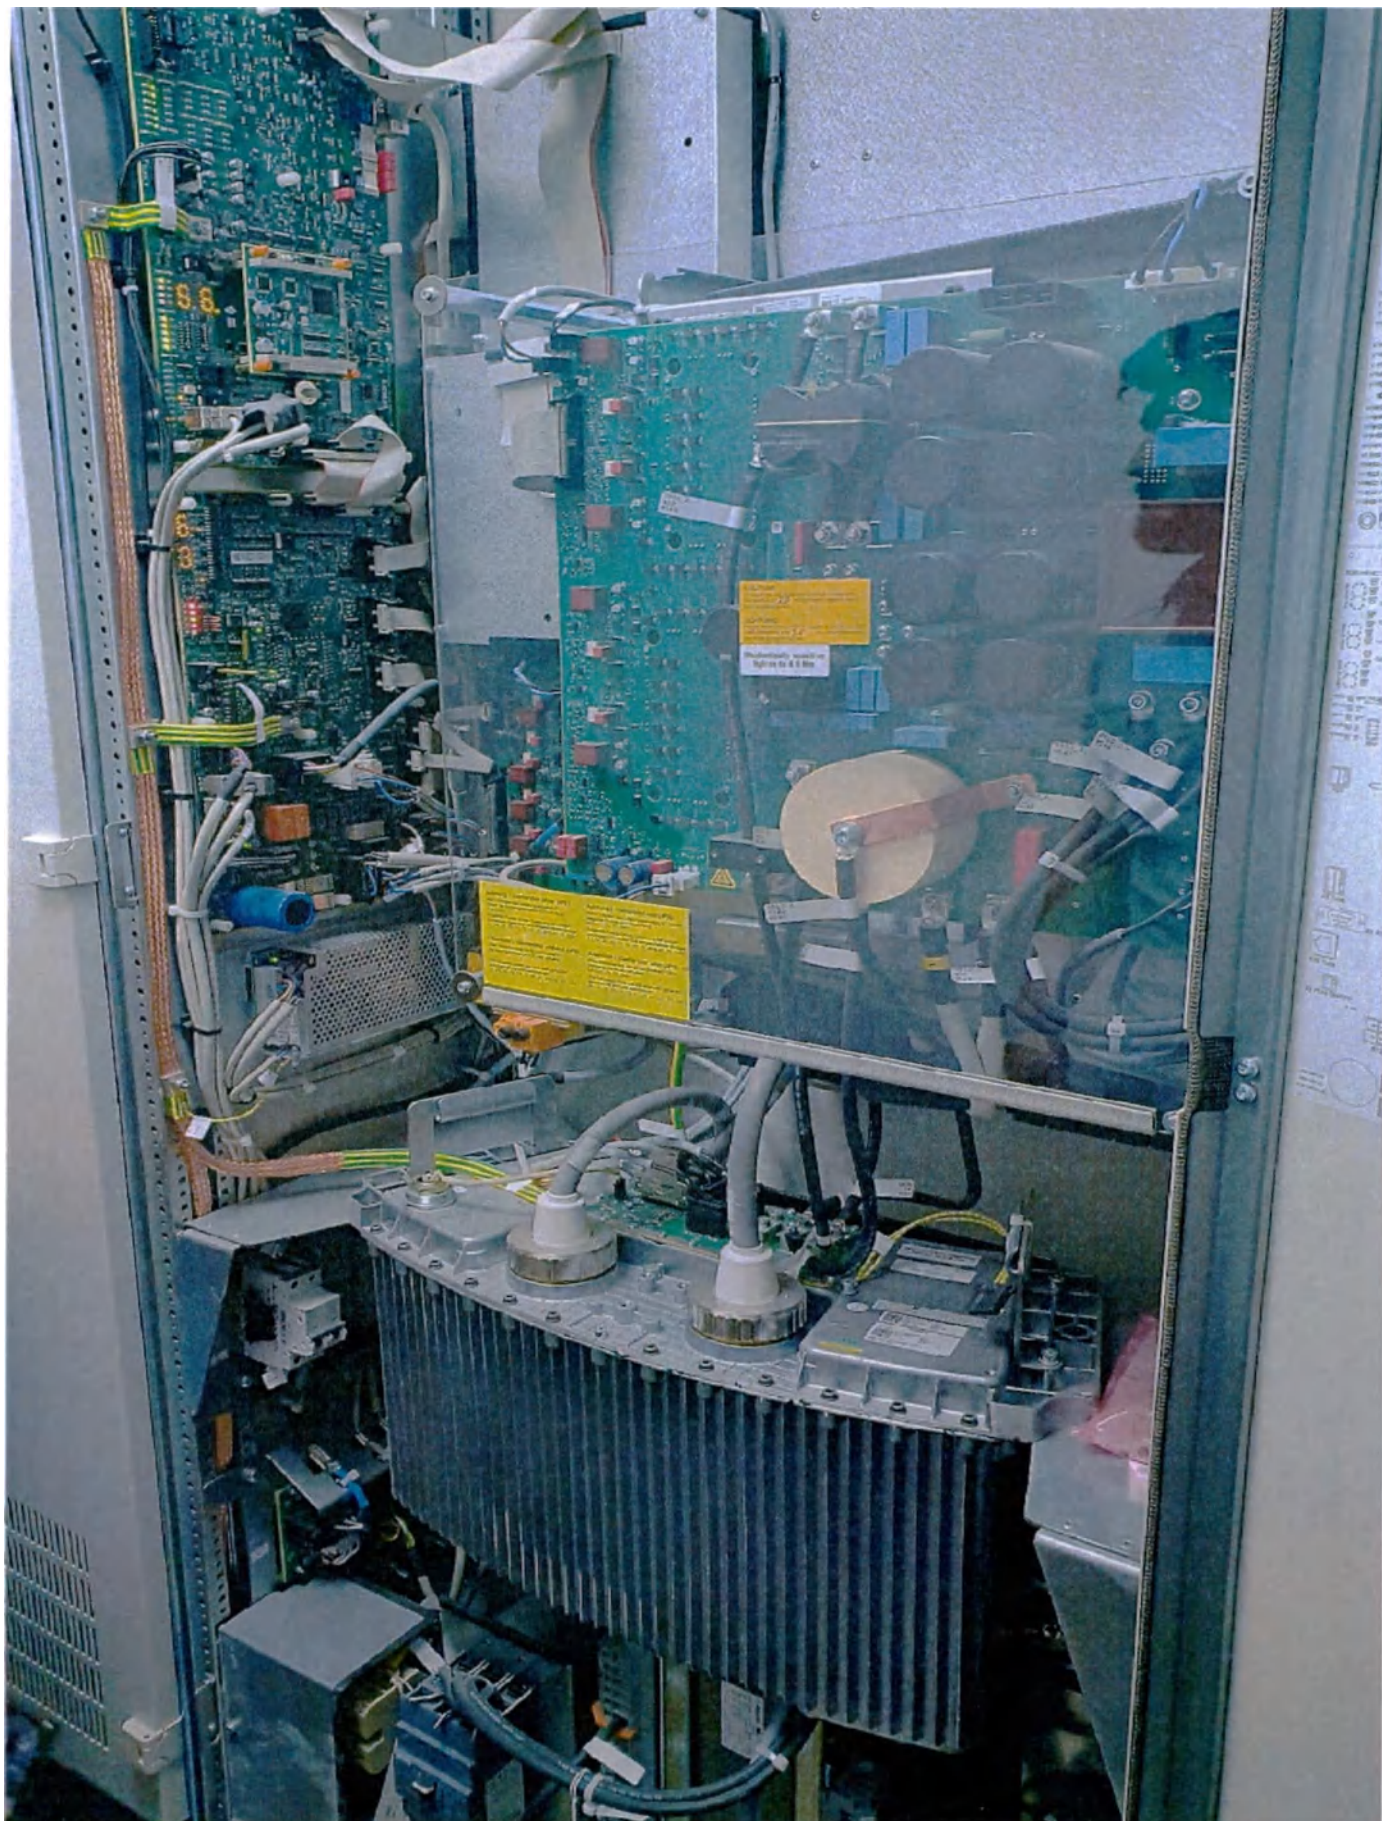

5. Стол пациента.




6. Матрас для стола пациента.




7. Чехол для матраса.



8. Подвеска потолочная для мониторов с монитором диагональю 30 дюймов;

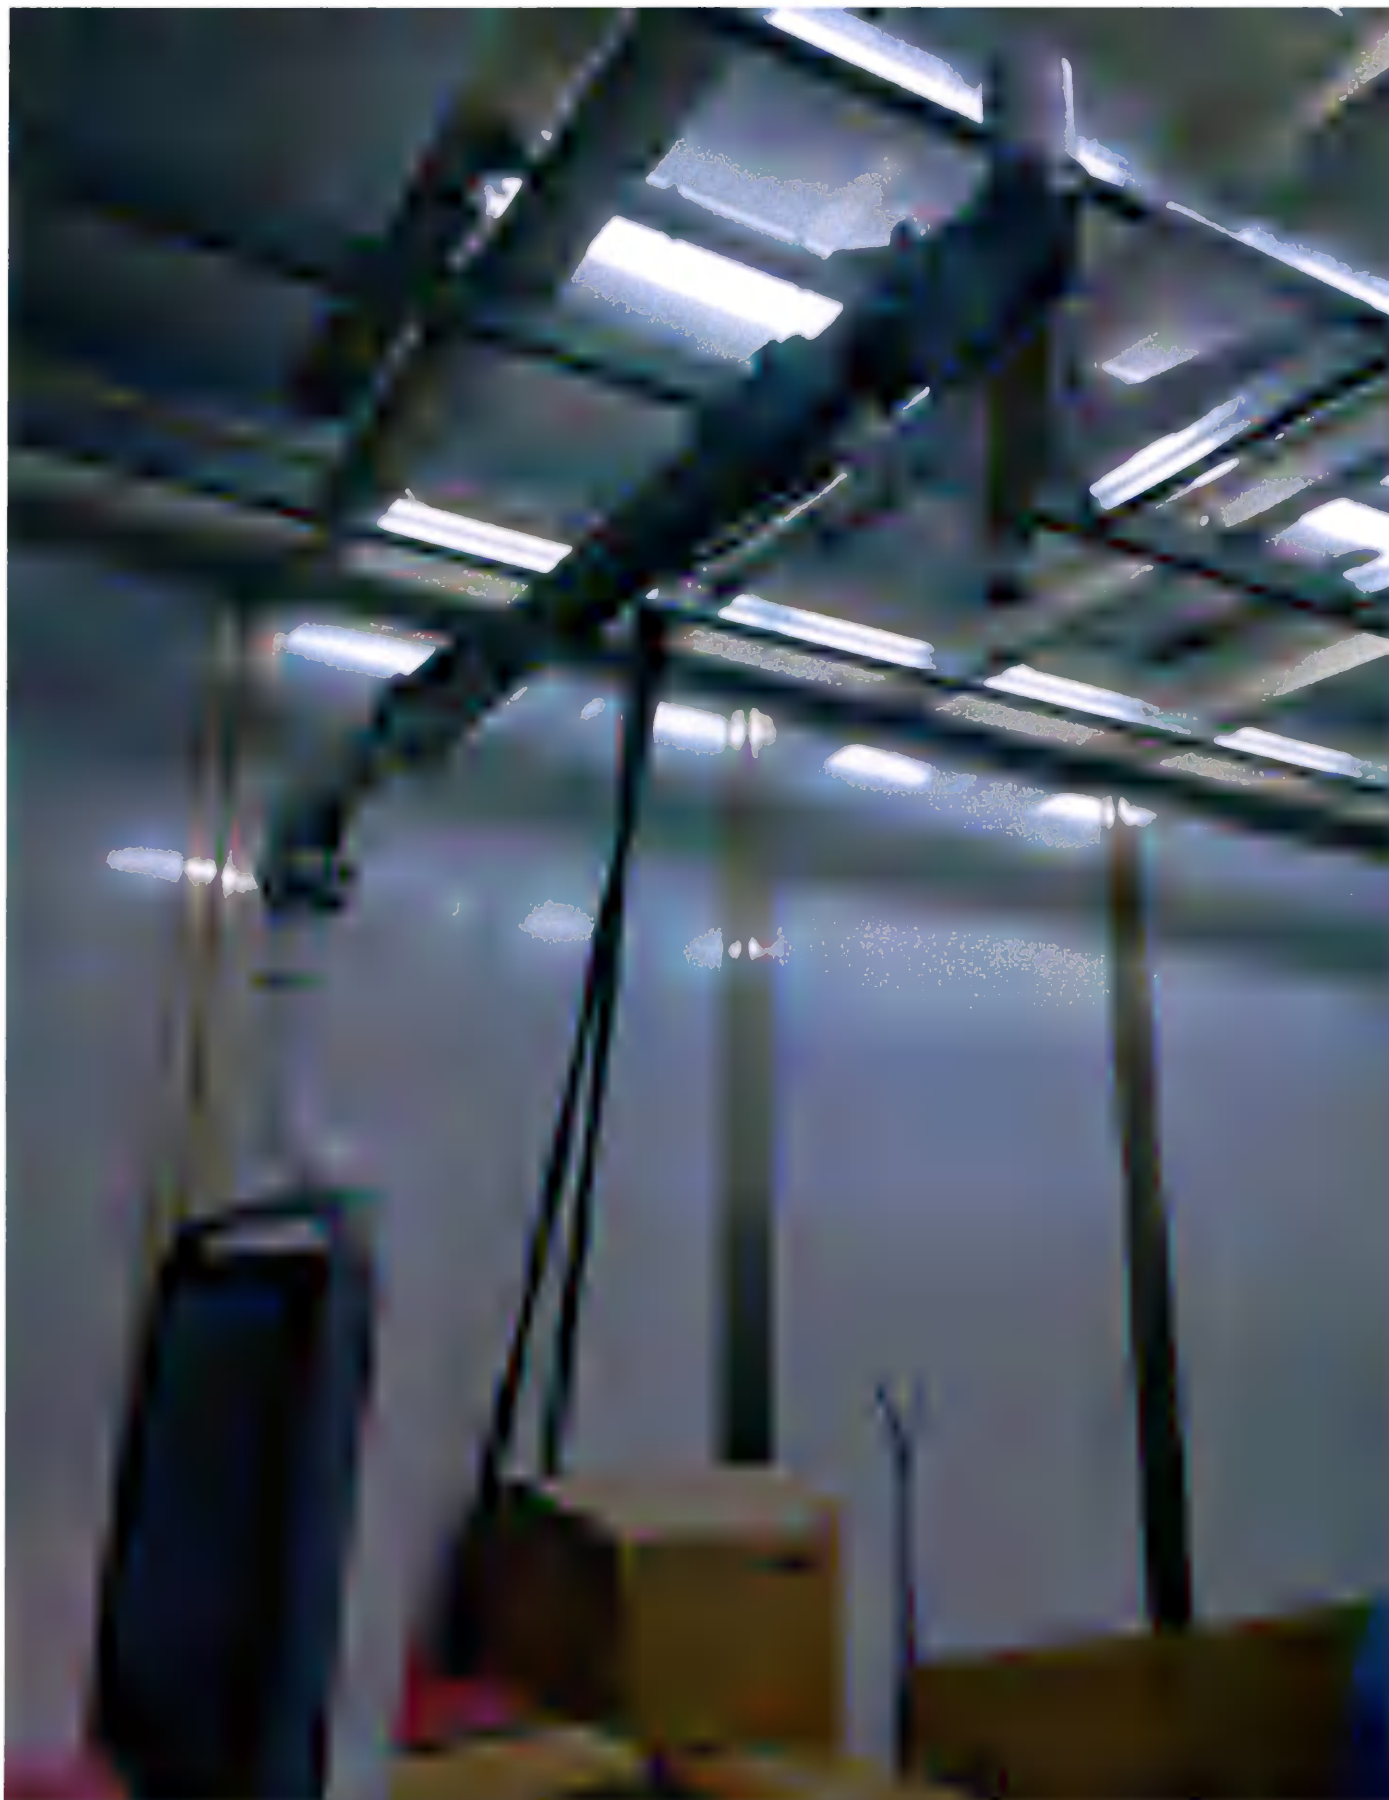

Подвеска потолочная для мониторов с монитором диагональю 55 дюймов.

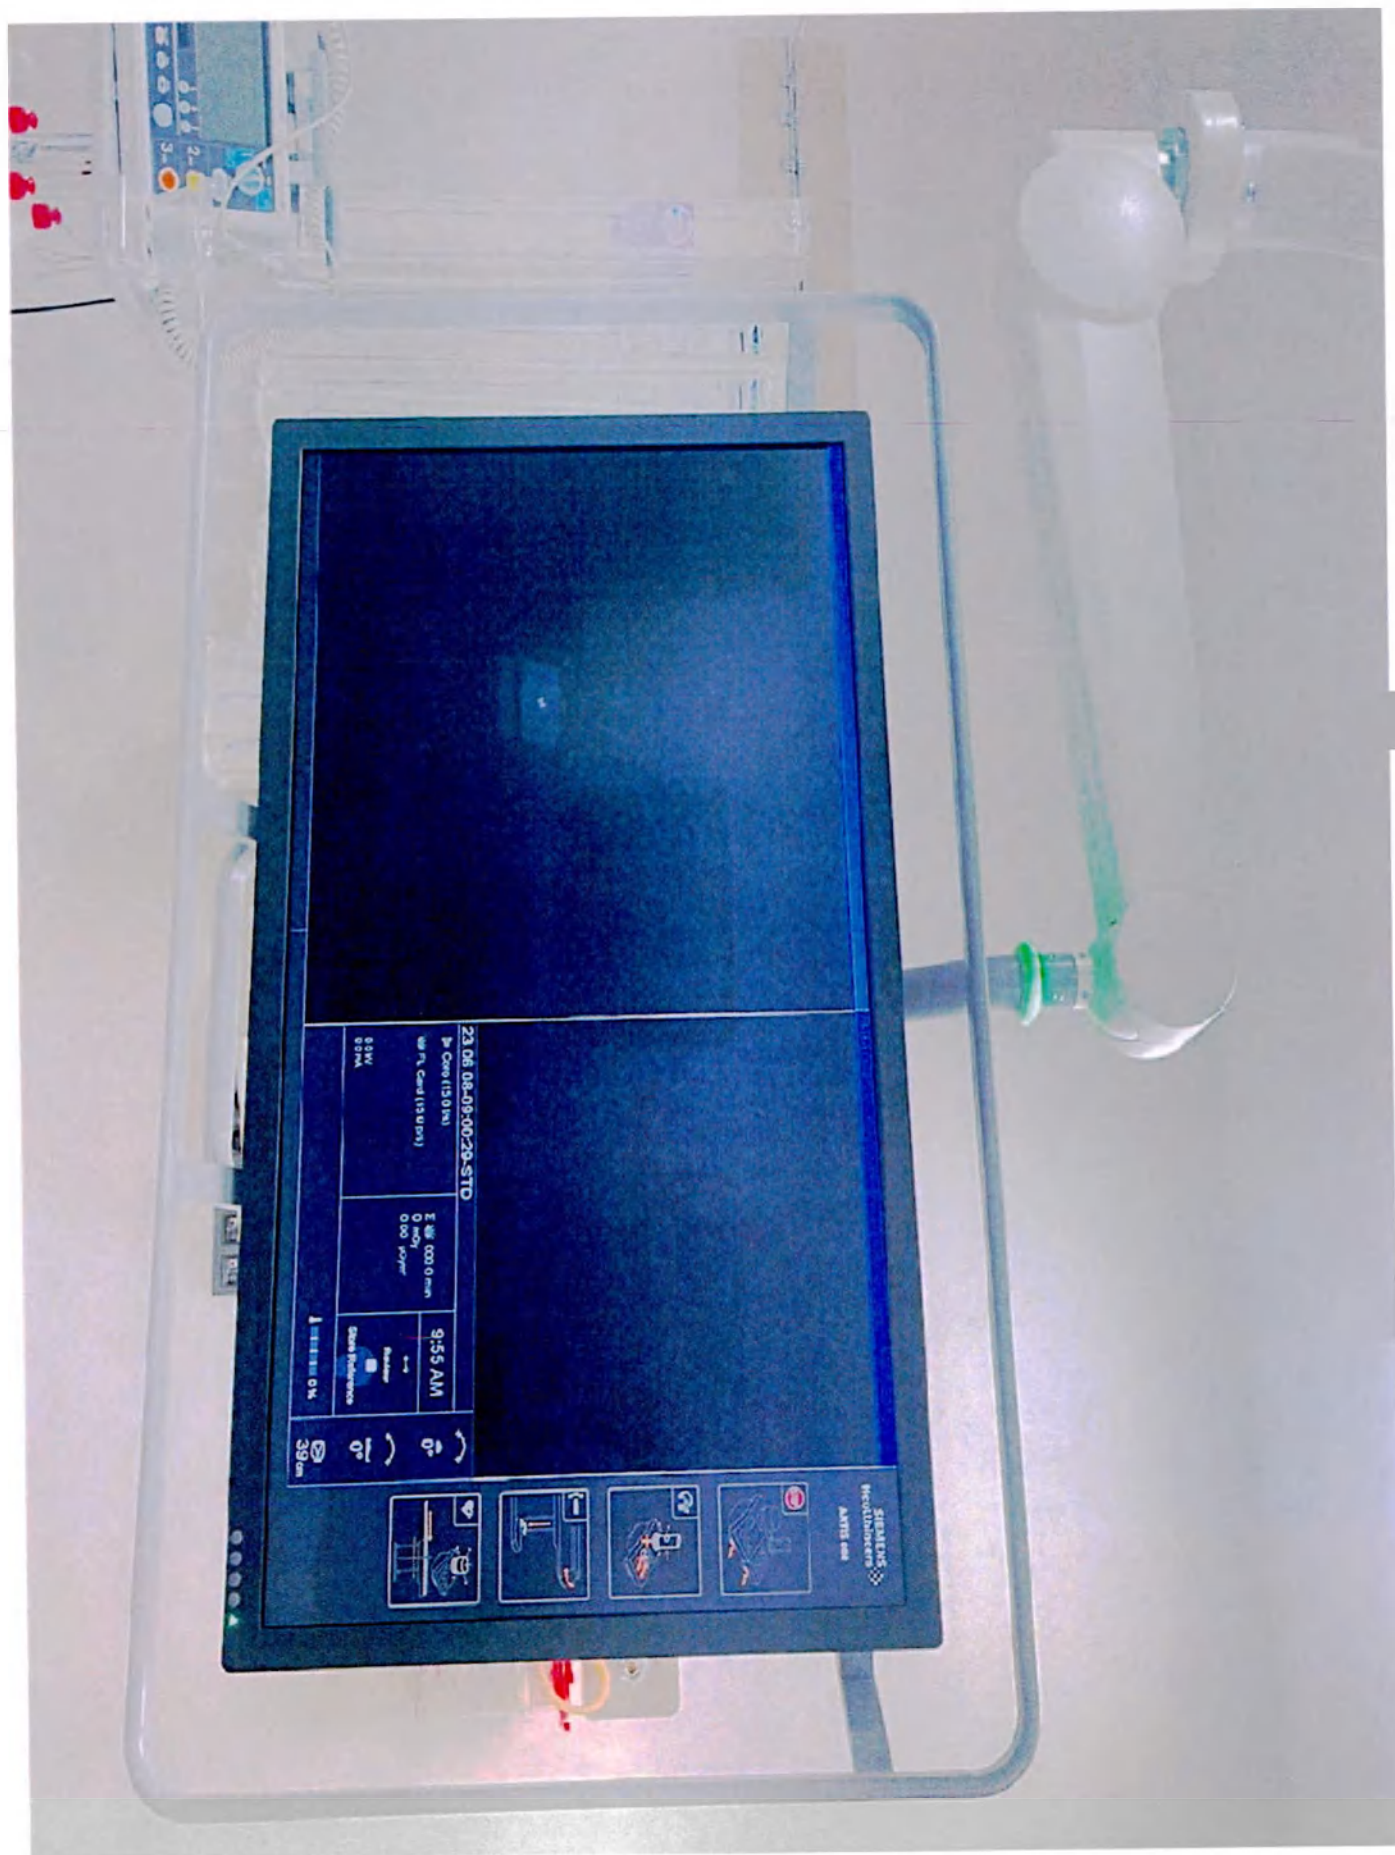

9. Педальный переключатель для включения излучения беспроводной в составе с зарядным устройством



Педальный переключатель для включения излучения проводной.





11. Блок системы формирования изображений:- компьютер (системный блок), с дисководом CD/DVD;
Блок системы формирования изображений: базовое программное обеспечение.





14.05.14 11:04:28 STD
14.05.14 11:04:28 STD-82018
* 1/1/1900
5/14/2014
11:06:25 AM
1 - 1/17

H

Hospital
FAS
VA100 140228
VPS
2008

14.05.14 11:04:28 STD

info

status

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

14.05.14 11:04:28 STD

Dynamic range filter

14.05.14

11:04:28

14.05.14

11:04:28

14.05.14

11:04:28

14.05.14

11:04:28

14.05.14

11:04:28


14.05.14

11:04:28

14.05.14

11:04:28

12. ЖК-монитор в пультной.

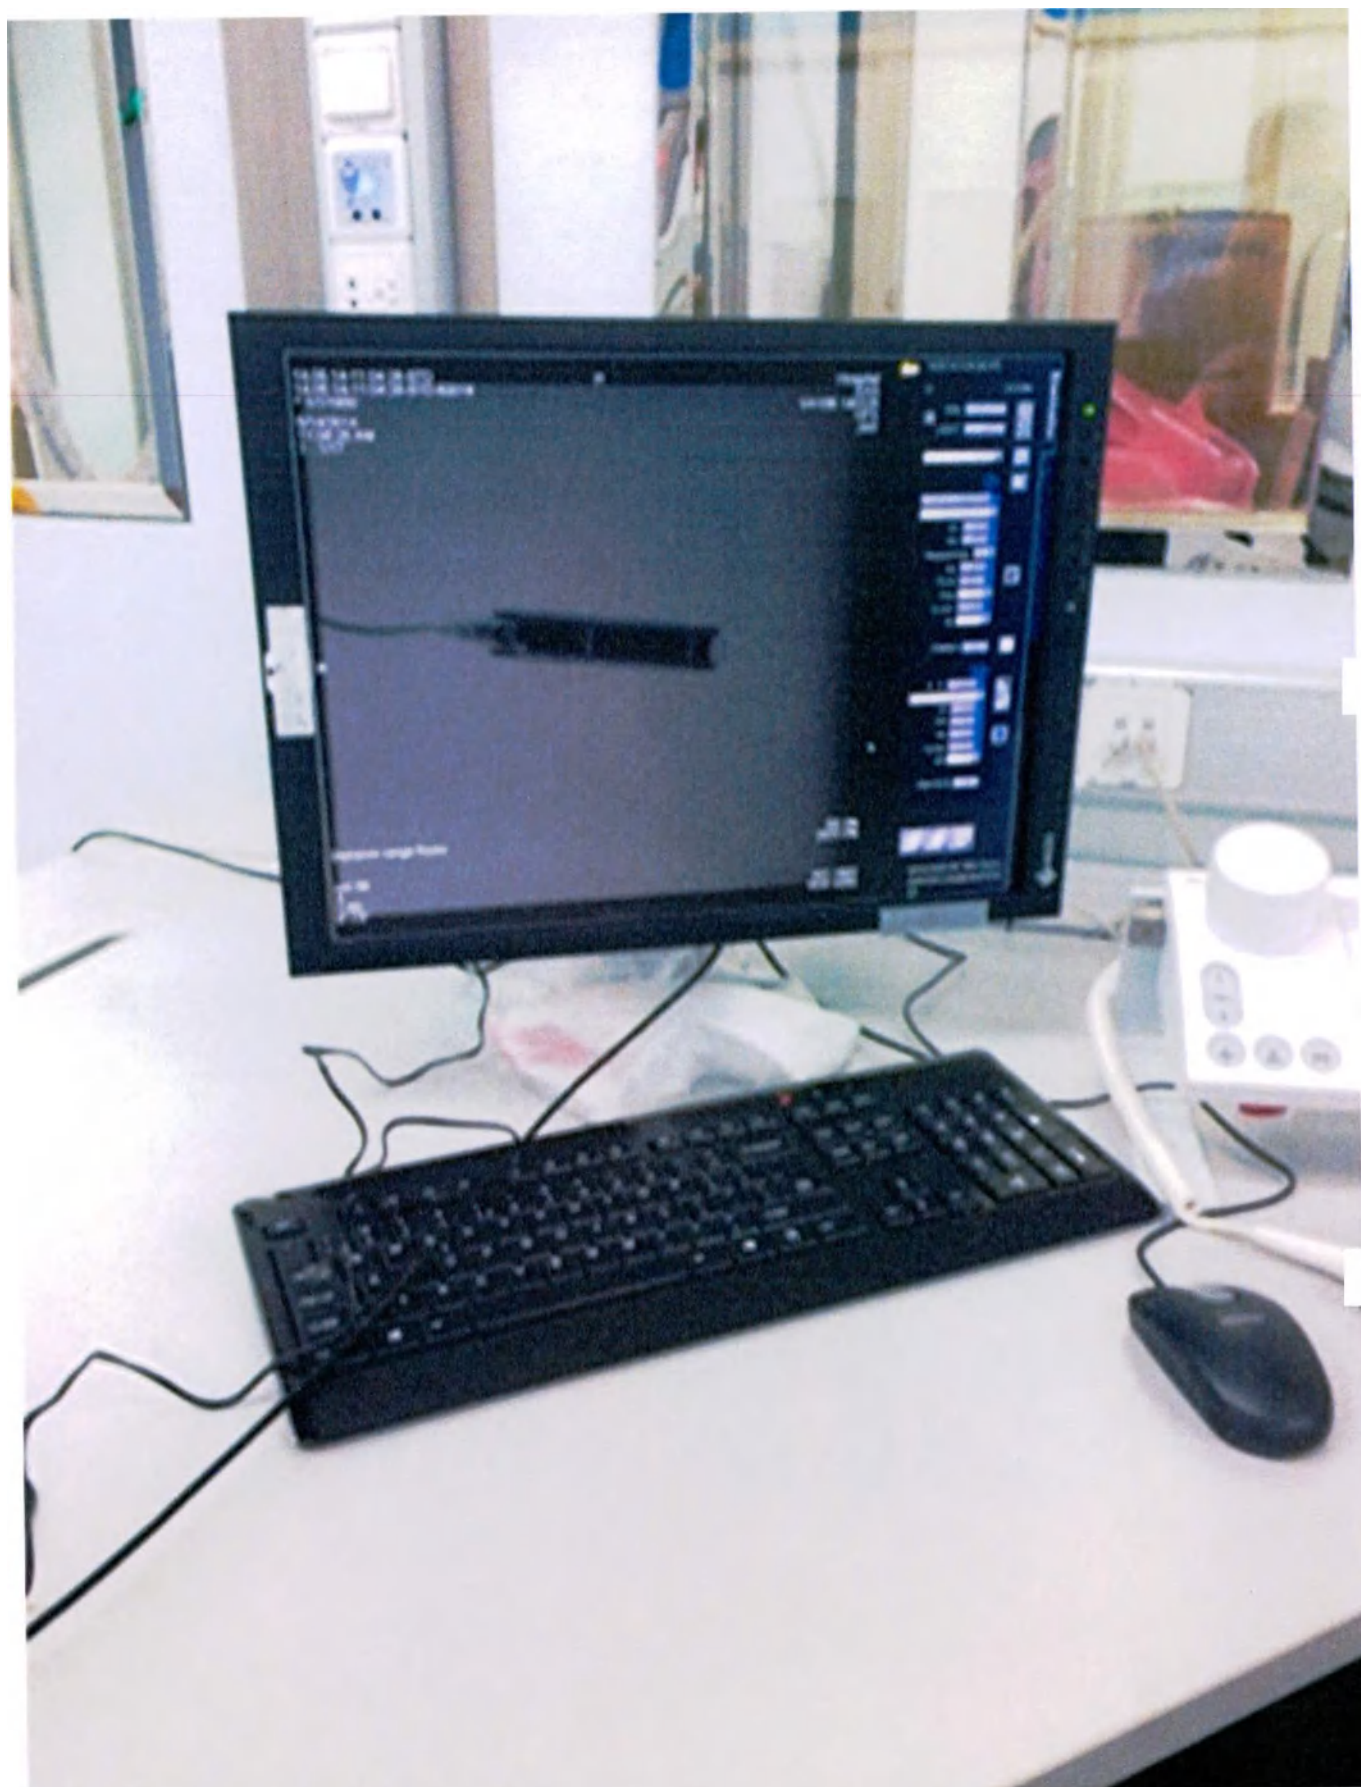

13. Клавиатура.






15. Переключатель ручной.



16. Дозиметр KermaX-plus 120-160 EAS.

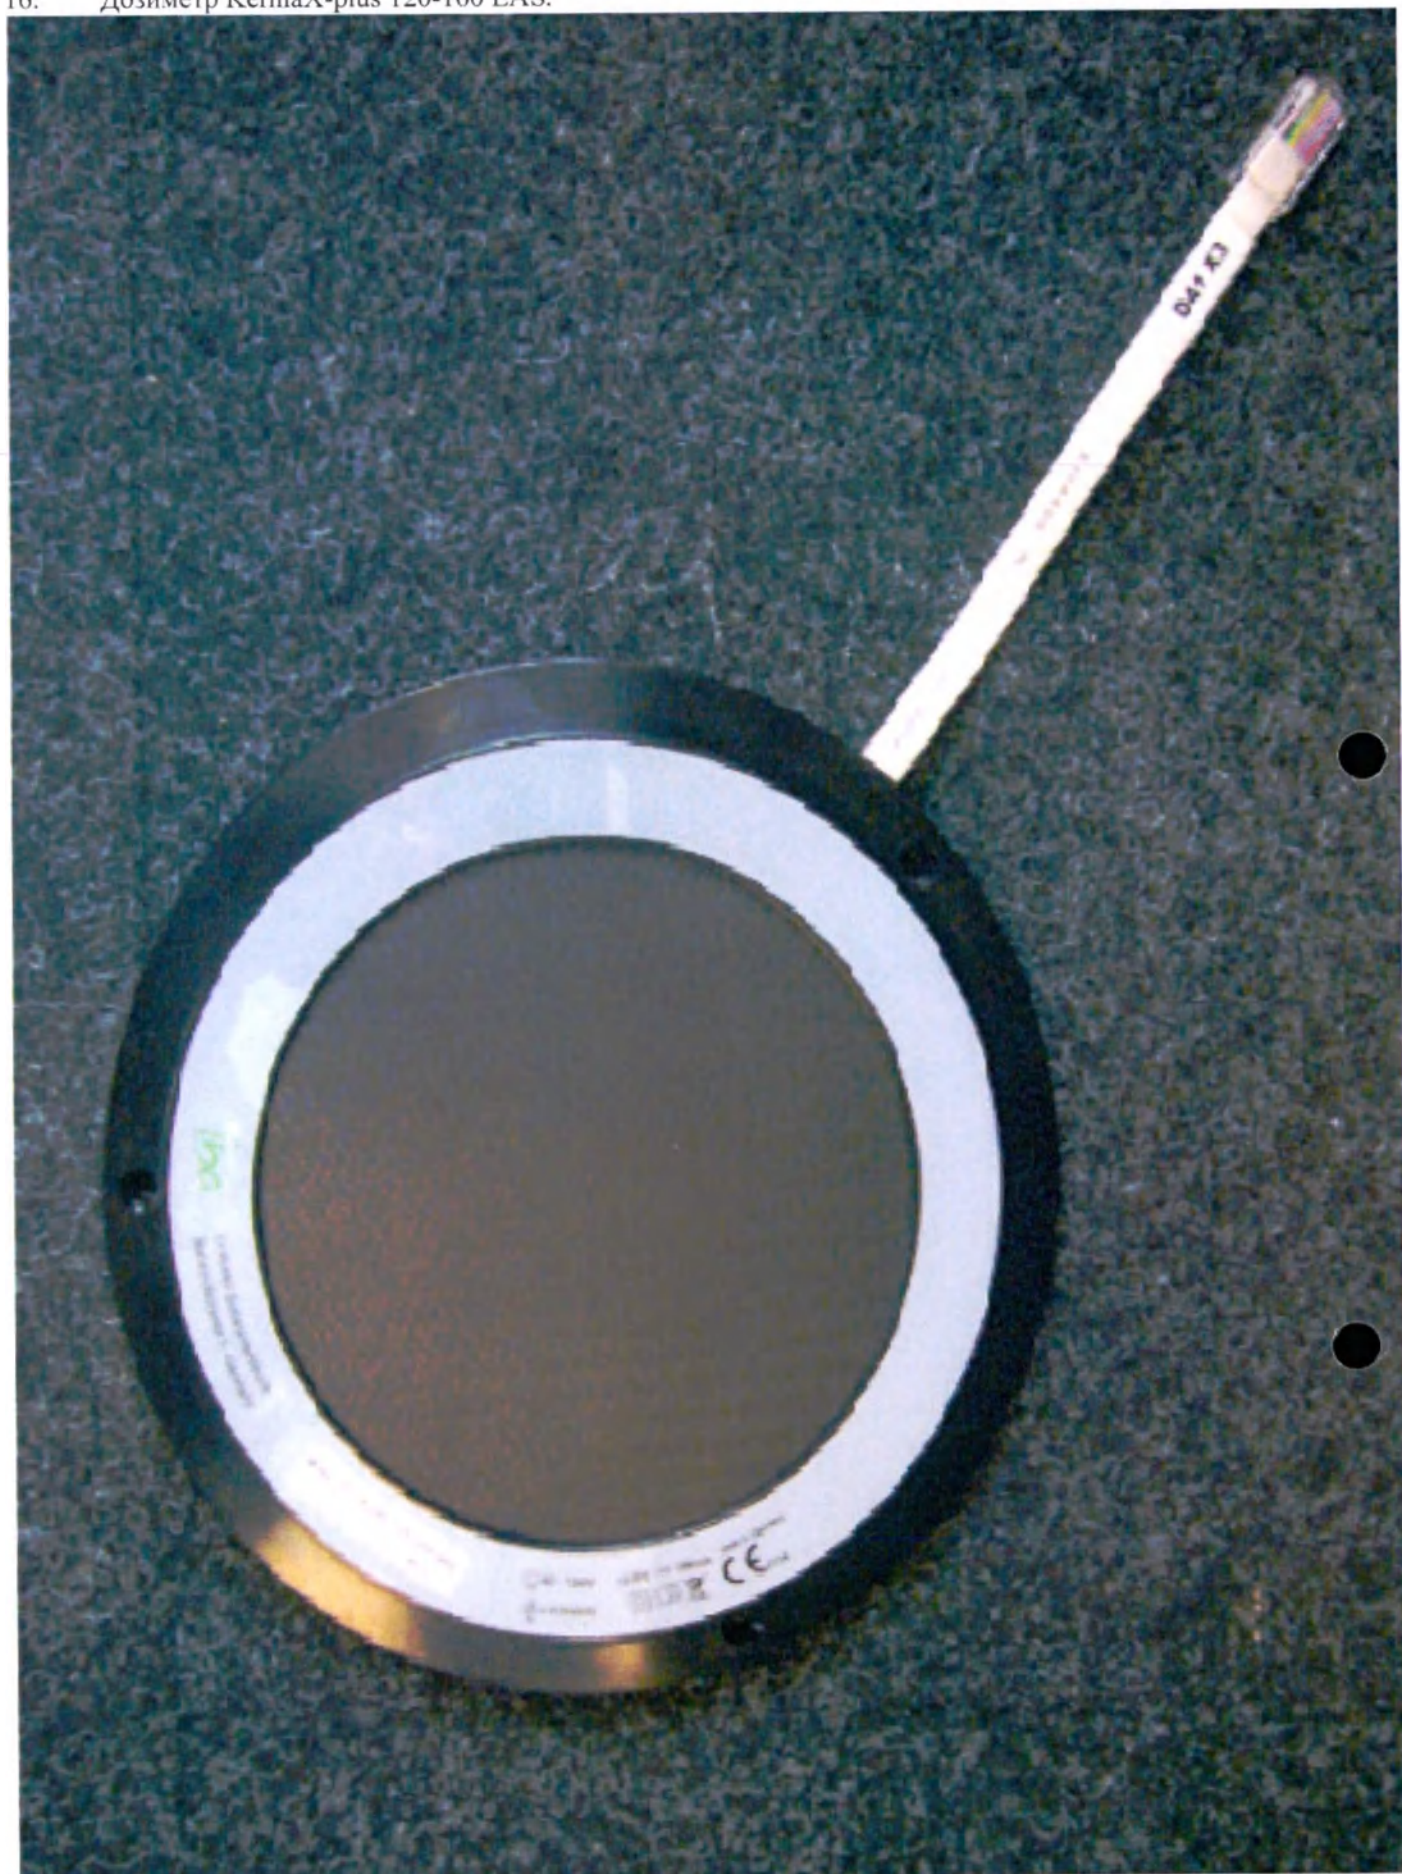



KermaX® plus 120-160 EAS

Руководство пользователя оборудования



ARTIS one


Руководство пользователя
VA1

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

Принадлежности:


1. Программный режим Цифровая ангиография.

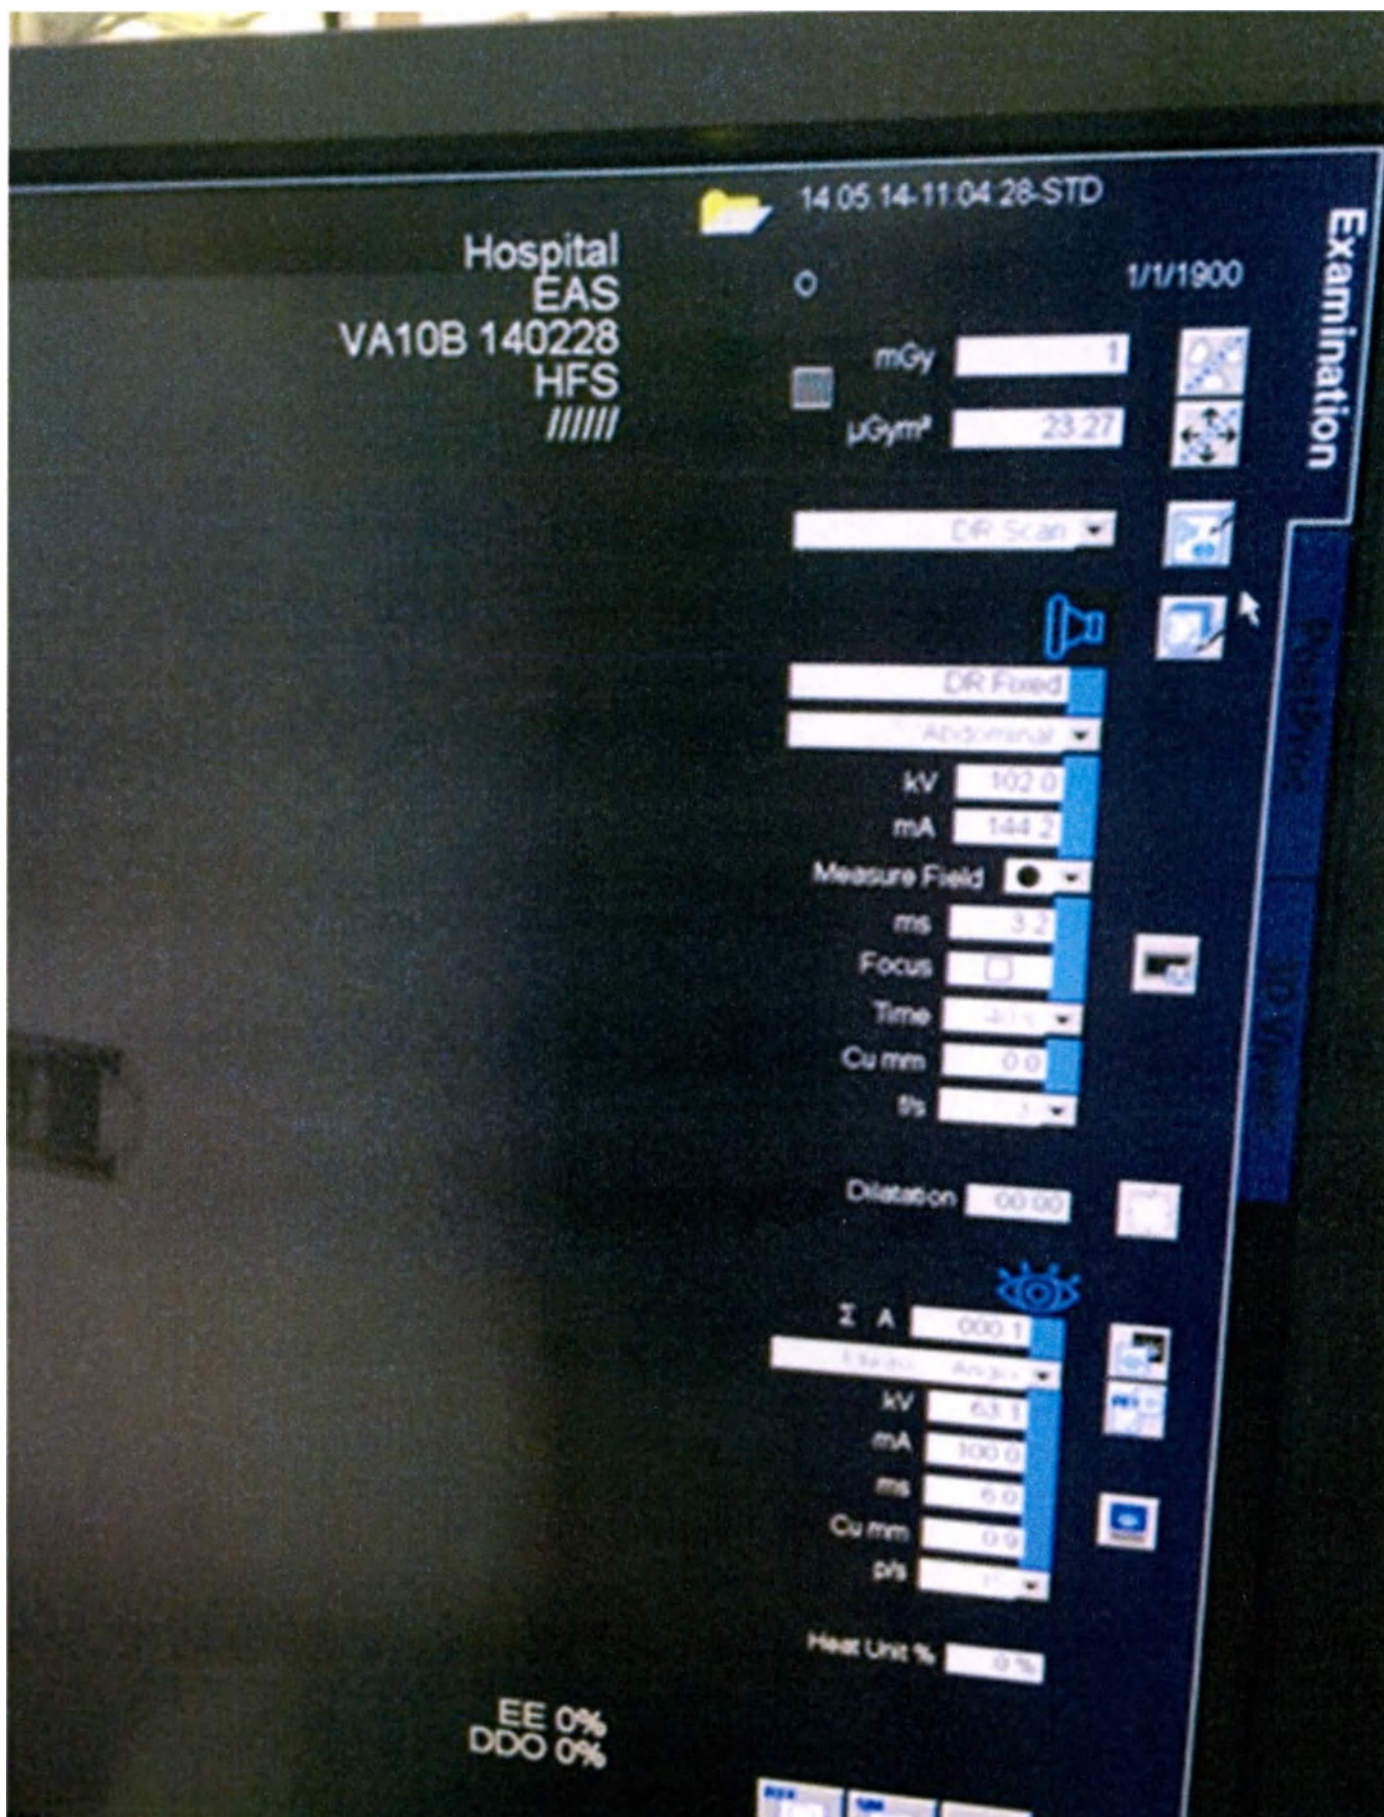

2. Программный режим Ангиокардиография.

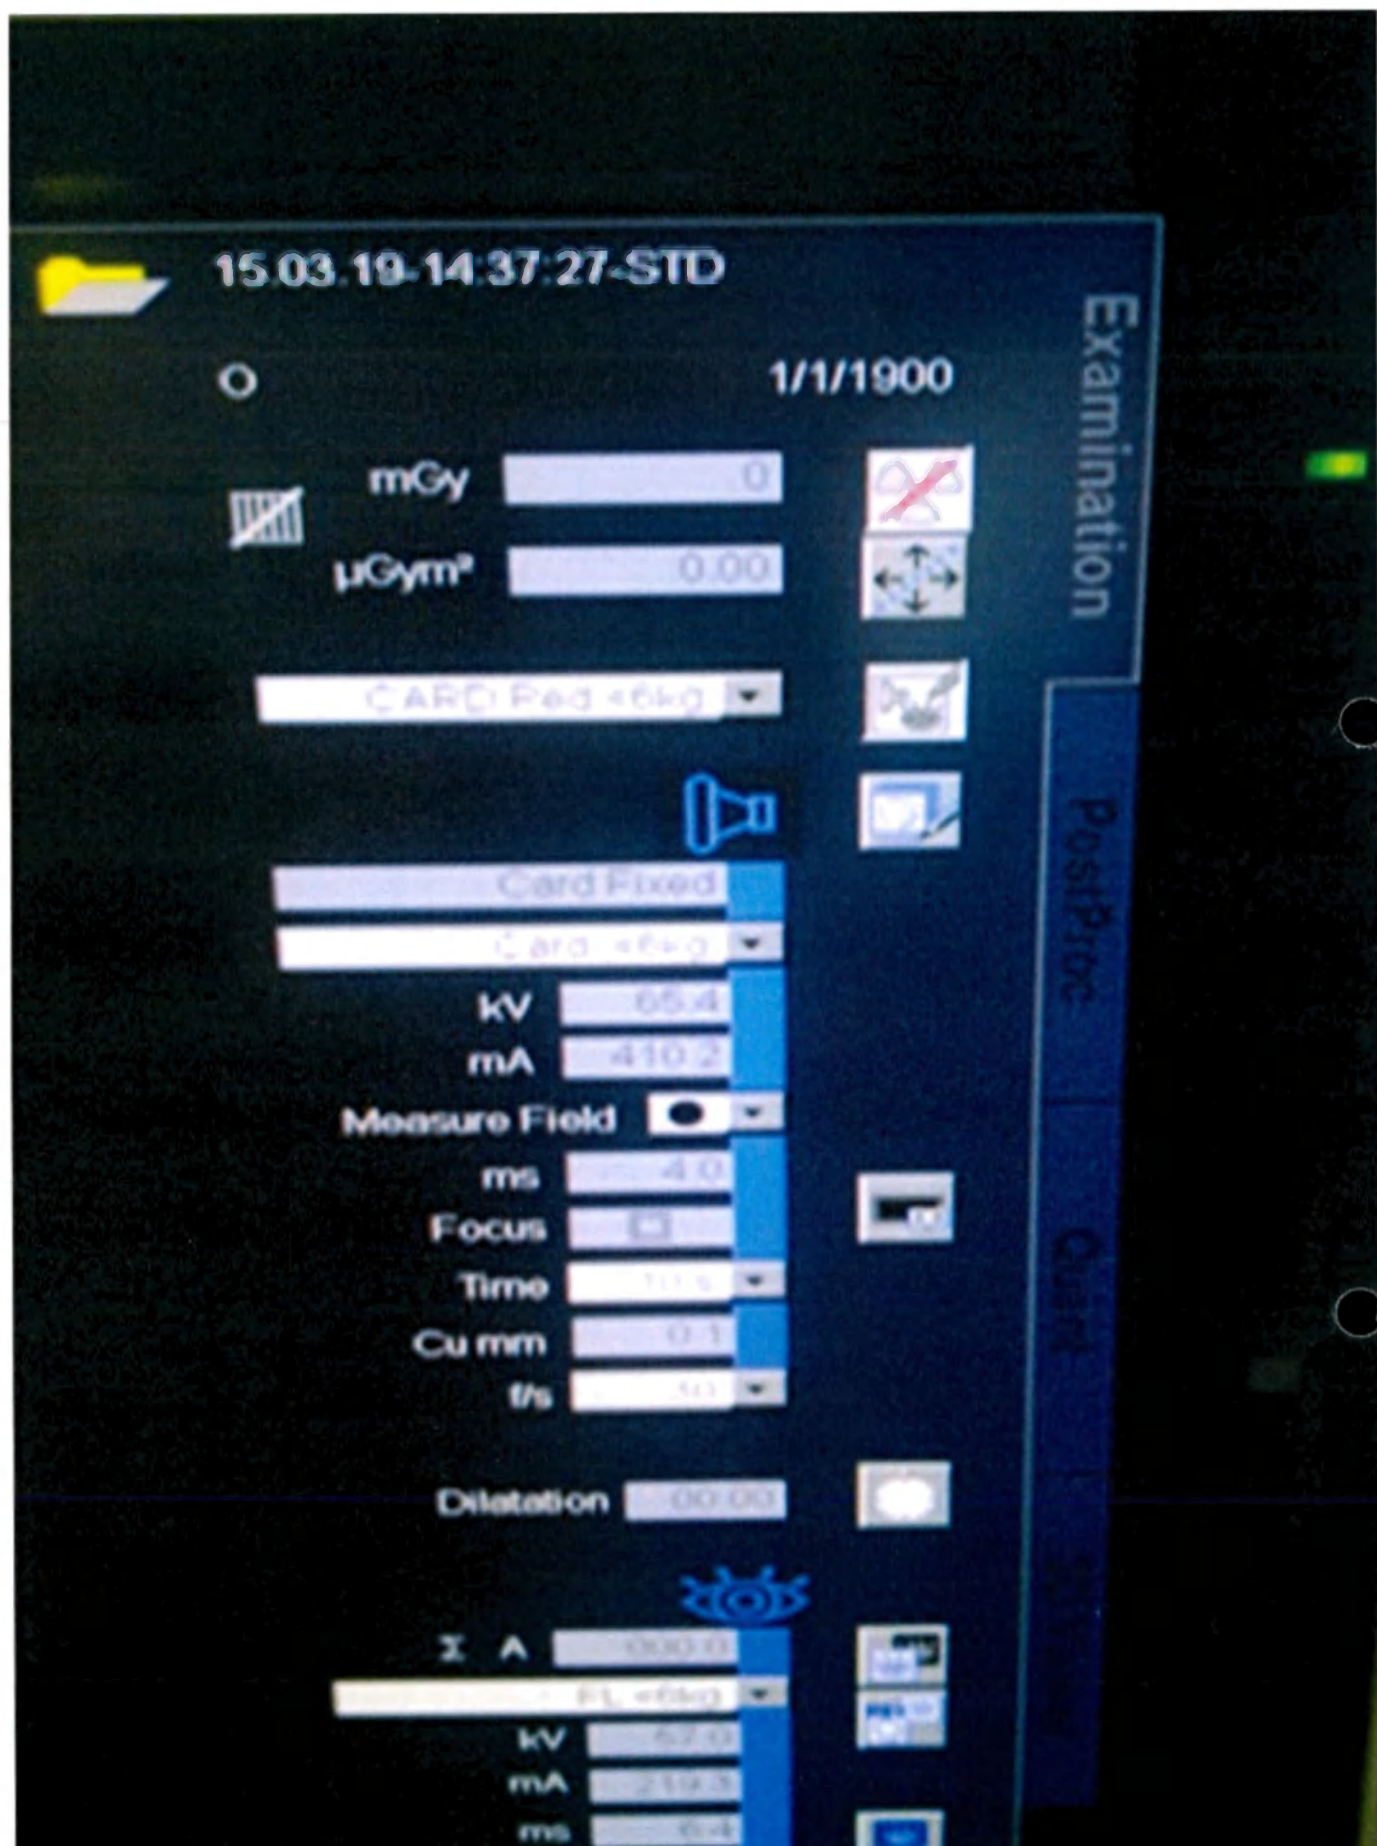


3. Программный режим Цифровая субтракционная ангиография.

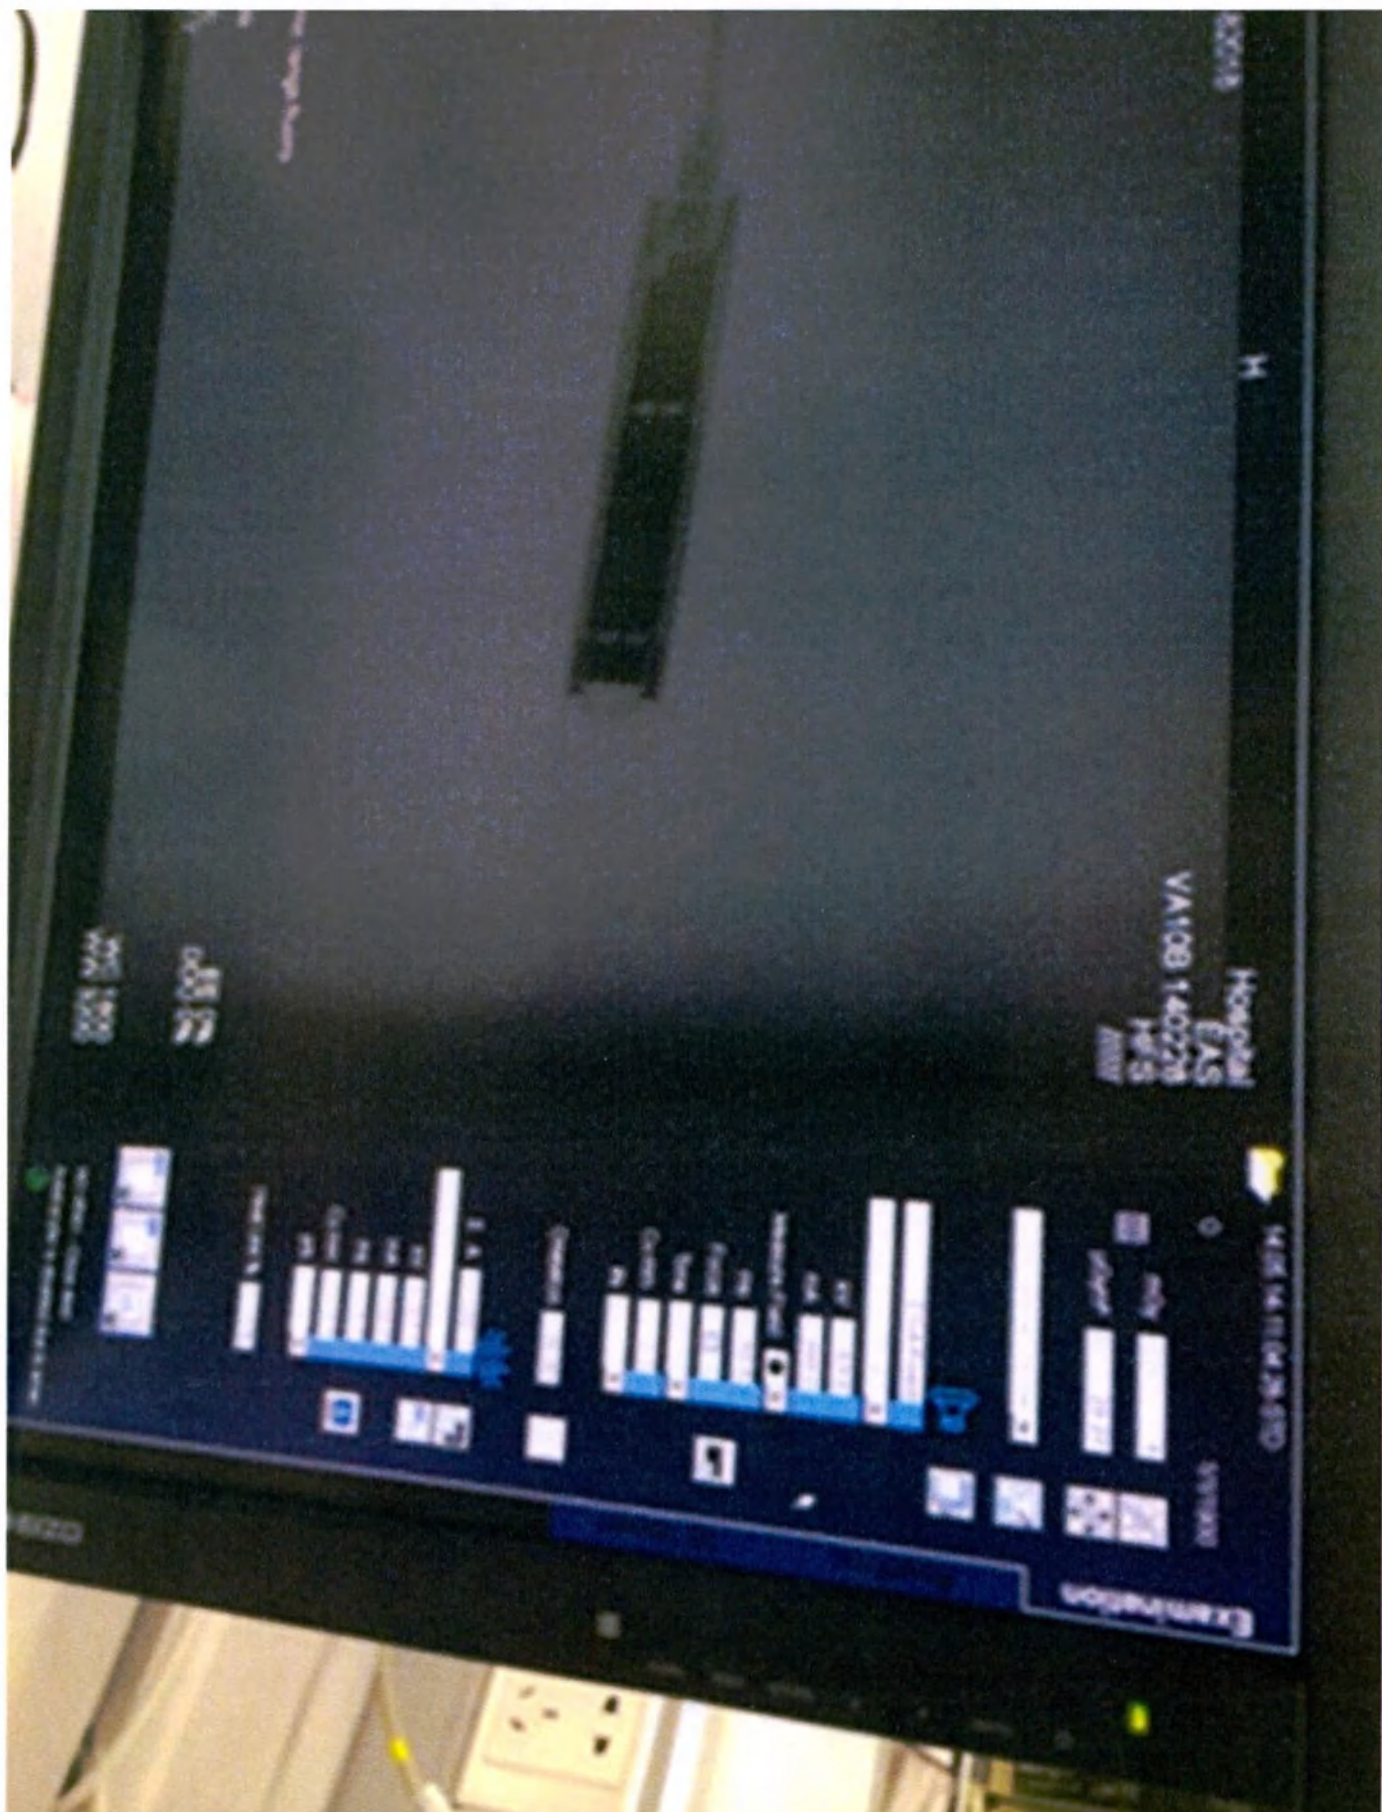


4. Программный режим Ангиография с использованием шагового метода.




5. Программный режим Ангиография с использованием шагового метода в субтрагированном виде.

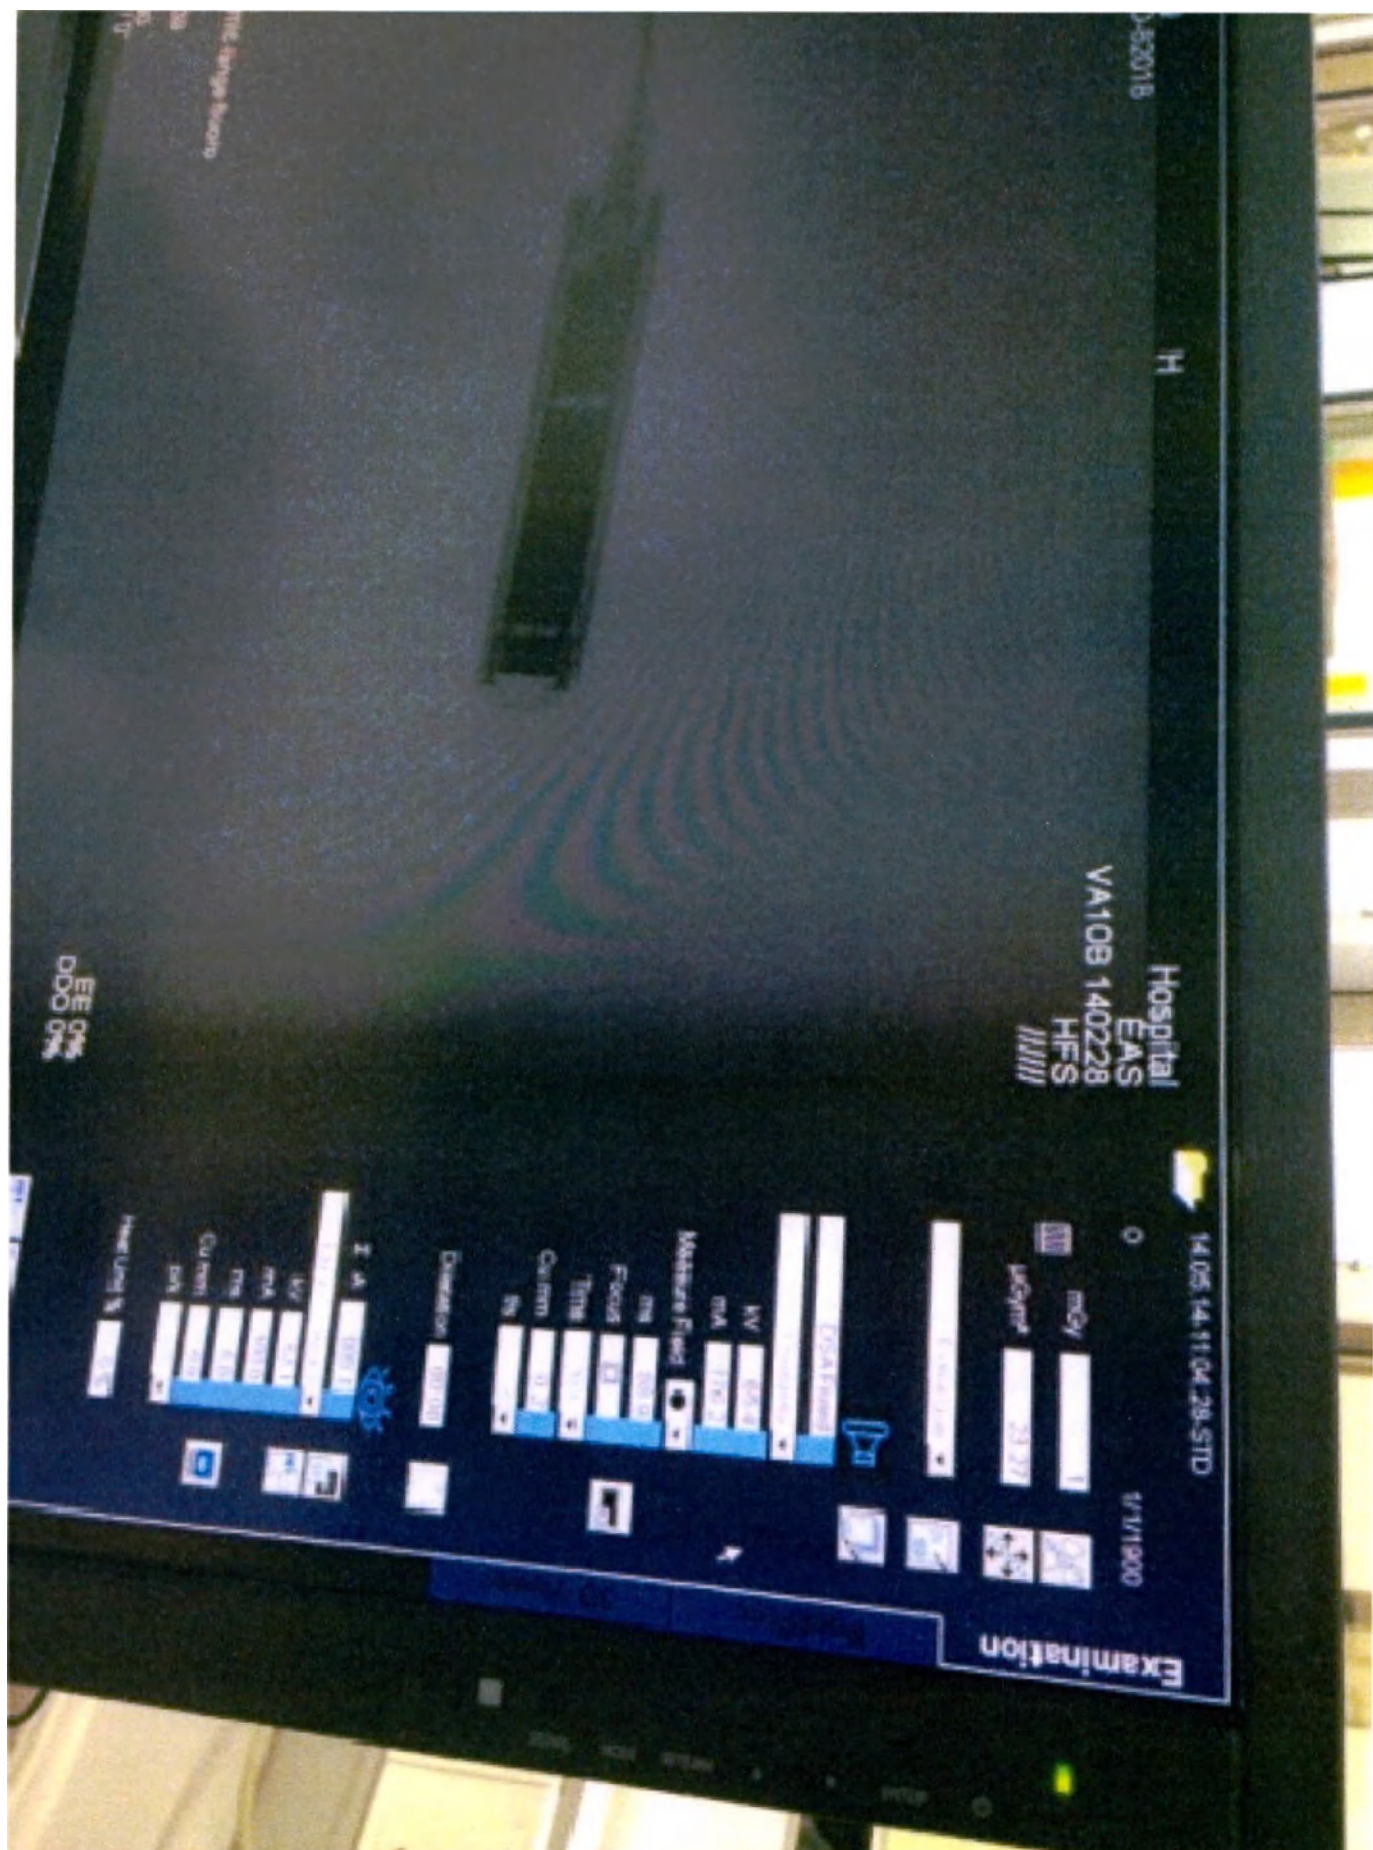

6. Программный режим Двухосевая ротационная ангиография.

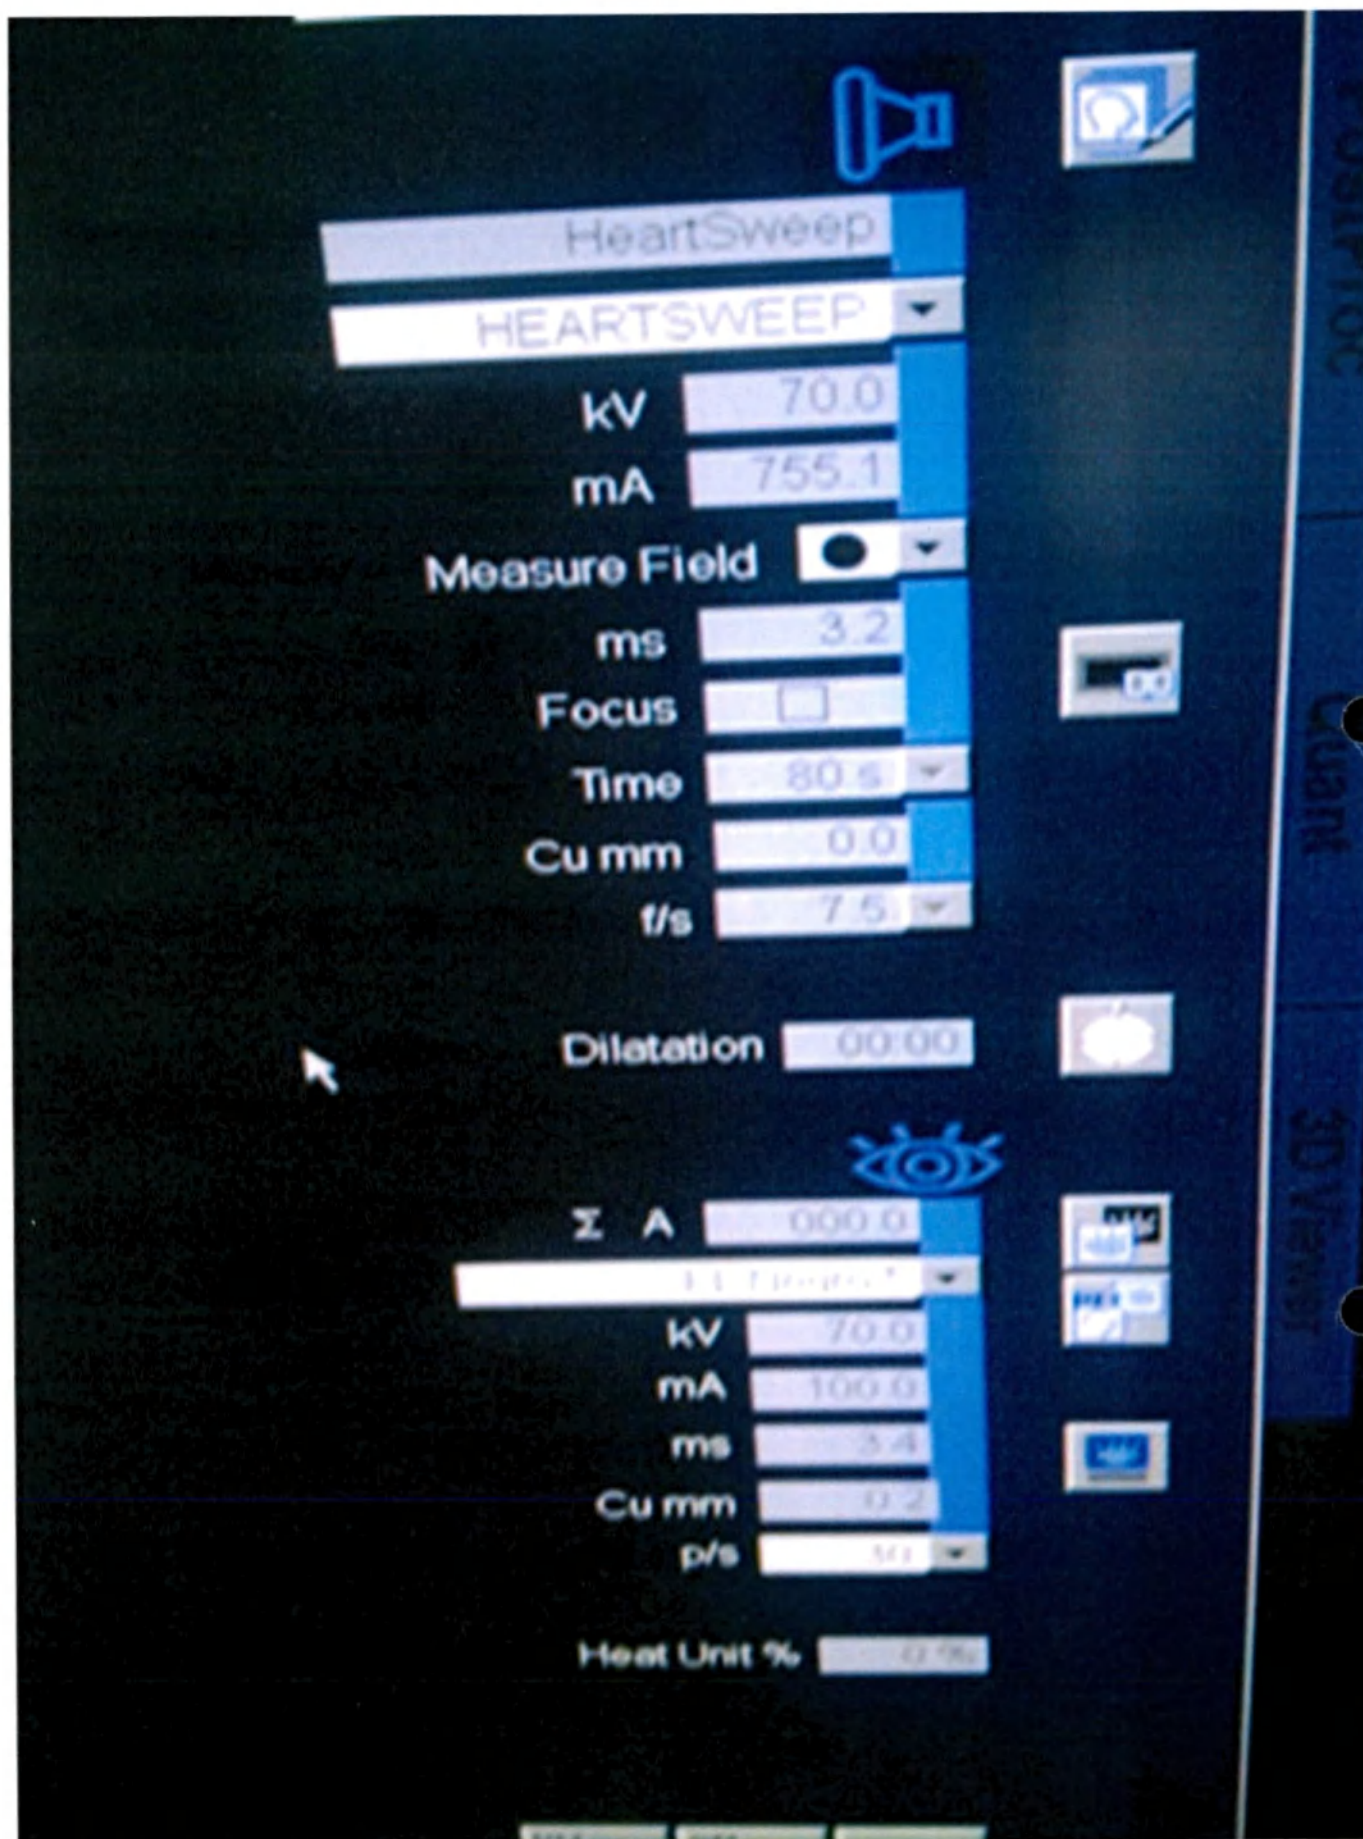


7. Программный режим 3D рентгенография.

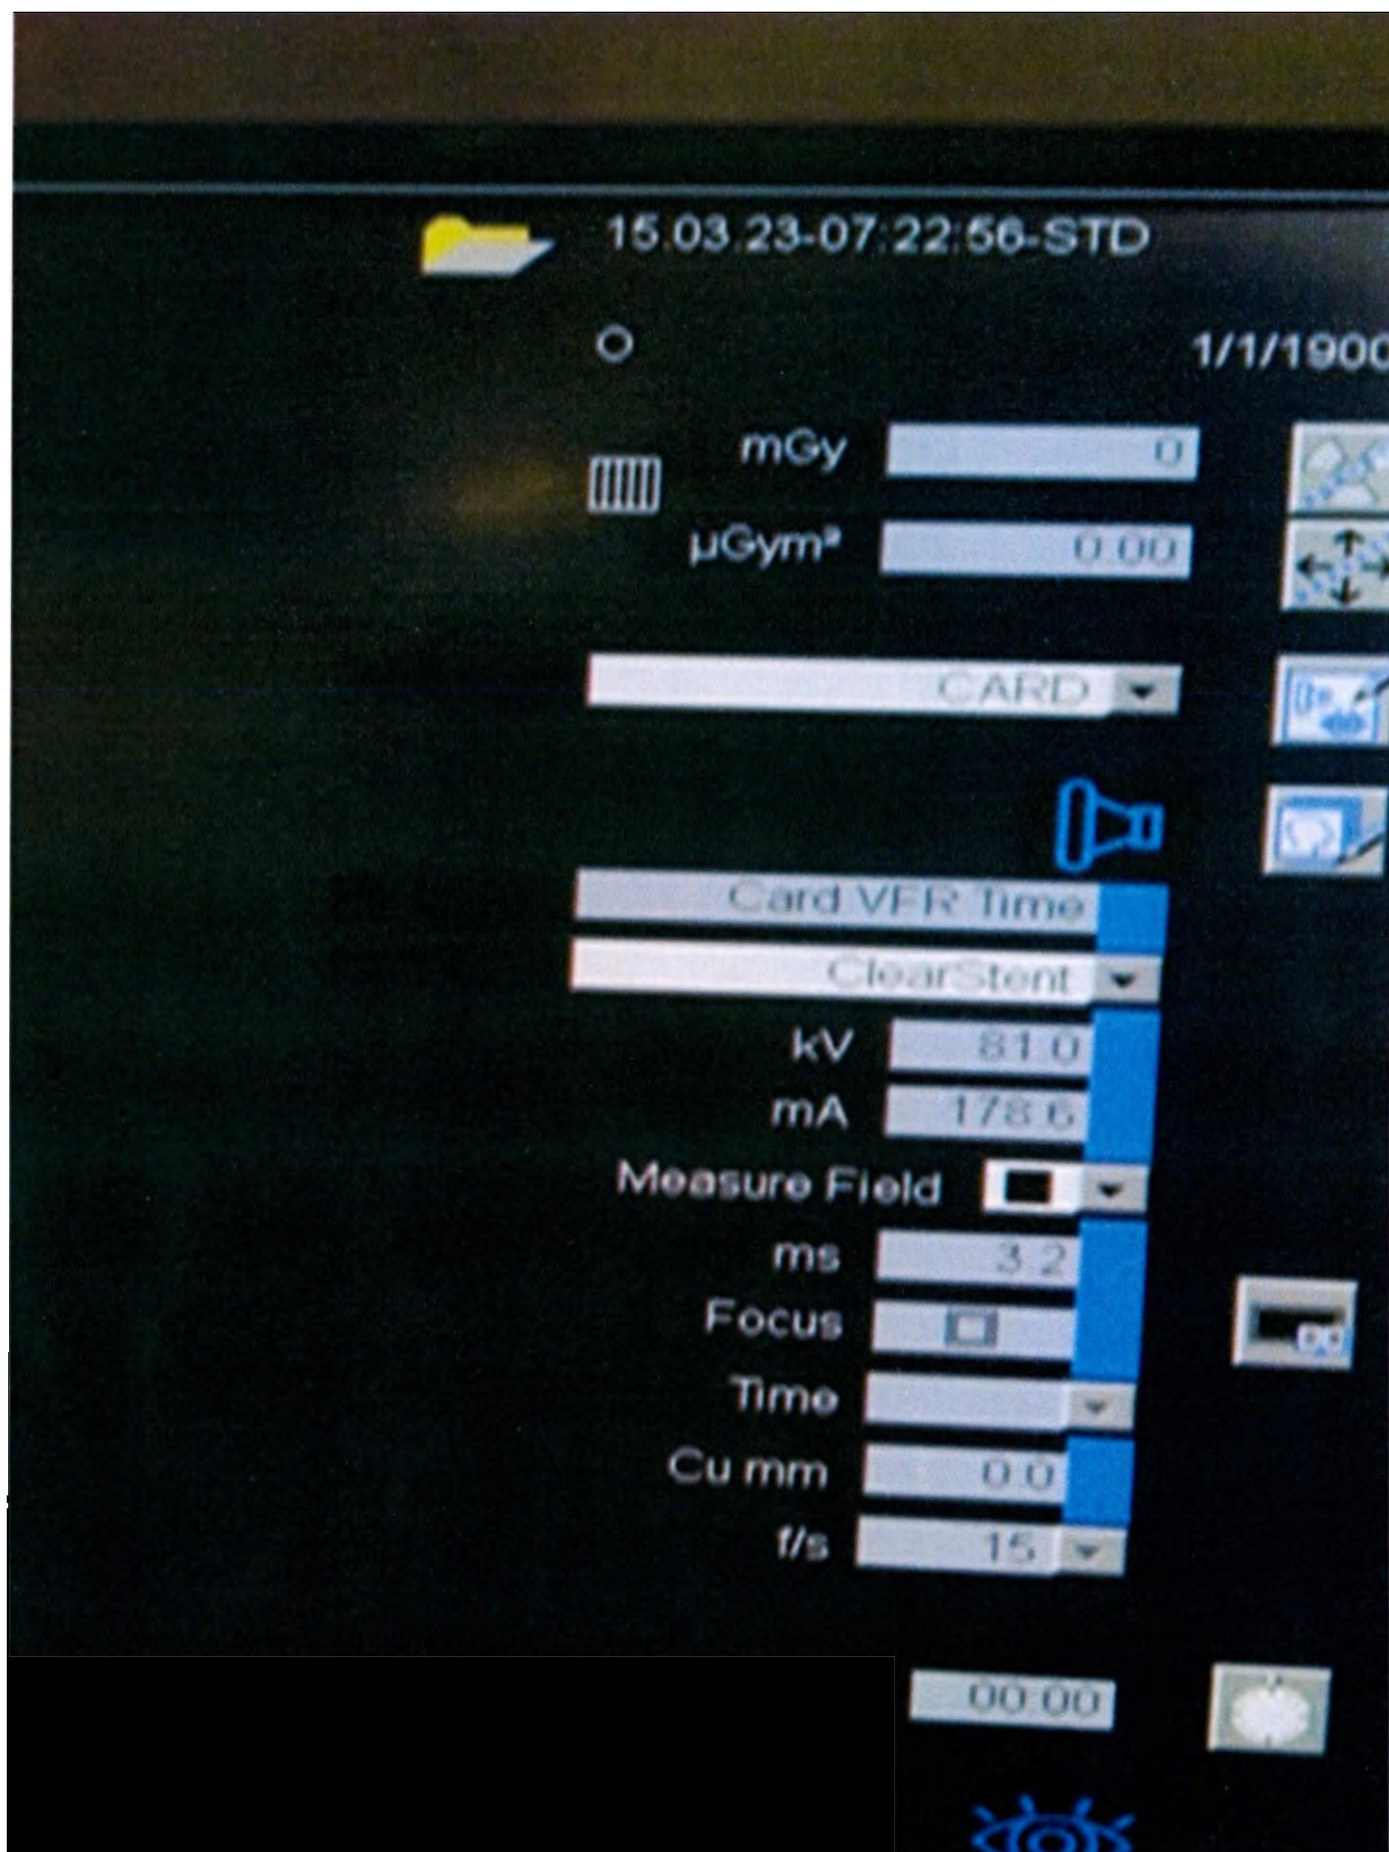


8. Программный режим Сегментации левого предсердия.




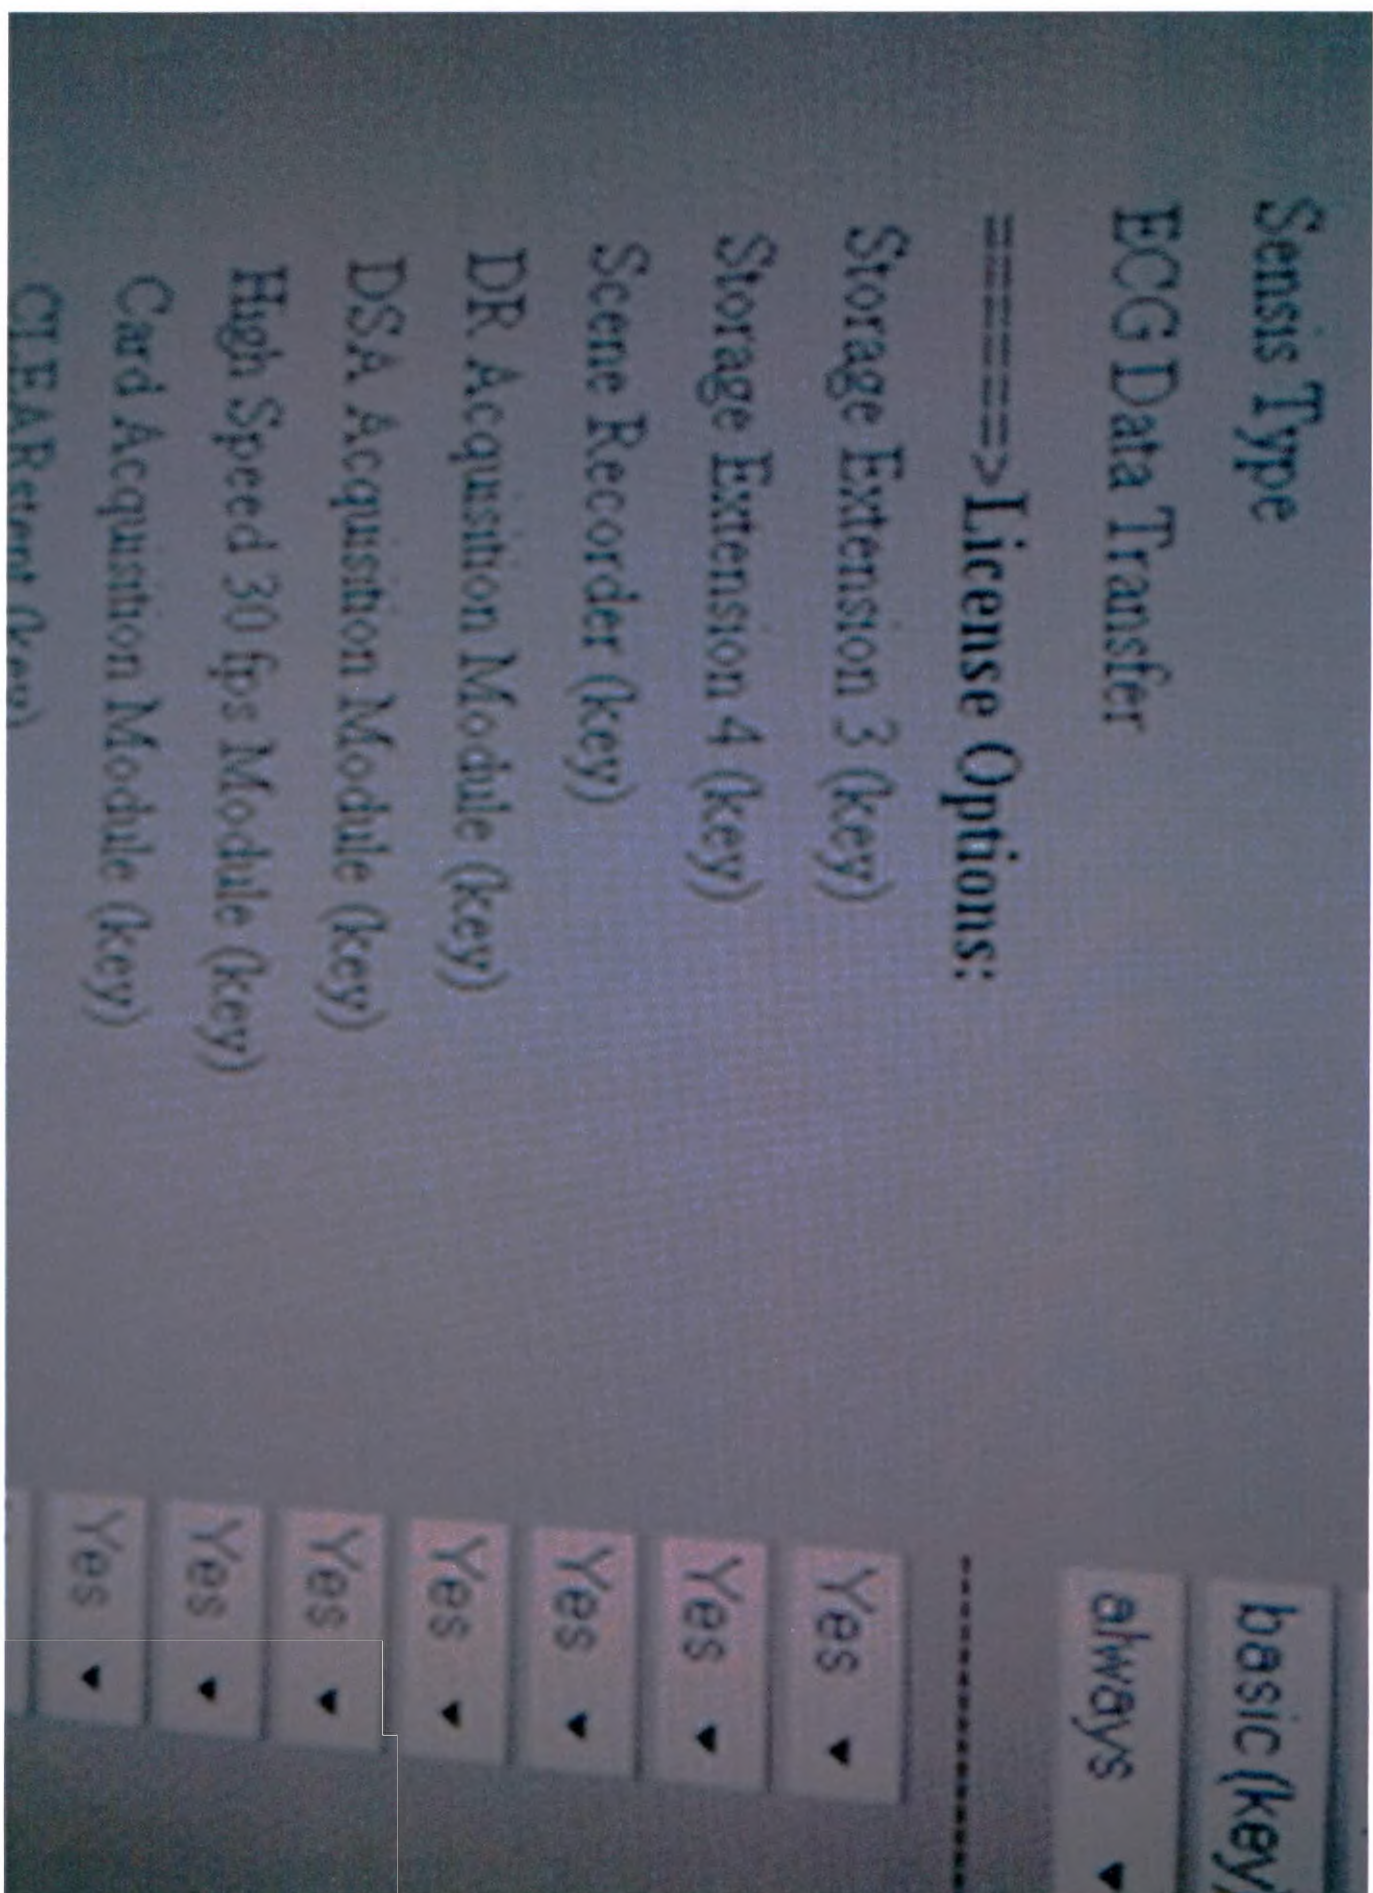


10. Программный режим рентгенографии, синхронизированной с ЭКГ.

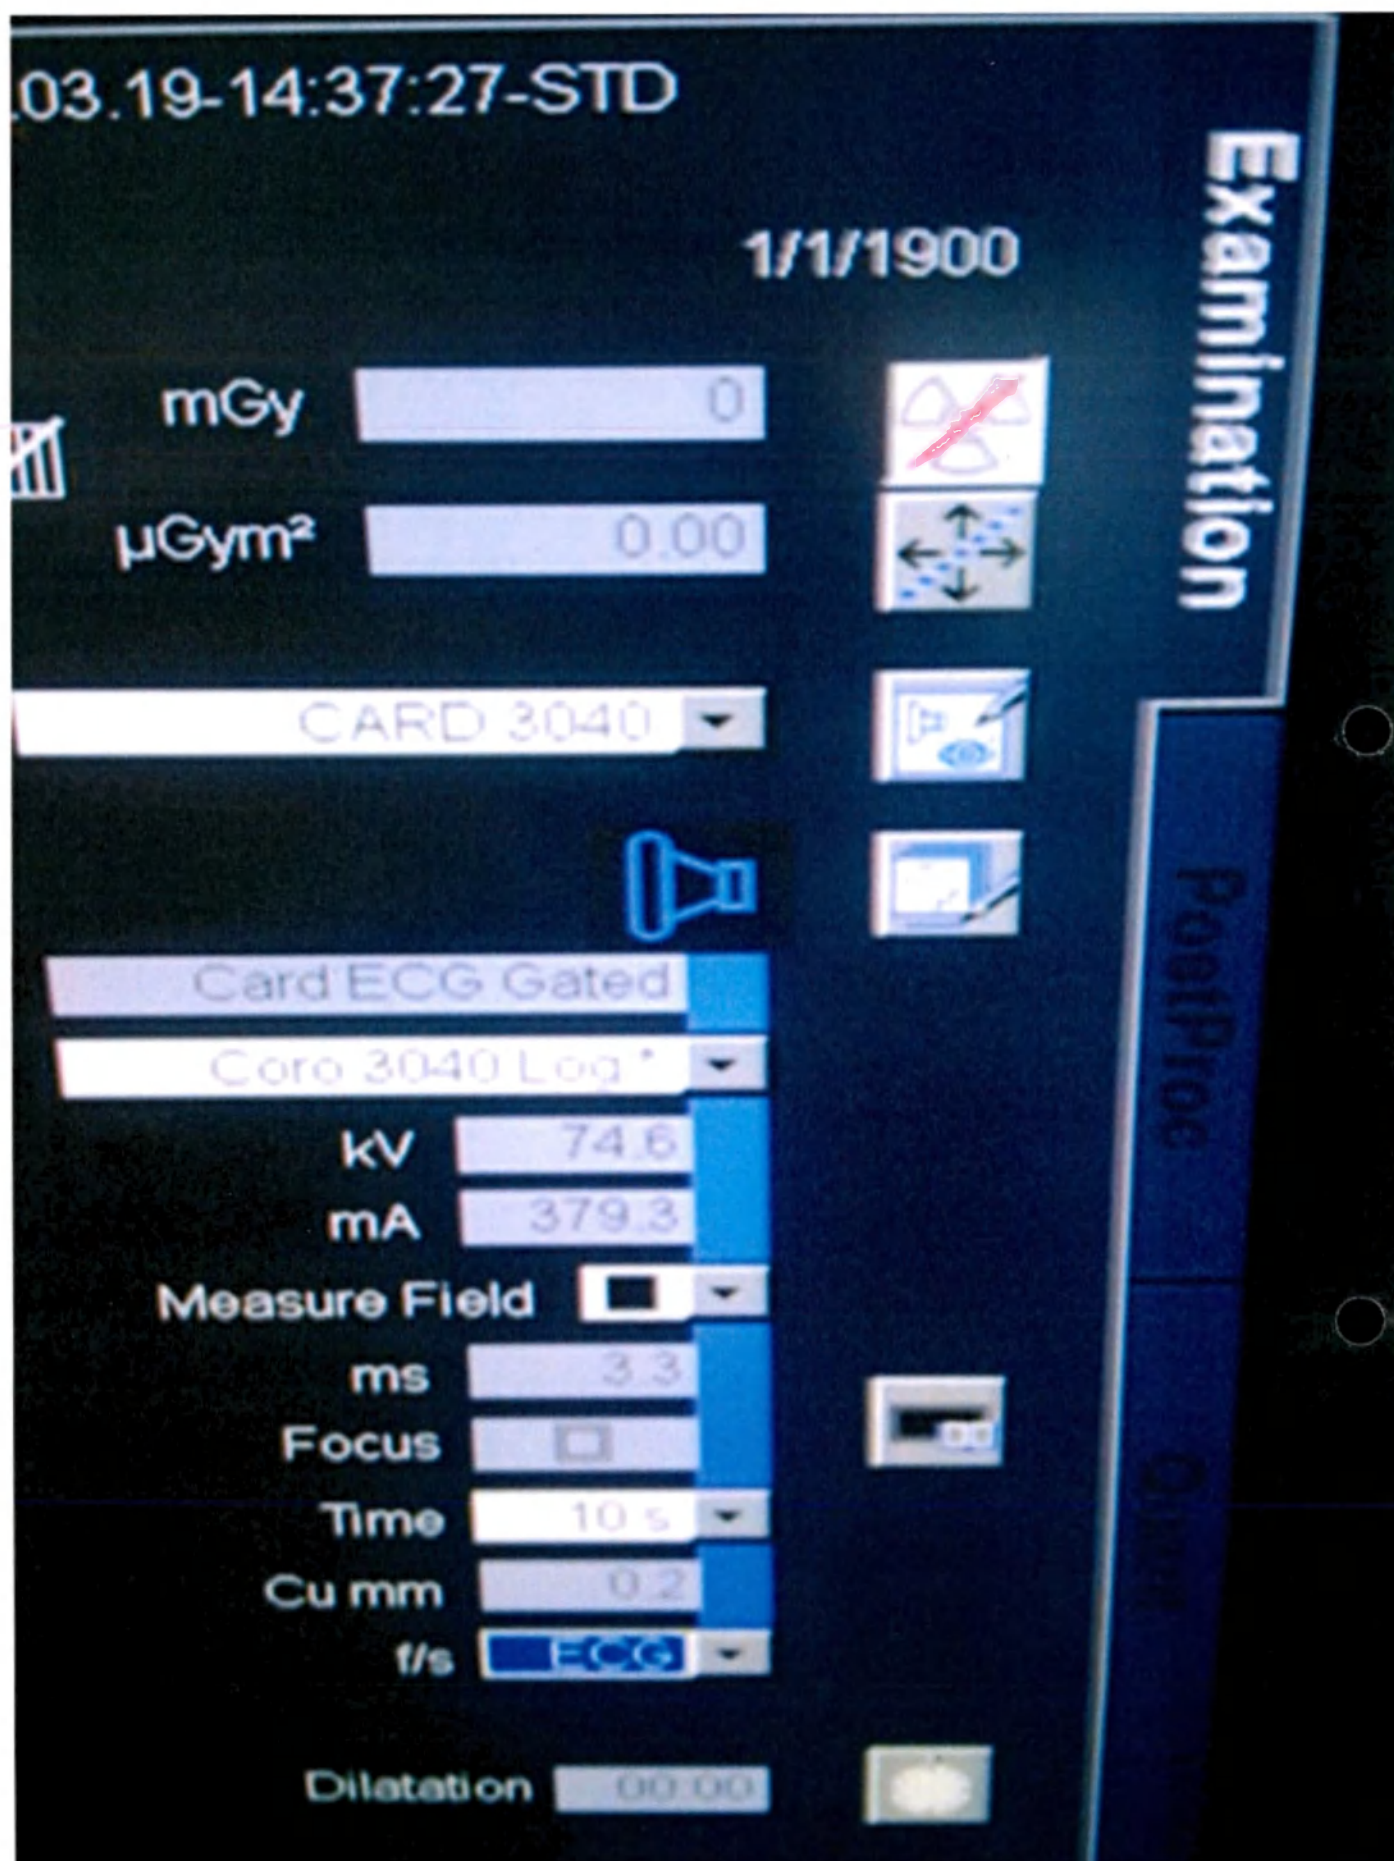



11. Комплект для синхронизации с ЭКГ:
- фильтры (2 шт.);
- дополнительный цветной монитор, 21 дюйм.

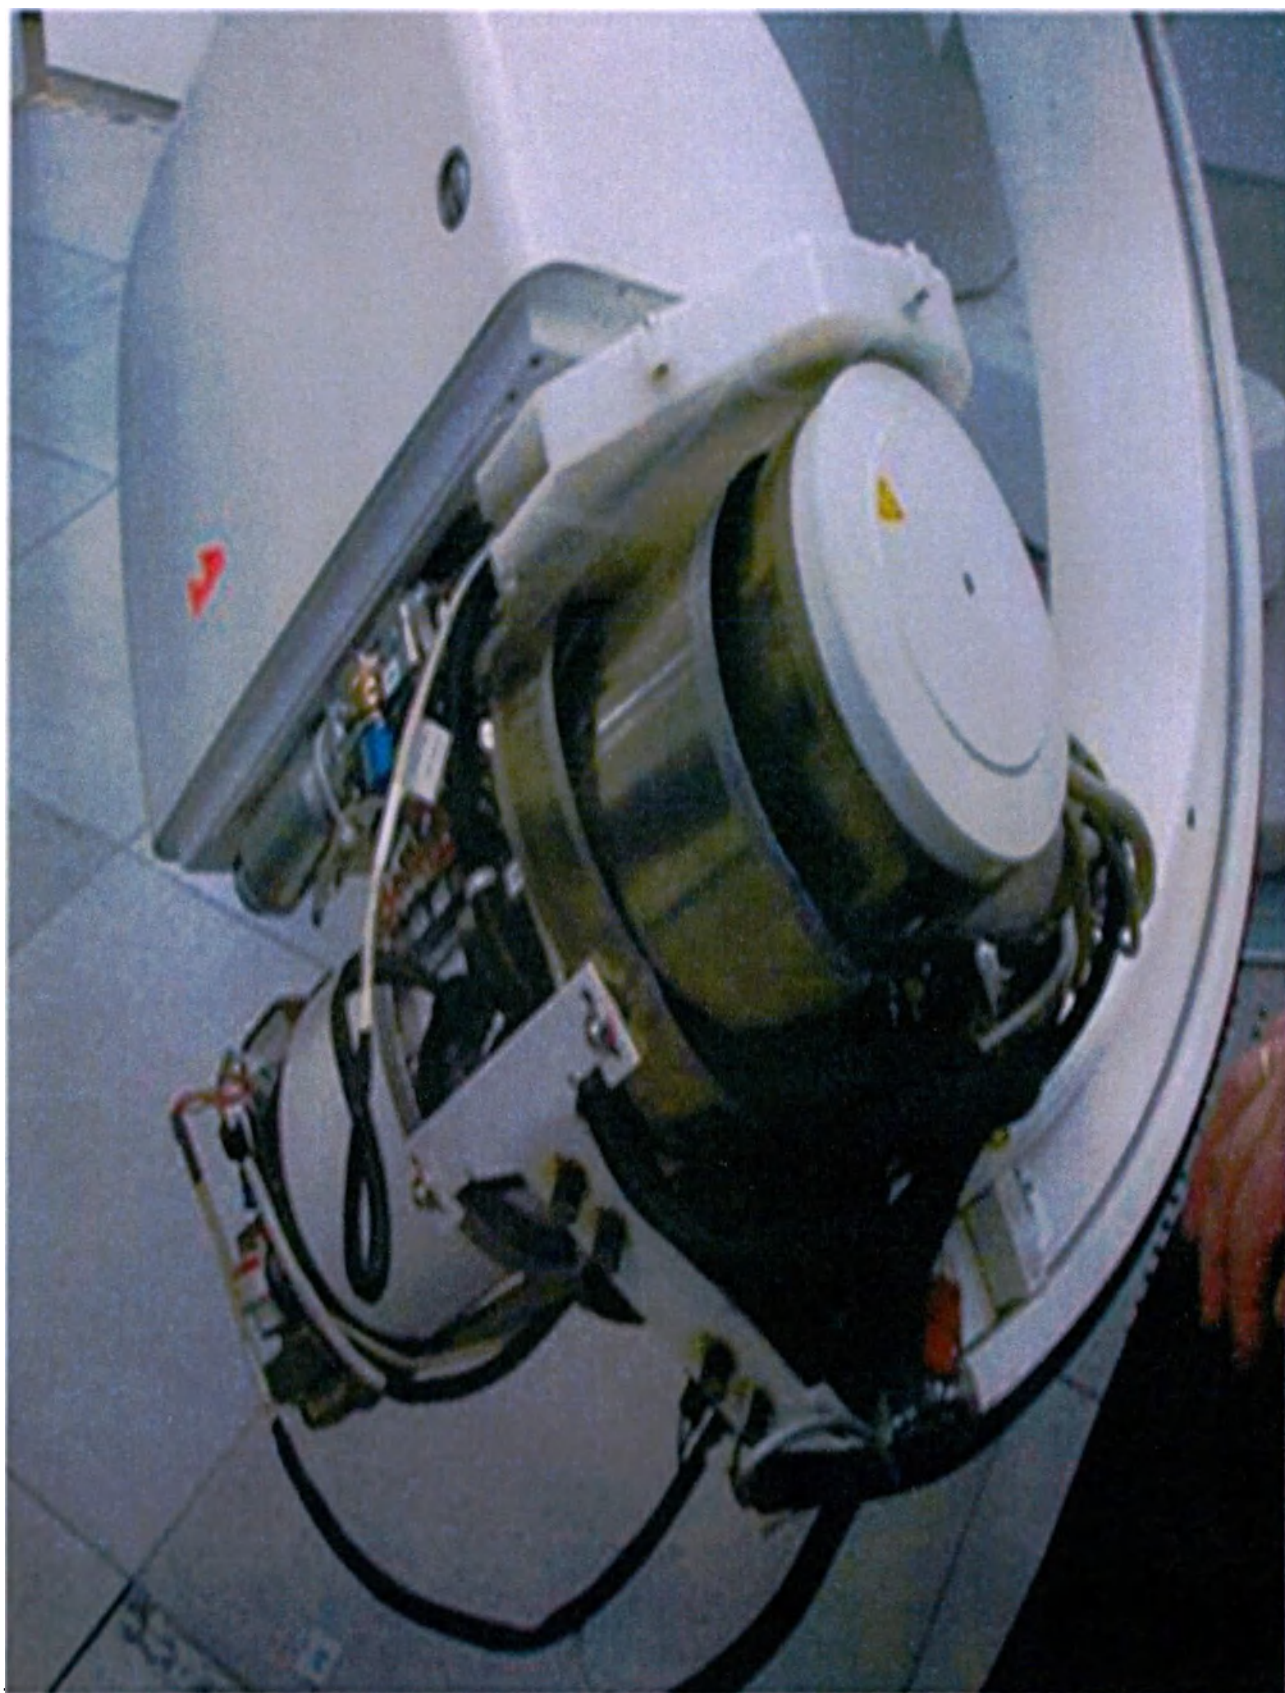

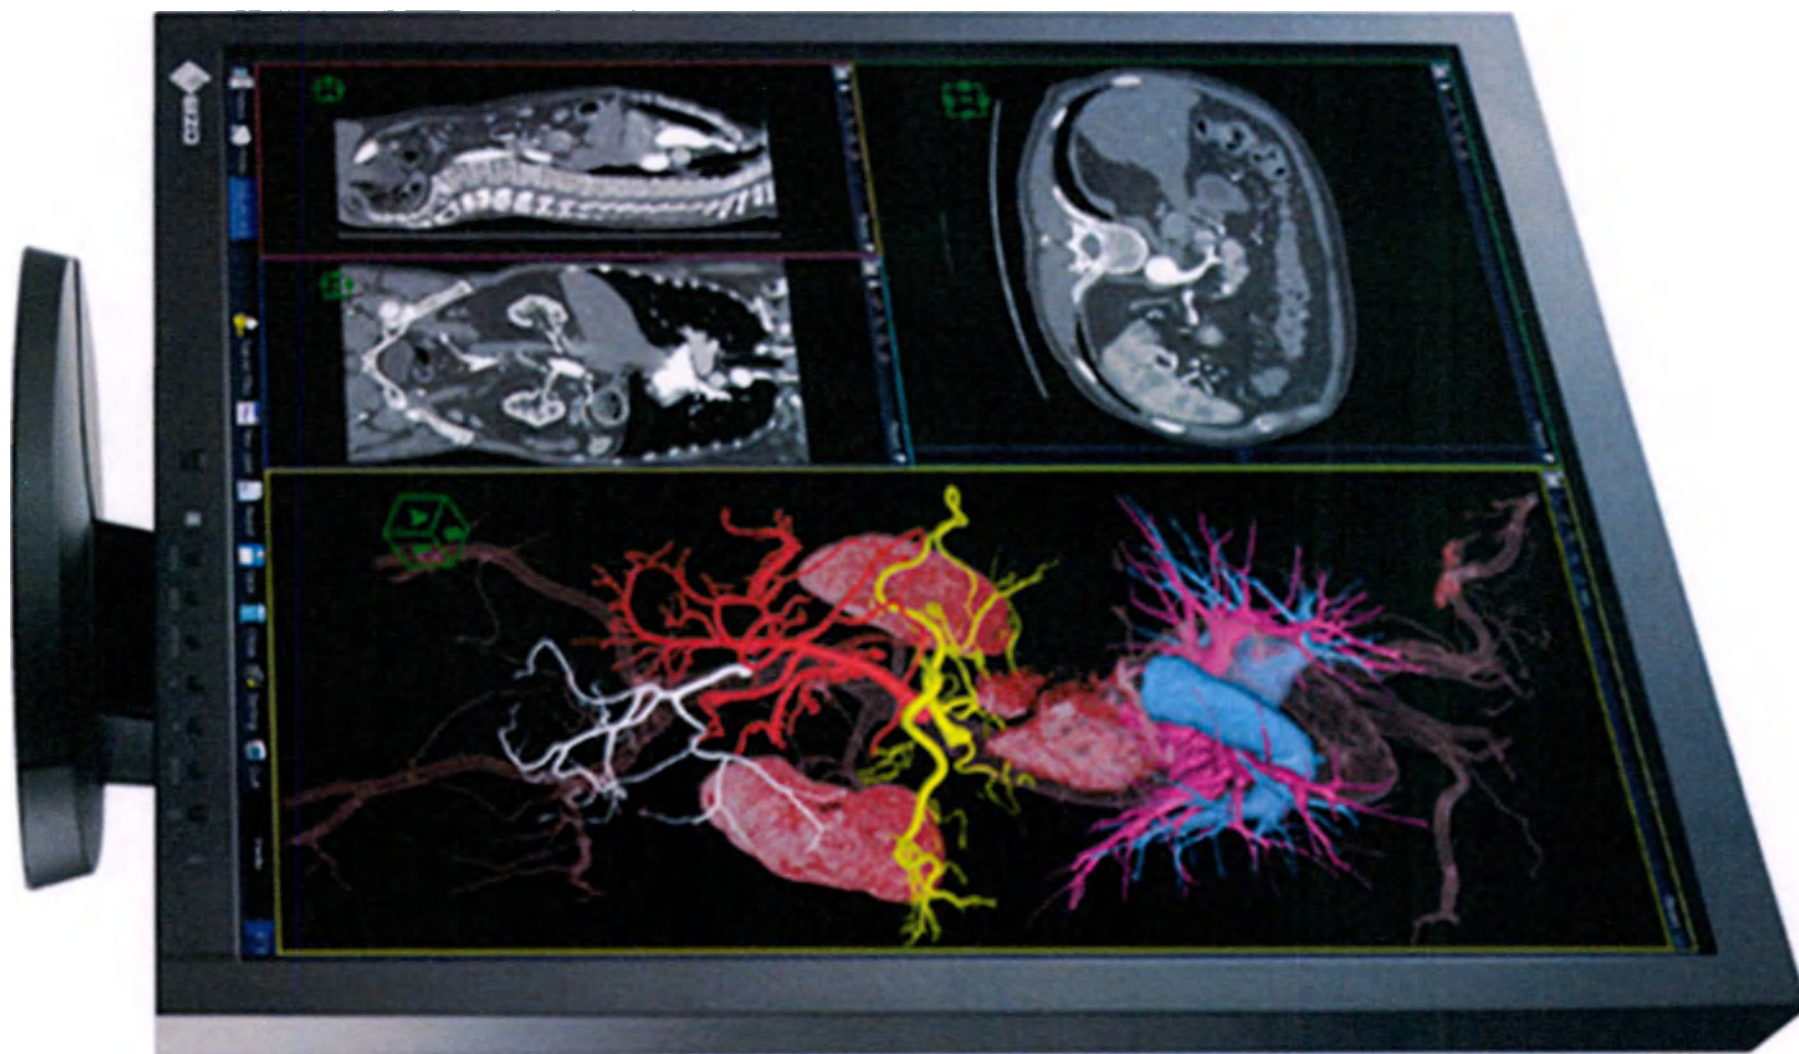

12. Программный режим выделения раскрываемых стентов.

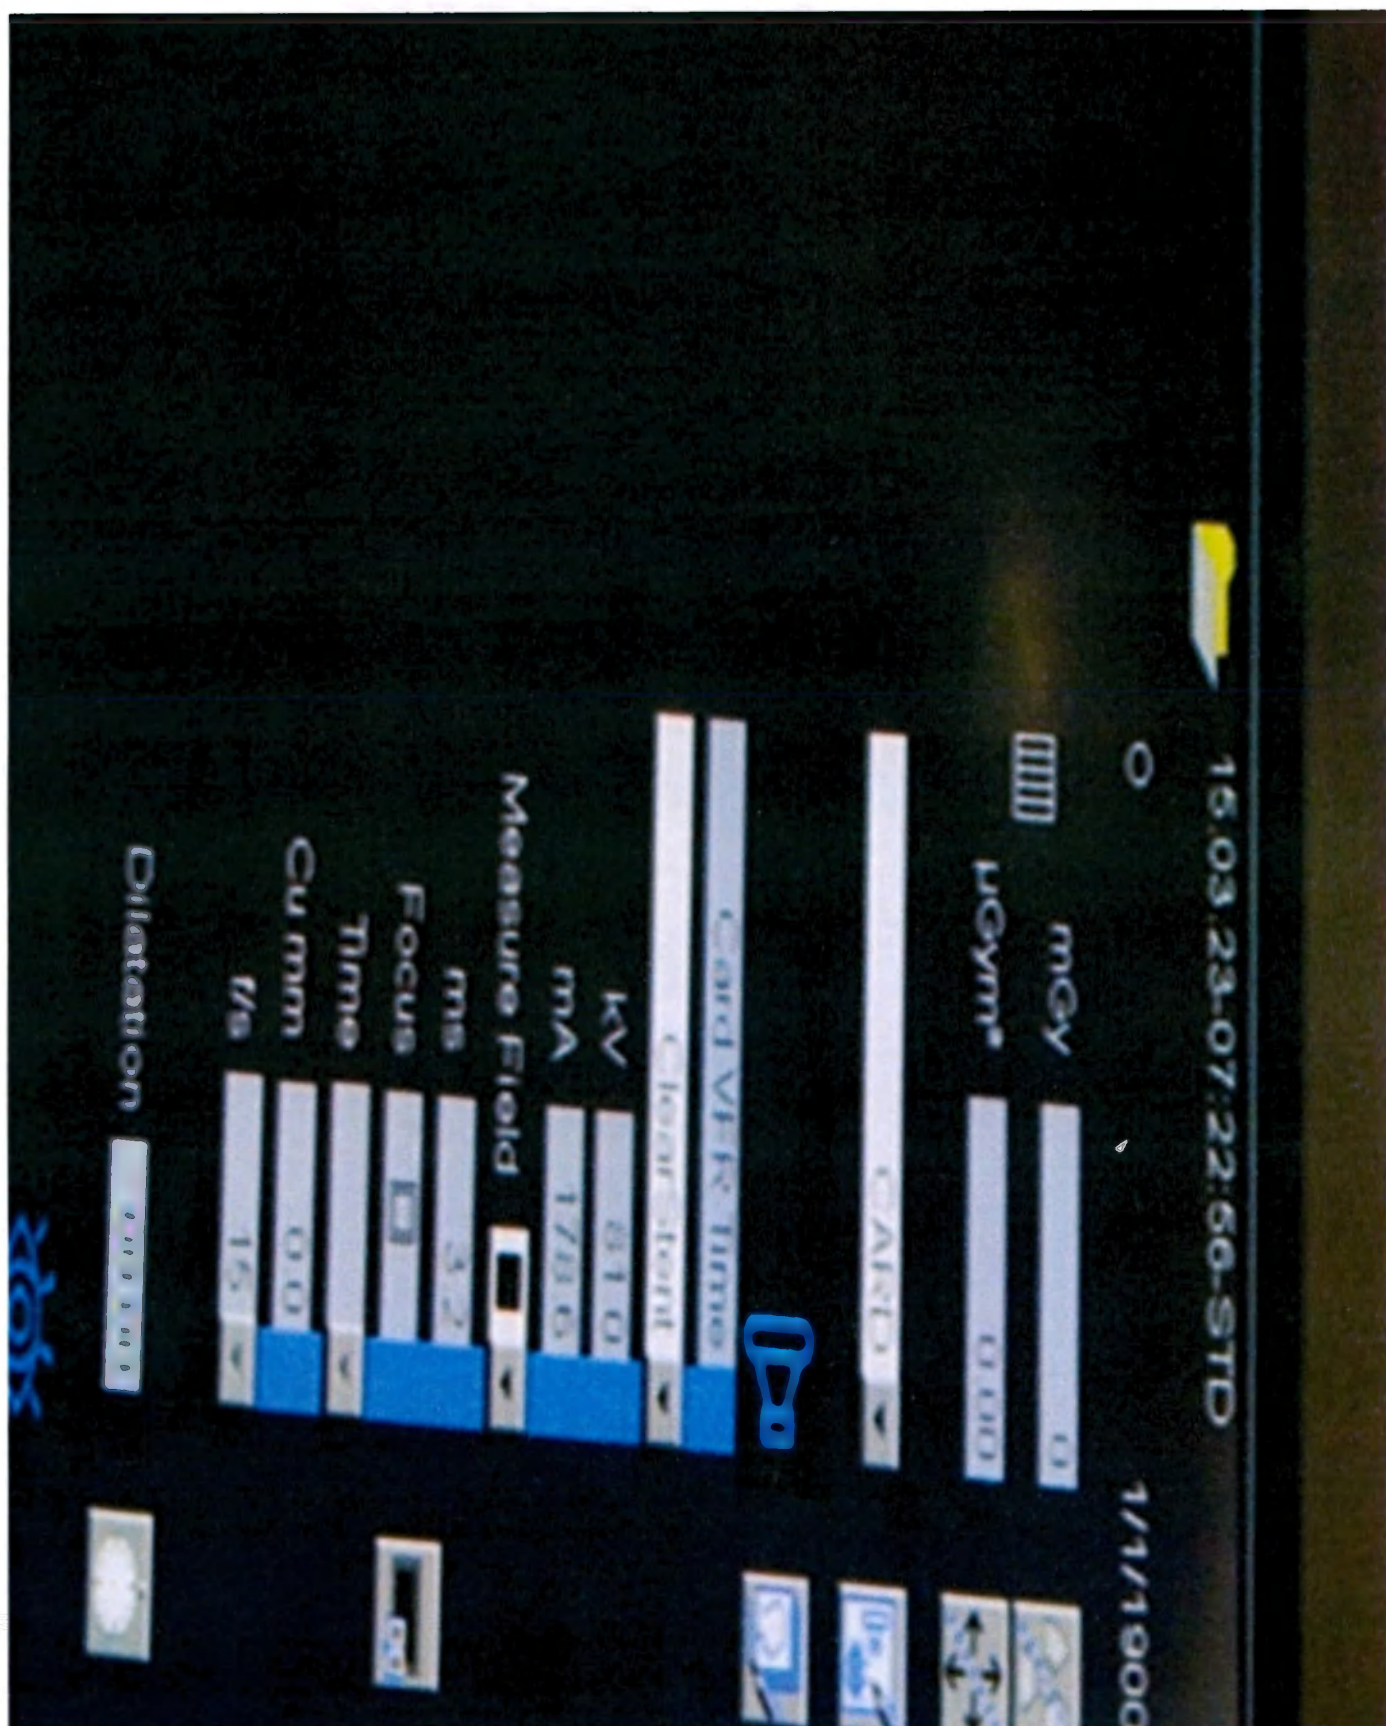

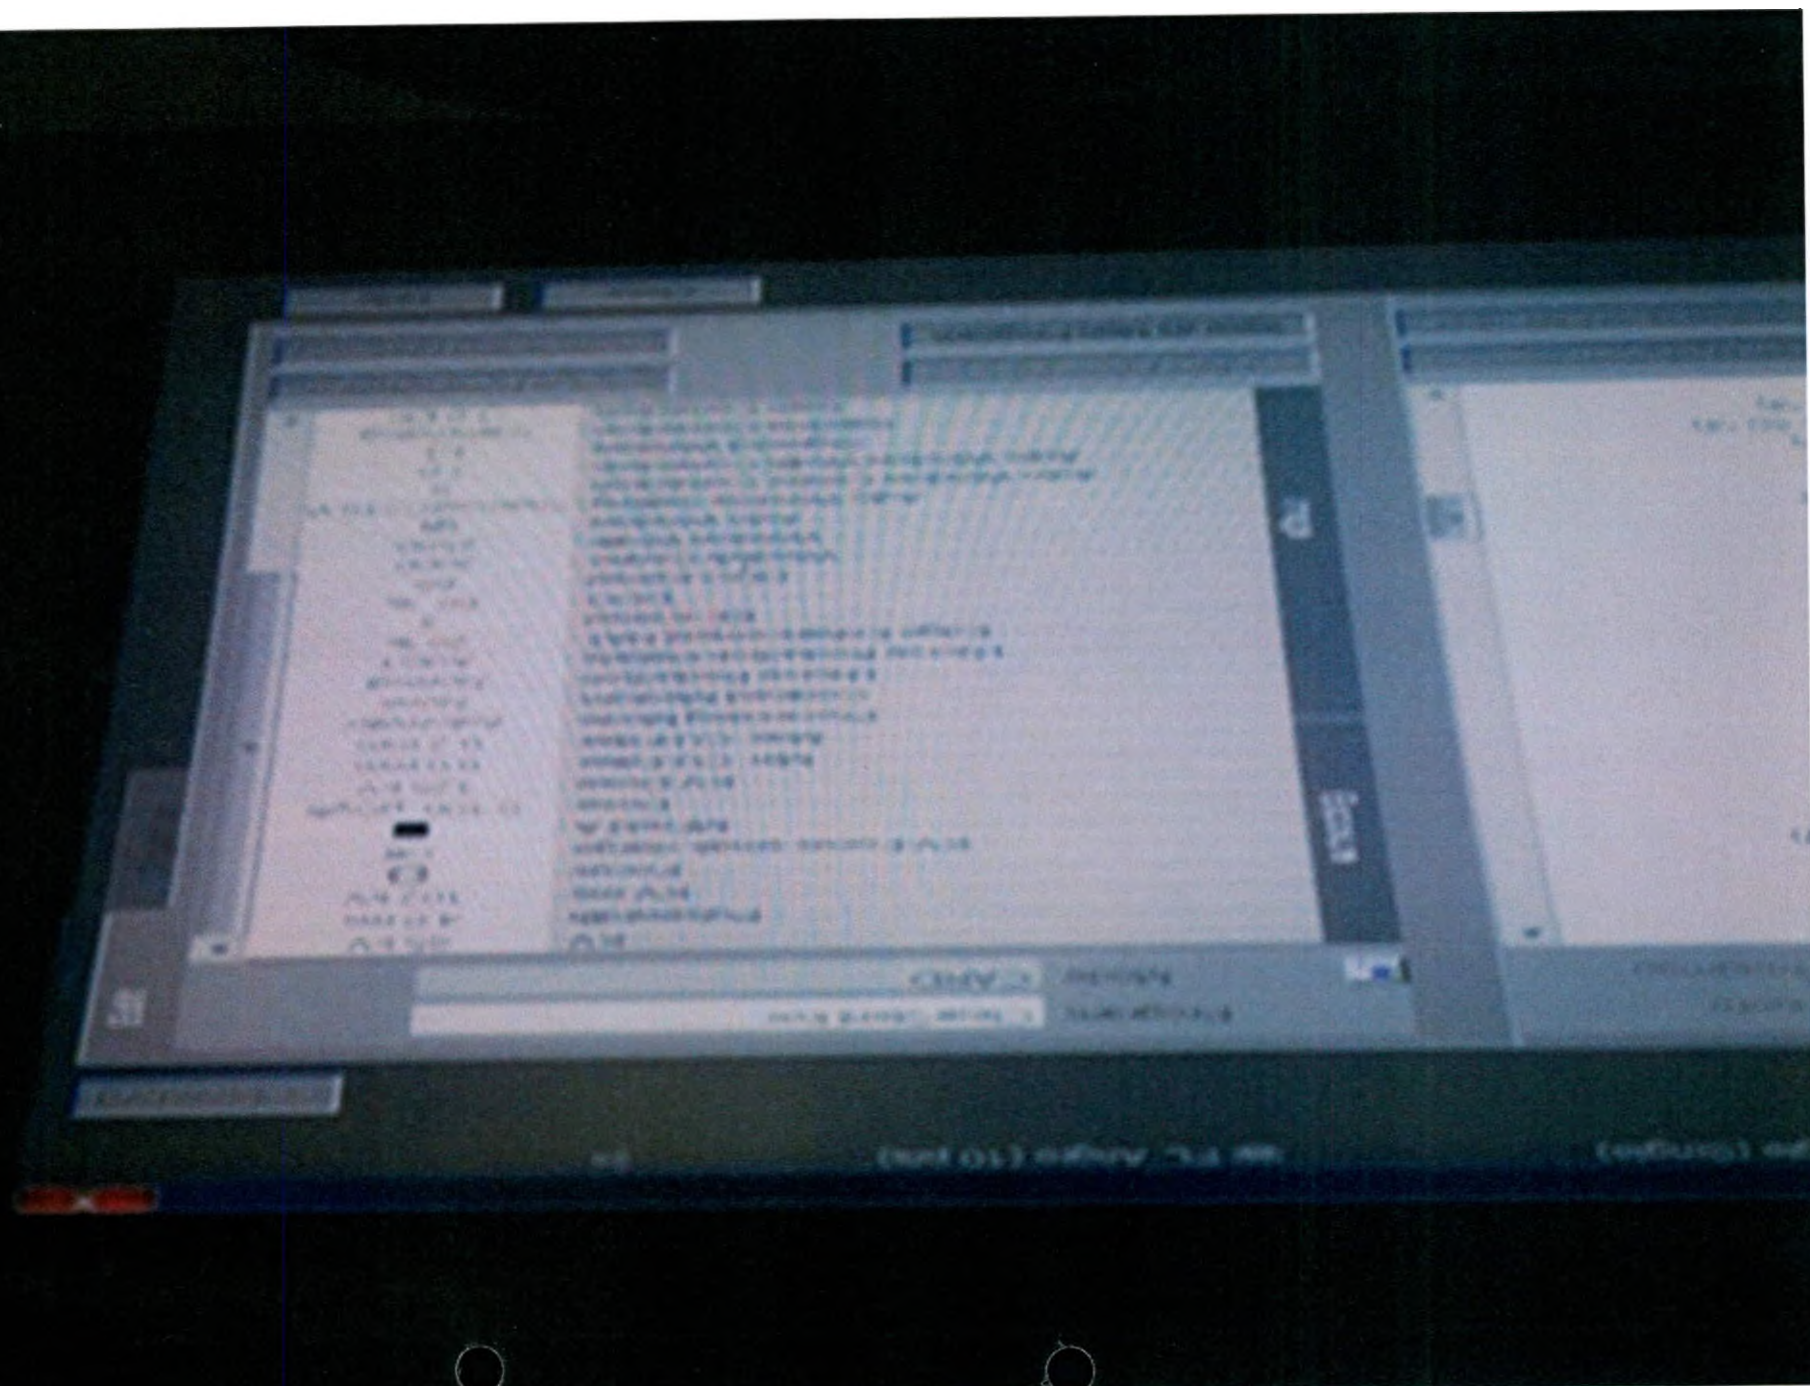

13. Устройство защиты от излучения нижней части тела.



14. Устройство защиты от излучения верхней части тела.



15. Кабель подключения системы ЭКГ.



16. Кабели подключения системы внутрисосудистого ультразвука (не более 10 шт.).



17. Программный режим Количественный анализ сосудов.




18. Программный режим Количественный анализ коронарных сосудов.



19. Программный режим Количественный анализ коронарных сосудов с бифуркацией.




20. Программный режим Количественный анализ желудочка.

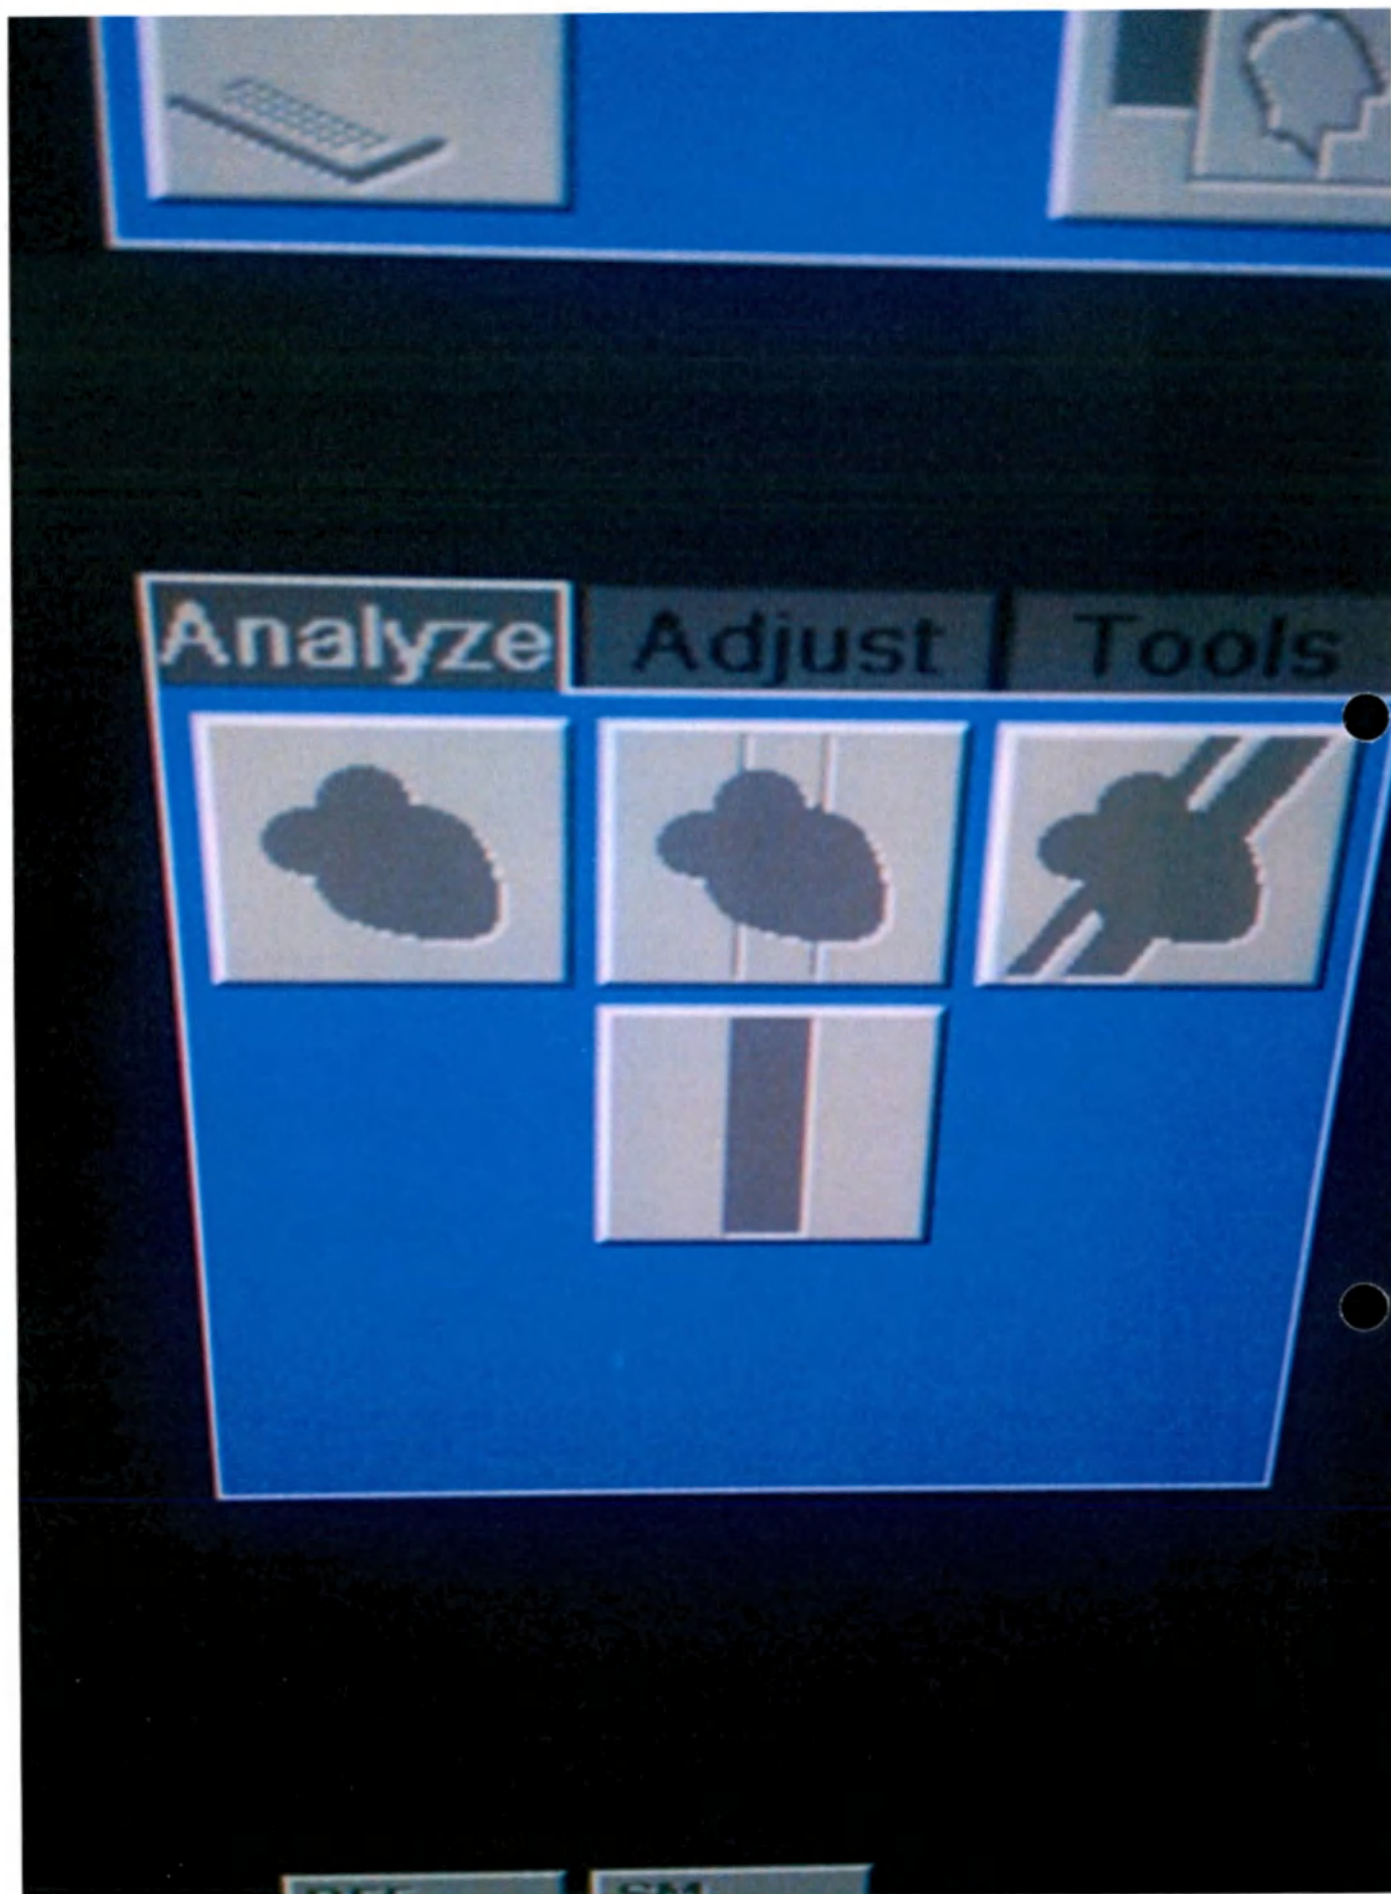


21. Программный режим 3-мерного количественного анализа коронарных сосудов.




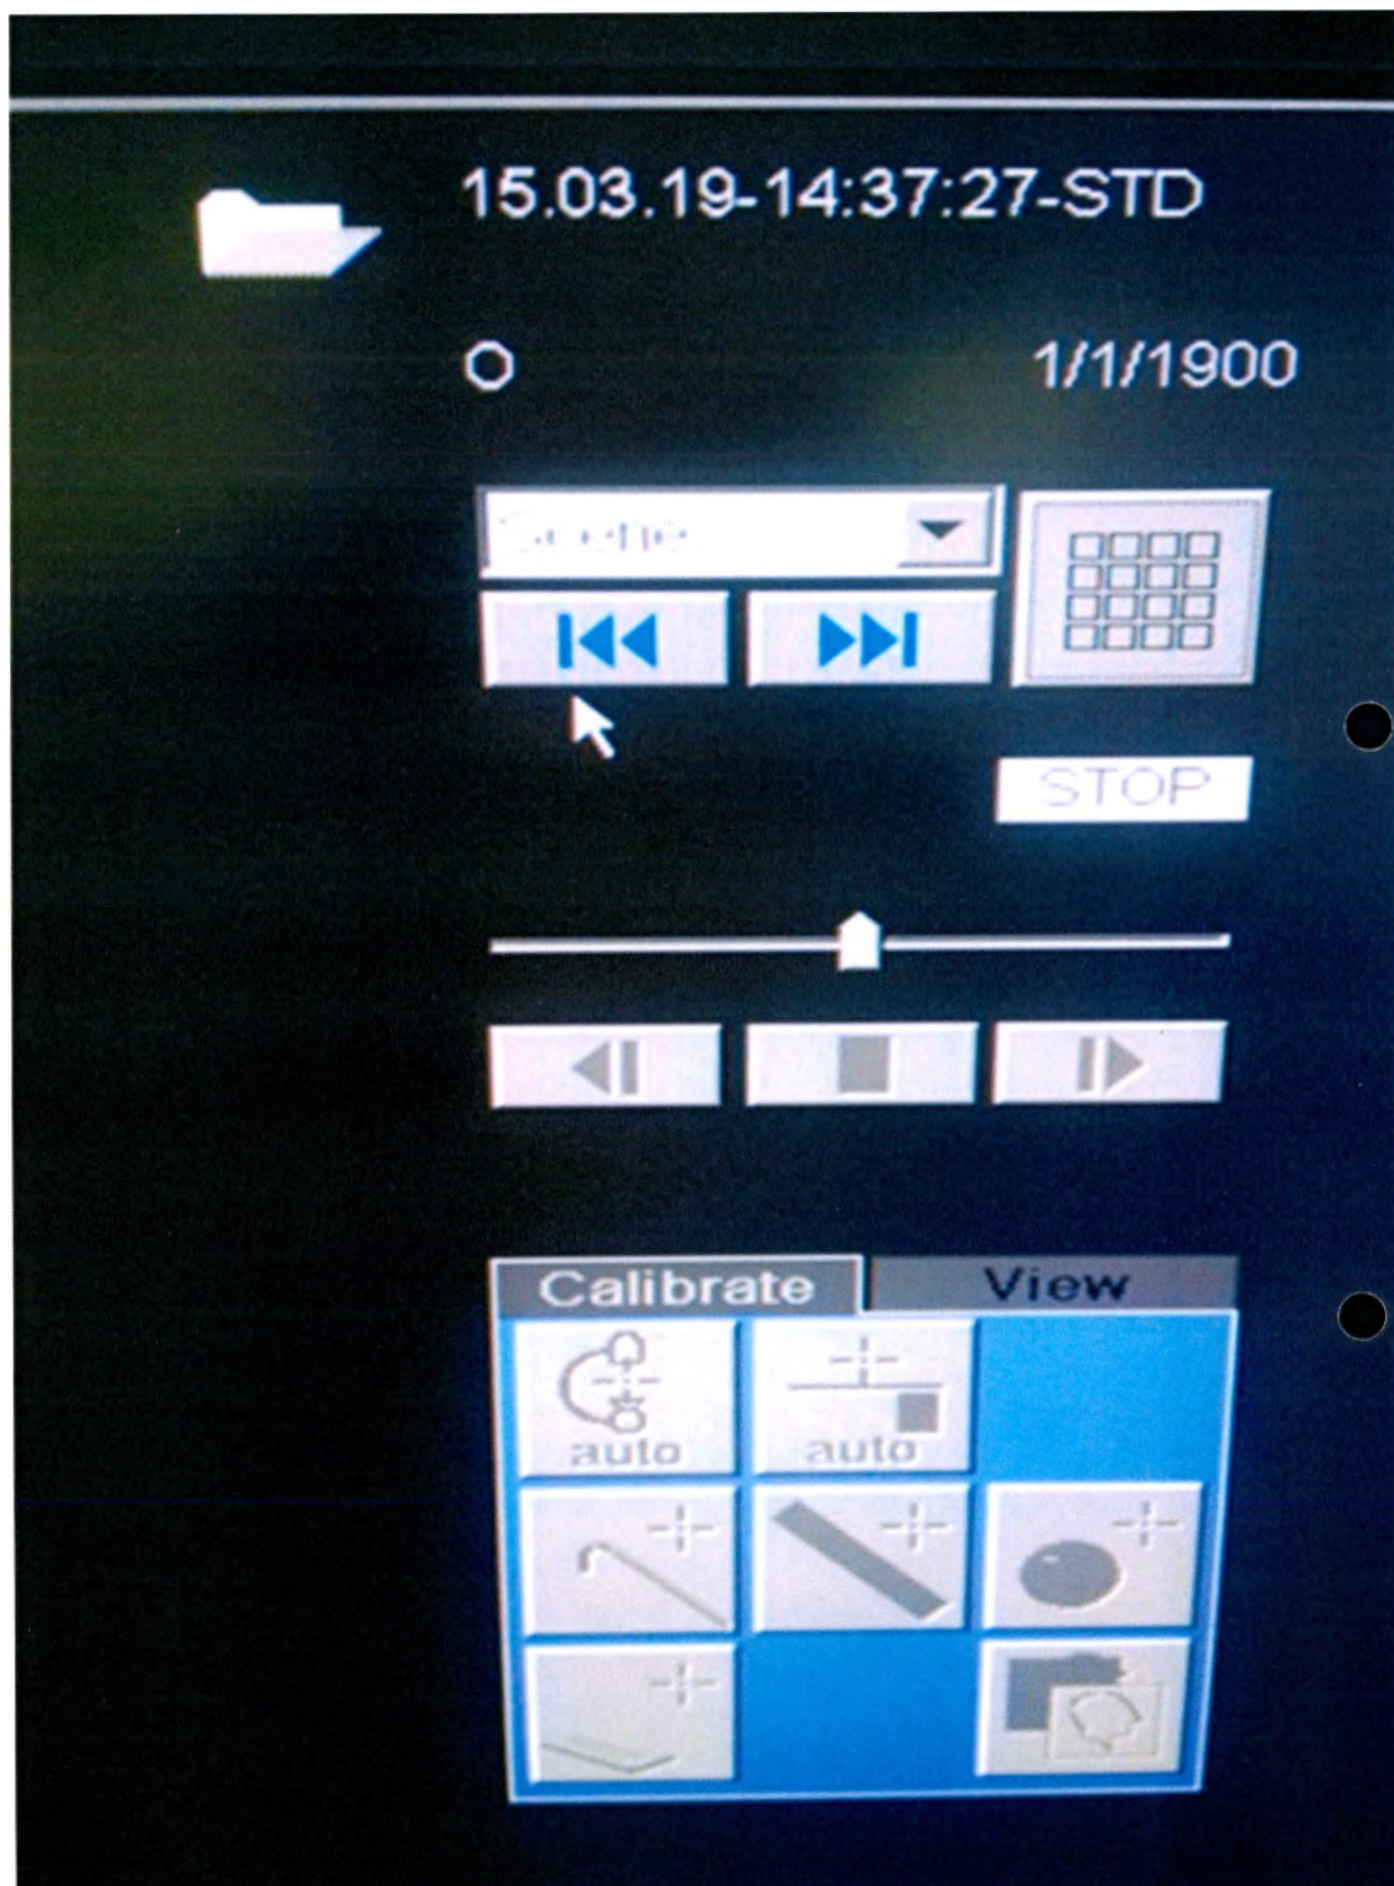


23. Программный режим позиционирования системы по выбранному референсному изображению
Автокартирование.

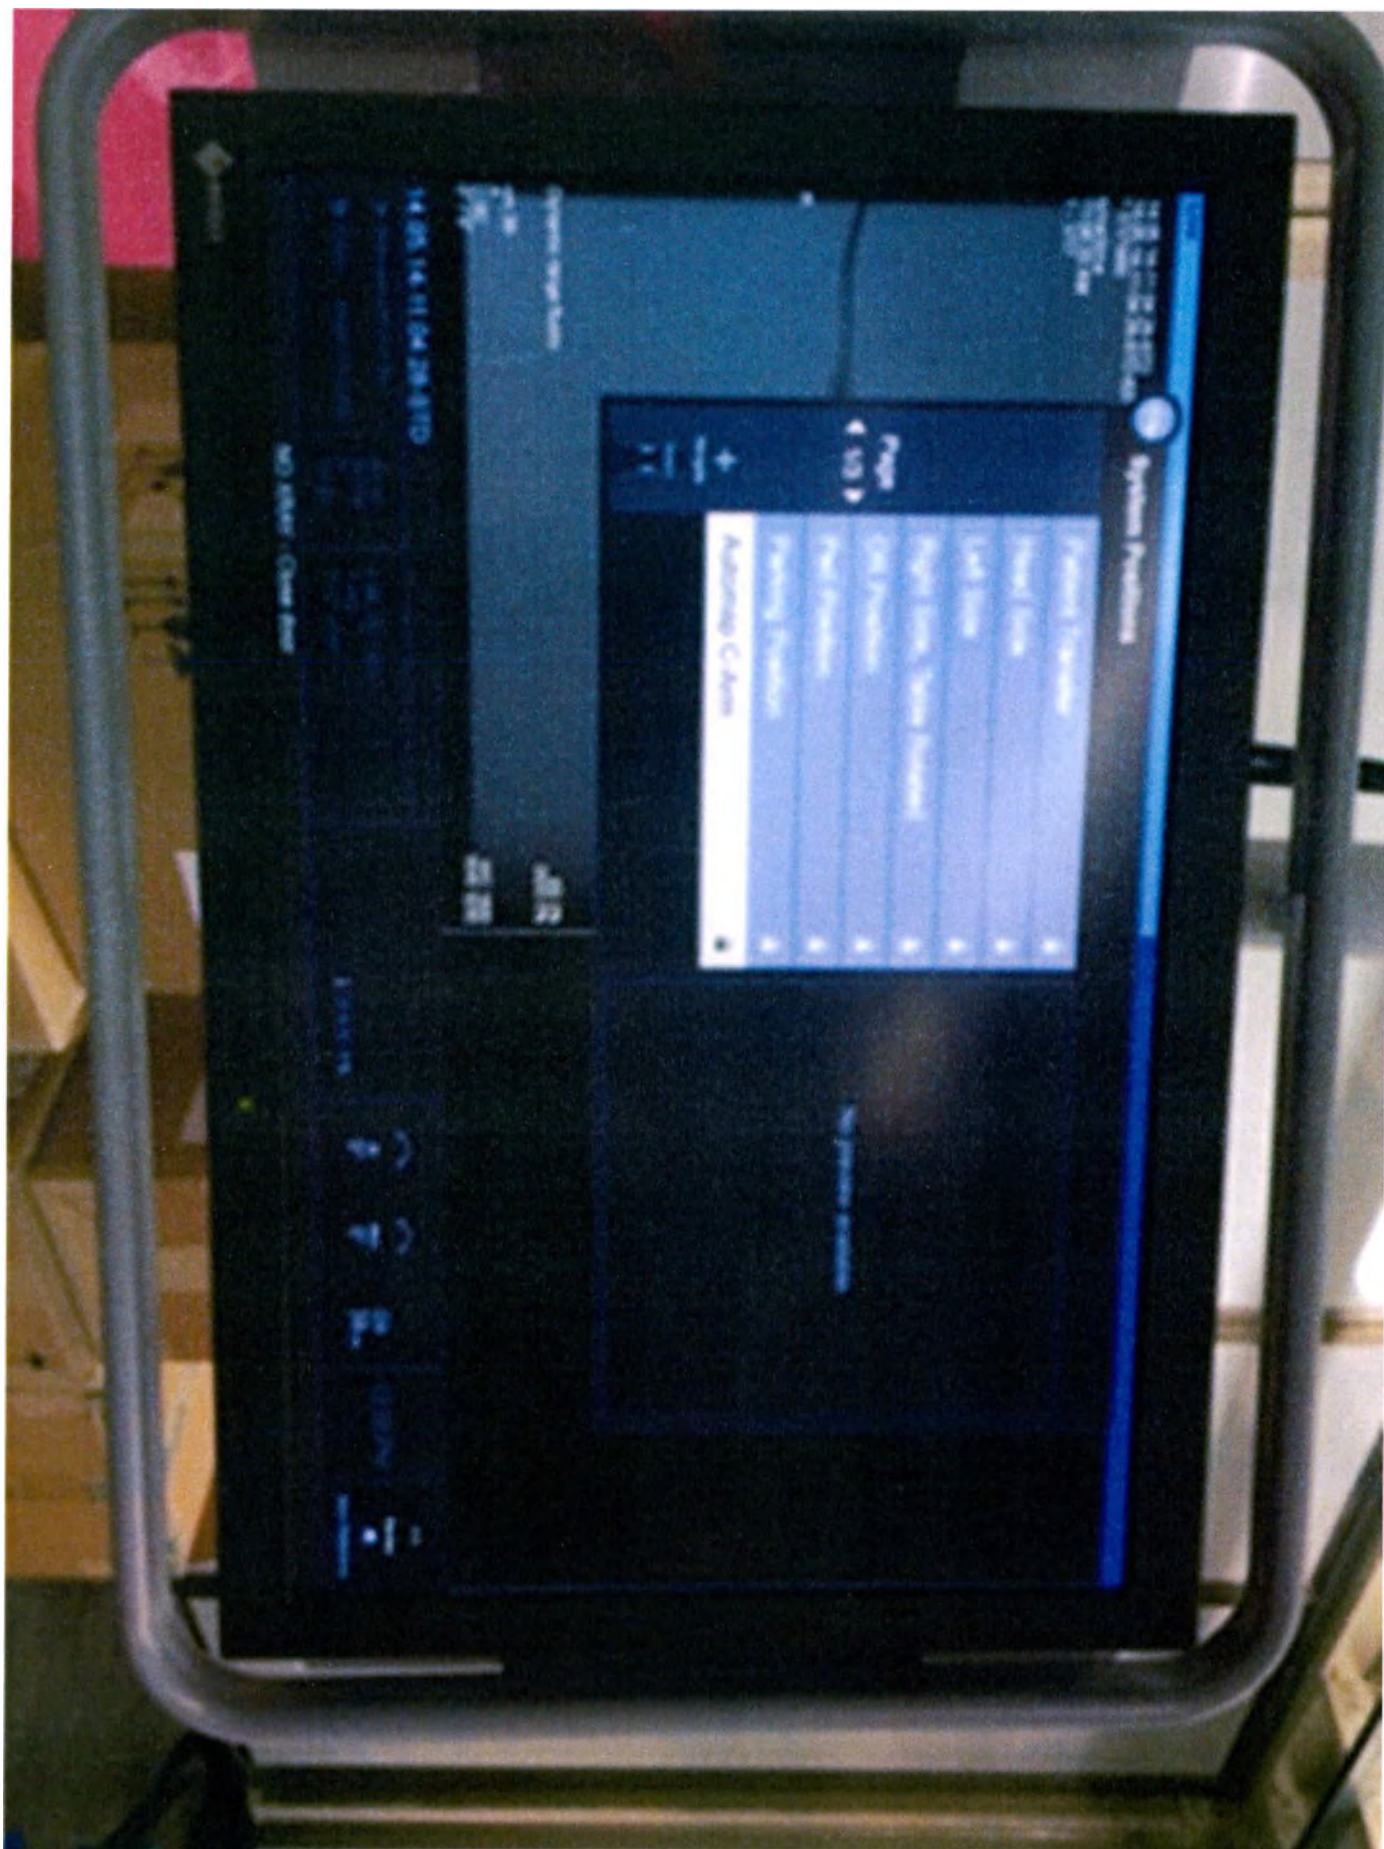

24. Программный режим поиска и регистрации в системе RIS, запрос рабочего списка Worklist.

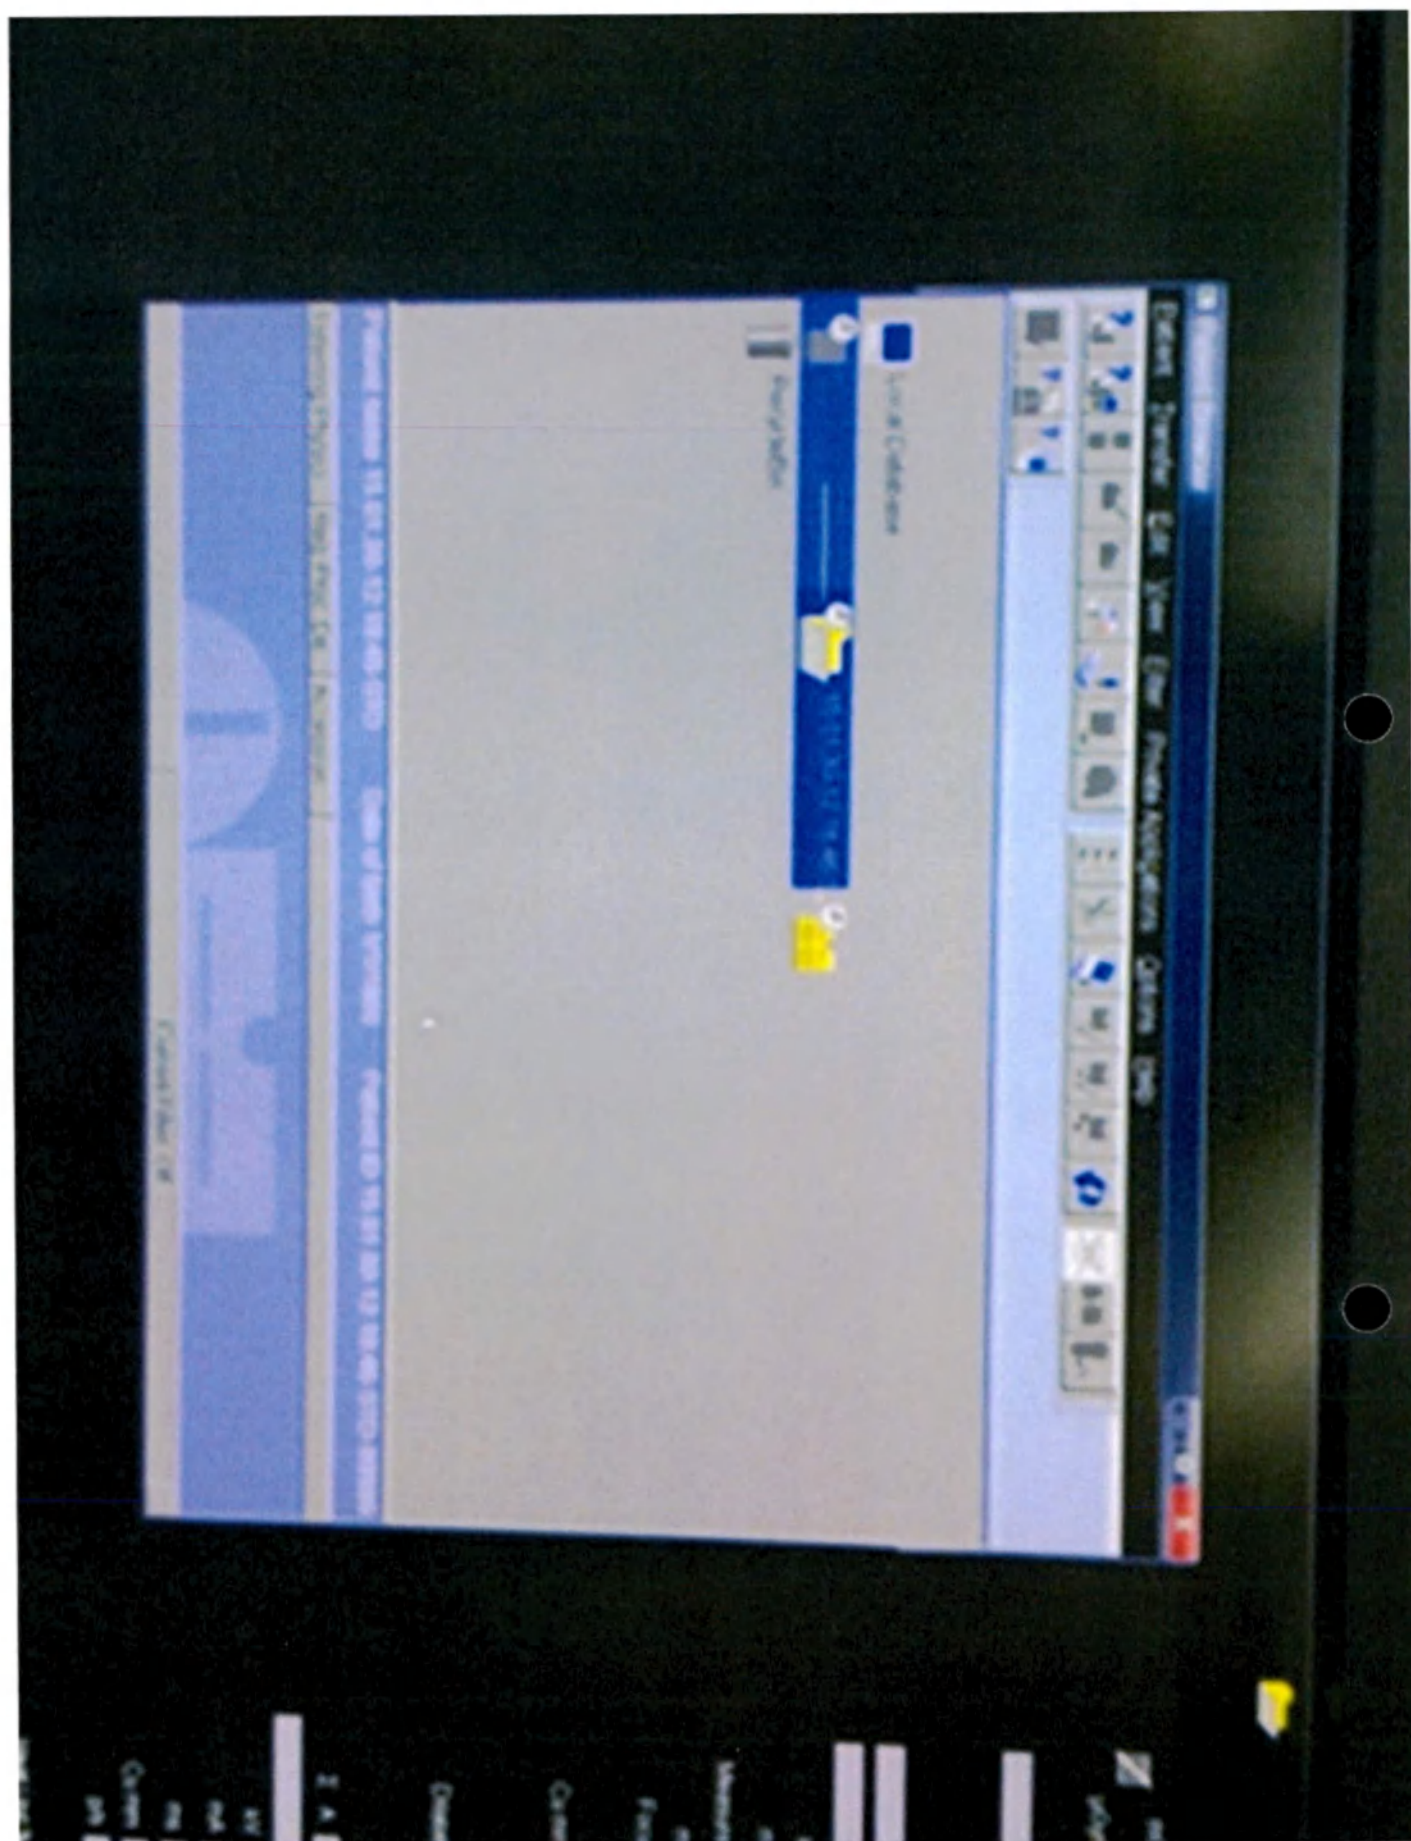

25. Программный режим отслеживания процедуры с помощью MPPS.

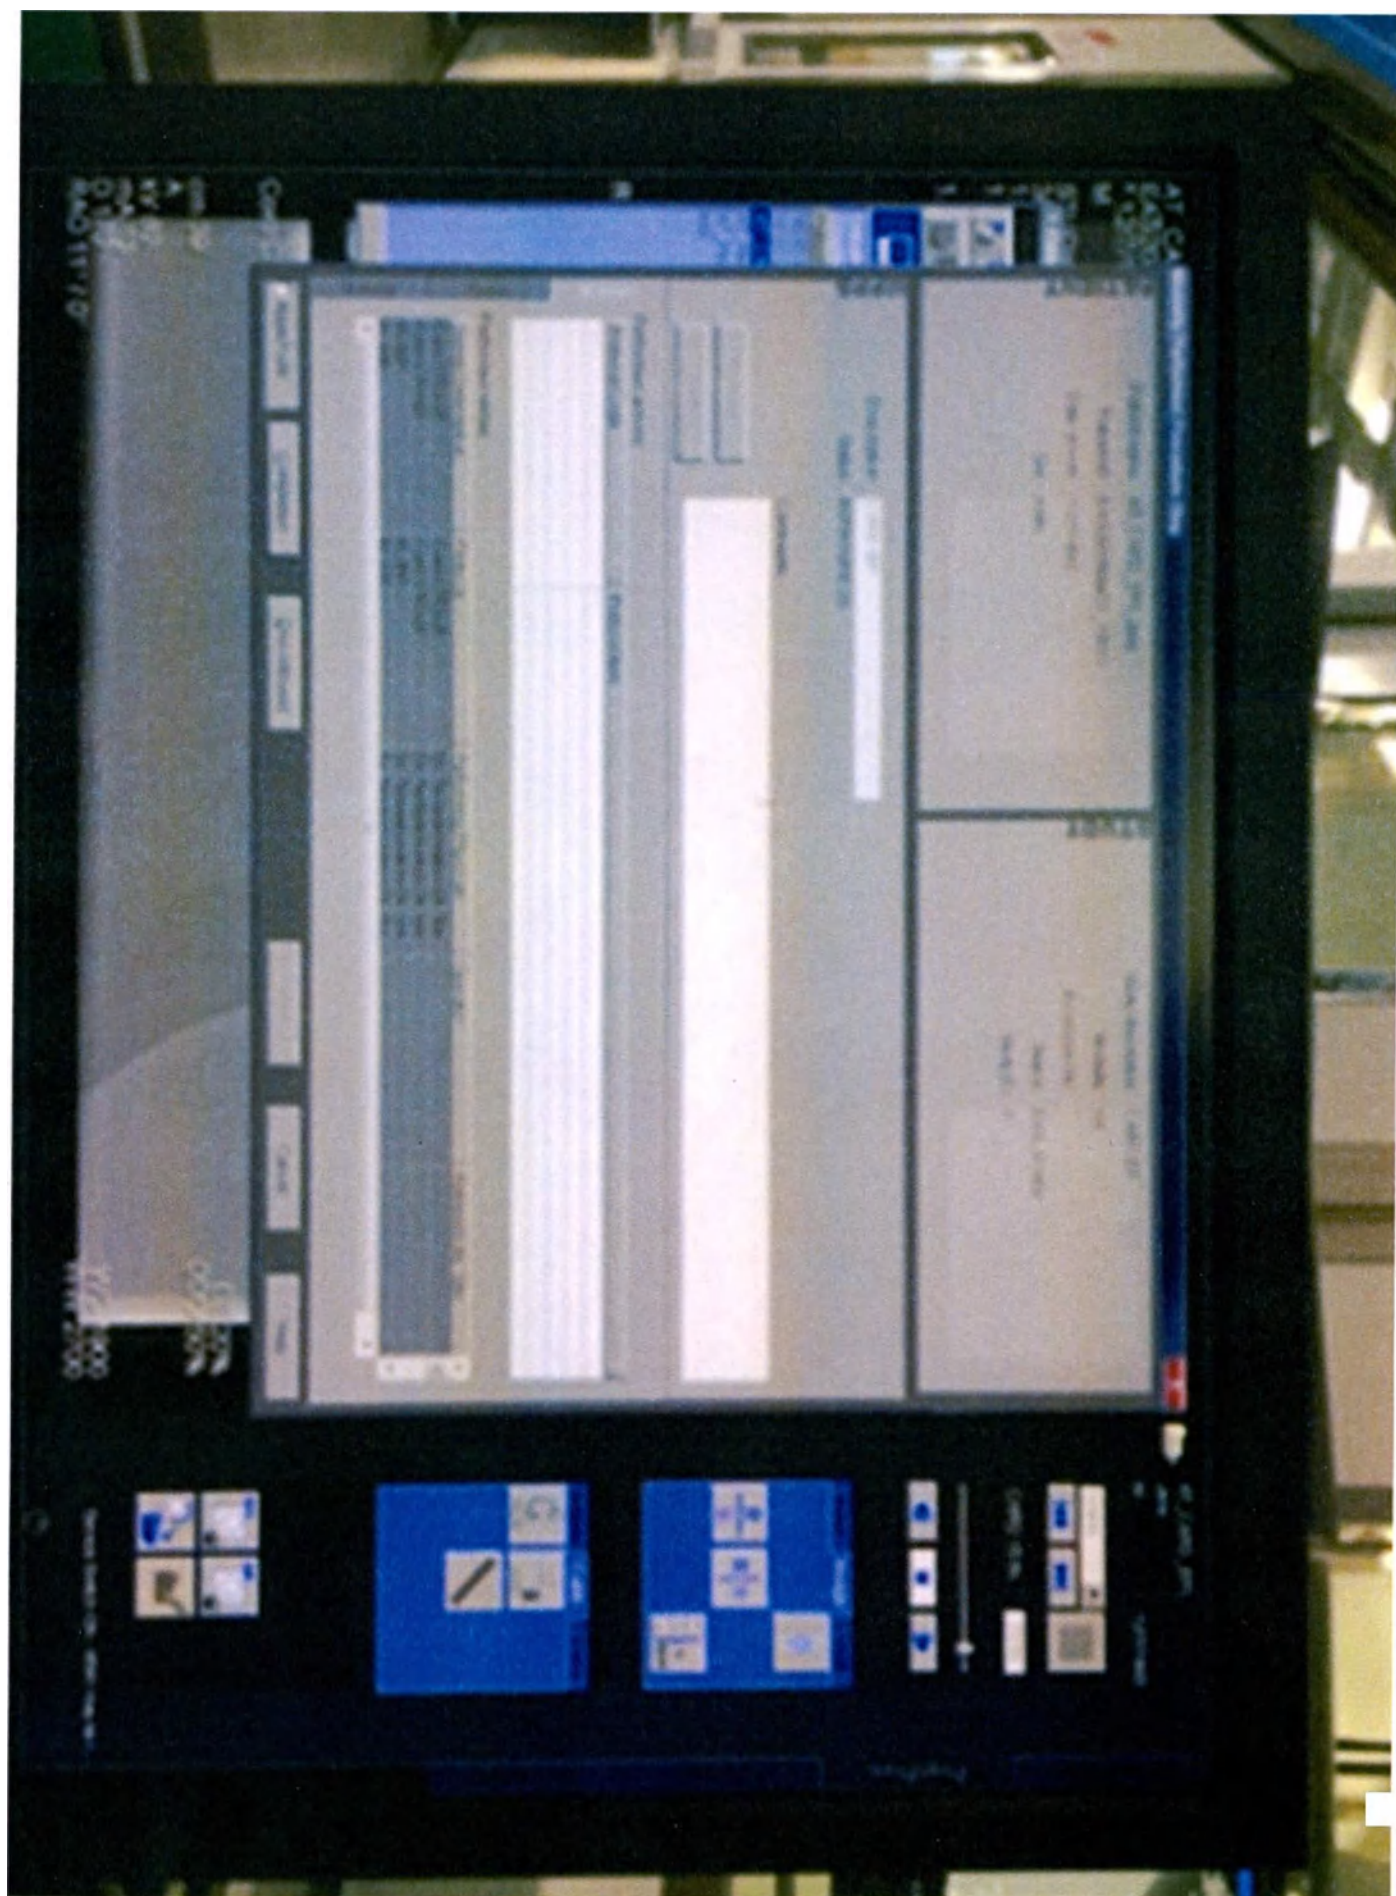

26. Программный режим вывода изображений на печать.



27. Устройство сопряжения для подключения к сети.



28. ЖК-дисплей в операционной дополнительный.




29. Кабели подключения дополнительного ЖК-дисплея в операционной (не более 15 шт.).



30. Источник бесперебойного питания.



31. Крепление для инжектора на стене, специальный зажим.

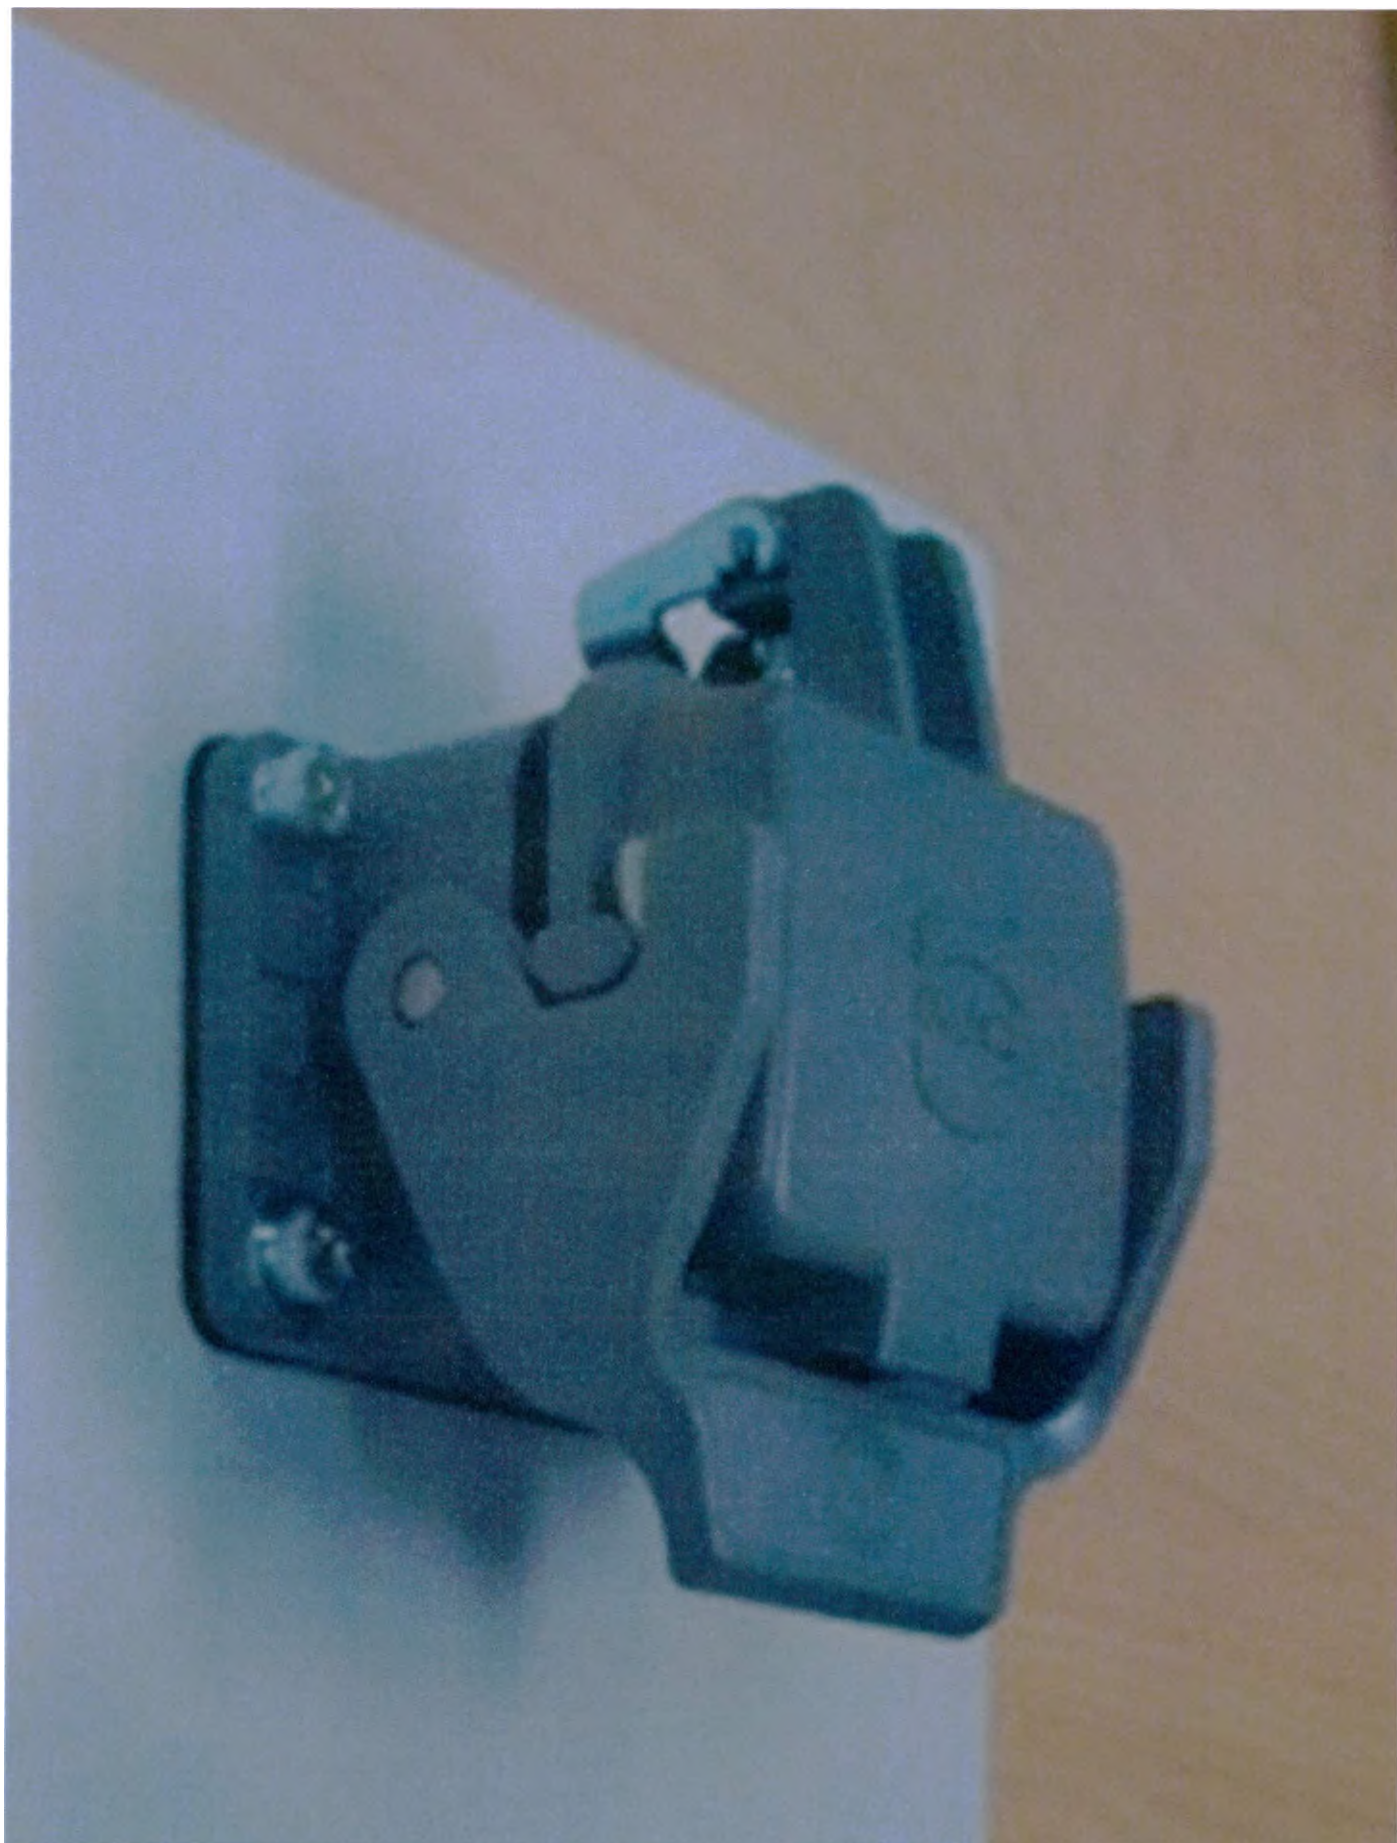


32. Разъем для подключения инжектора в пультовой.




33. Устройство переговорное, в составе:

- кабели подключения (не более 3 шт.);
- блок переговорного устройства;
- динамик;
- микрофон.



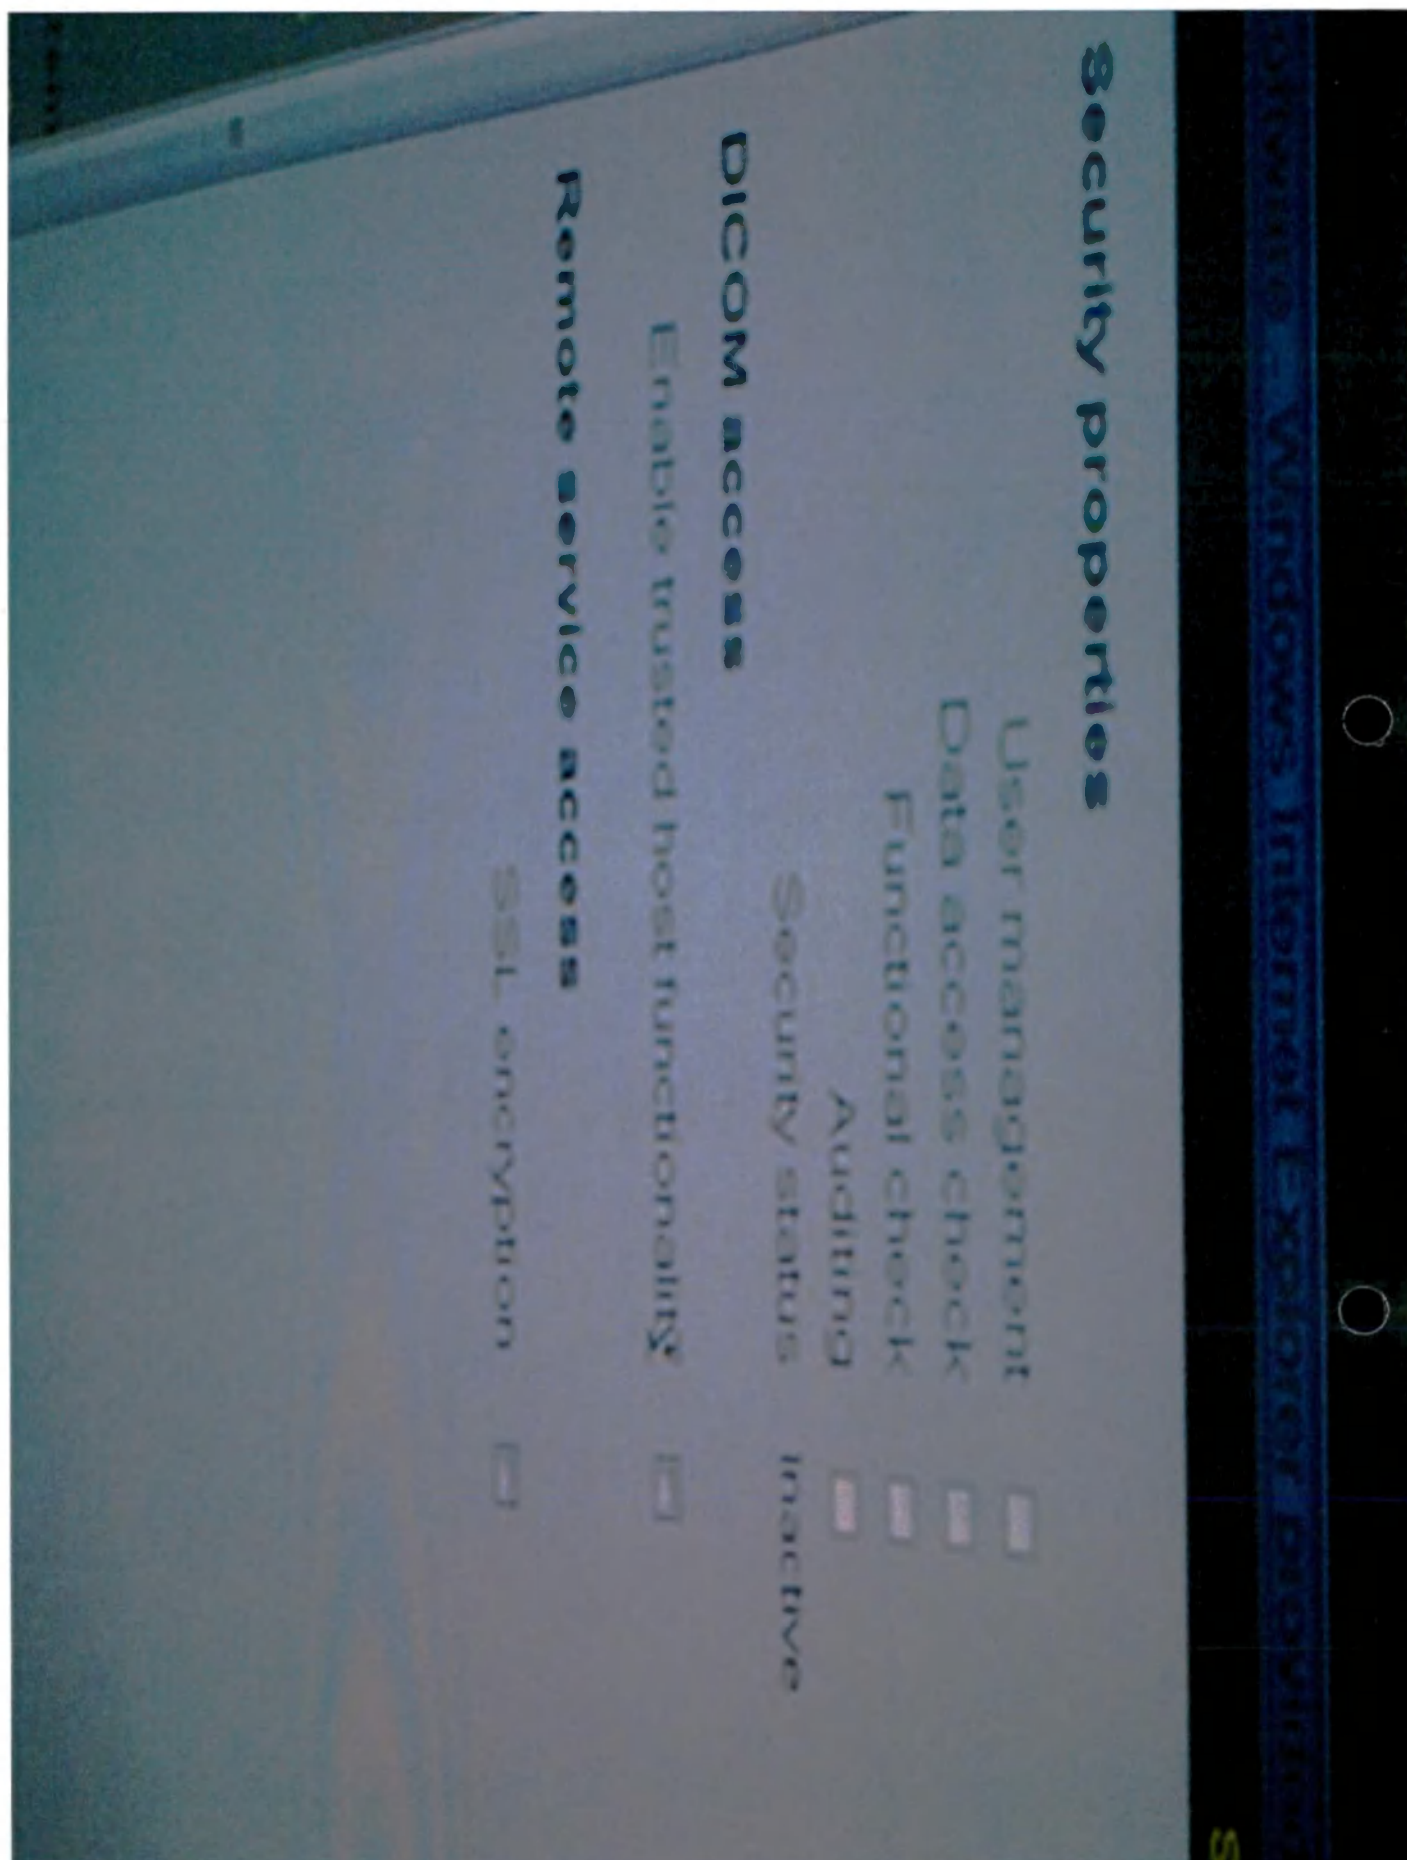

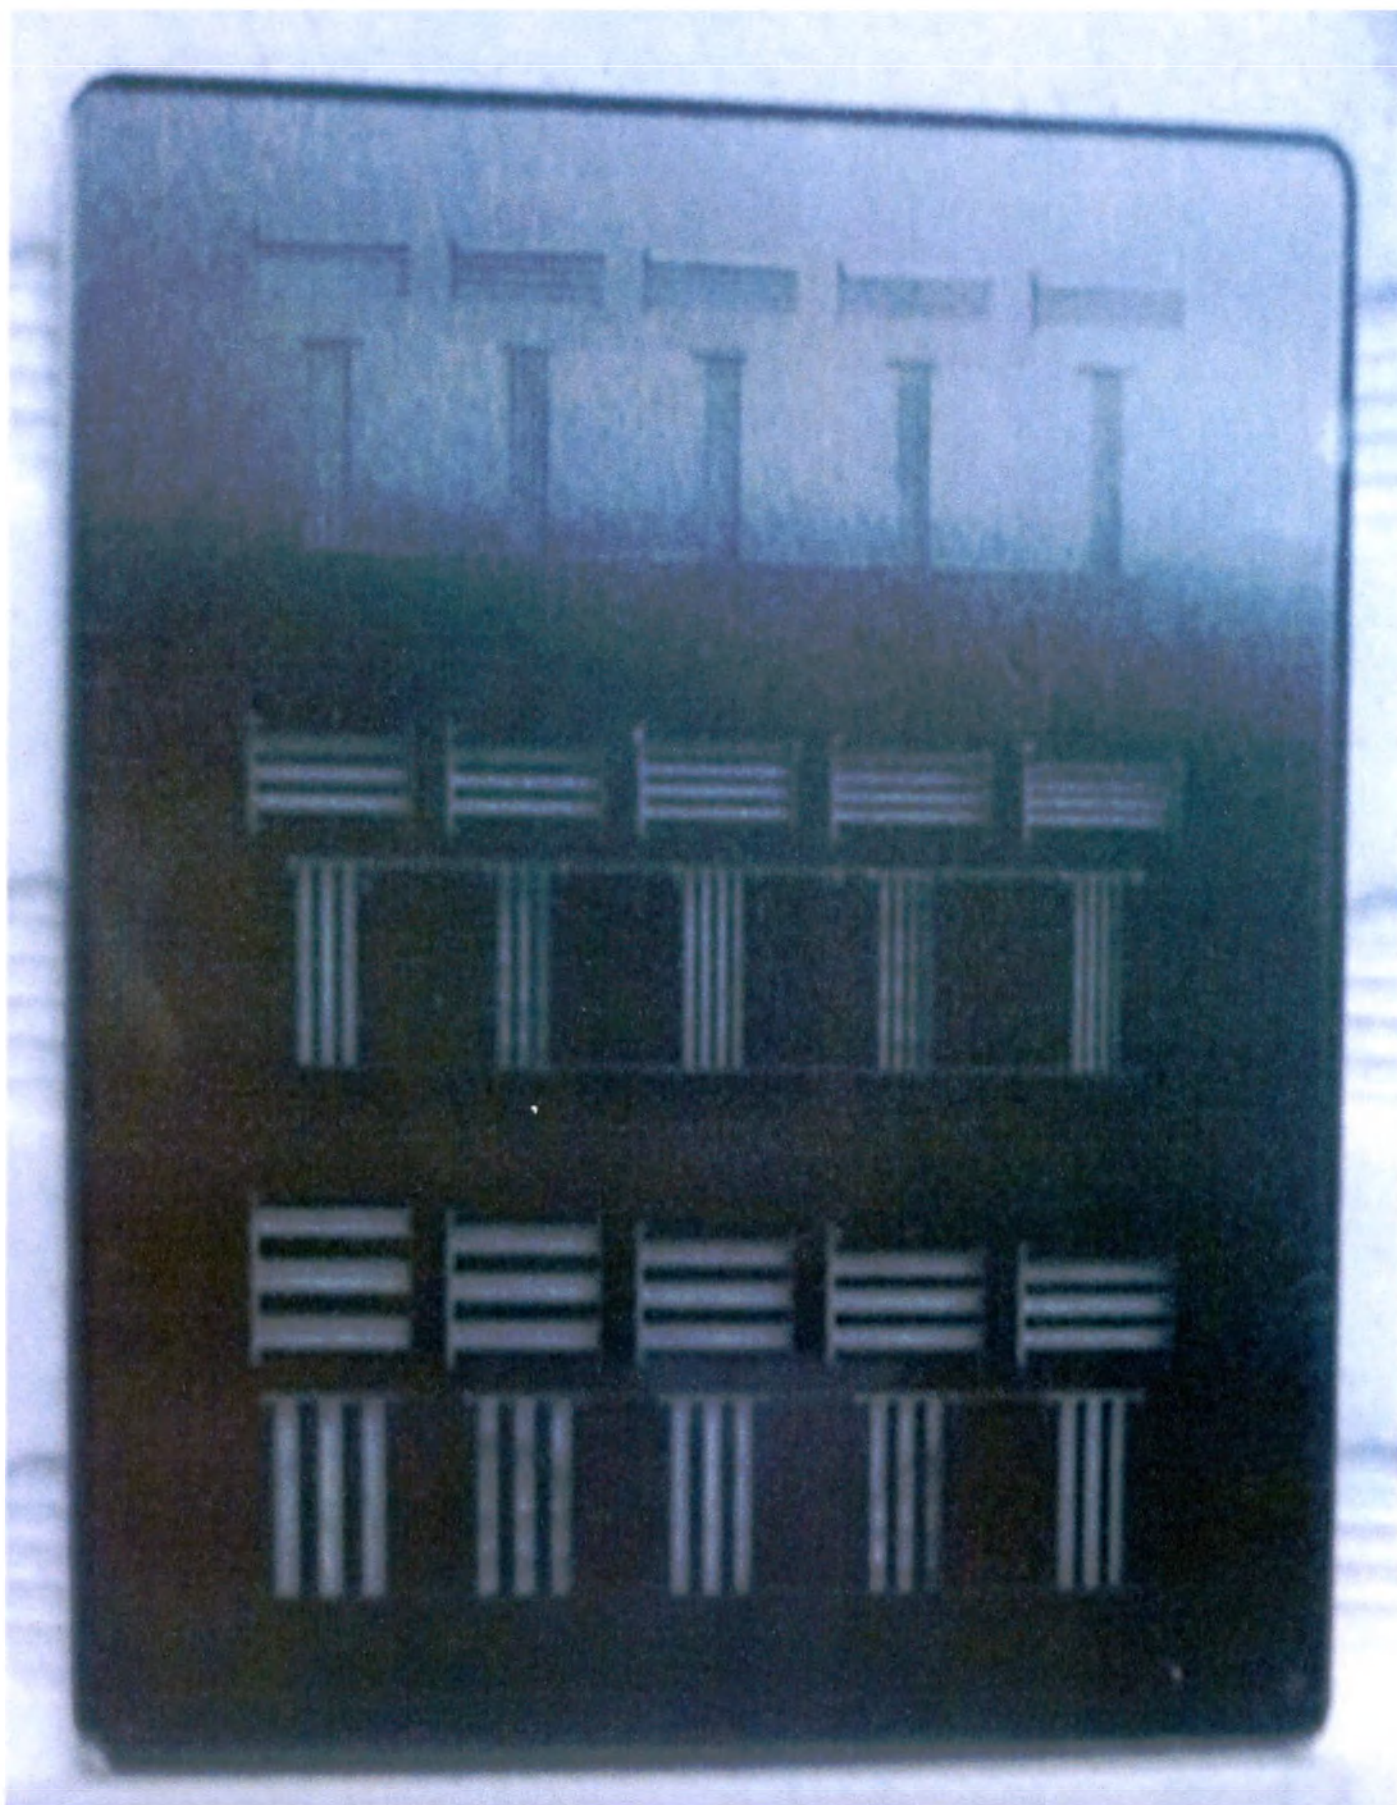

36. Кронштейн для сосуда инфузионной системы.



37. Кабельные зажимы для крепления ЭКГ-кабелей (не более 10 шт.).



38. Держатель с направляющей для перемещения по деке стола.



39. Держатель для установки принадлежностей со стороны головы пациента.



40. Столик для инструментов.



41. Клиновидная подкладка для головы.




42. Держатель головы для позиционирования головы пациента в положении лежа на животе.



43. Подкладка для головы, углубленная.



44. Подкладка для головы, плоская.

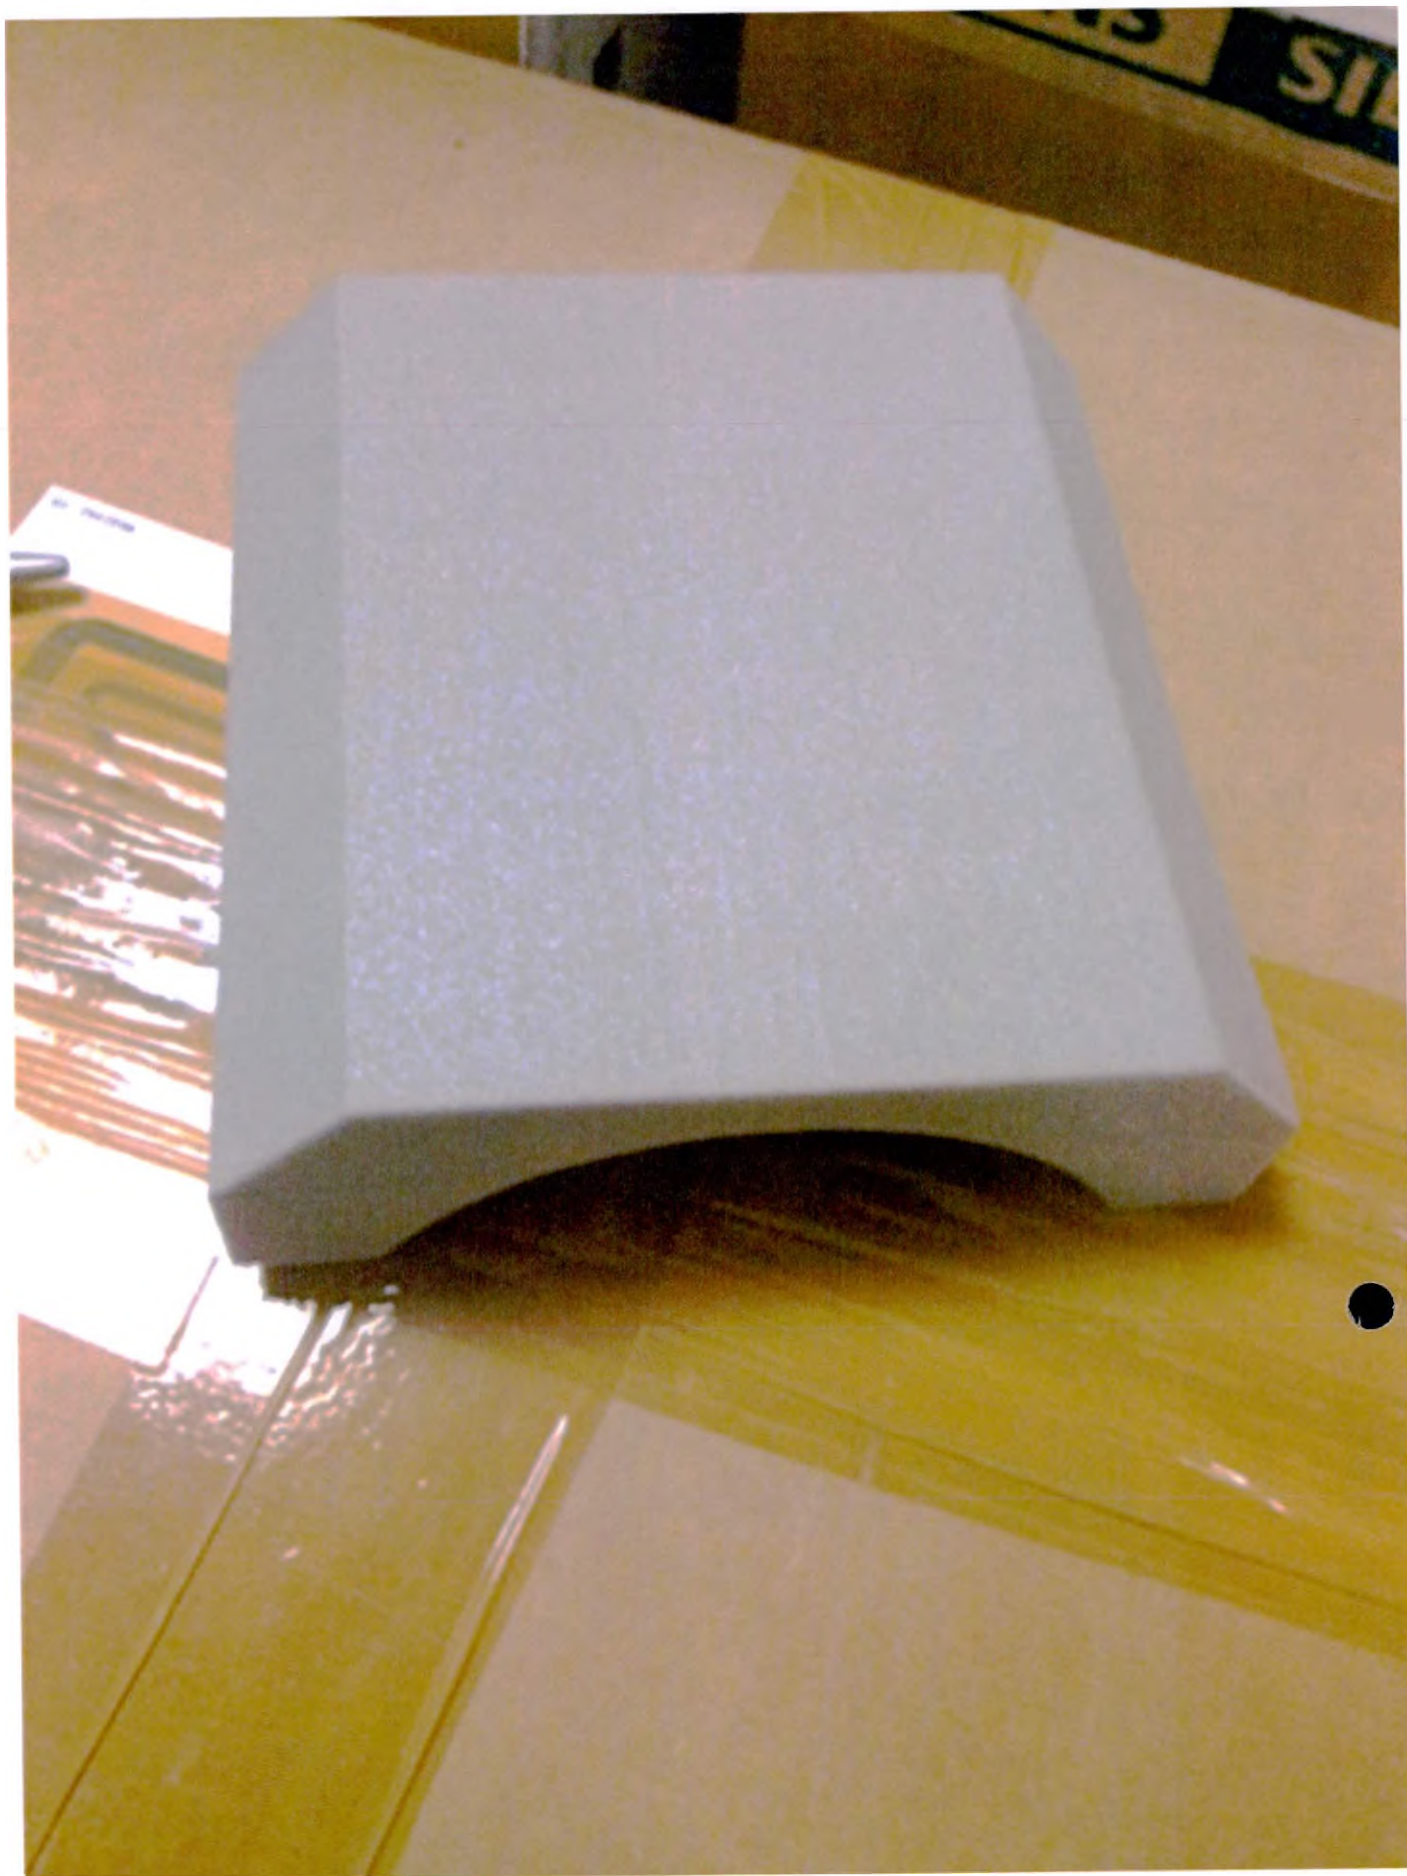

45. Ручки (2 шт.).



46. Поручни с опорами.



47. Опоры для рук (2 шт.).



48. Опора для рук, односторонняя.



49. Опора для руки, шарнирная.



50. Держатели рук (2 шт.).



51. Ремни фиксации тела (2 шт.).



52. Чехлы защитные, одноразовые (не более 25 шт.).



53. Чехлы одноразовые, размера 1.



54. Чехлы одноразовые, размера 2 (не более 100 шт.).




55. Чехлы одноразовые, размера 3 (не более 80 шт.).



56. Чехлы одноразовые, размера 4 (не более 100 шт.).



57. Программный режим для работы с IVUS/OCT.

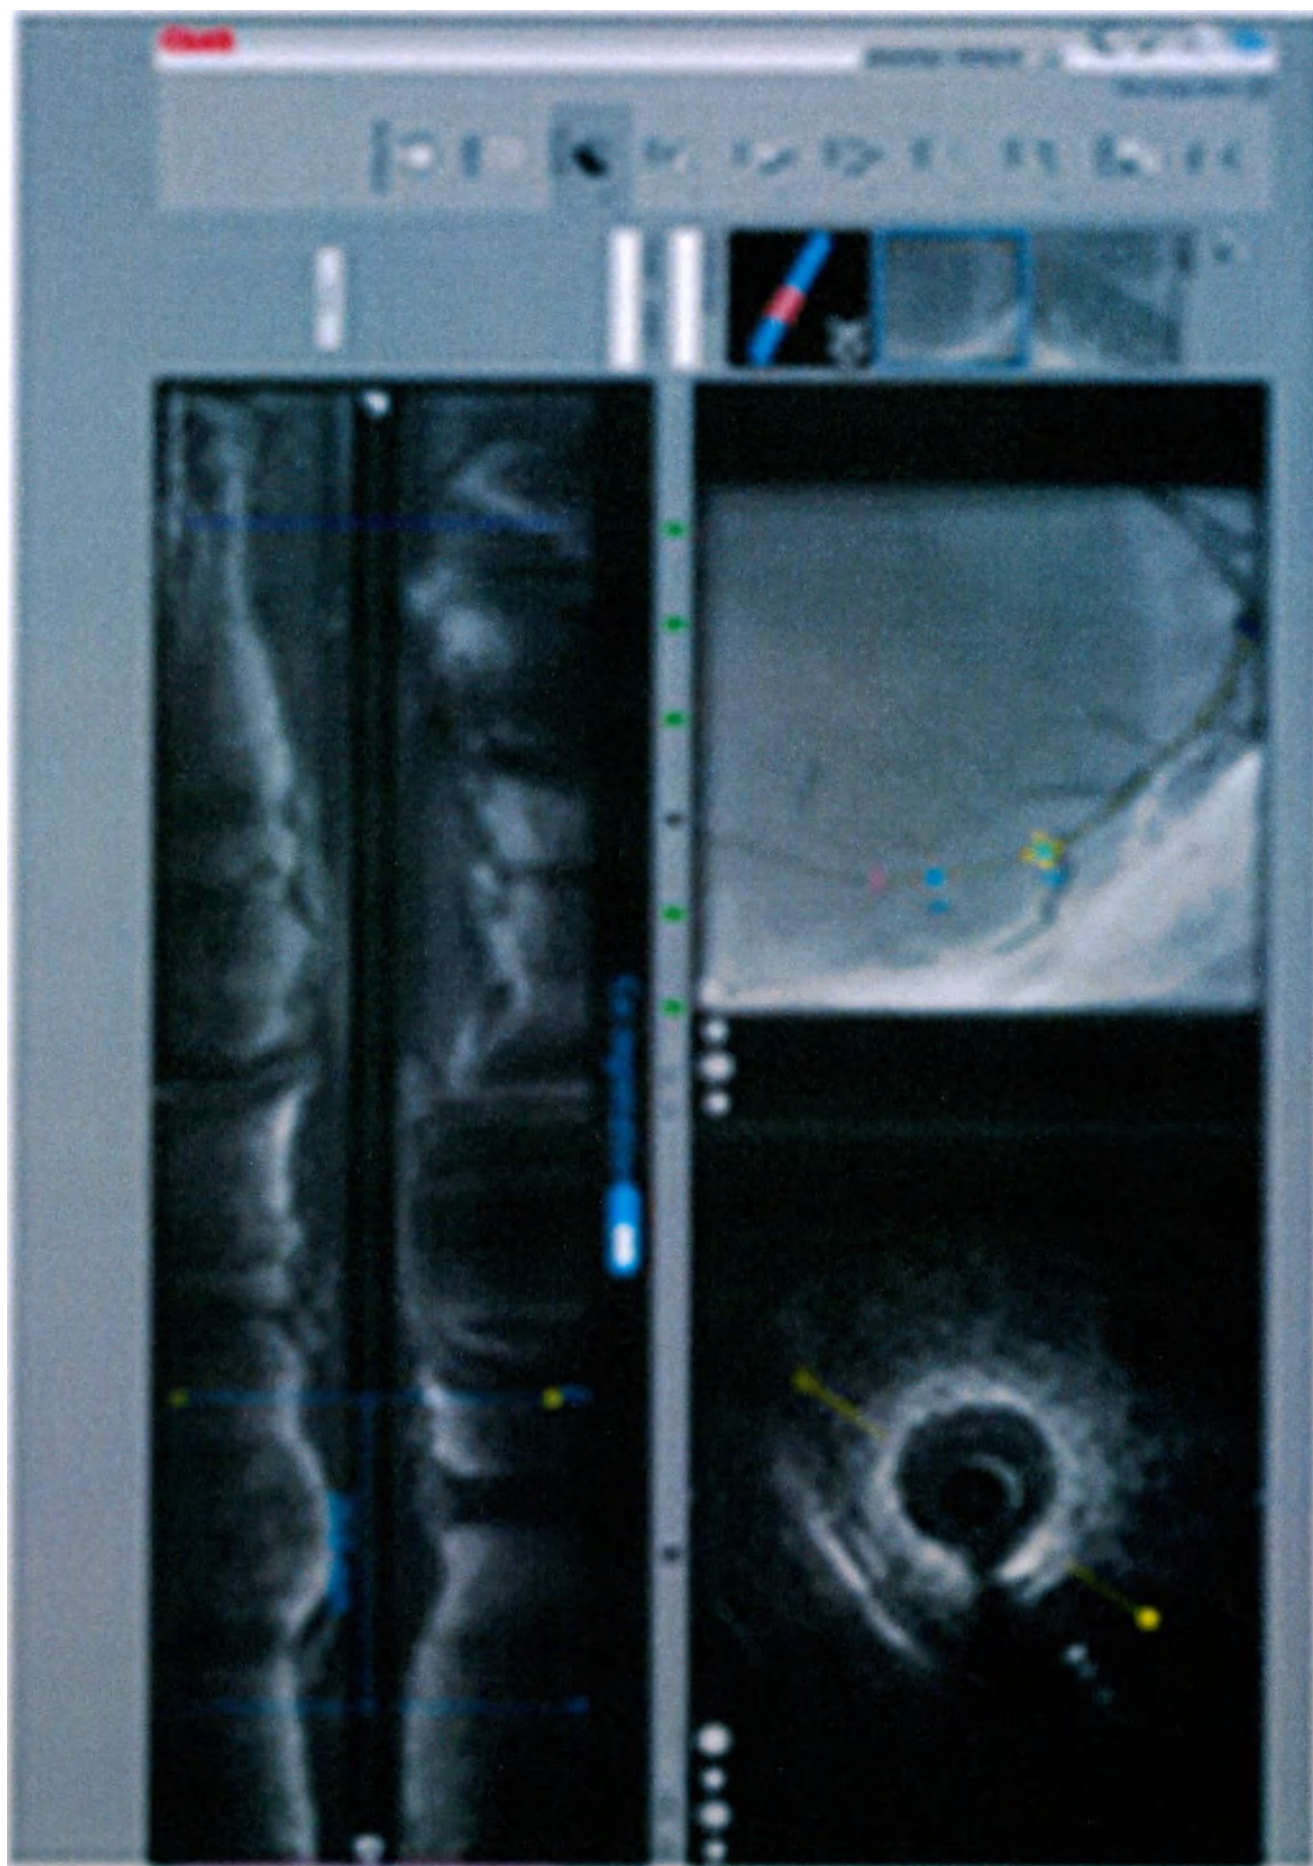

58. Программный режим для работы с IVUS/ОСТ дополнительный.






60. Устройство персональное для измерения дозовой нагрузки в режиме реального времени



61. Дополнительная съемная рельса для крепления аксессуаров

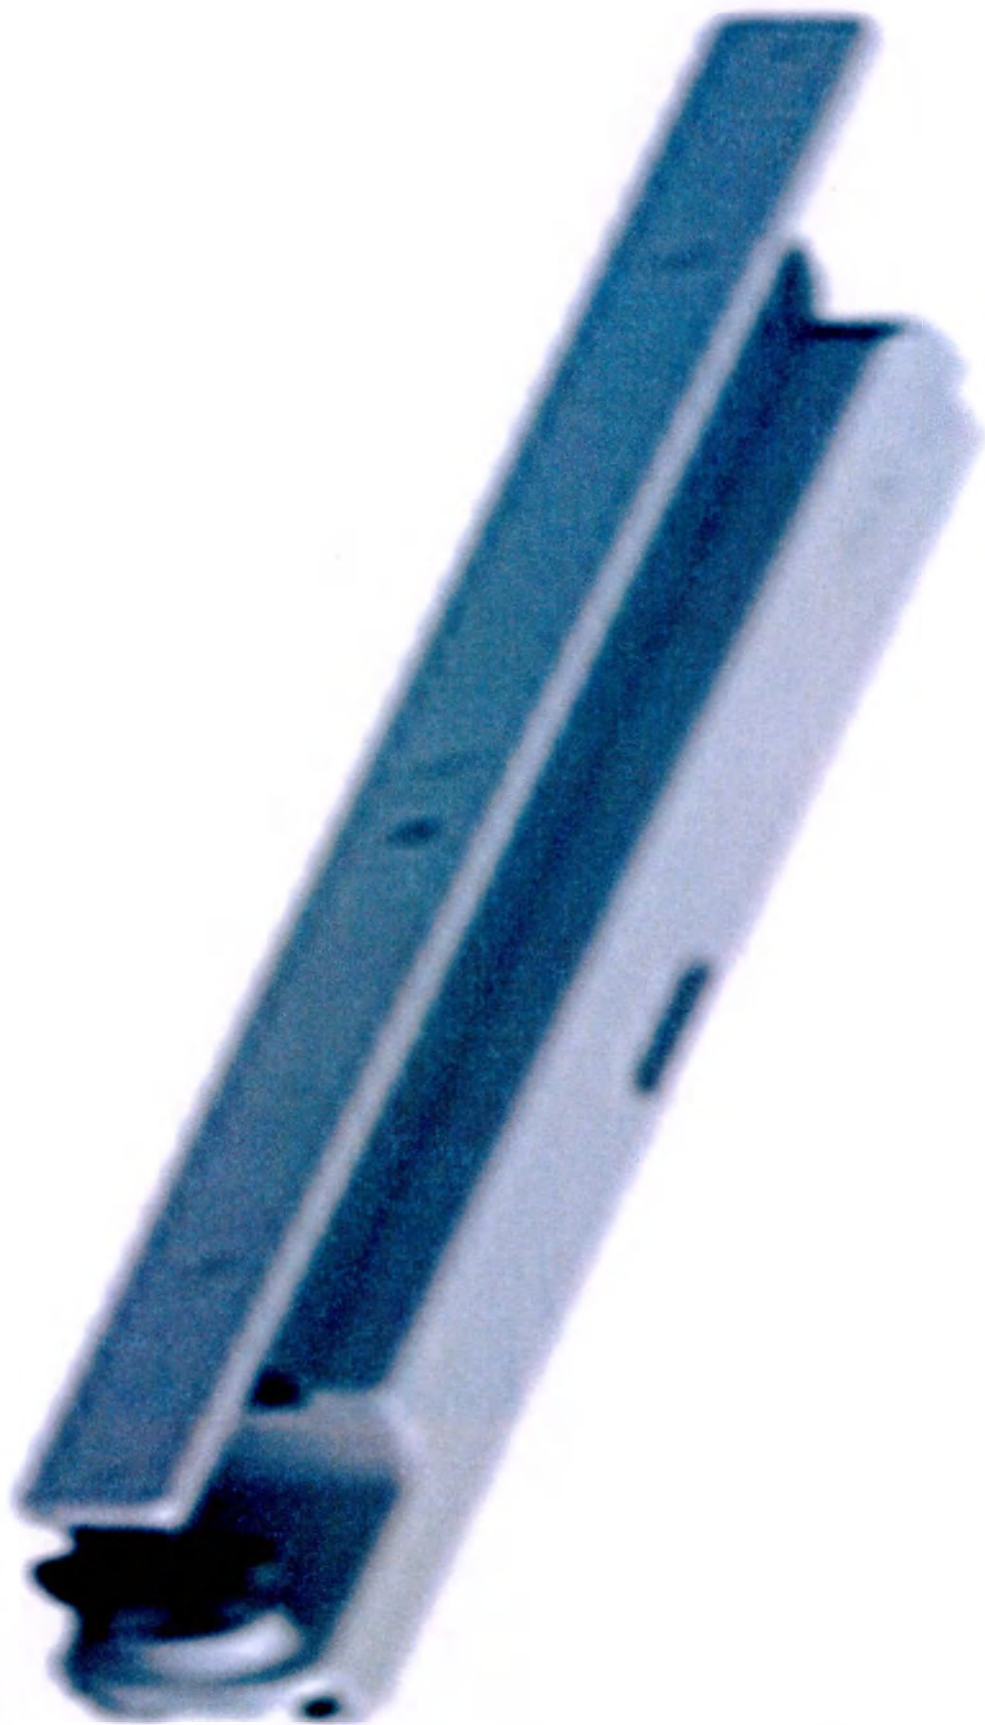

Всего прошито и пронумеровано
44 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

