

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТМС»
Сергеев Р.В.

«18» июля 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Монитор пациента серии GZ, варианты исполнения: GZ-130P, GZ-140P»

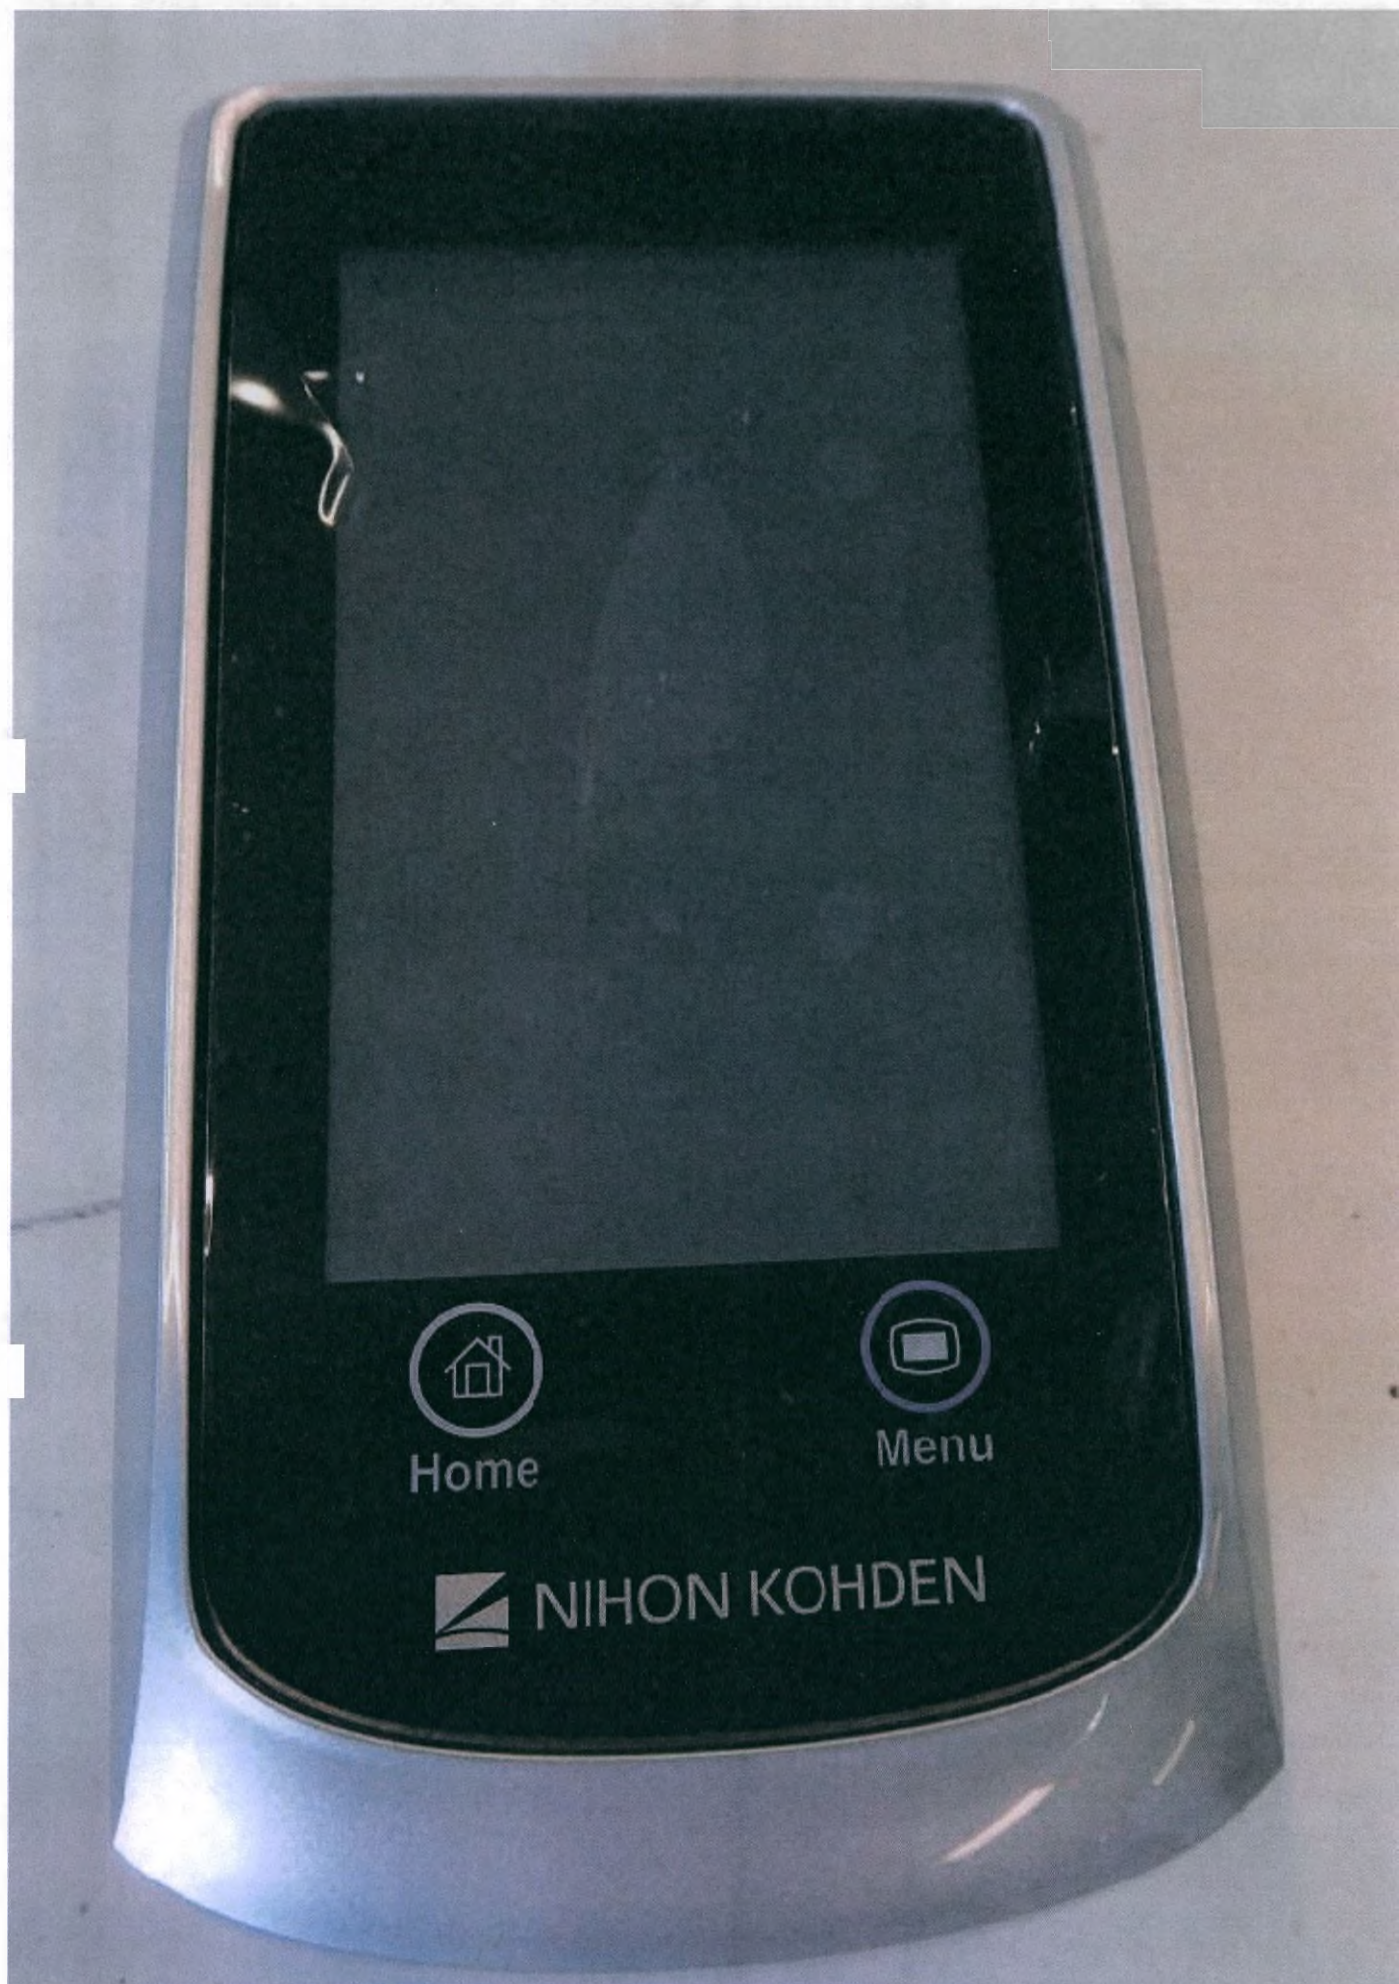


Рисунок 1. Монитор пациента GZ-130P. Передняя панель



Рисунок 2. Монитор пациента GZ-130P. Задняя панель



Рисунок 3. Монитор пациента GZ-130P. Верхняя панель.



Рисунок 4. Сумка для монитора пациента GZ-130P

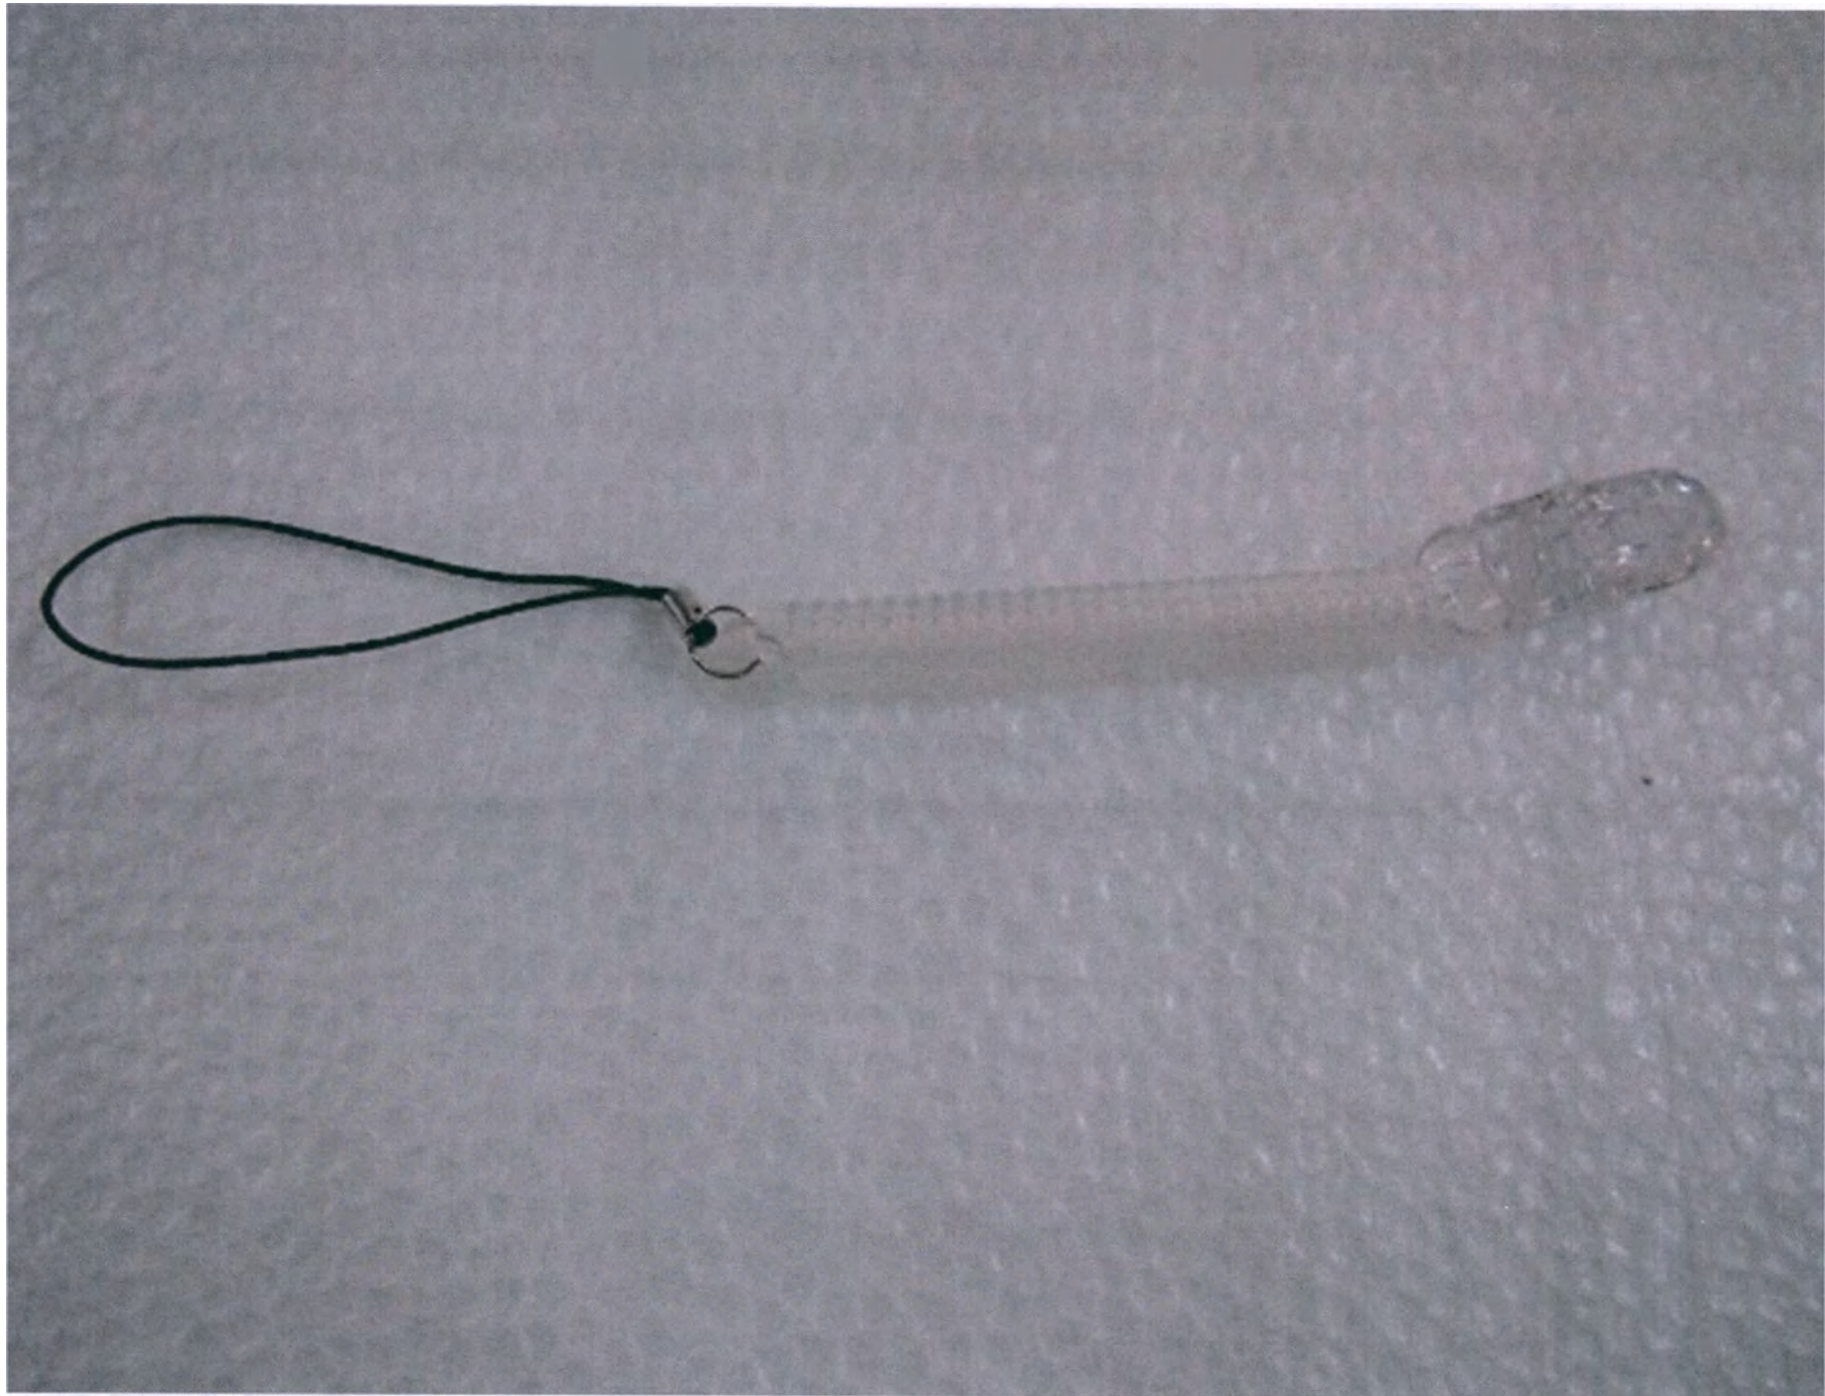


Рисунок 5. Ремешок

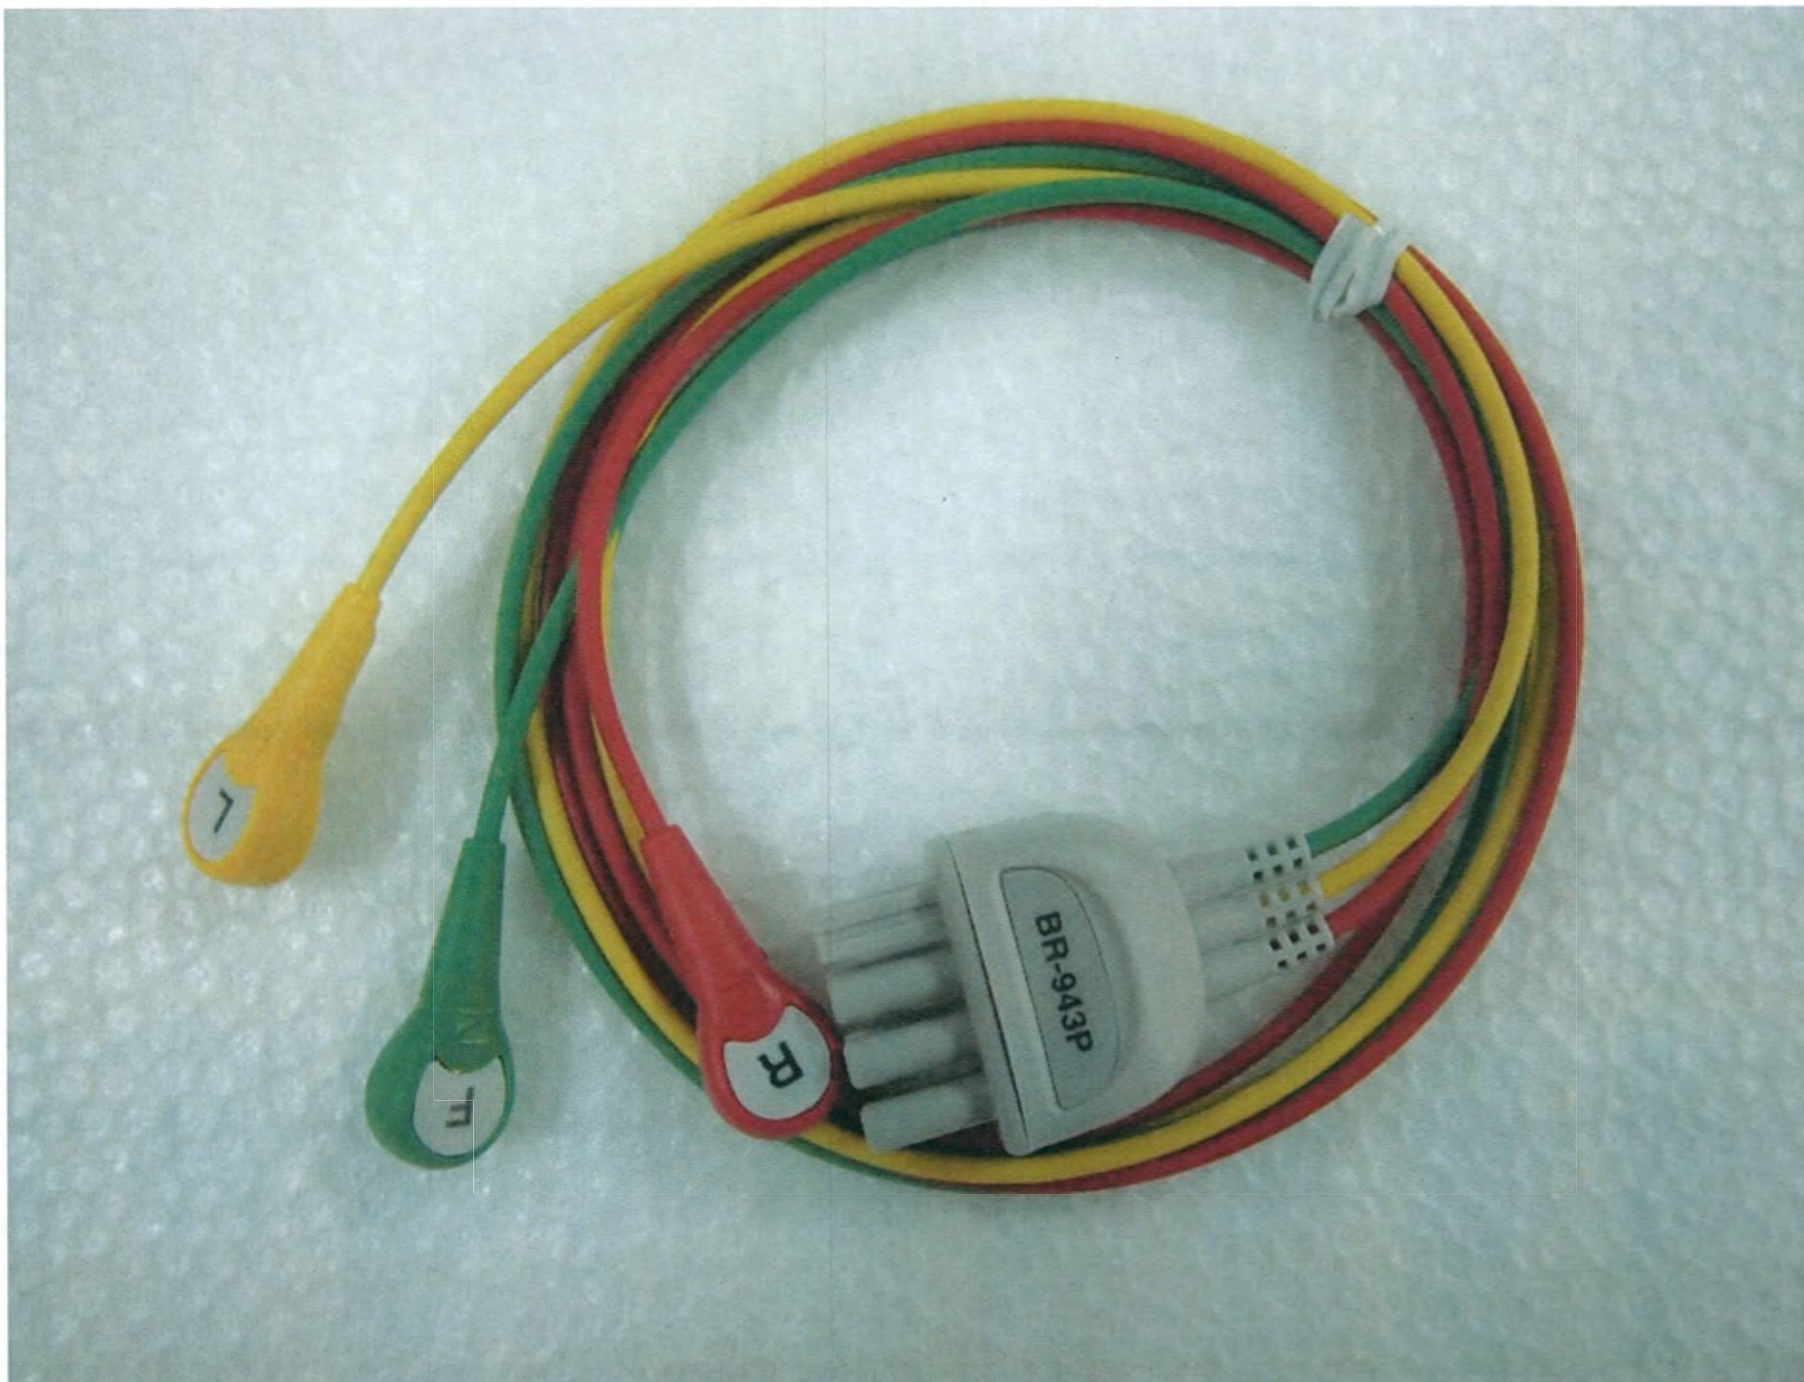


Рисунок 6. Кабель отведений ЭКГ на 3 электрода (клипса)

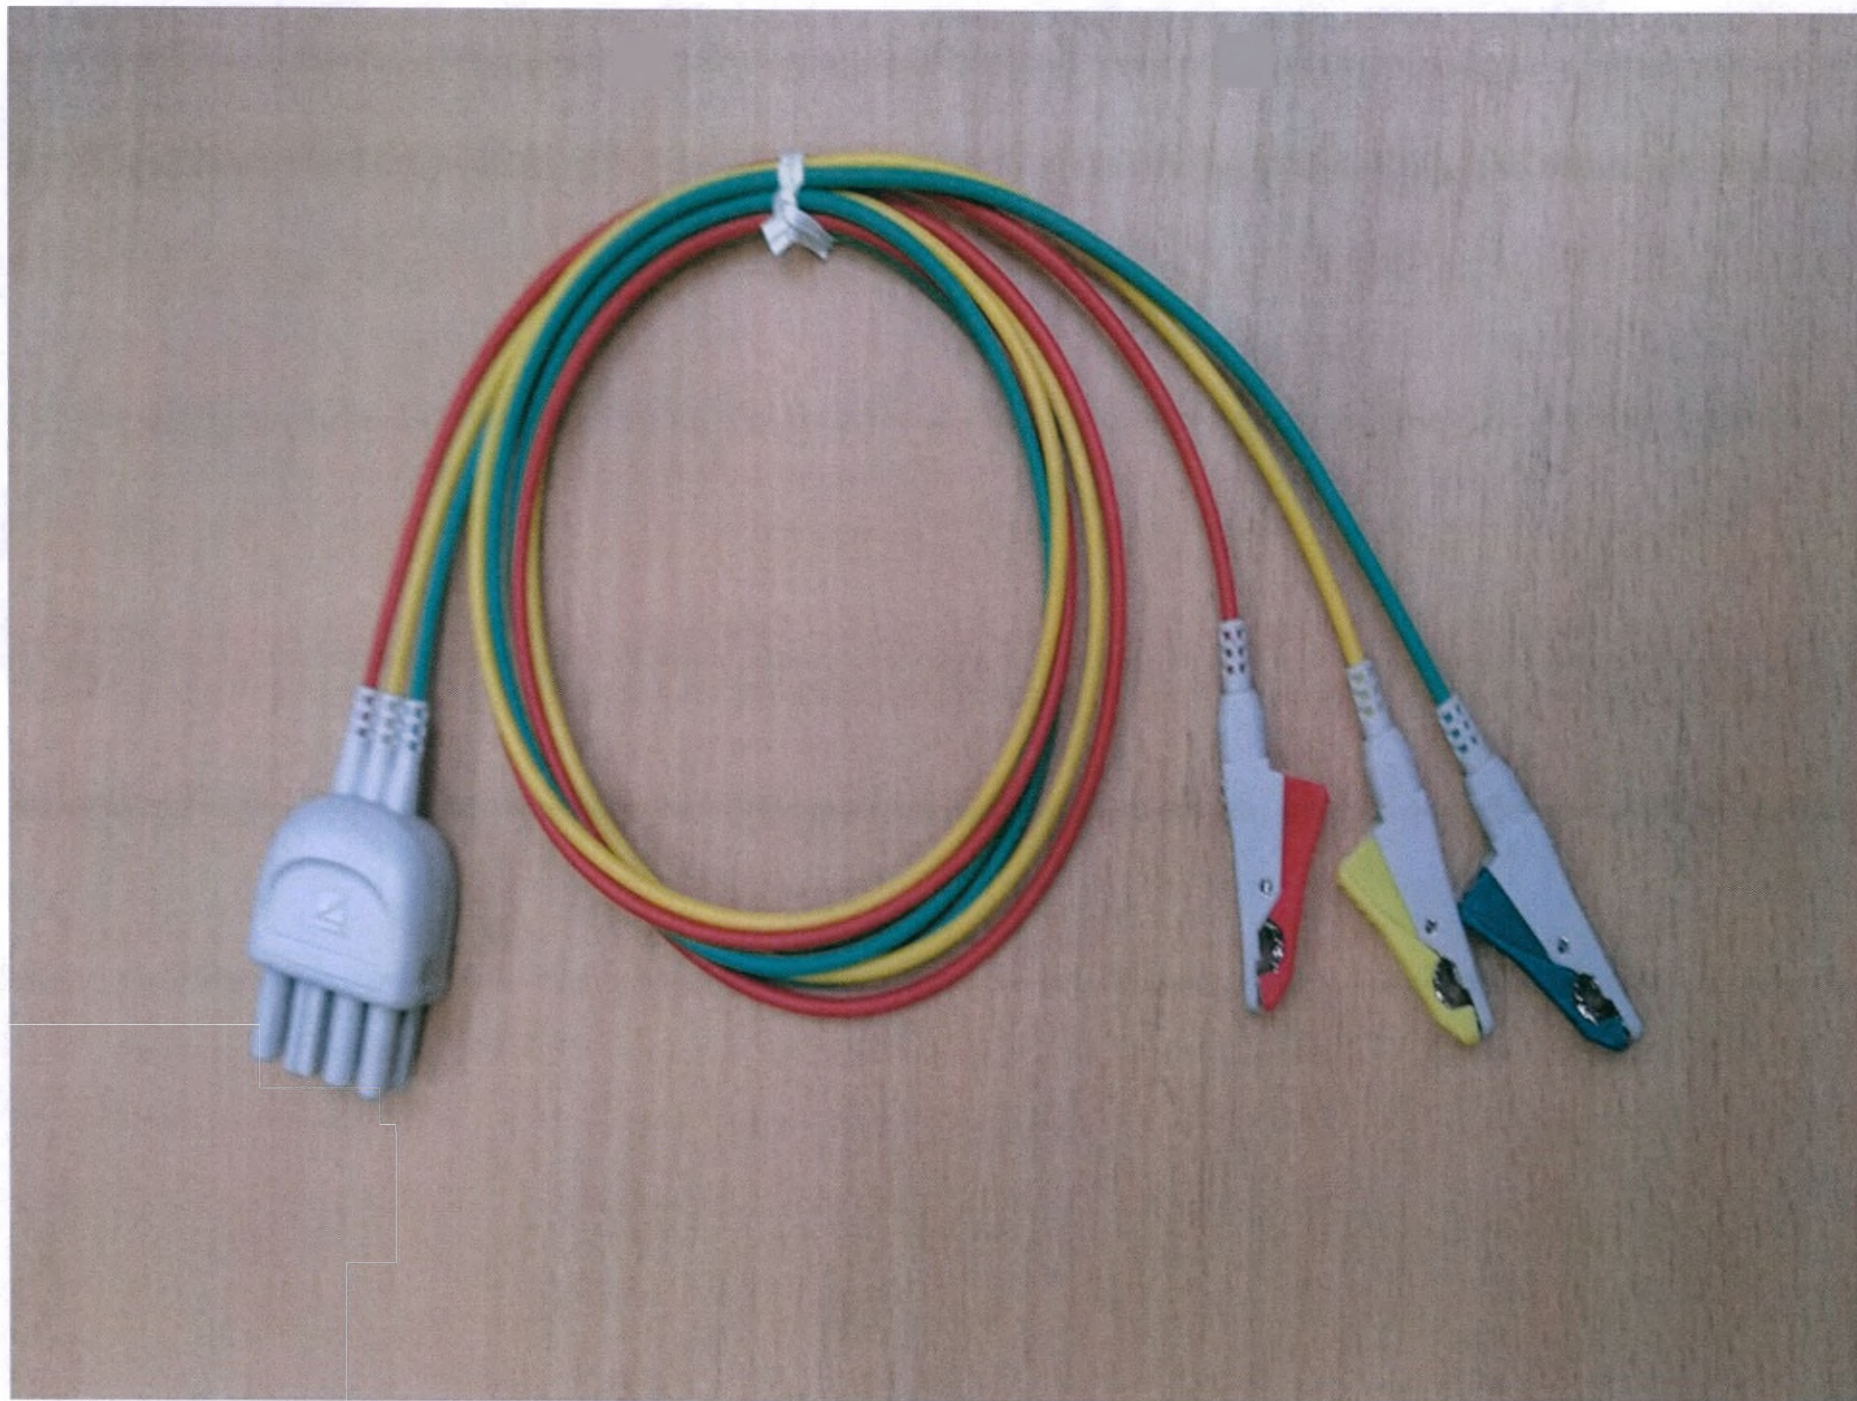


Рисунок 7. Кабель отведений ЭКГ на 3 электрода (зажим)



Рисунок 8. Кабель отведений ЭКГ на 6 электродов (клипса)

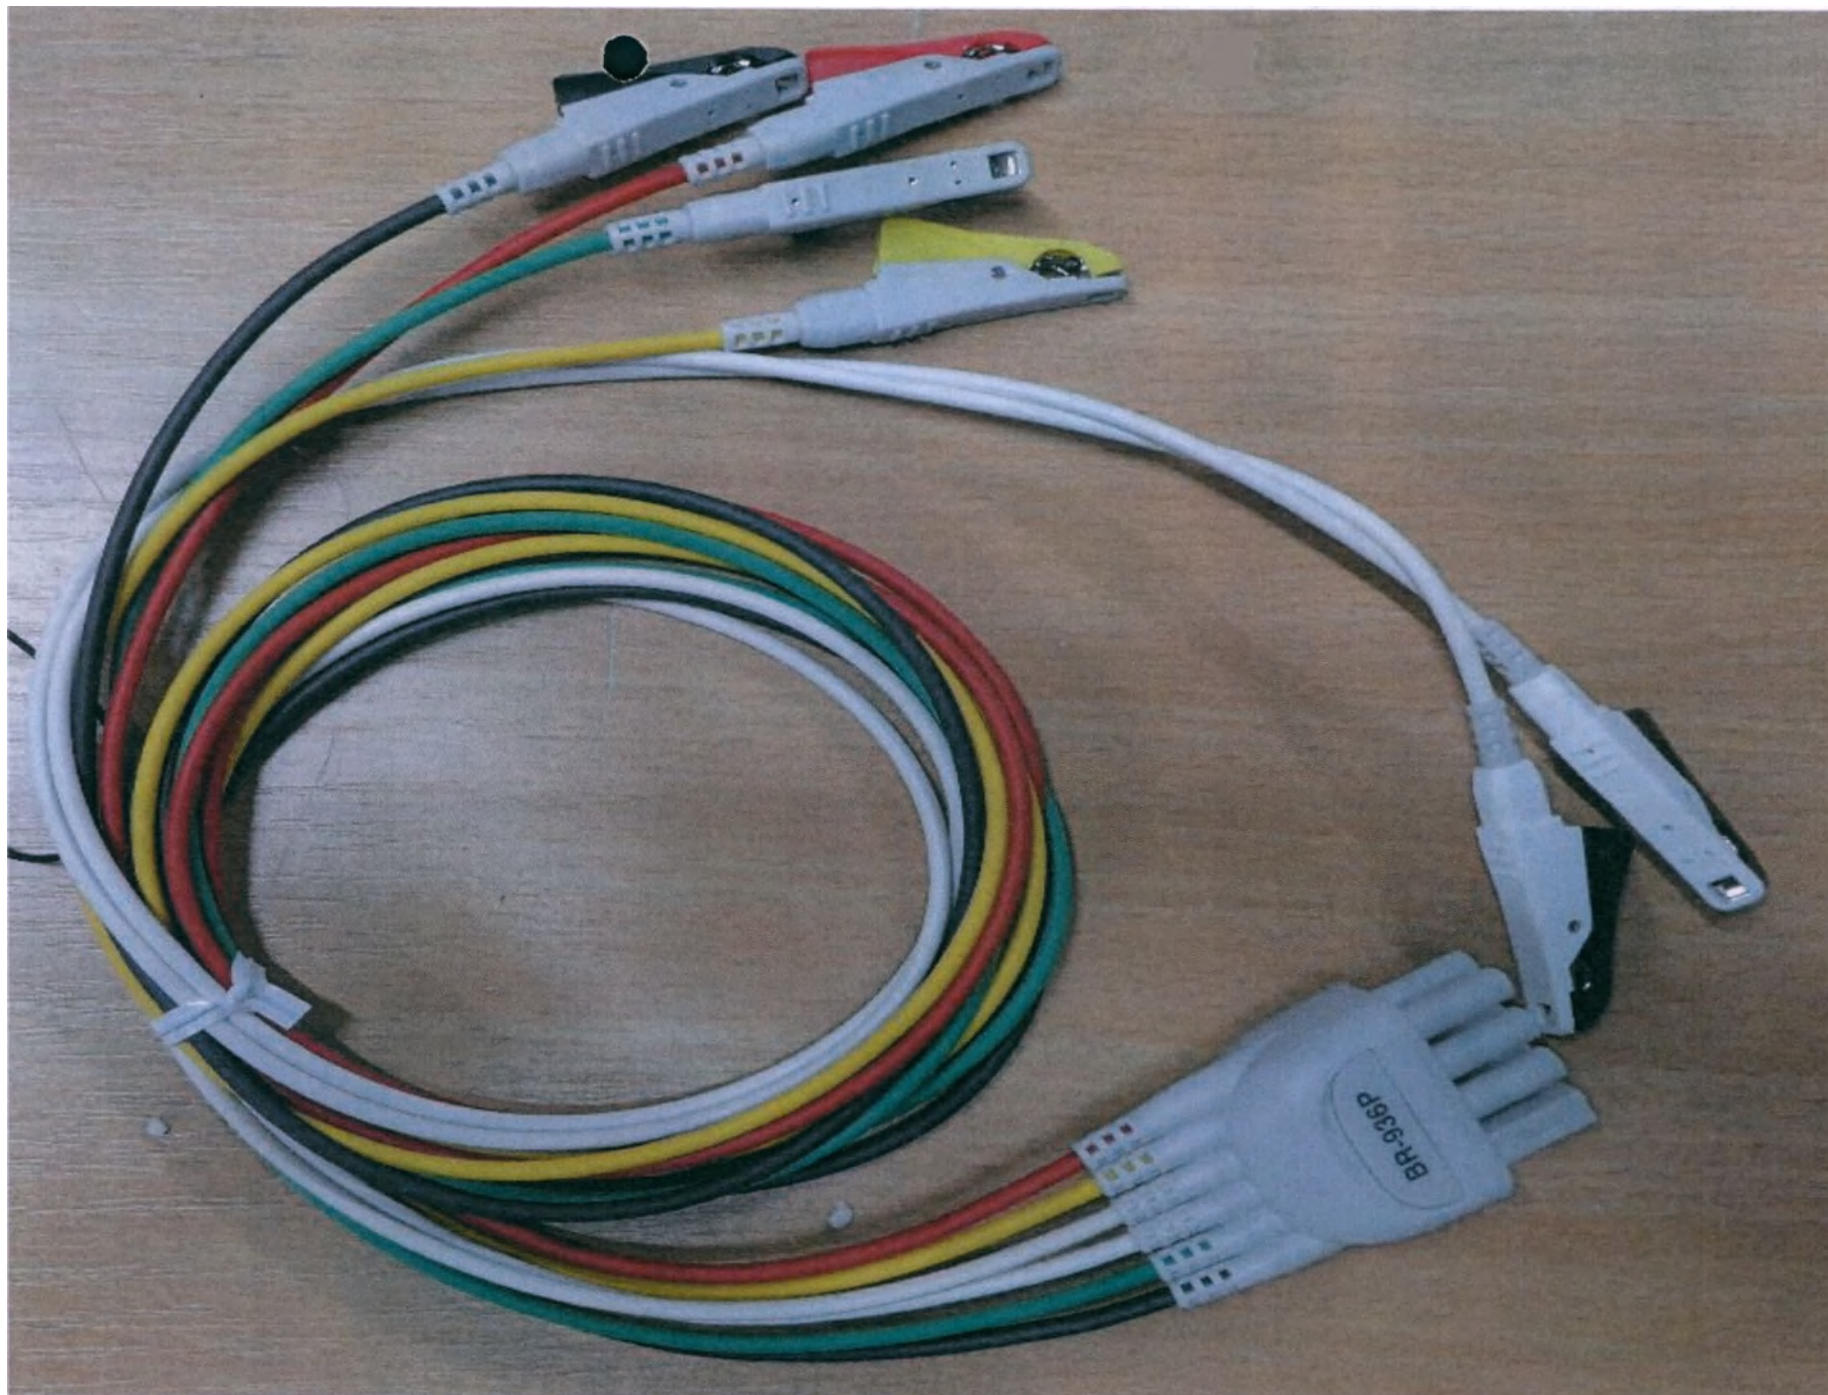


Рисунок 9. Кабель отведений ЭКГ на 6 электродов (зажим)



Рисунок 10. Электроды одноразовые Vitrode (для новорожденных, детей), 150 шт./уп.



Рисунок 11. Электроды одноразовые Vitrode (для взрослых), 150 шт./уп.

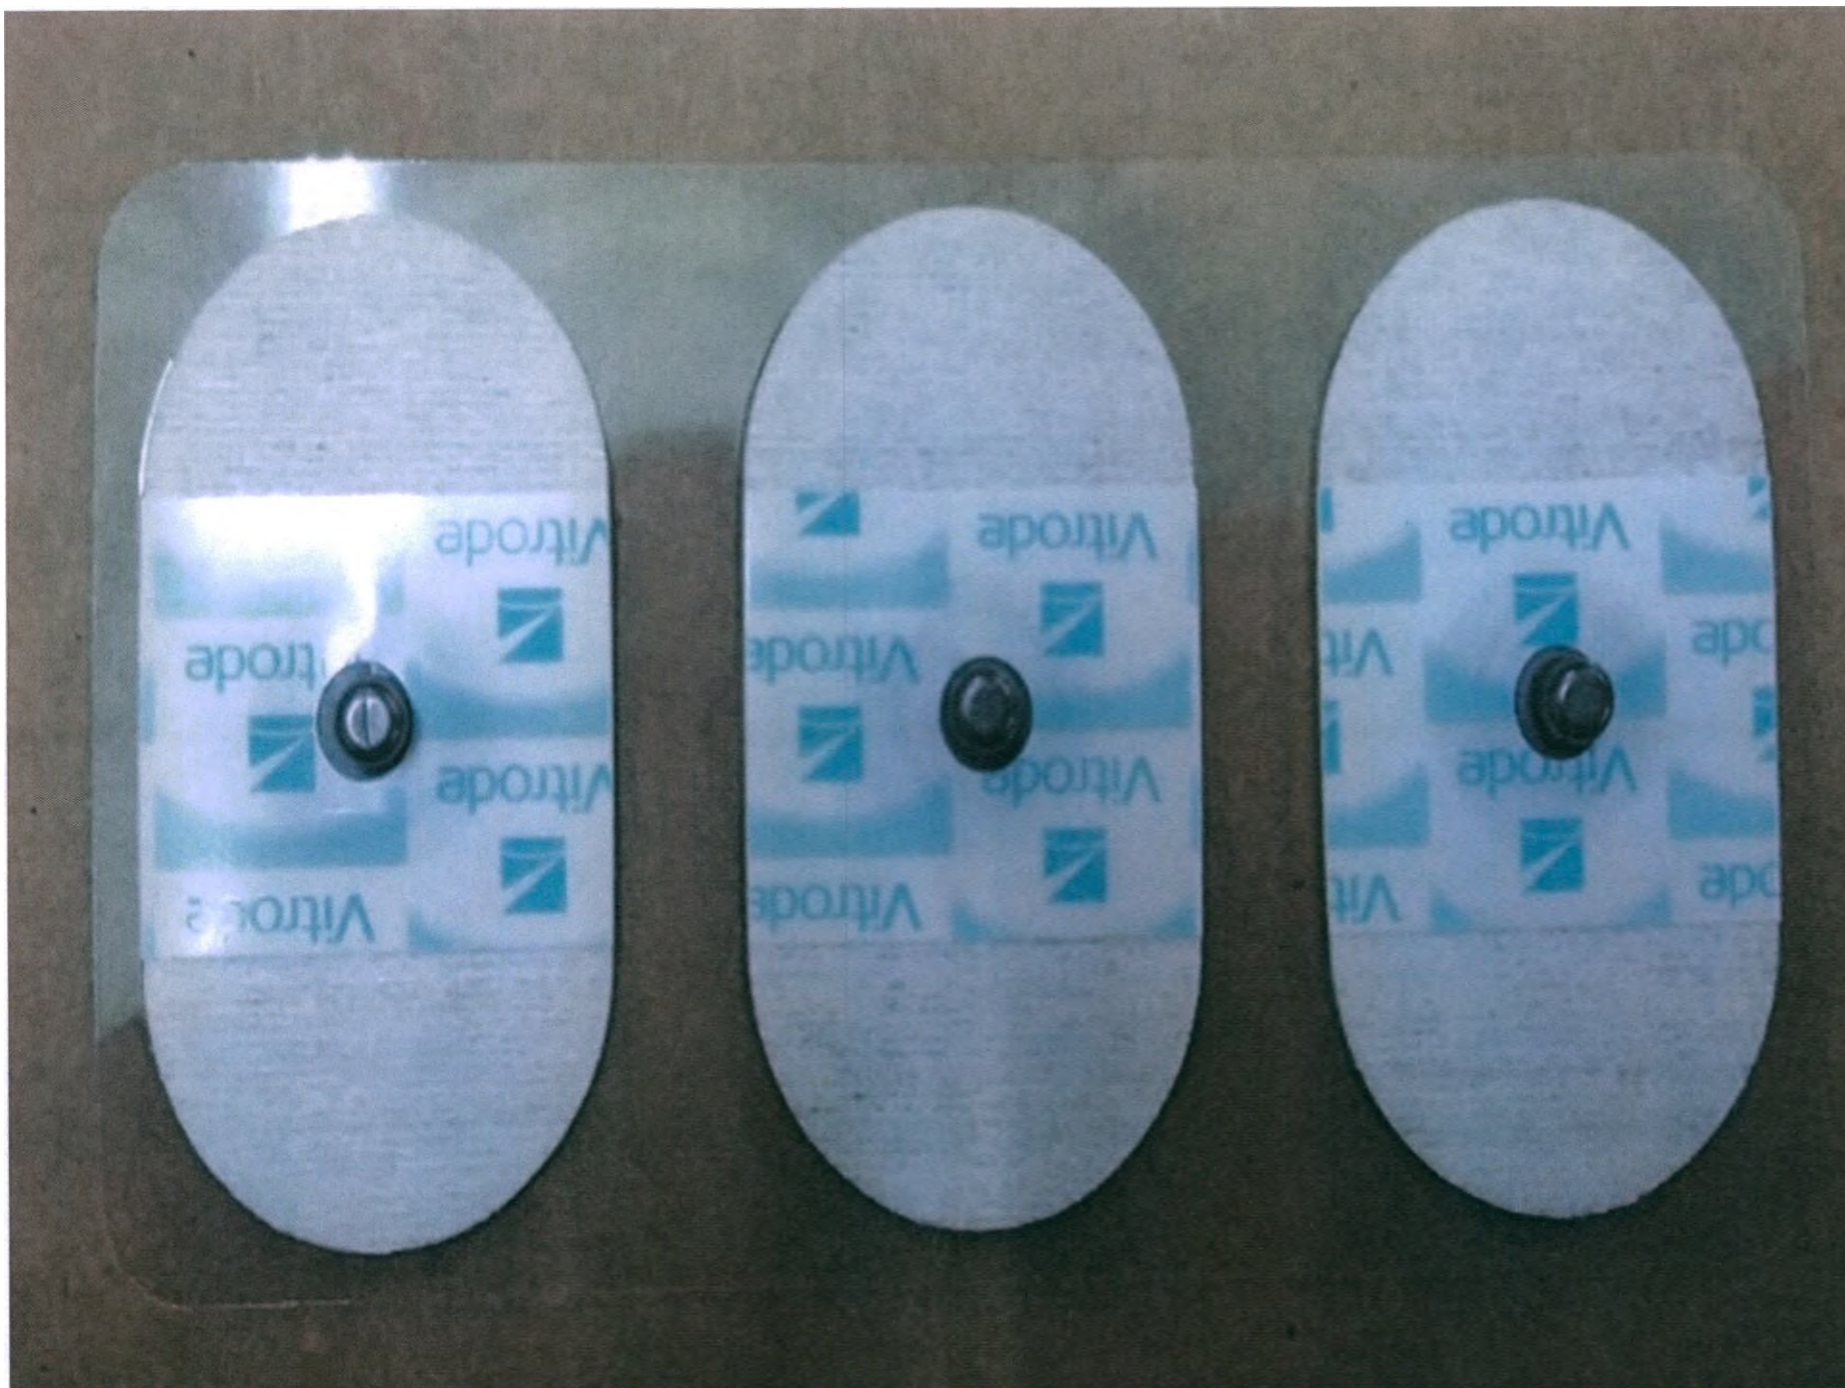


Рисунок 12. Электроды одноразовые Vitrode (для взрослых для чувствительной кожи), 150 шт./уп.



Рисунок 13. Датчик SpO2 пальцевой многожильный

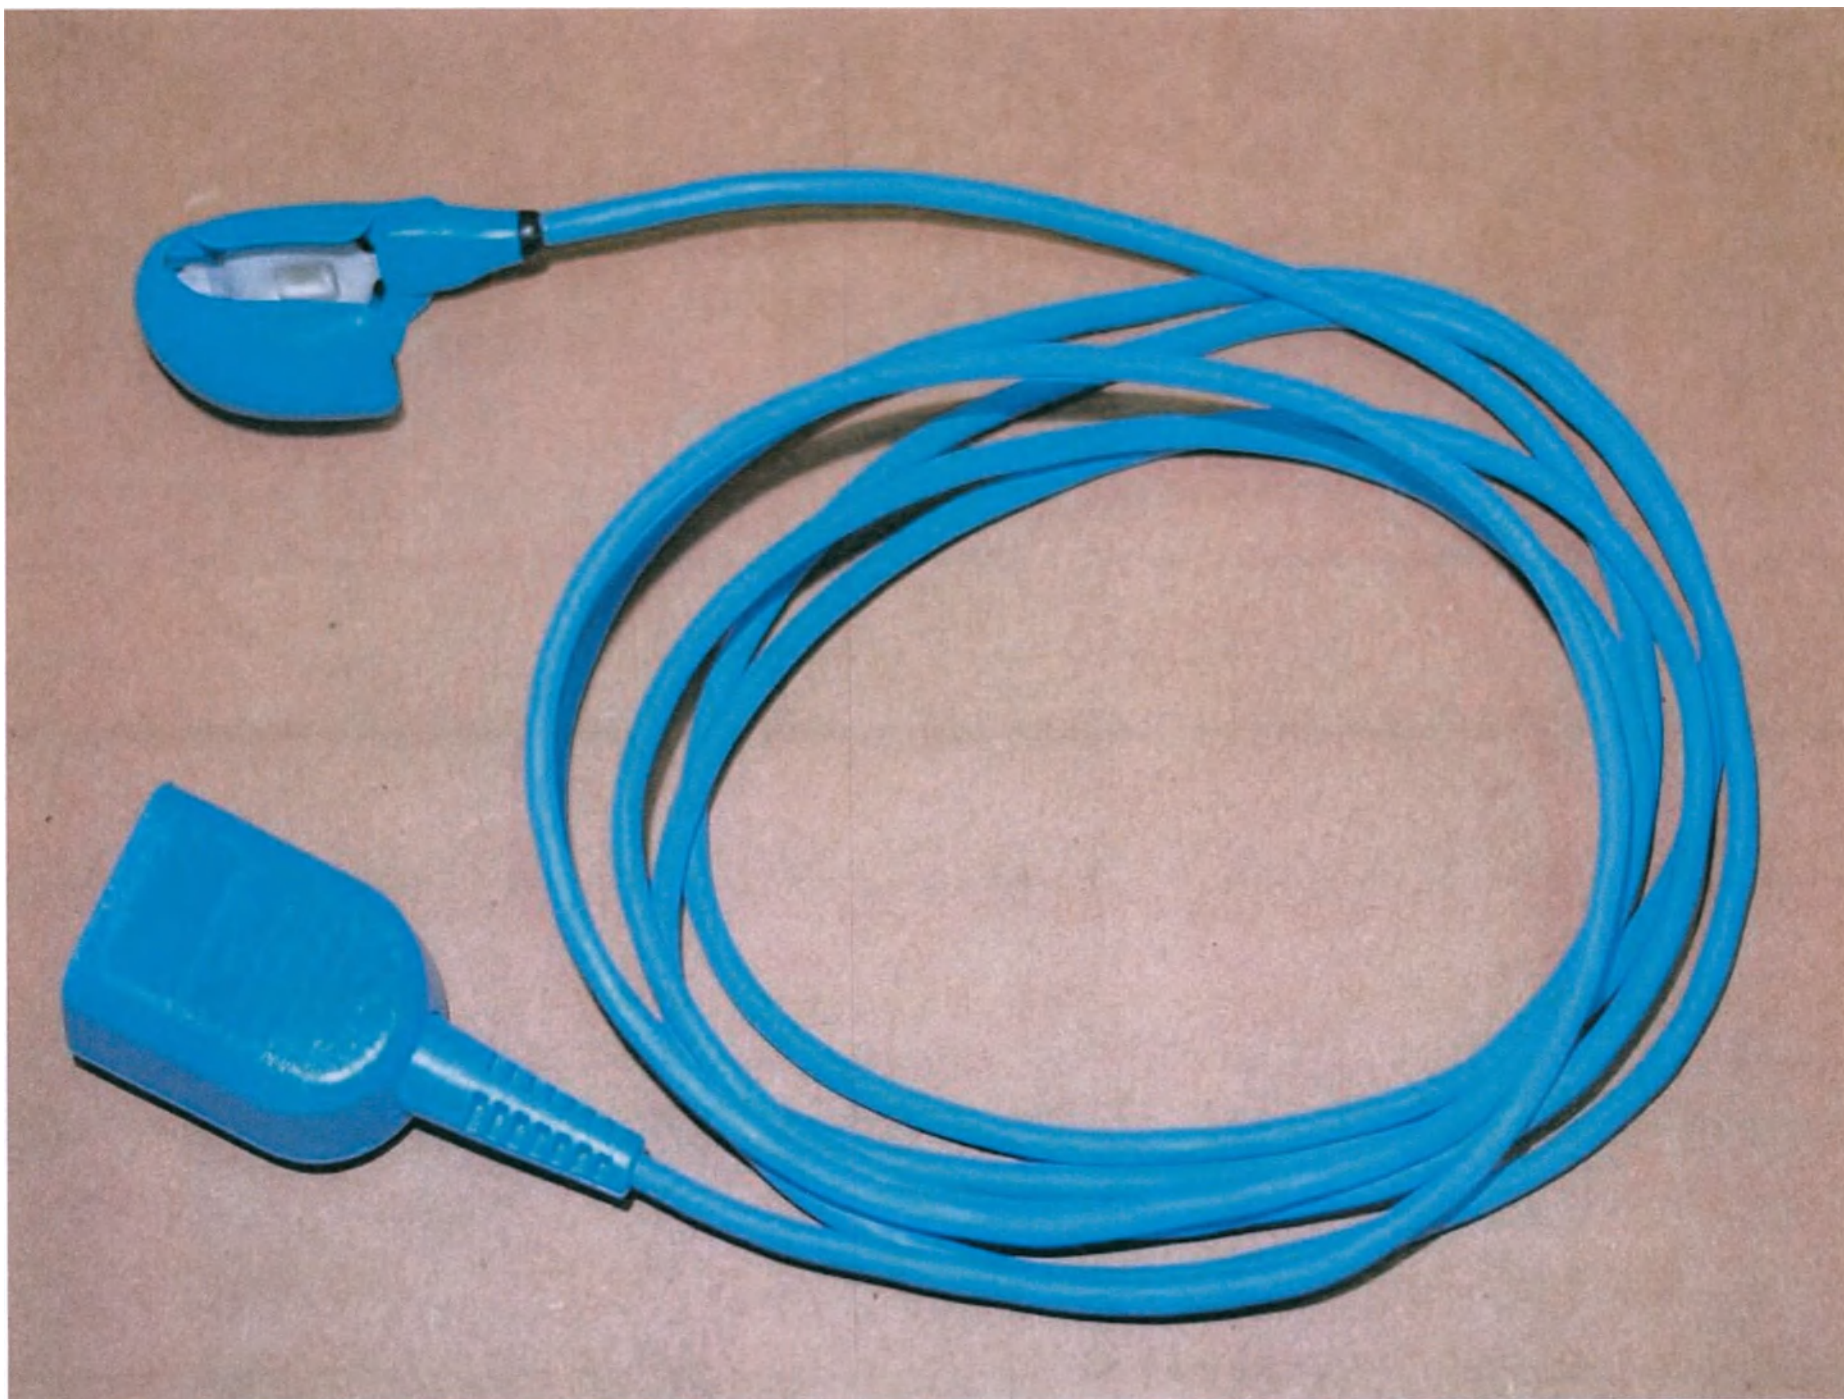


Рисунок 14. Датчик SpO2 пальцевой многоразовый длительного использования (для детей, взрослых весом от 20 кг)



Рисунок 15. Датчик SpO2 пальцевый многожильный длительного использования (для детей, взрослых весом от 50 кг)



Рисунок 16. Датчик SpO2 универсальный многоразовый

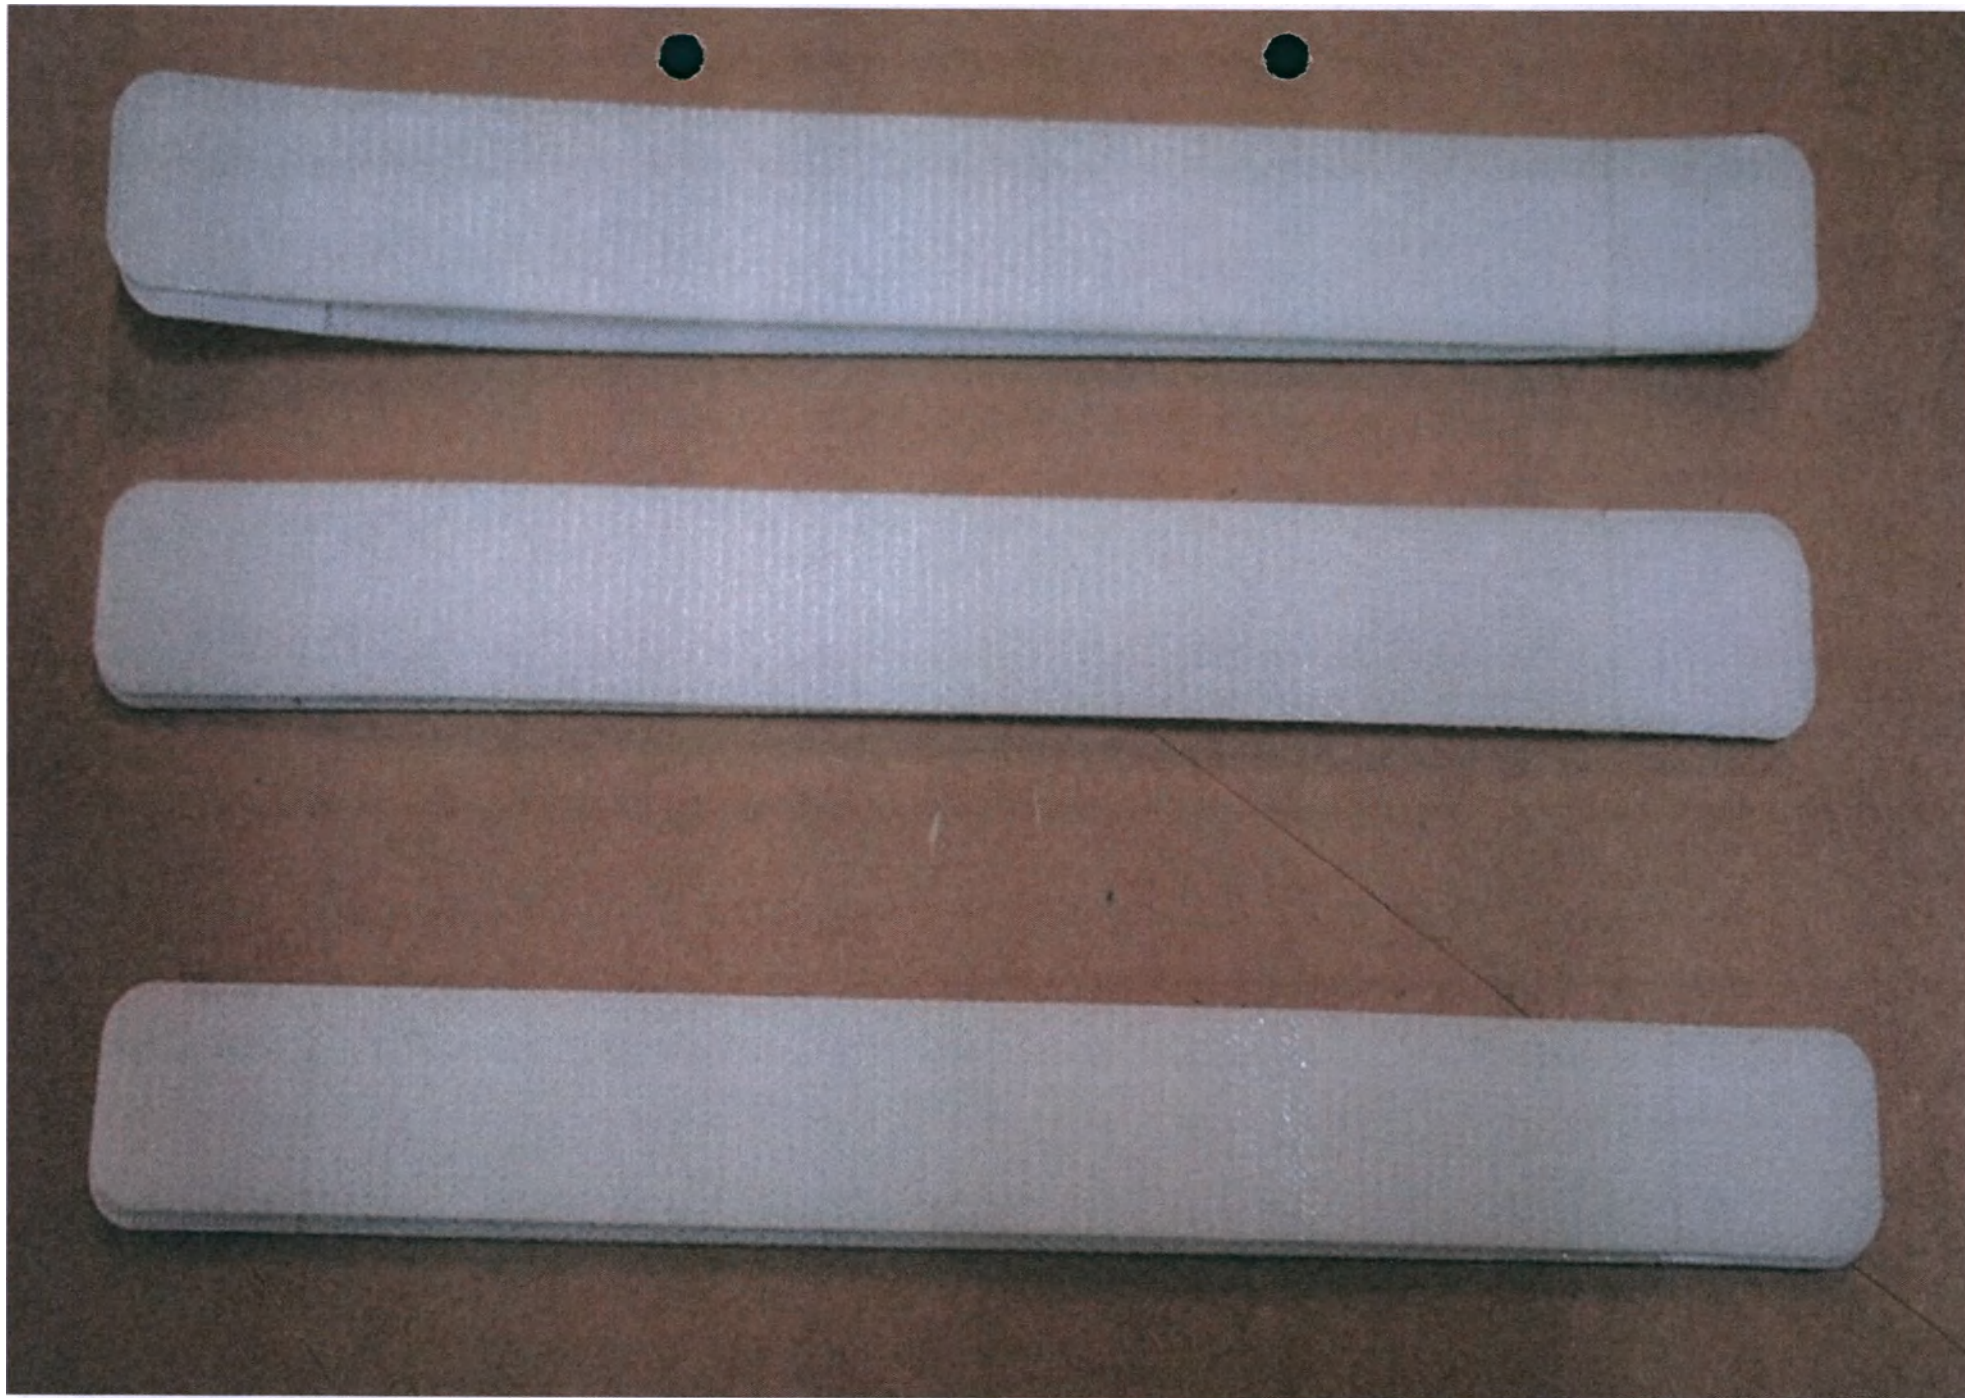


Рисунок 17. Фиксатор датчика SpO2, 30 шт./уп.



Рисунок 18. Датчик SpO2 одноразовый (для новорожденных, детей), 24 шт./уп.



Рисунок 19. Датчик SpO2 одноразовый (для детей), 24 шт./уп.



Рисунок 20. Датчик SpO2 одноразовый (для детей, взрослых), 24 шт./уп.



Рисунок 21. Датчик SpO2 одноразовый универсальный, 24 шт./уп.



Рисунок 22. Датчик SpO2 одноразовый универсальный, Y-образный, 5 шт./уп.



Рисунок 23. Фиксатор датчика SpO2 Y-образного, размер S, 24 шт./уп.



Рисунок 24. Фиксатор датчика SpO2 Y-образного, размер L, 24 шт./уп.

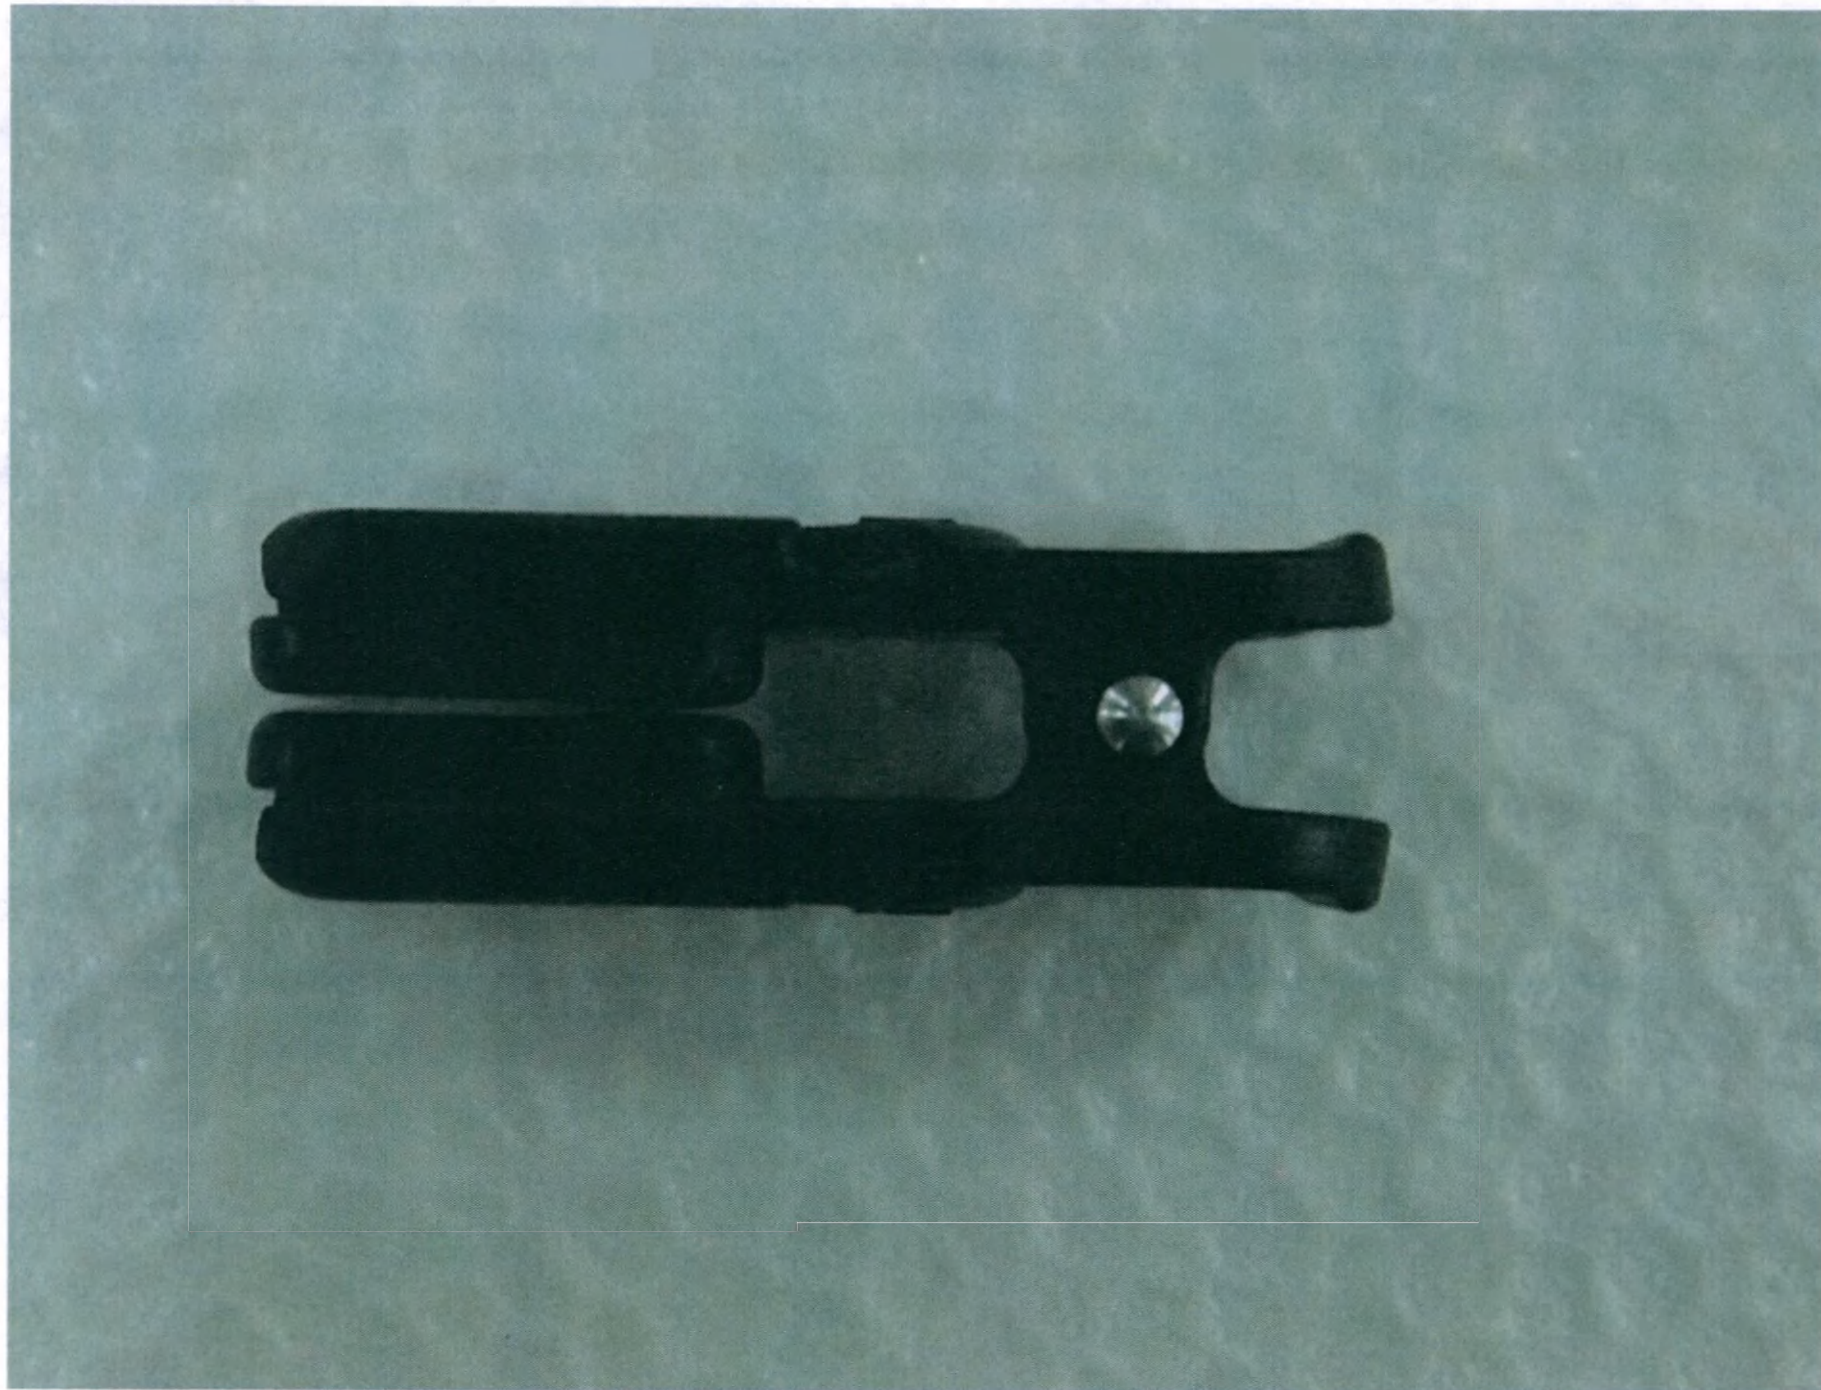


Рисунок 25. Зажим-адаптер для датчика SpO2 Y-образного



Рисунок 26. Монитор пациента GZ-140P. Передняя панель



Рисунок 27. Монитор пациента GZ-140P. Задняя панель



Рисунок 28. Монитор пациента GZ-140P. Нижняя панель



Рисунок 29. Монитор пациента GZ-140P. Верхняя панель



Рисунок 30. Сумка для монитора пациента GZ-140P



Рисунок 31. Шланг для манжет

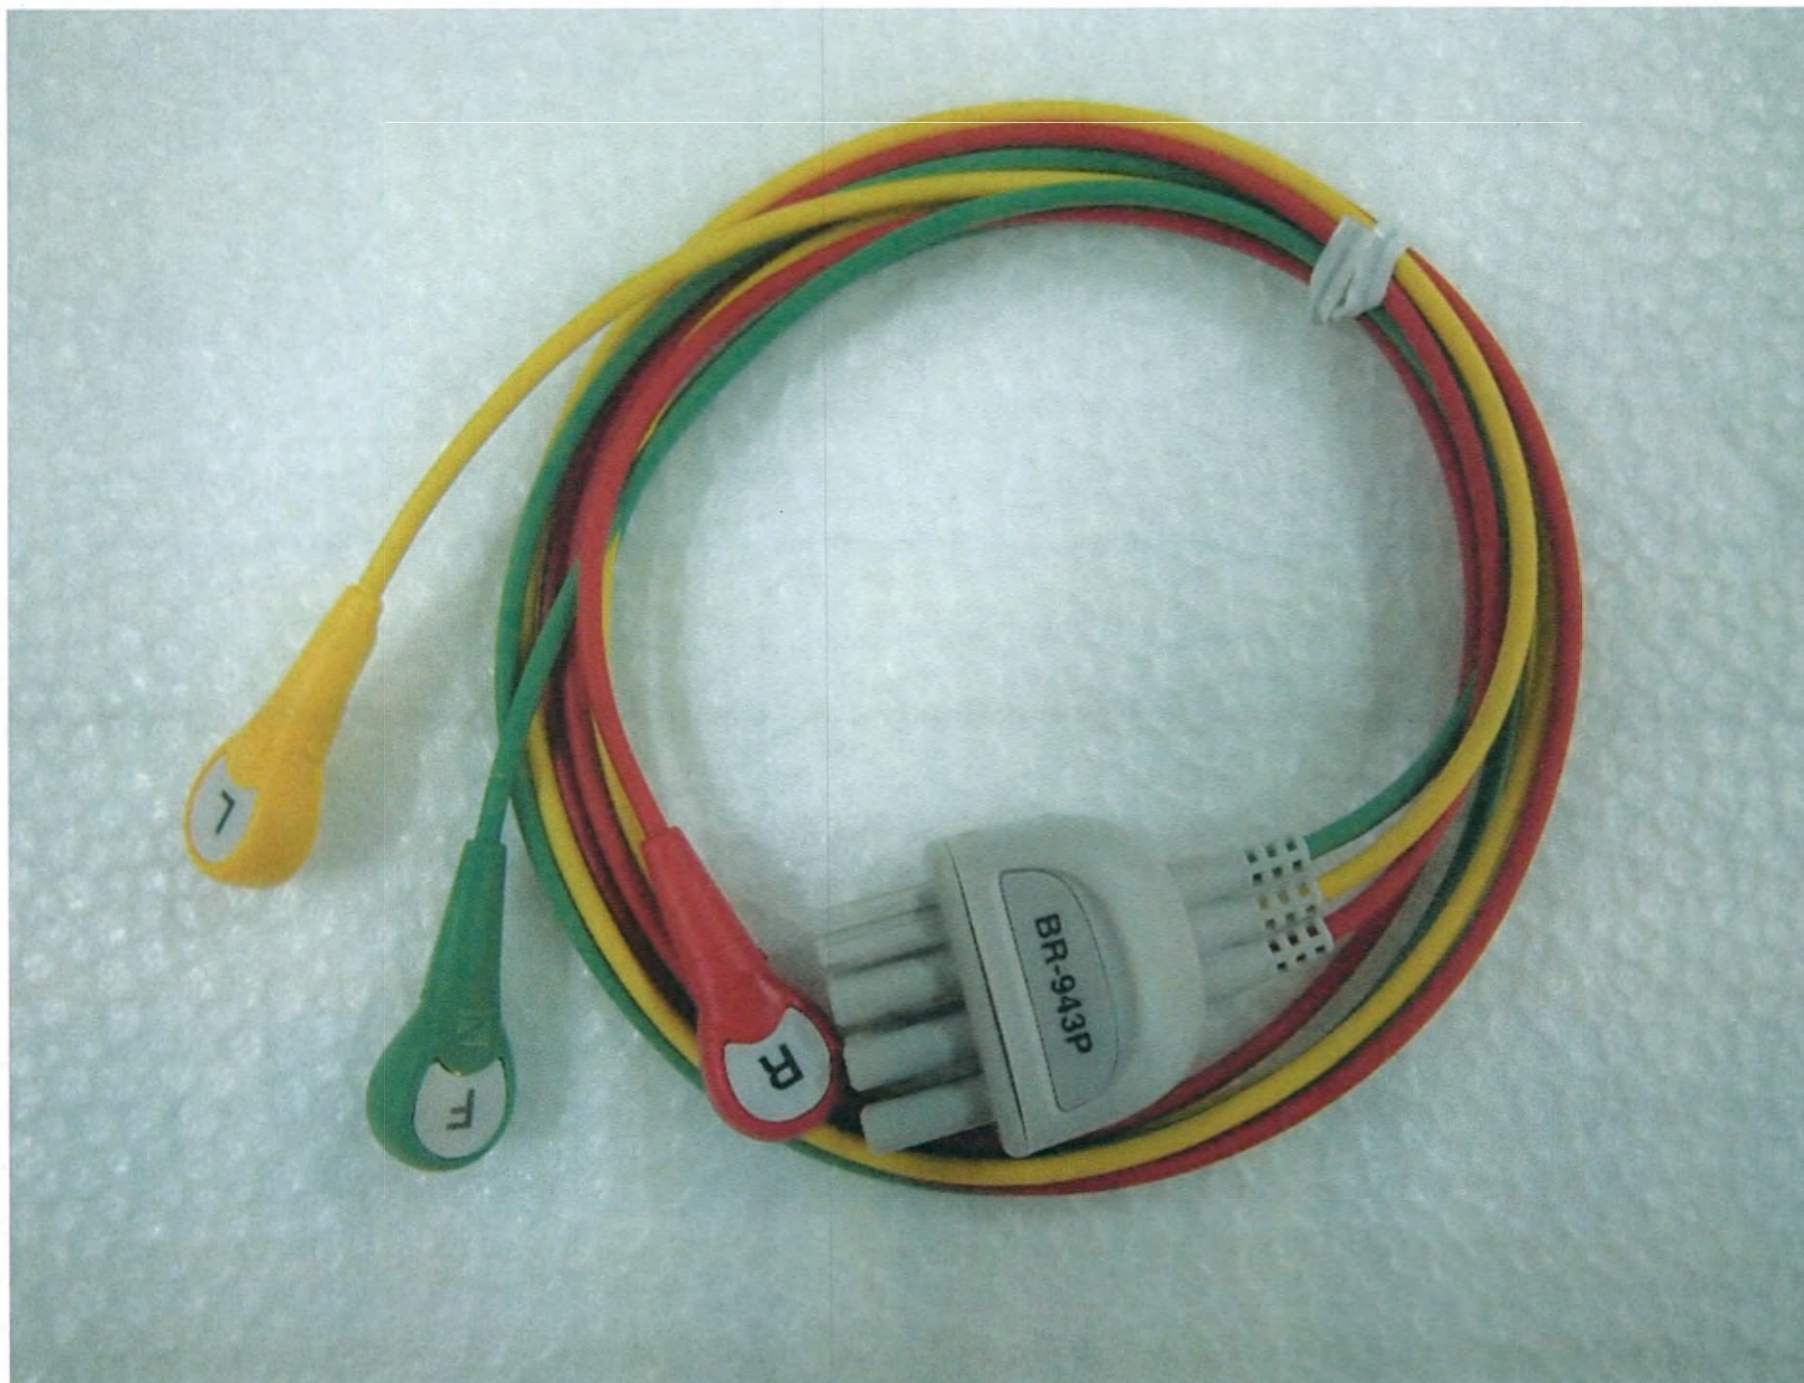


Рисунок 32. Кабель отведений ЭКГ на 3 электрода (клипса)



Рисунок 33. Кабель отведений ЭКГ на 3 электрода (зажим)

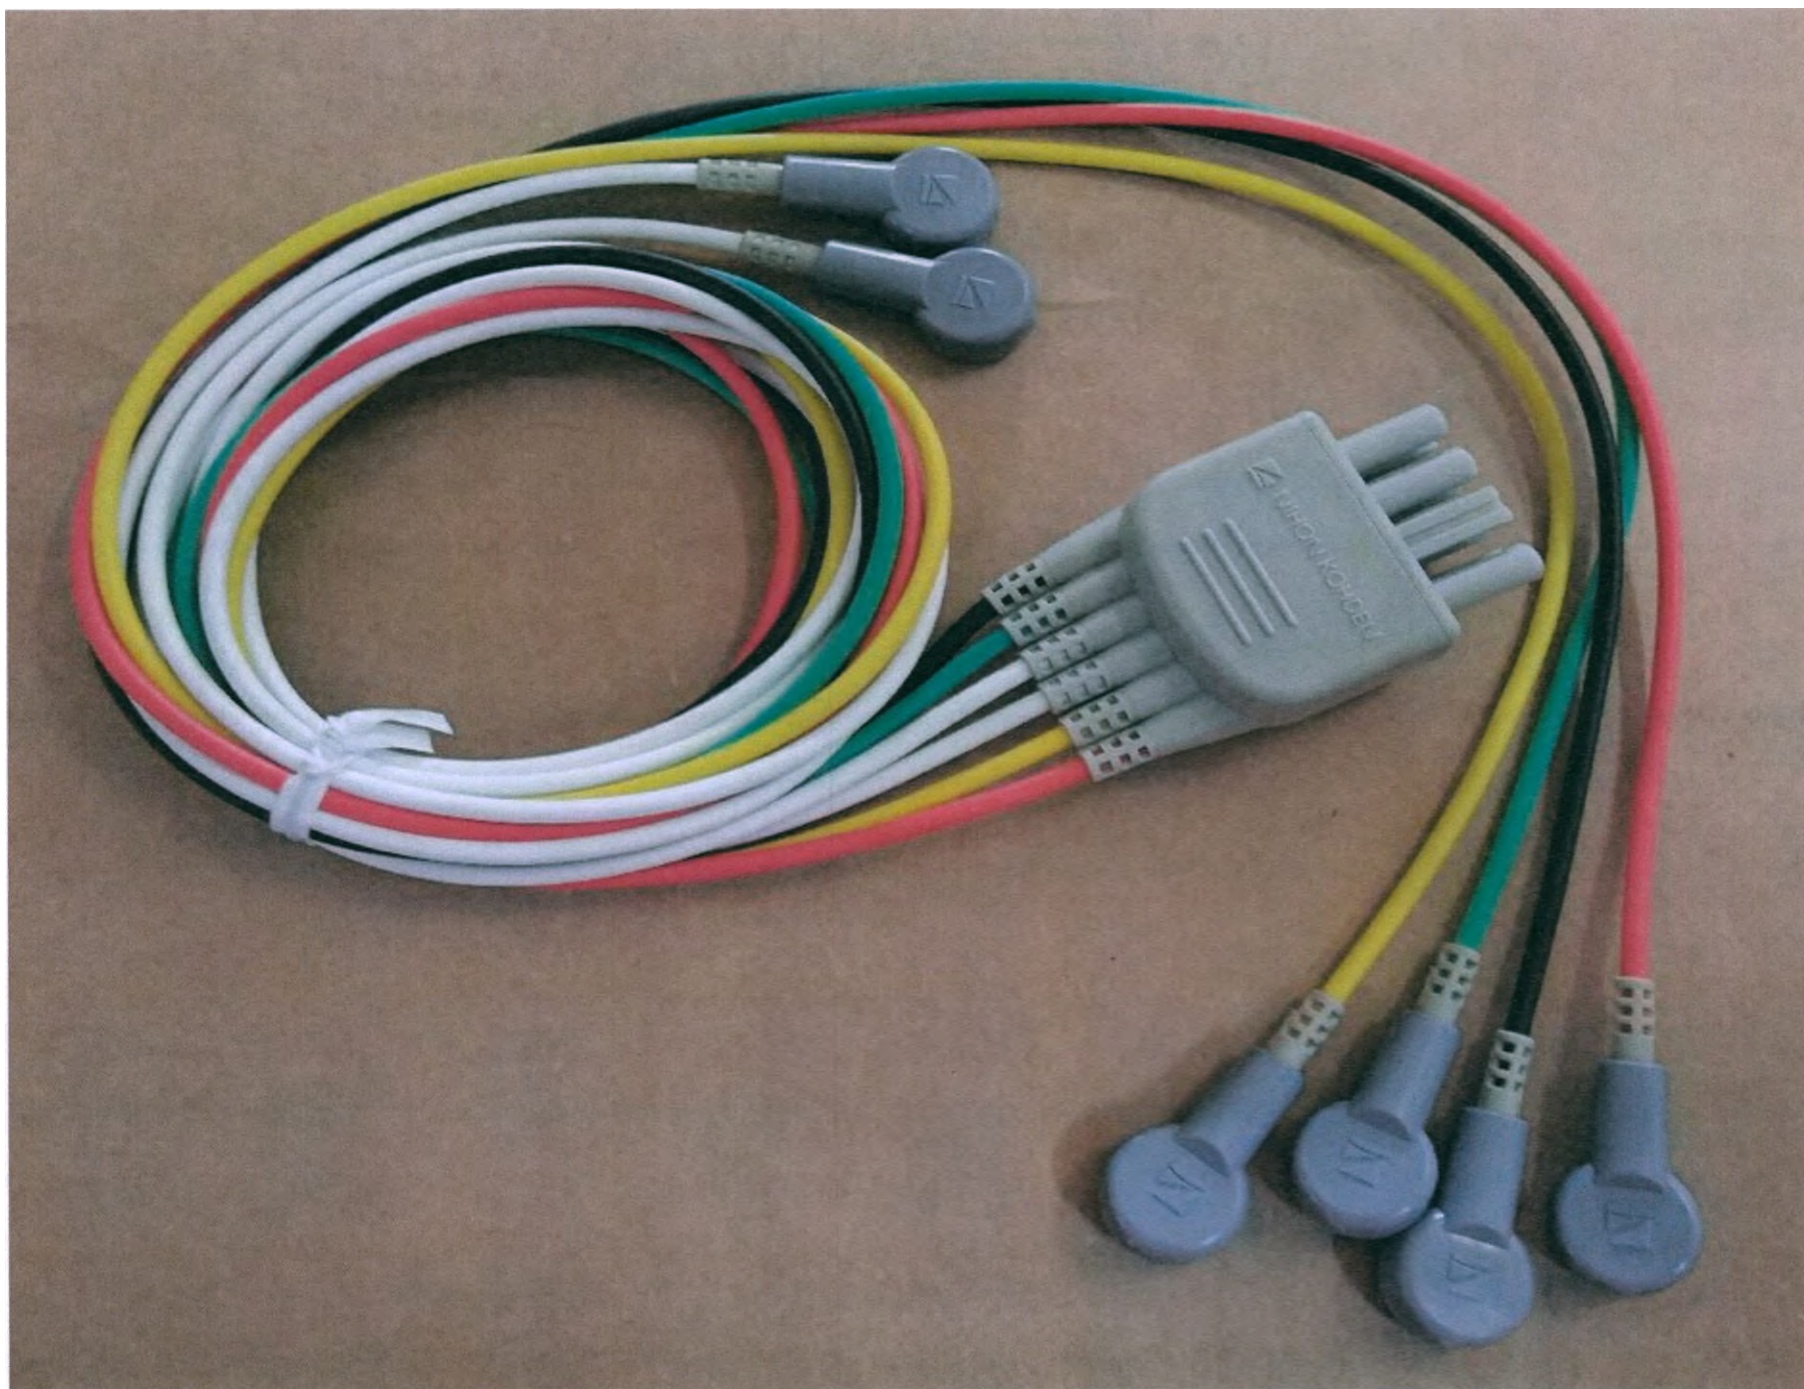


Рисунок 34. Кабель отведений ЭКГ на 6 электродов (клипса)

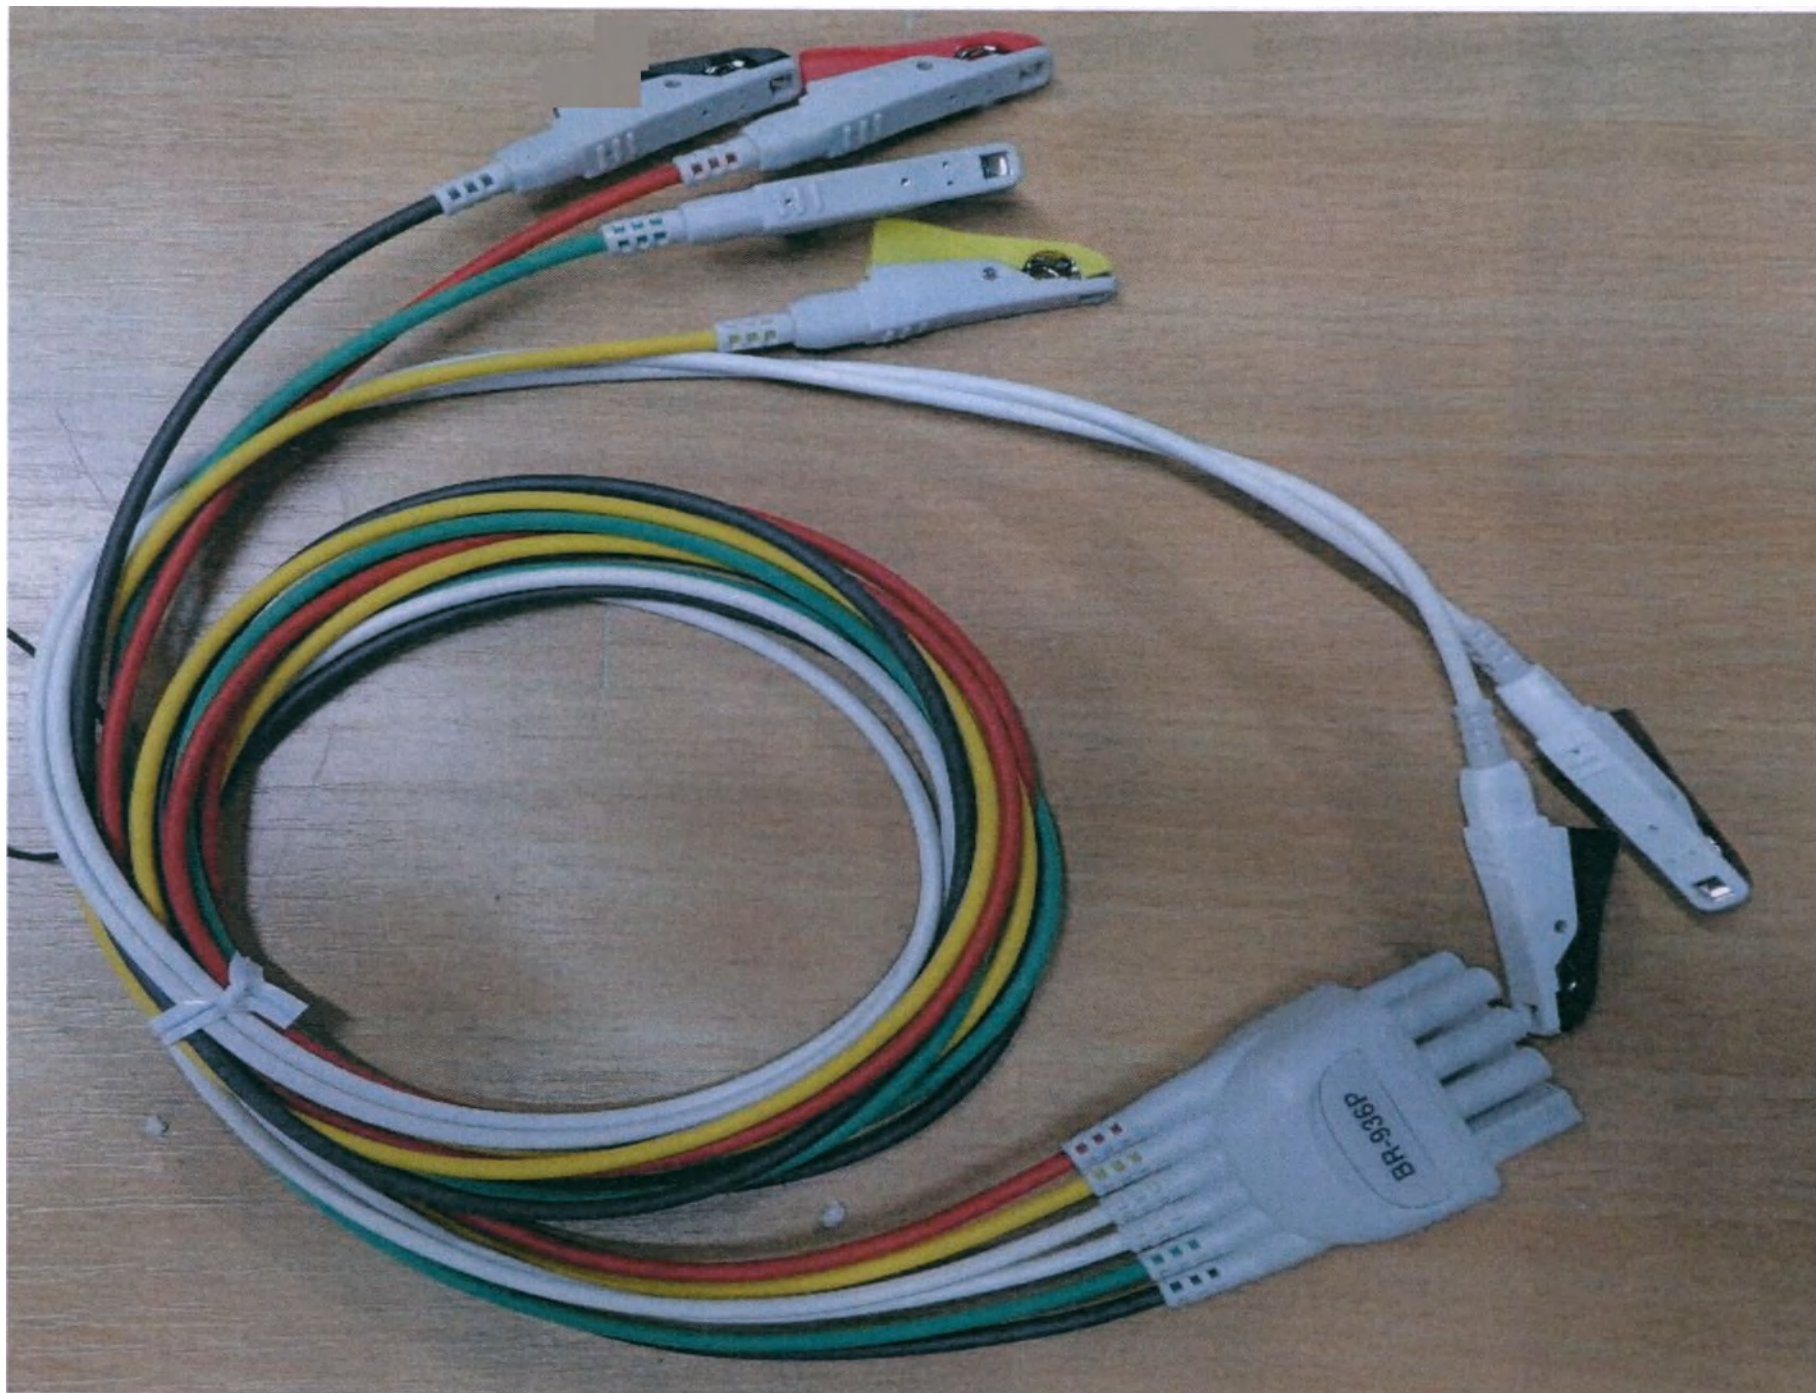


Рисунок 35. Кабель отведений ЭКГ на 6 электродов (зажим)



Рисунок 36. Электроды одноразовые Vitrode (для новорожденных, детей), 150 шт./уп.



Рисунок 37. Электроды одноразовые Vitrode (для взрослых), 150 шт./уп.

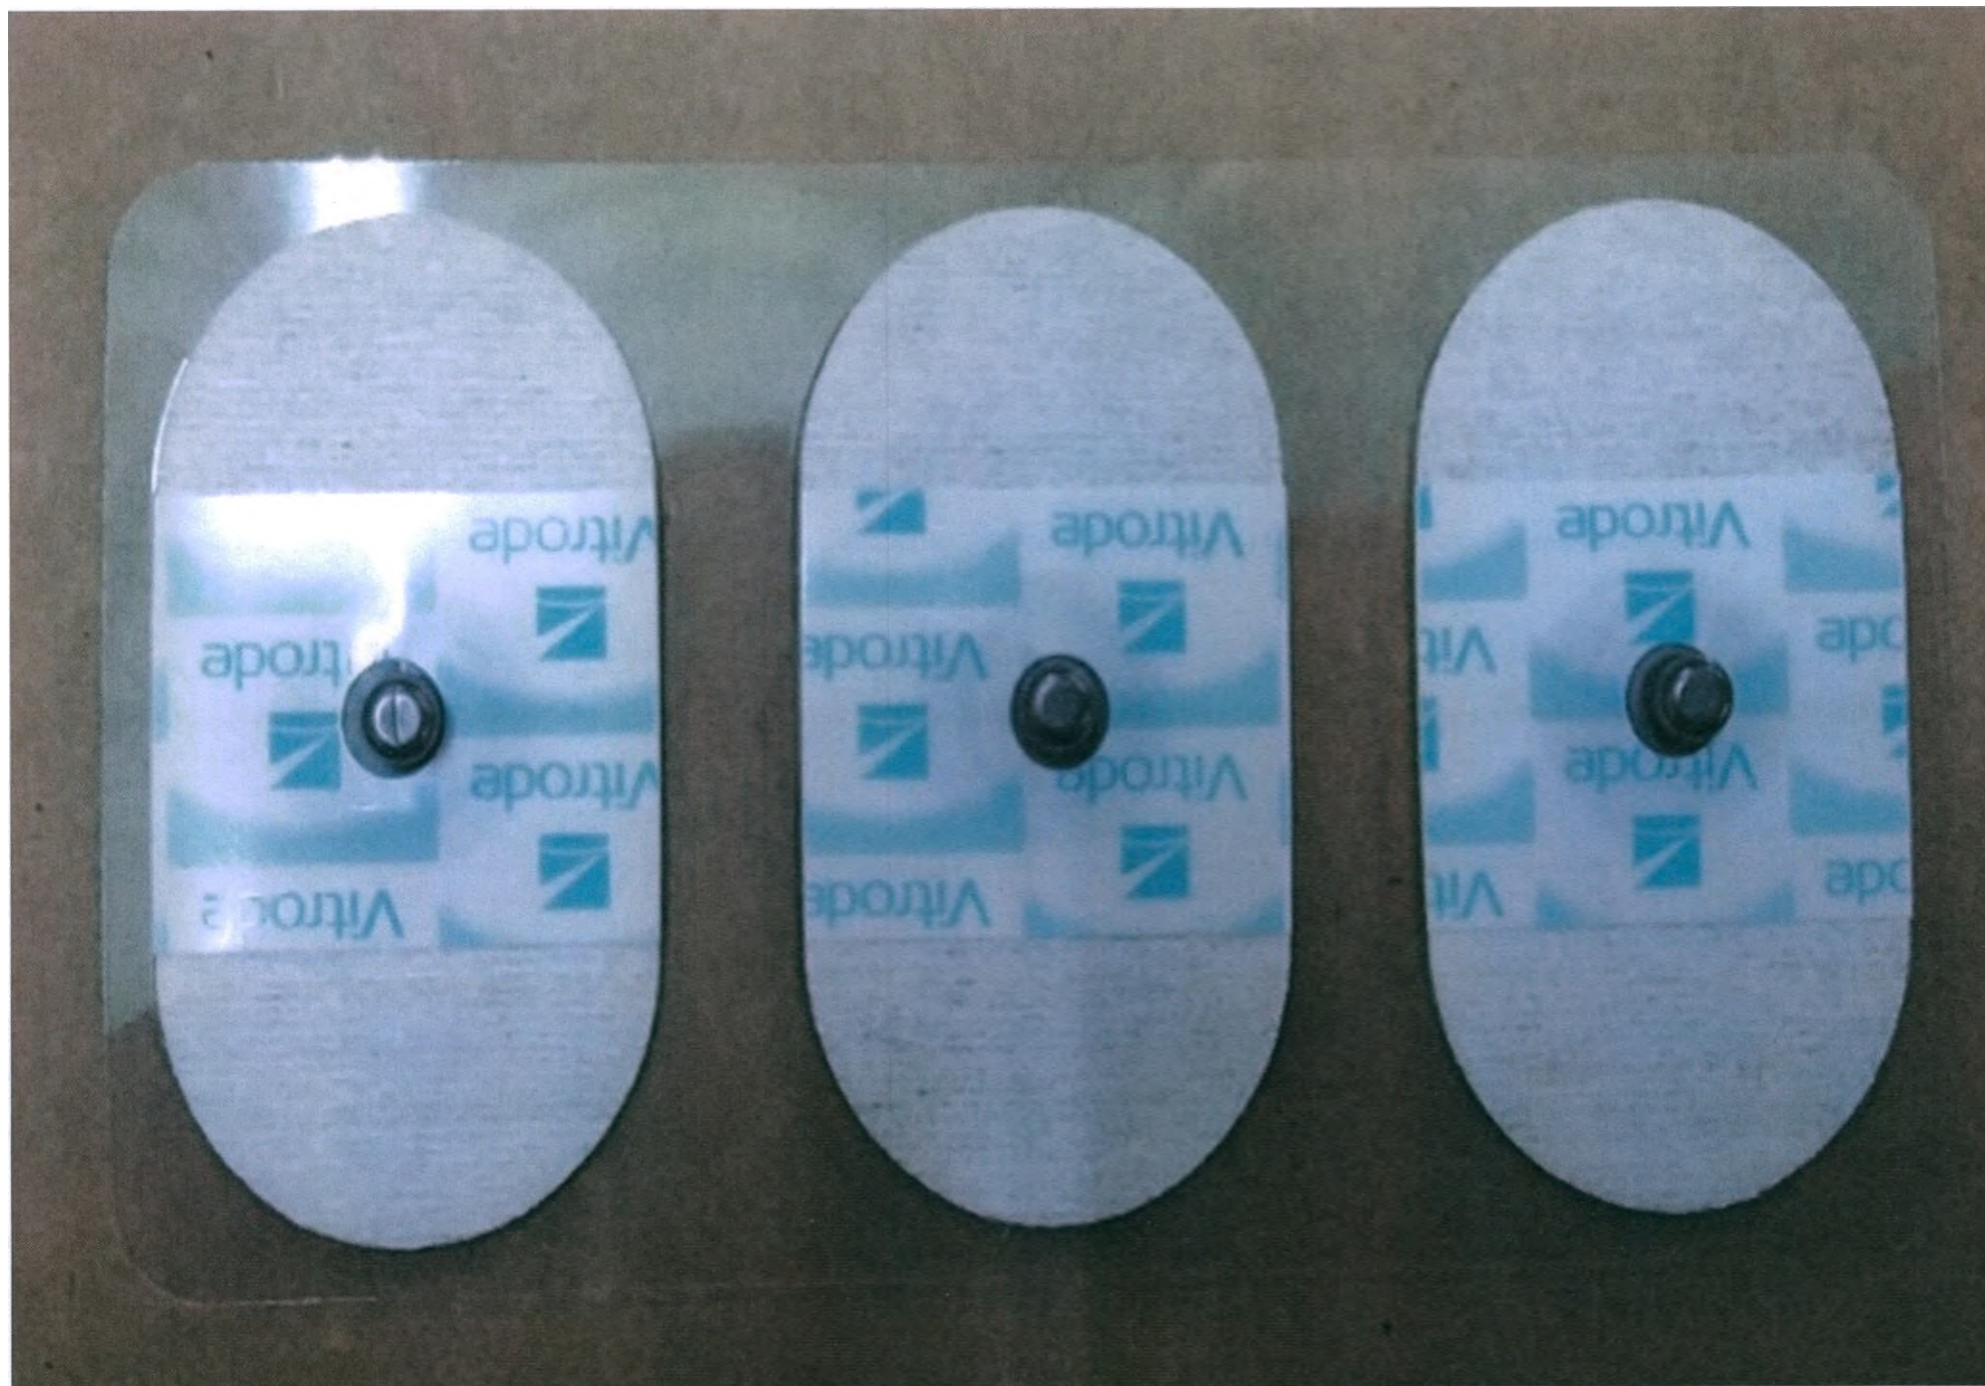


Рисунок 38. Электроды одноразовые Vitrode (для взрослых для чувствительной кожи), 150 шт./уп.



Рисунок 39. Датчик SpO2 пальцевой многожильный

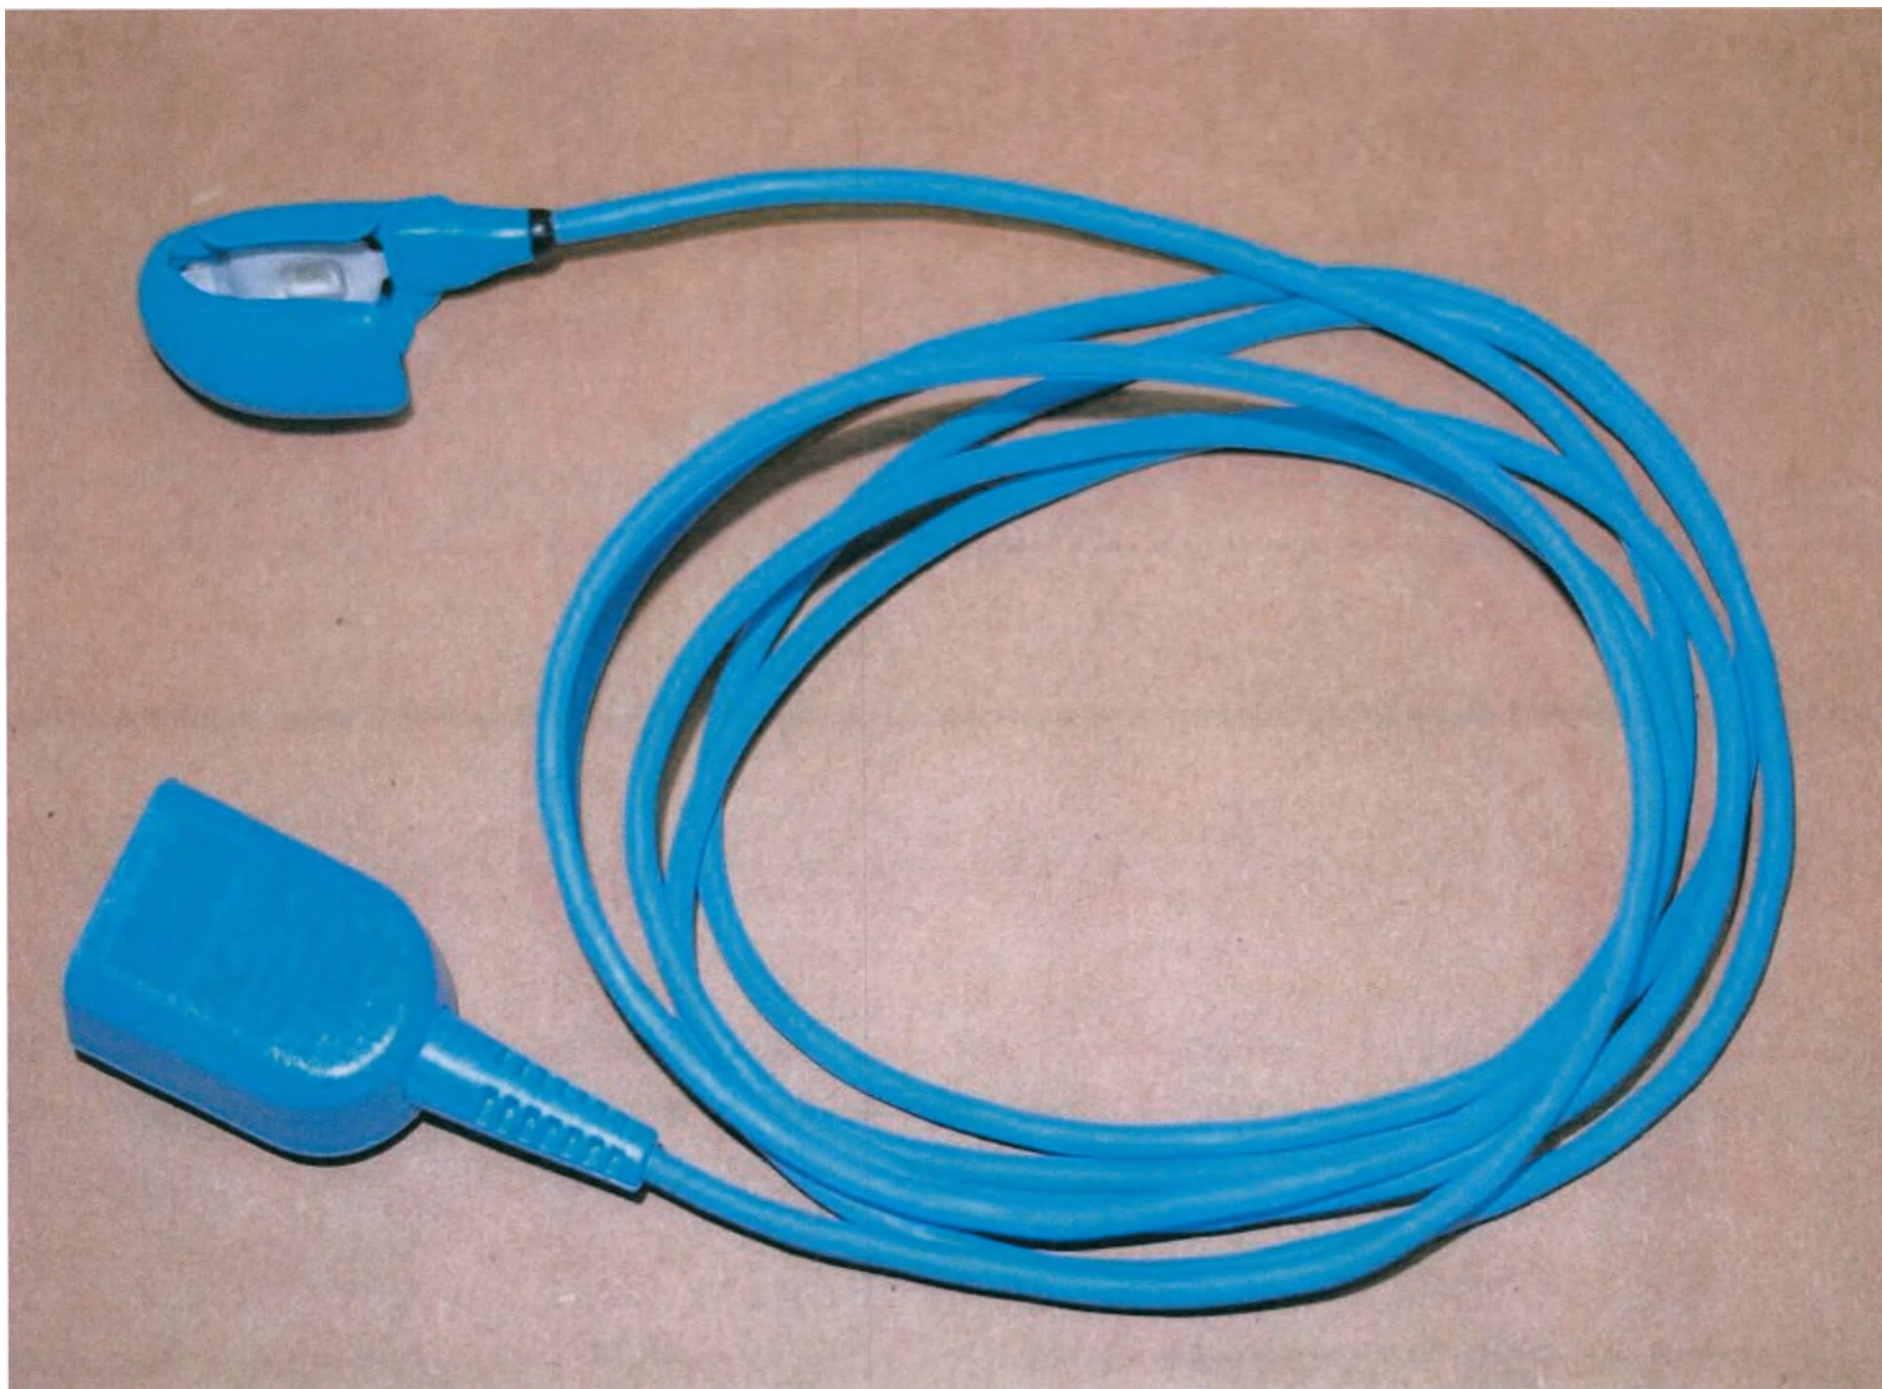


Рисунок 40. Датчик SpO₂ пальцевой многоразовый длительного использования (для детей, взрослых весом от 20 кг)



Рисунок 41. Датчик SpO2 пальцевой многоразовый длительного использования (для детей, взрослых весом от 50 кг)



Рисунок 42. Датчик SpO2 универсальный многоразовый



Рисунок 43. Фиксатор датчика SpO2, 30 шт./уп.



Рисунок 44. Датчик SpO2 одноразовый (для новорожденных, детей), 24 шт./уп.



Рисунок 45. Датчик SpO2 одноразовый (для детей), 24 шт./уп.



Рисунок 46. Датчик SpO2 одноразовый (для детей, взрослых), 24 шт./уп.



Рисунок 47. Датчик SpO2 одноразовый универсальный, 24 шт./уп.



Рисунок 48. Датчик SpO2 одноразовый универсальный, Y-образный, 5 шт./уп.



Рисунок 49. Фиксатор датчика SpO2 Y-образного, размер S, 24 шт./уп.



Рисунок 50. Фиксатор датчика SpO2 Y-образного, размер L, 24 шт./уп.

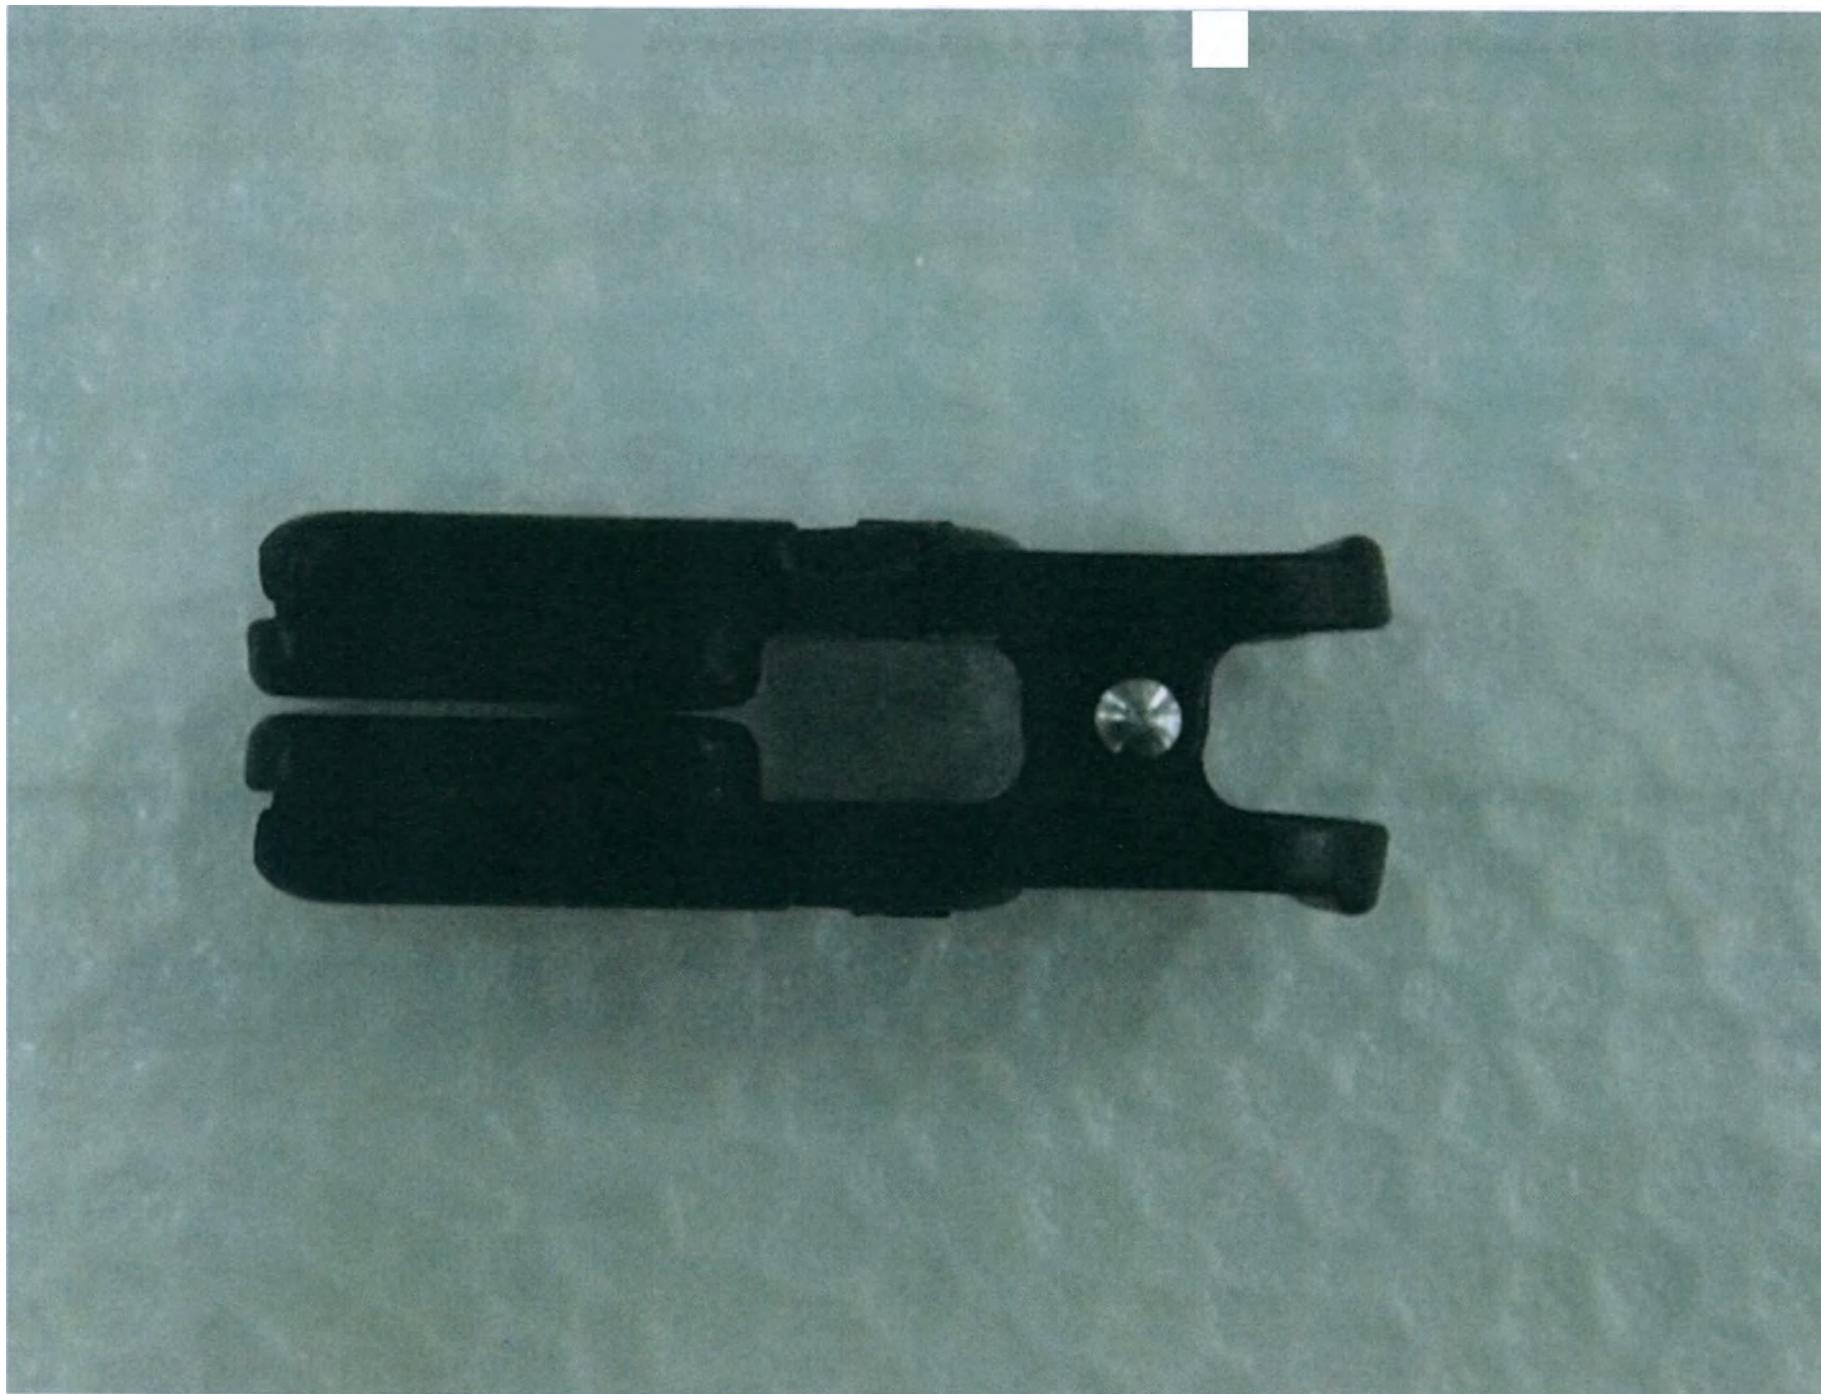


Рисунок 51. Зажим-адаптер для датчика SpO2 Y-образного



Рисунок 52. Манжета одноразовая (для новорожденных, ширина 5 см), 20 шт./уп.



Рисунок 53. Манжета одноразовая (для детей, ширина 7 см), 20 шт./уп.



Рисунок 54. Манжета одноразовая (для взрослых малая, ширина 10 см), 20 шт./уп.



Рисунок 55. Манжета одноразовая (для взрослых стандарт, ширина 13 см), 20 шт./уп.



Рисунок 56. Манжета одноразовая (для взрослых большая, ширина 16 см), 20 шт./уп.



Рисунок 57. Манжета одноразовая (для взрослых бедренная, ширина 19 см), 20 шт./уп.

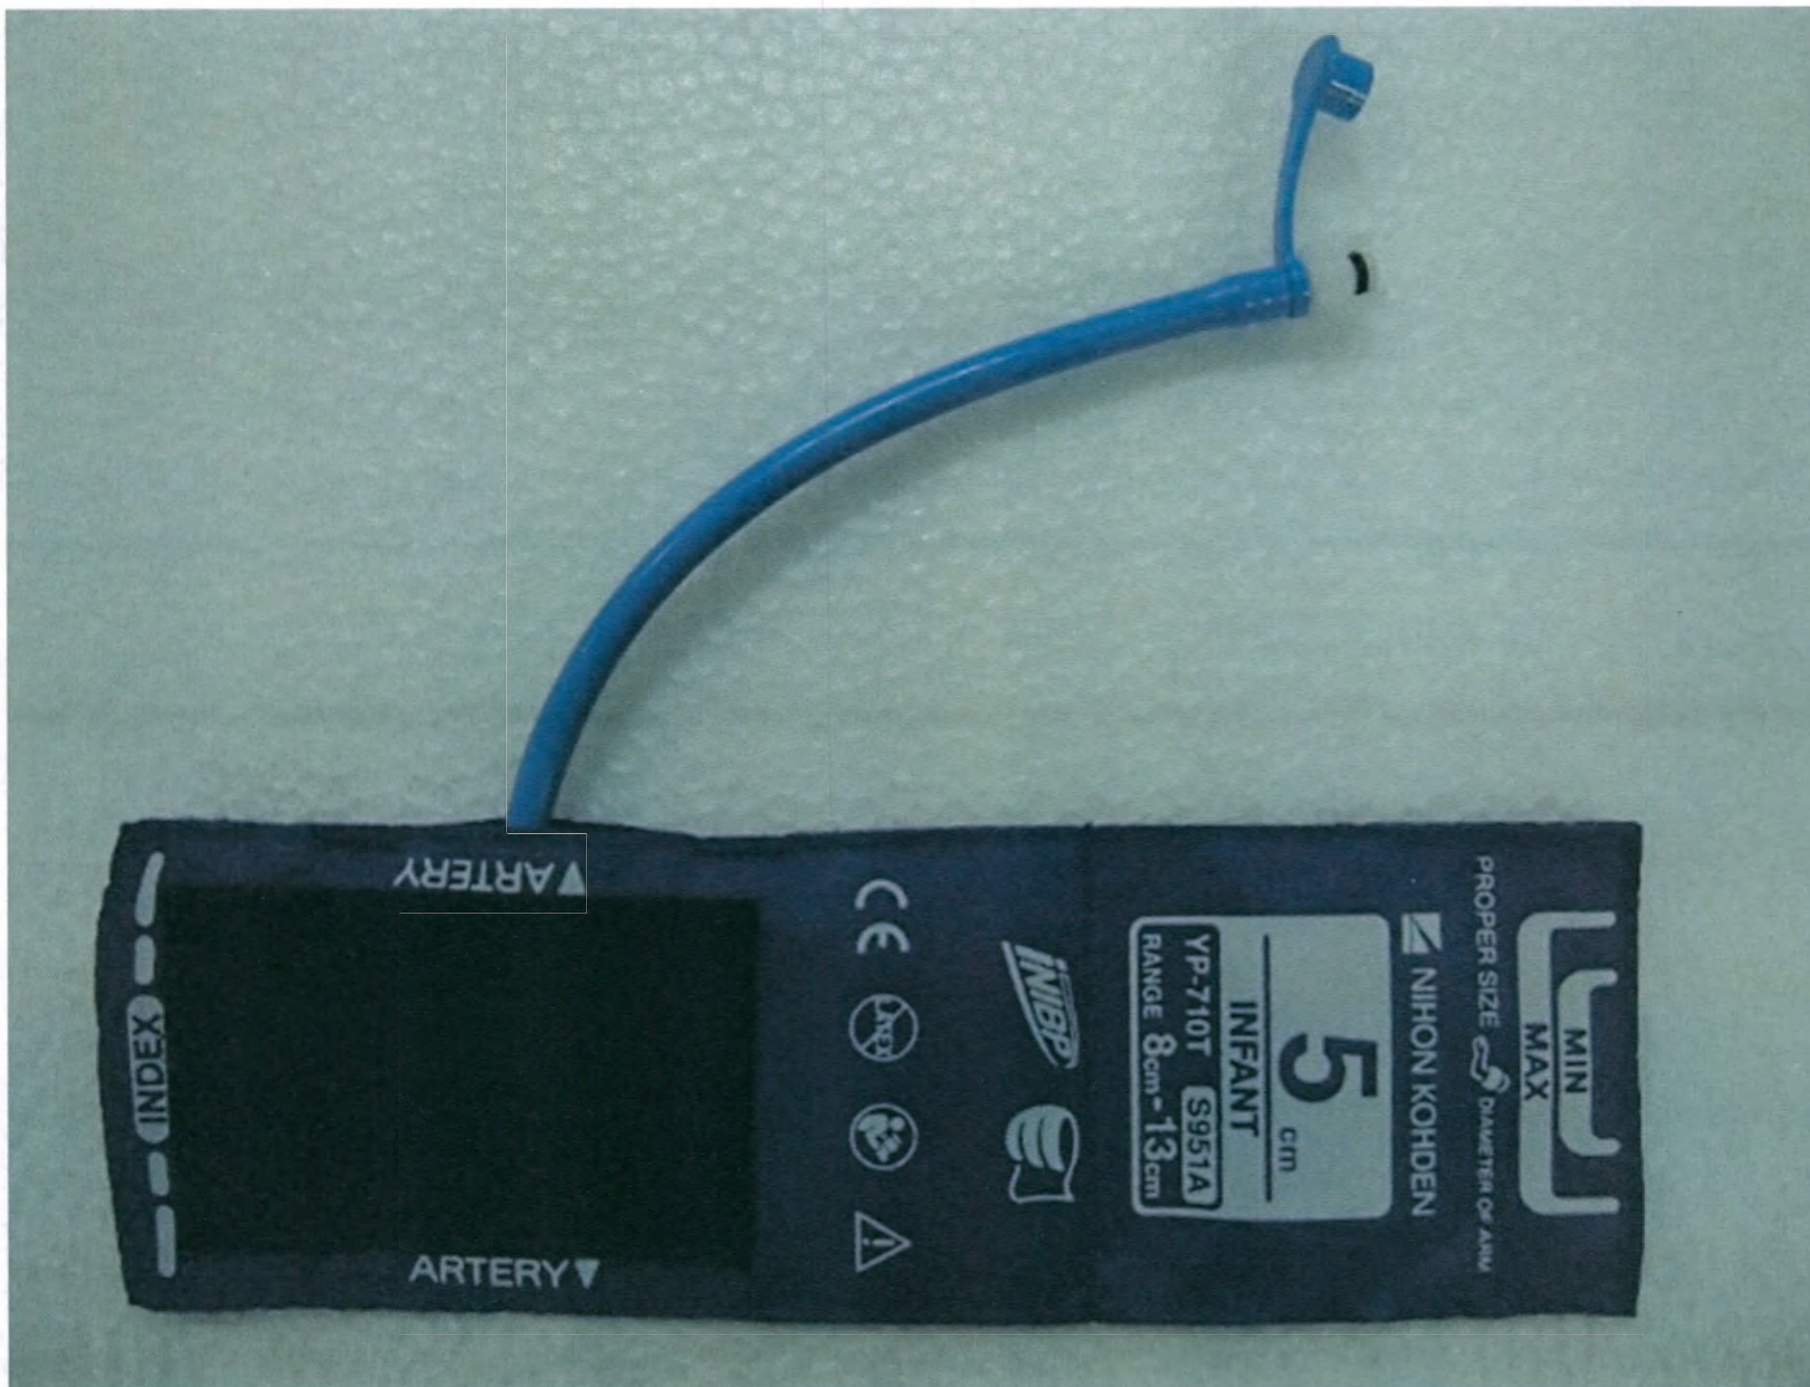


Рисунок 58. Манжета многоразовая (для новорожденных, ширина 5 см)



Рисунок 59. Манжета многоразовая (для детей, ширина 7 см)



Рисунок 60. Манжета многоразовая (для взрослых малая, ширина 10 см)



Рисунок 61. Манжета многоразовая (для взрослых стандарт, ширина 13 см)



Рисунок 62. Манжета многоцветная (для взрослых большая, ширина 16 см)



Рисунок 63. Манжета многоразовая (для взрослых бедренная, ширина 19 см)



Рисунок 64. Общий вид транспортной упаковки монитора пациента GZ-130P



Рисунок 65. Вид упакованного изделия в коробке



Рисунок 66. Общий вид транспортной упаковки монитора пациента GZ-140P



Рисунок 67. Вид упакованного изделия в коробке



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листов.

Генеральный директор ООО «ТМС»
Сергеев Р.В.

