

Ниже представлены фото приборов, на которых проводились клинические испытания:

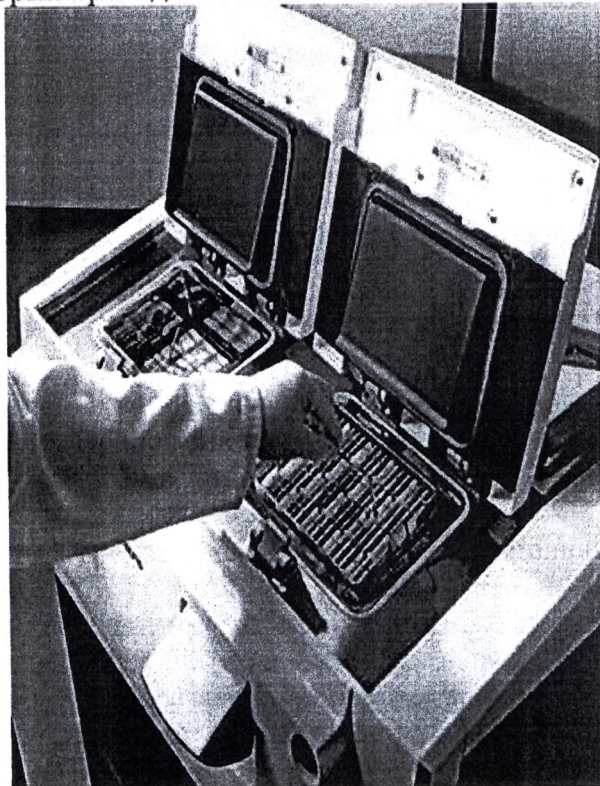
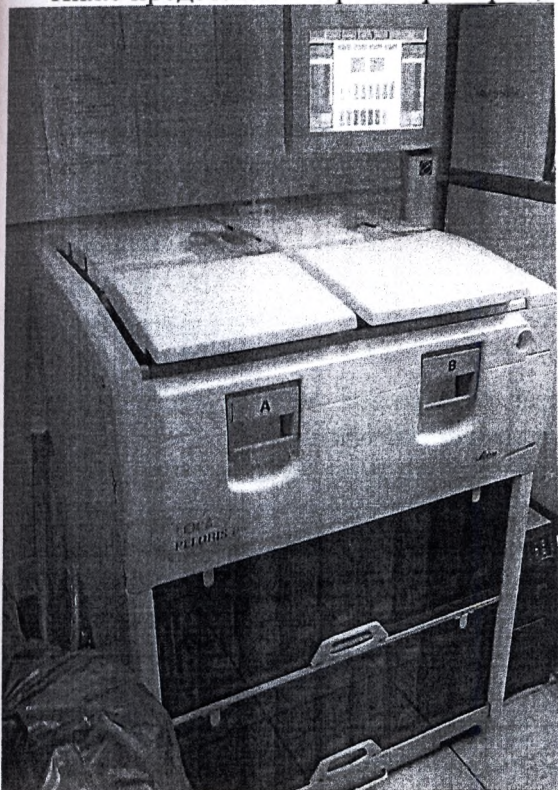


Фото прибора Peloris II

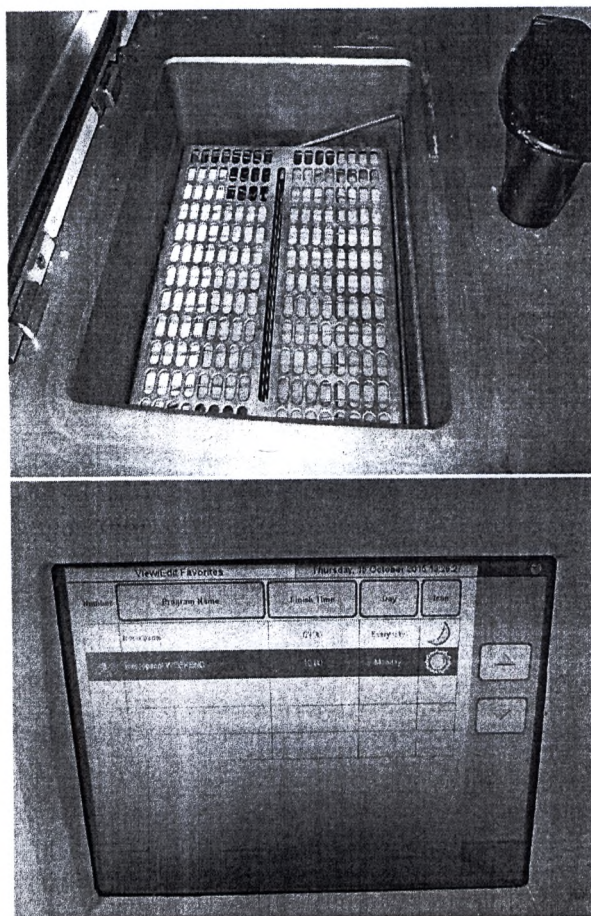
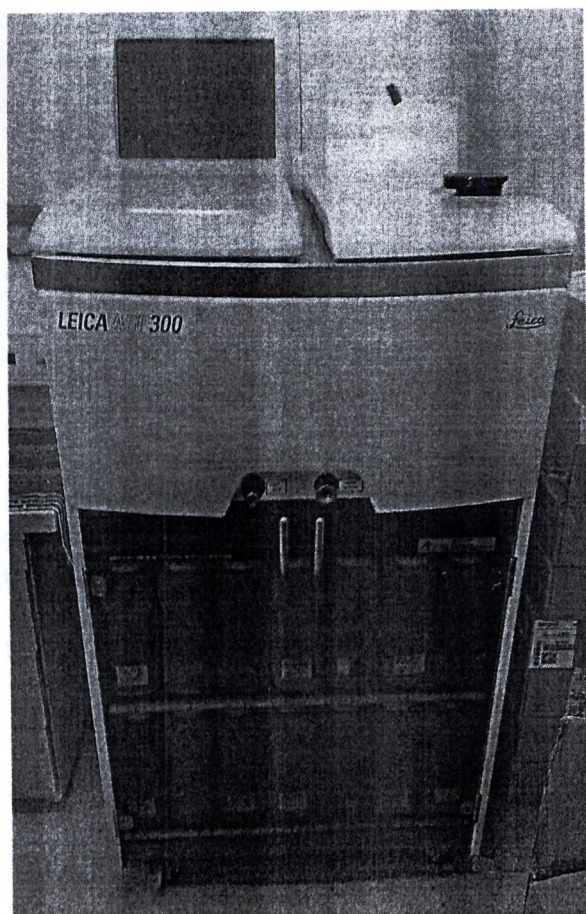


Фото прибора Leica ASP300

Воспрещается полностью либо частично перепечатка, либо копирование настоящего Протокол без разрешения
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России