

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТРЕЙТ»

Артамонова Н.С.


«31» мая 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
«Инструменты Системы имплантационной
стоматологической ROOTT»



Общий вид Сверла спирального, материал: SS

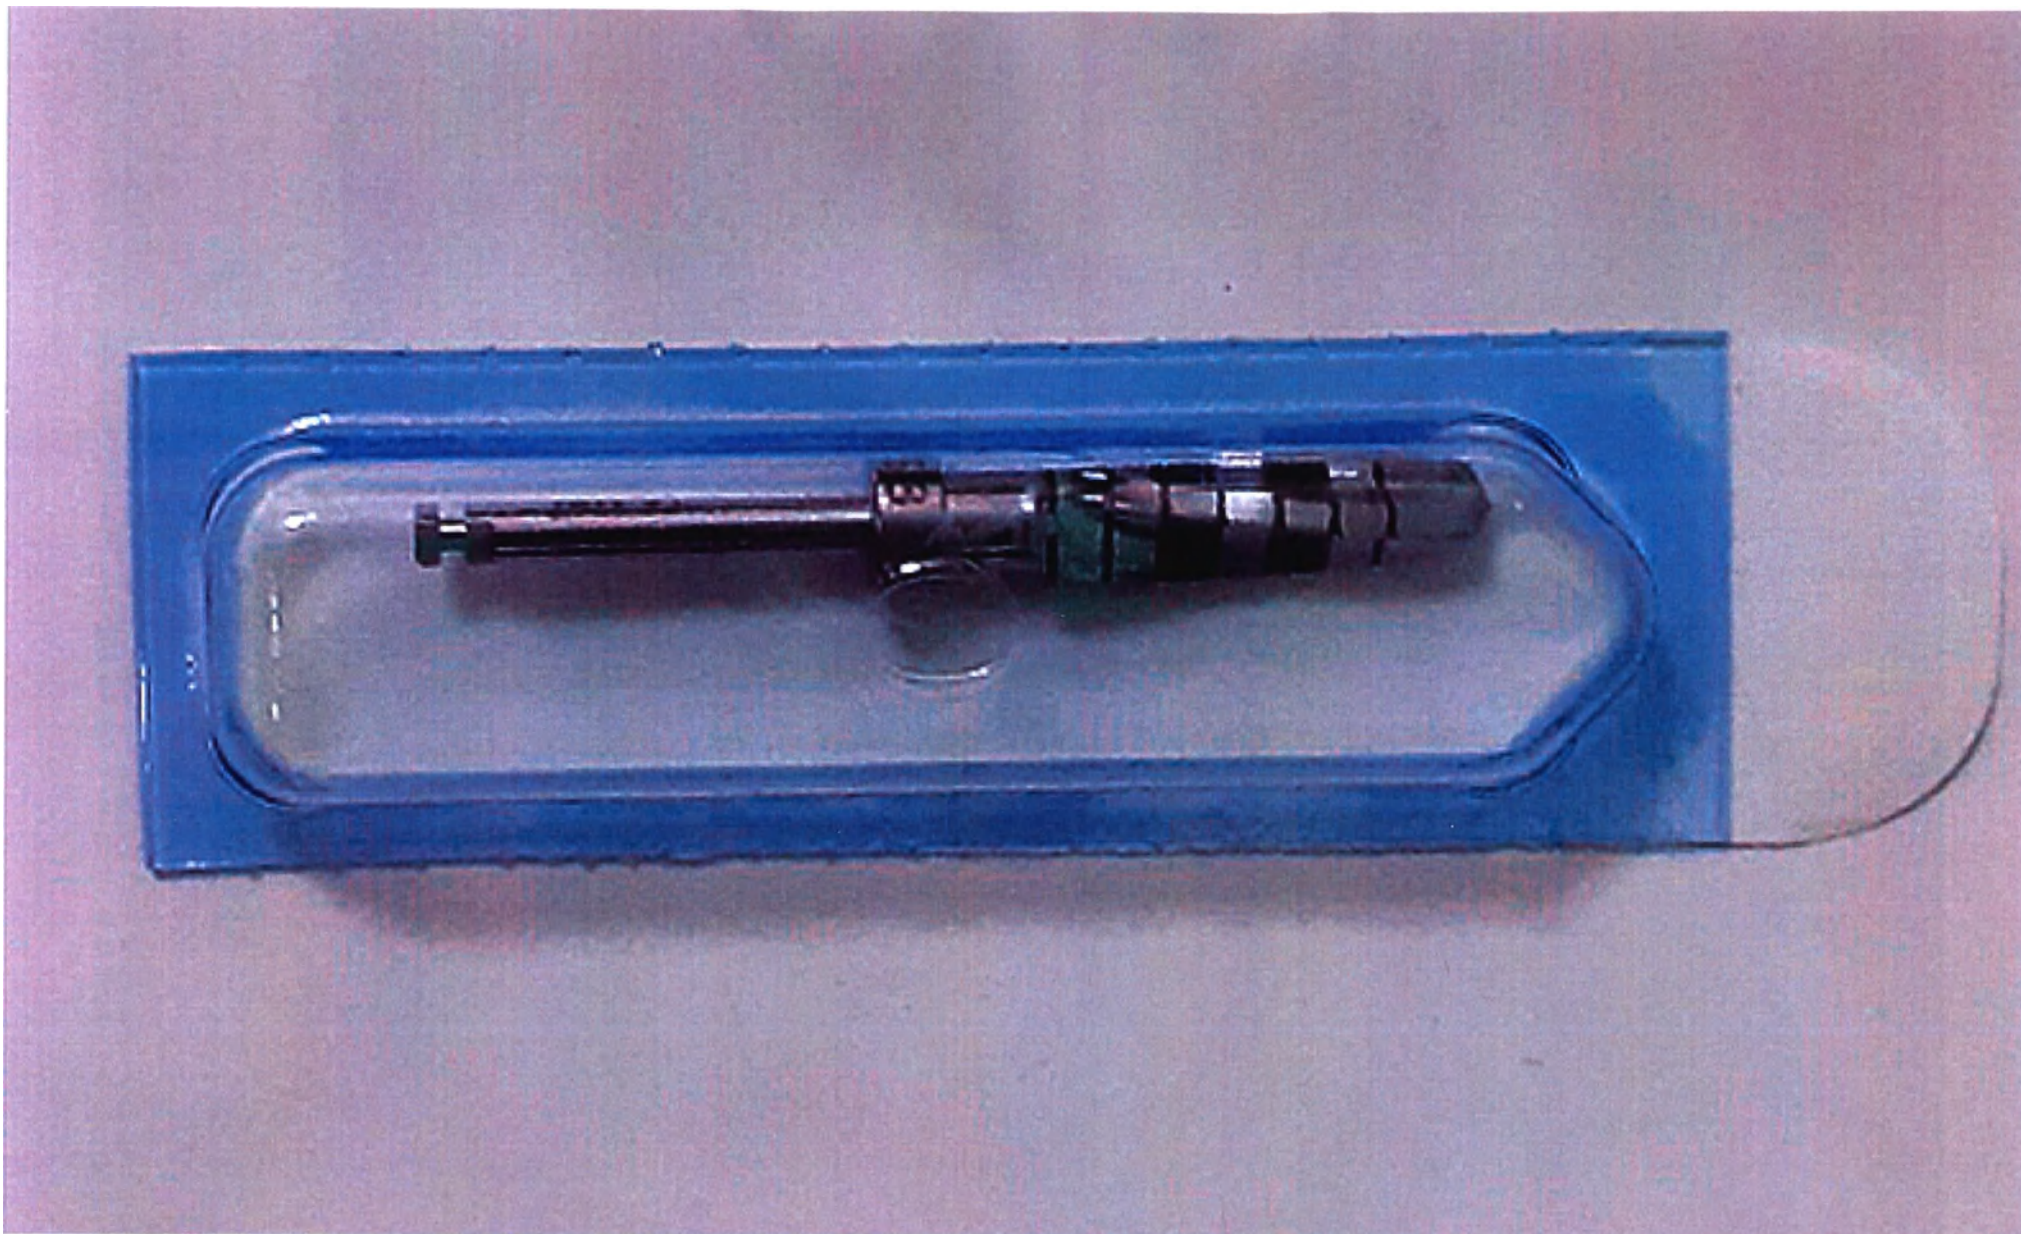




Общий вид **Сверла формирующего**, материал: SS в упаковке (блистер)




Общий вид Метчика, материал: Ti6Al4V в упаковке (блистер в коробке)

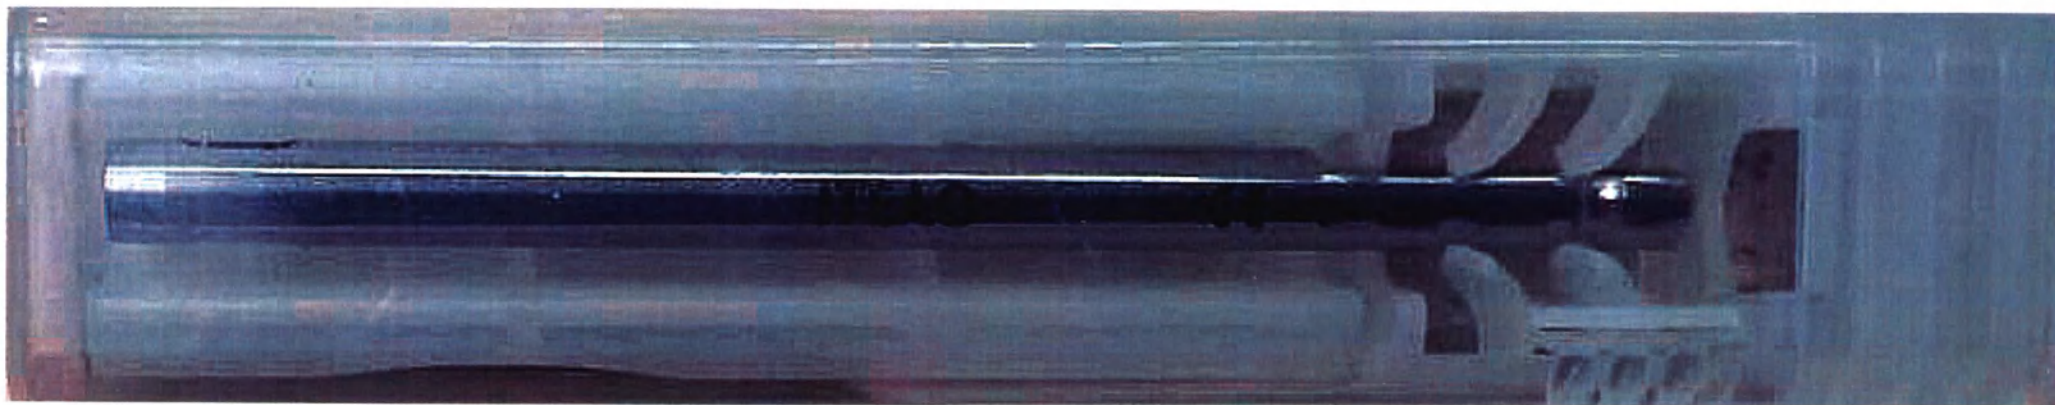

Общий вид **Имплантовода, материал: SS** в упаковке (в контейнере)



Общий вид Отвёртки, материал: SS

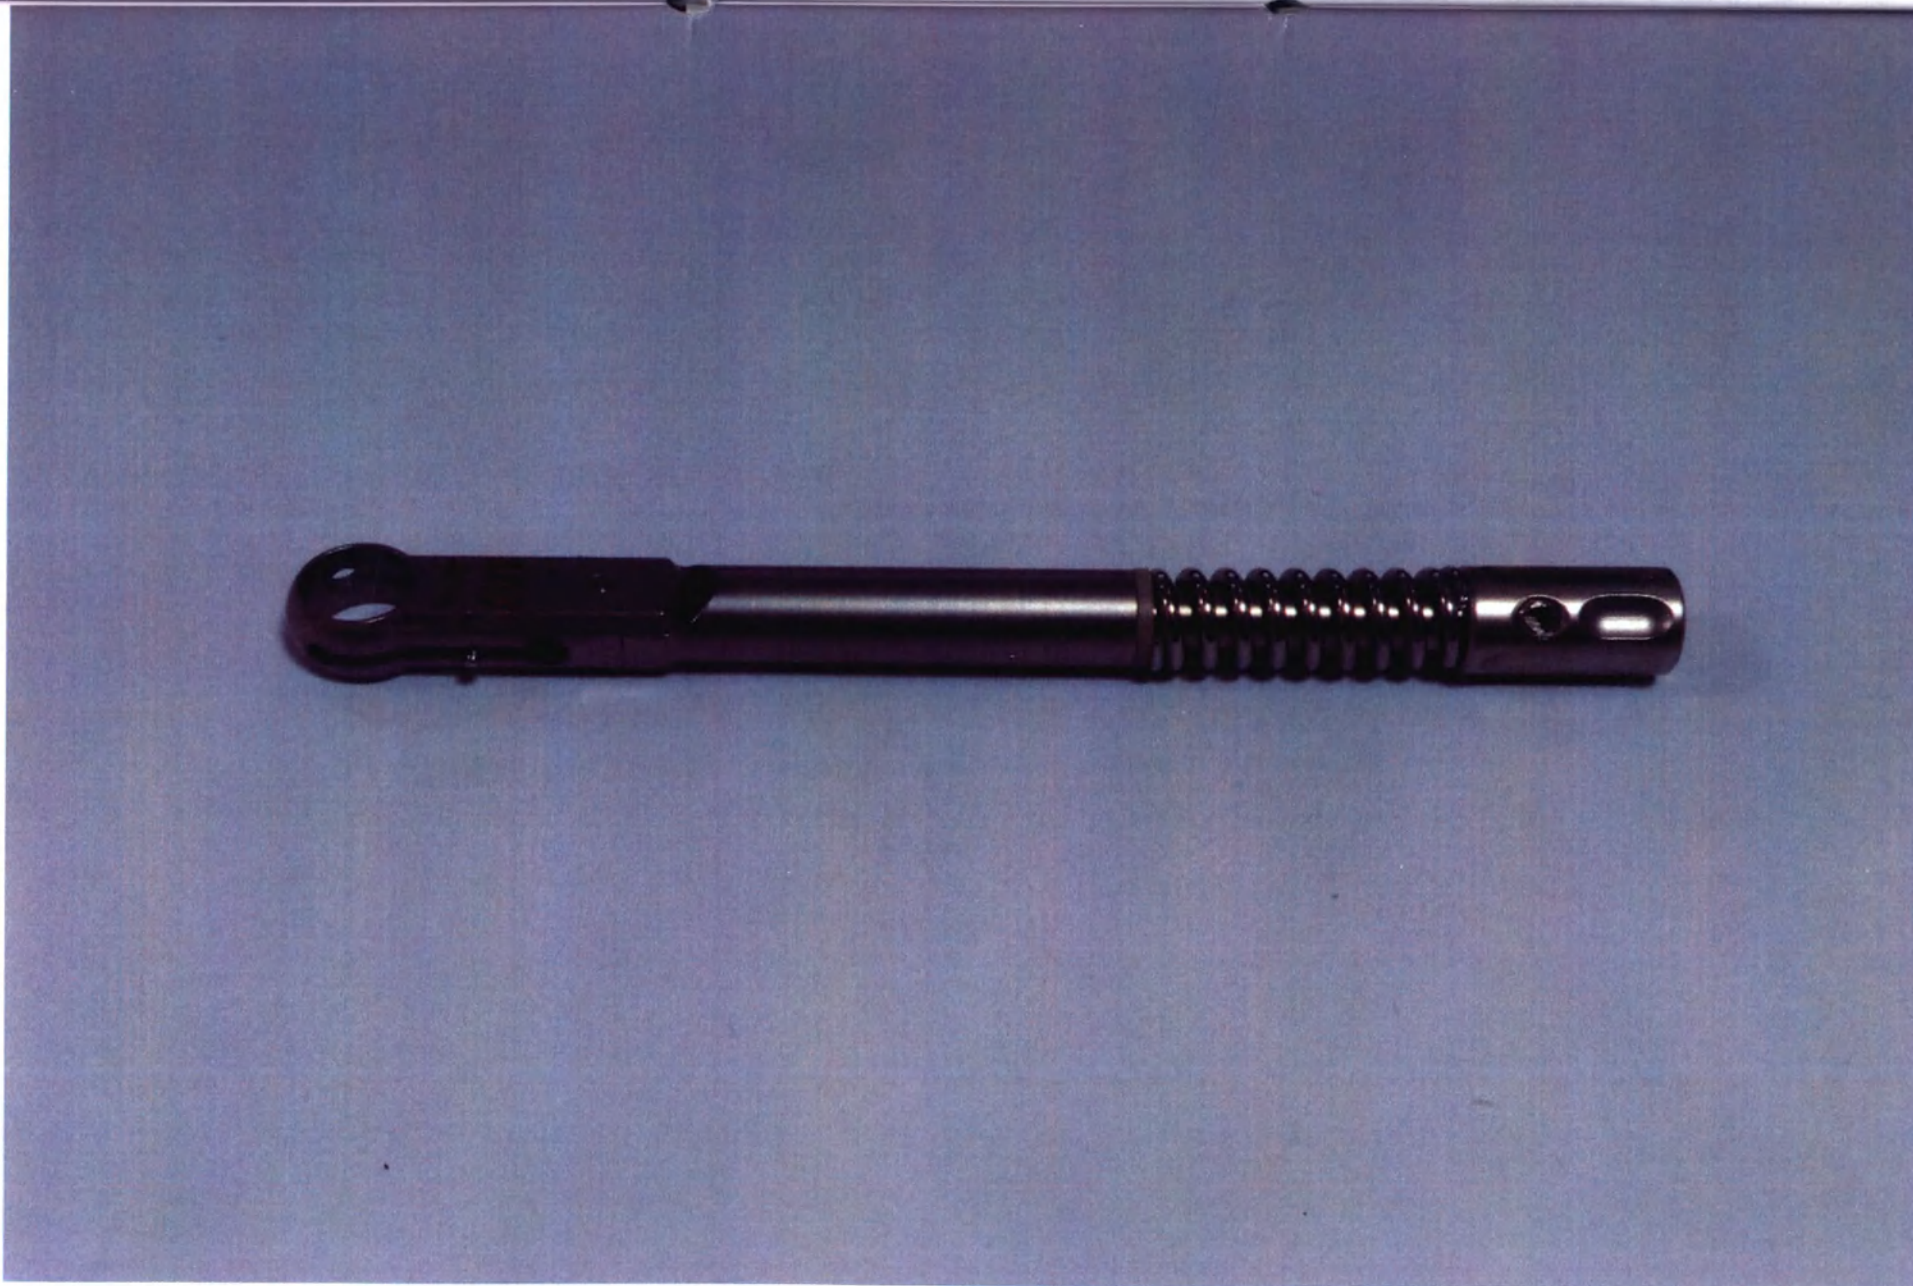


Общий вид Ключа, материал: SS


open implant system




Общий вид Извлекателя абатмента, материал: Ti6Al4V в упаковке (блистер в коробке)

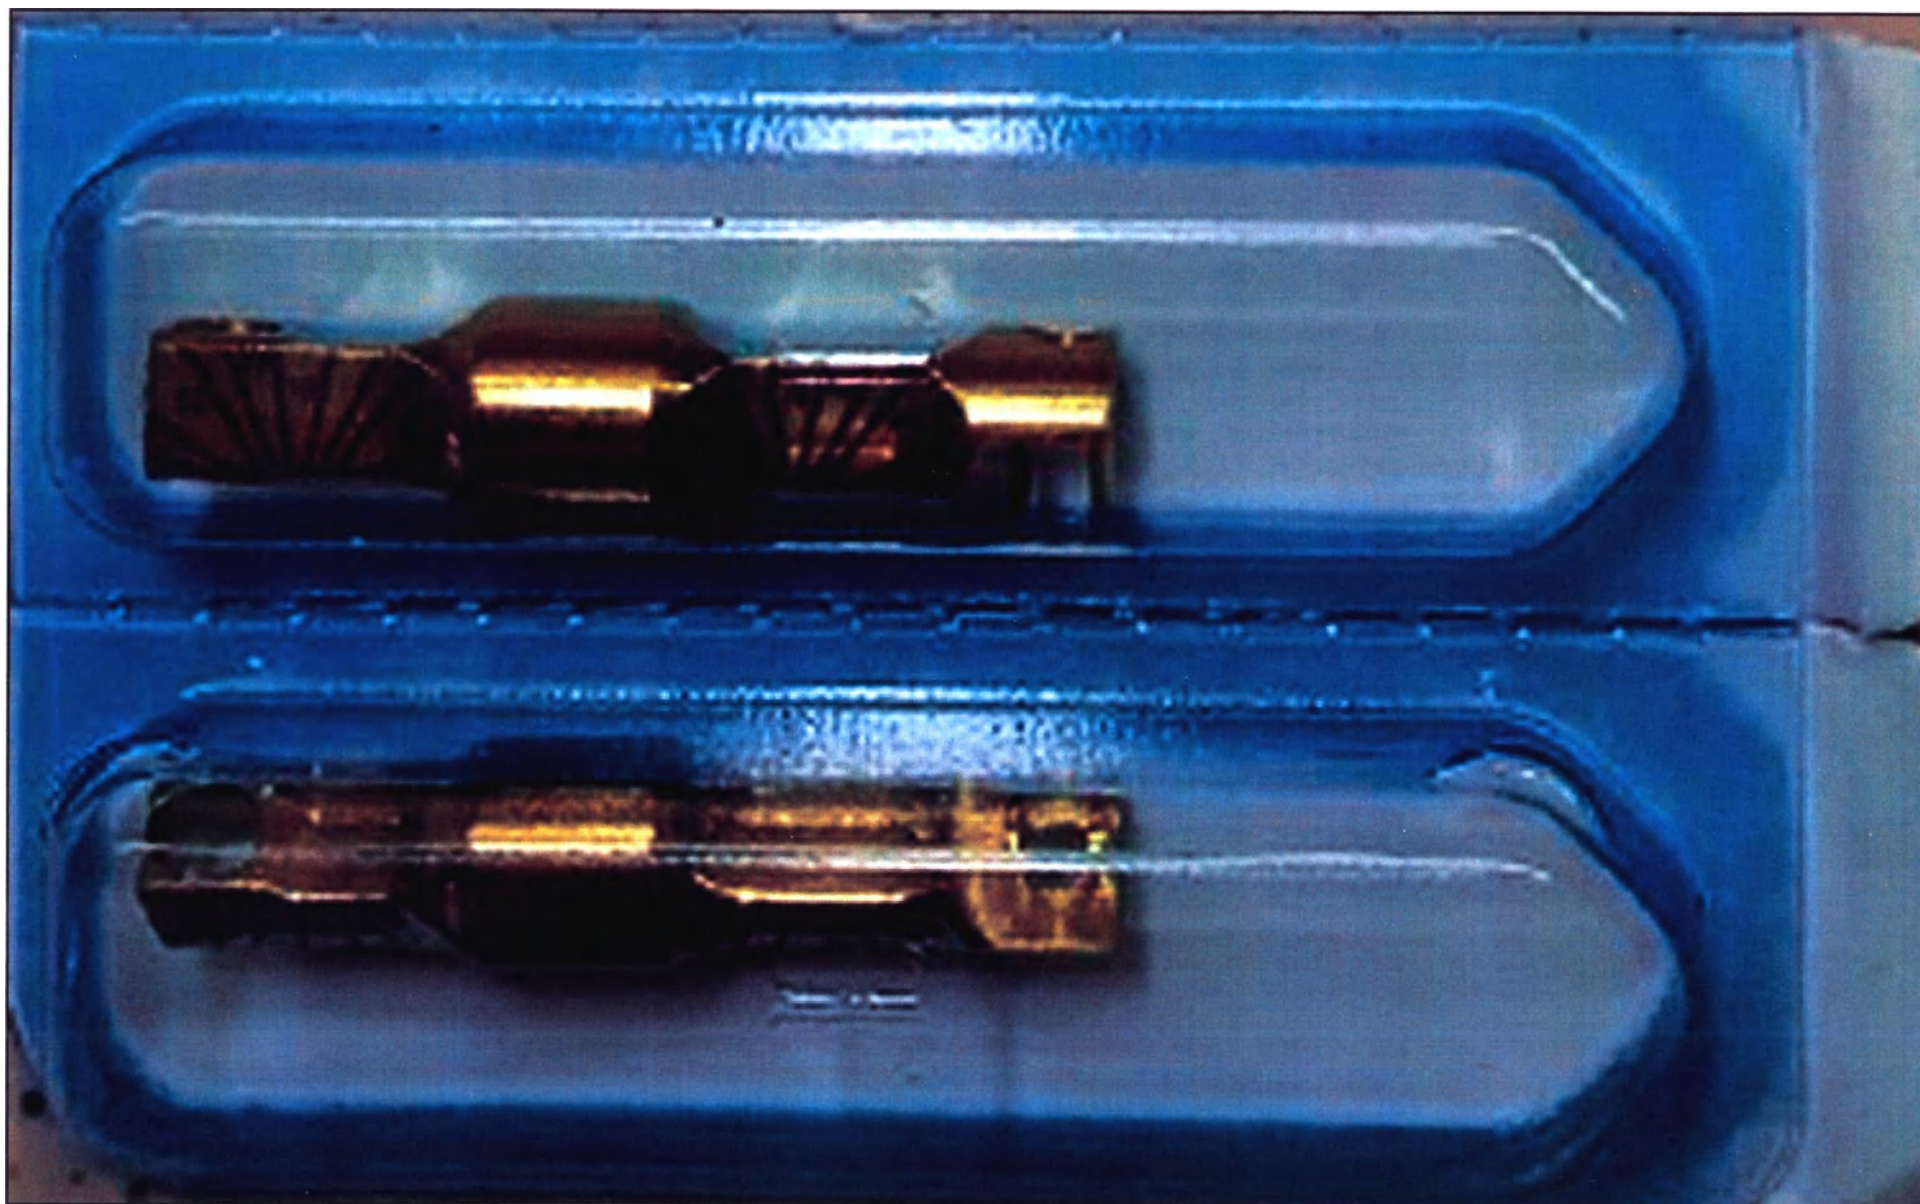

Общий вид **DIR**, Индикатор наклона, материал: **Ti6Al4V** в упаковке (блистер)

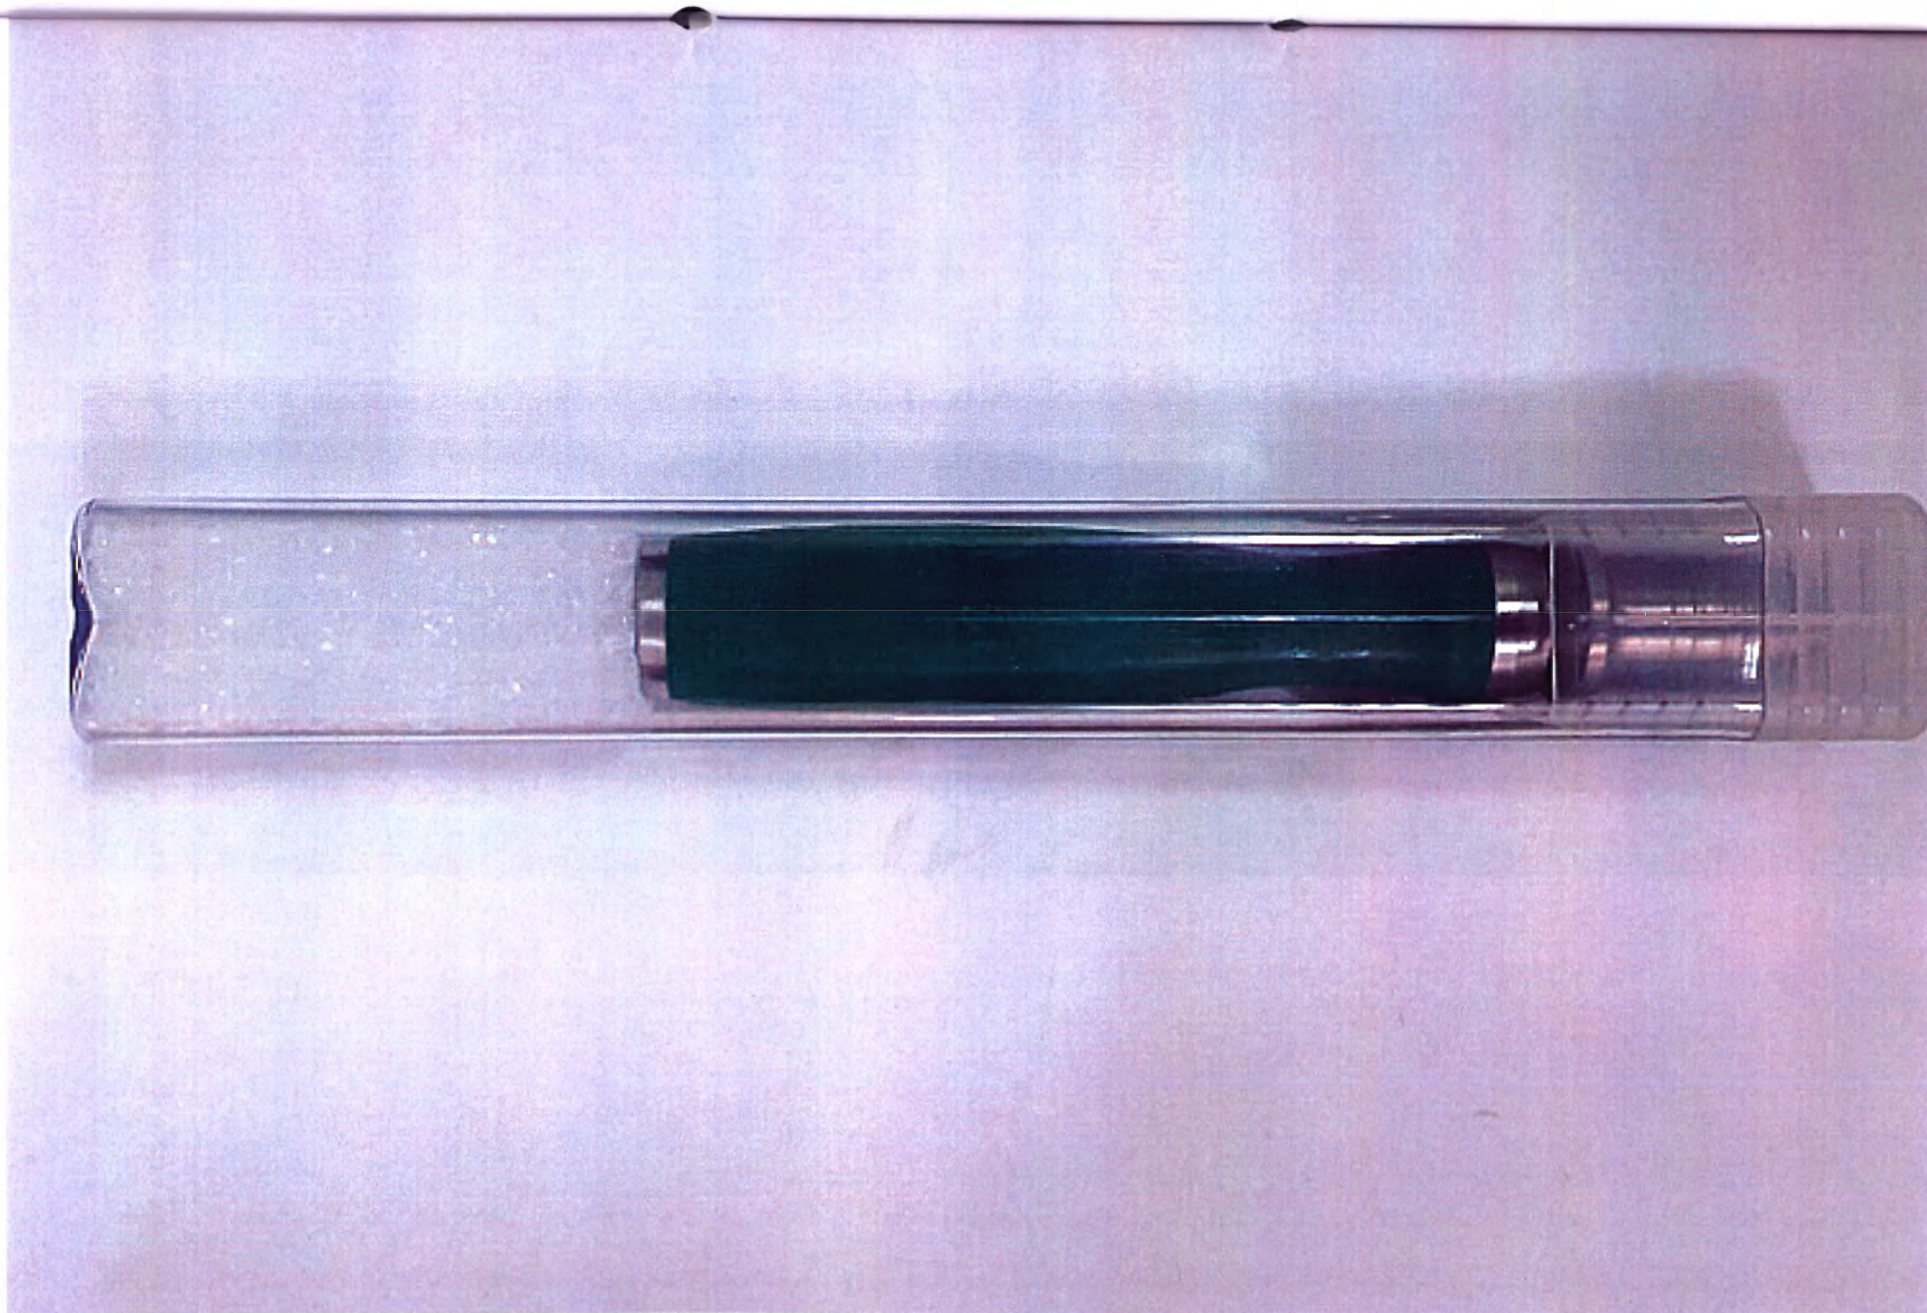

Общий вид ЕТАО, Рукоятка, АО в упаковке (контейнер)

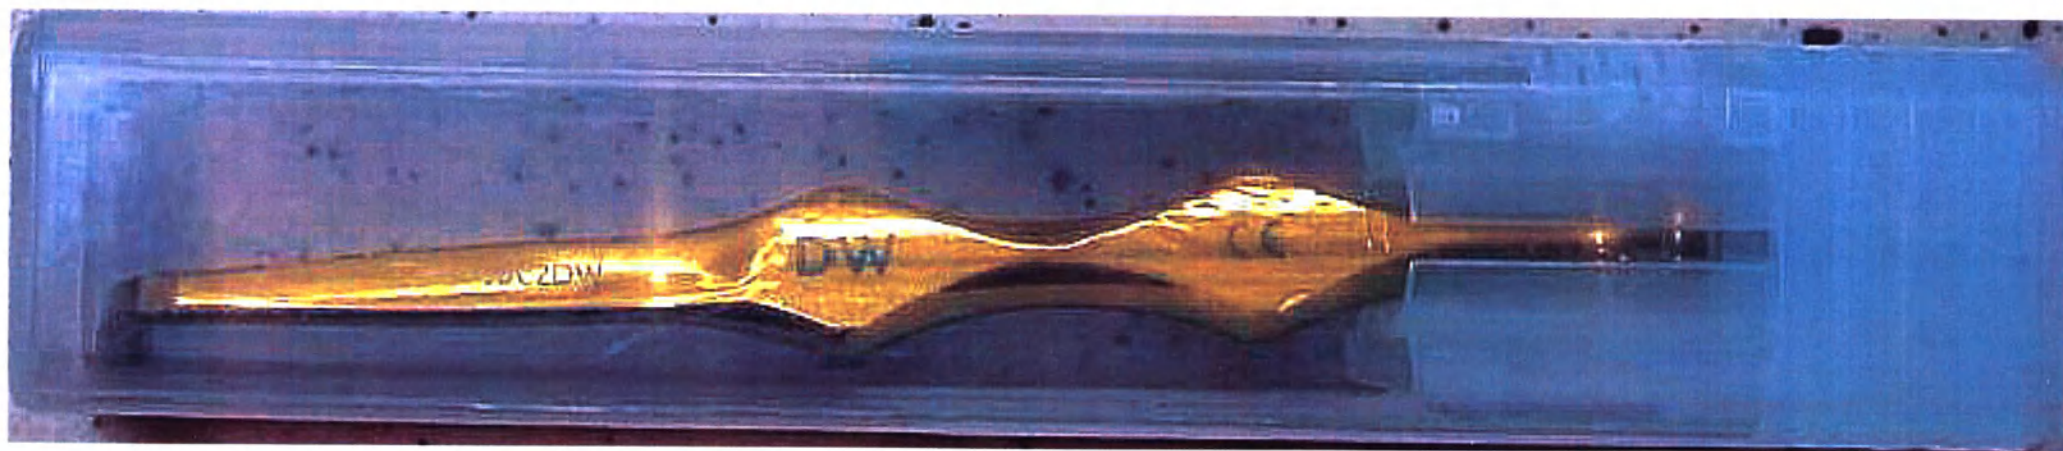

Общий вид DW, Рукоятка для имплантовода в упаковке (контейнер)

REF

XXX

LOT

XXX



XX XXXX

/наименование изделия/

Изготовитель: ТРЕЙТ АГ, Банхофстрассе 16, 6037 Рут, Швейцария

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2013/22 от XX XXXX

Внимание: перед использованием необходимо стерилизовать

Макет этикетки на русском языке



Макет транспортной маркировки на примере МИ DC4014, Сверло для С4014

Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью 14 лист об

Генеральный директор
ООО «ТРЕЙТ»

Н.С. Артамонова

