




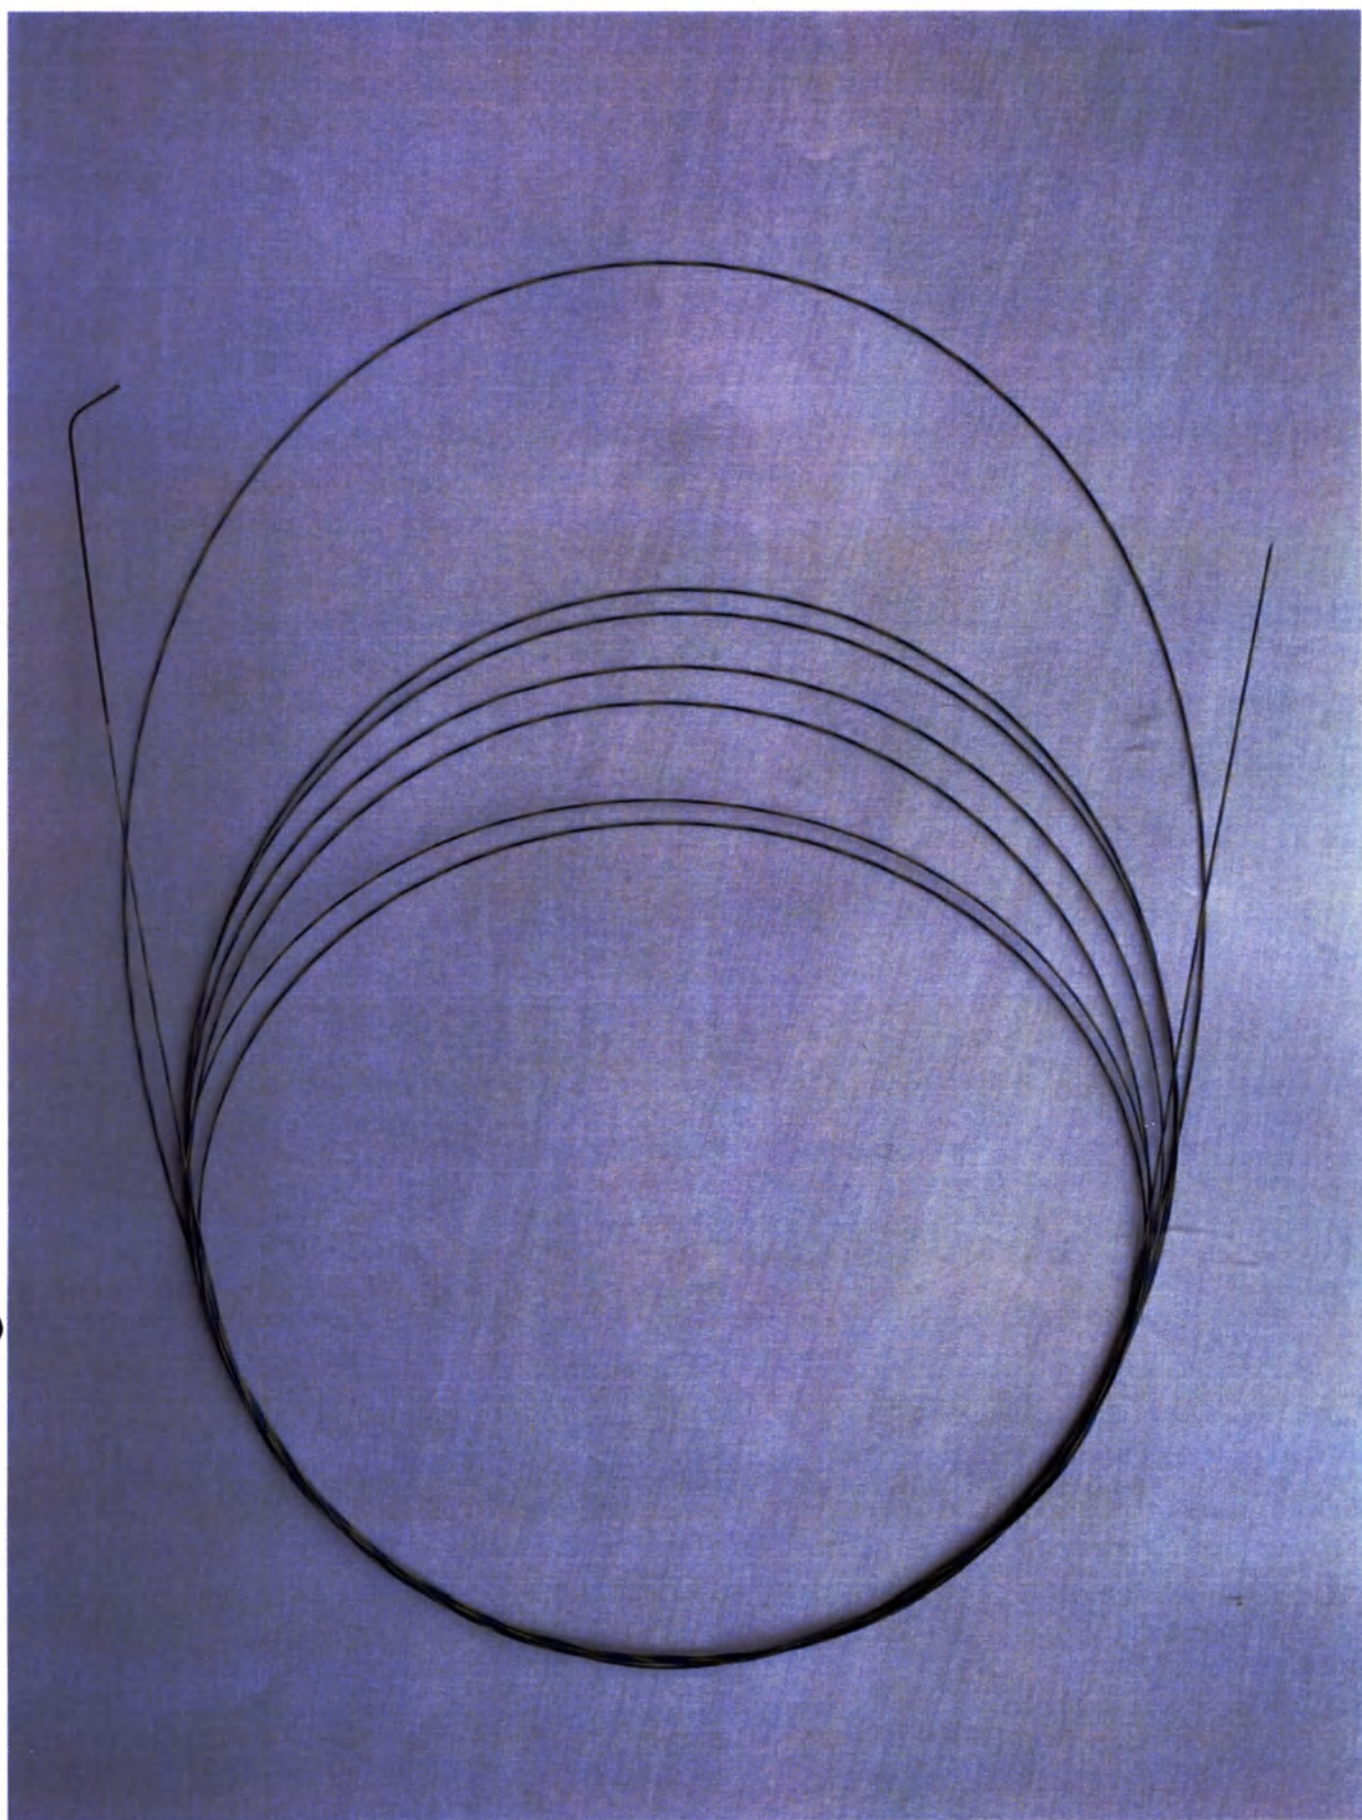

Проводник эндоскопический стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022 (Артикулы: GW260NIT0,6, GW260NIT0,6-J, GW450NIT0,6, GW450NIT0,6-J, GW260NIT0,8, GW260NIT0,8-J, GW450NIT0,8, GW450NIT0,8-J, GW400NIT0,8, GW400NIT0,8-J, GW400NIT0,6, GW400NIT0,6-J, GW500NIT0,8, GW500NIT0,8-J, GW500NIT0,6, GW500NIT0,6-J, GW260NIT0,4, GW260NIT0,4-J, GW450NIT0,4, GW450NIT0,4-J)

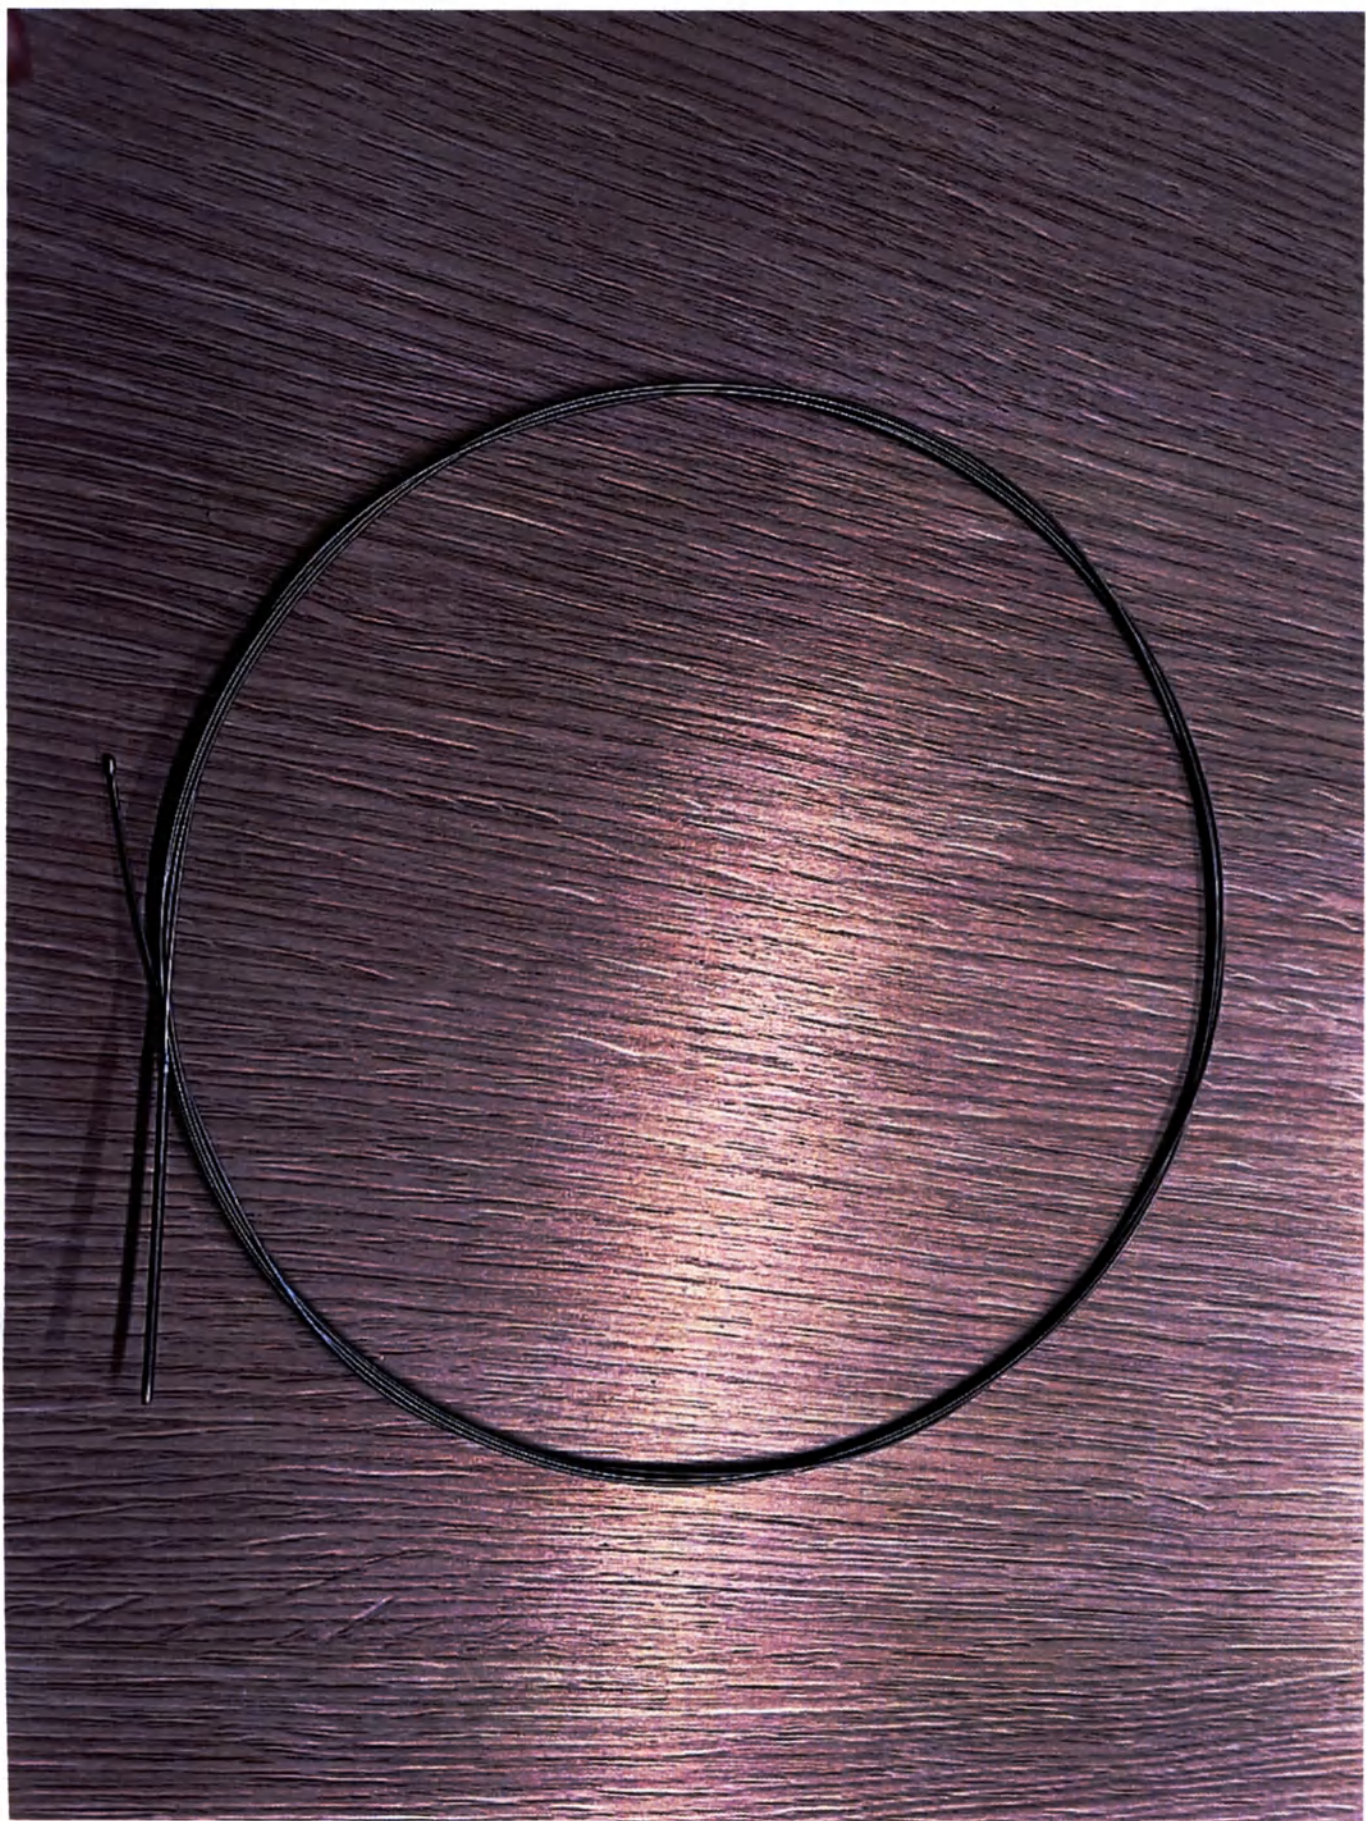

Проводник эндоскопический стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022 (Артикулы: GW300ST-06, GW400ST-06, GW300ST-08, GW400ST-08)

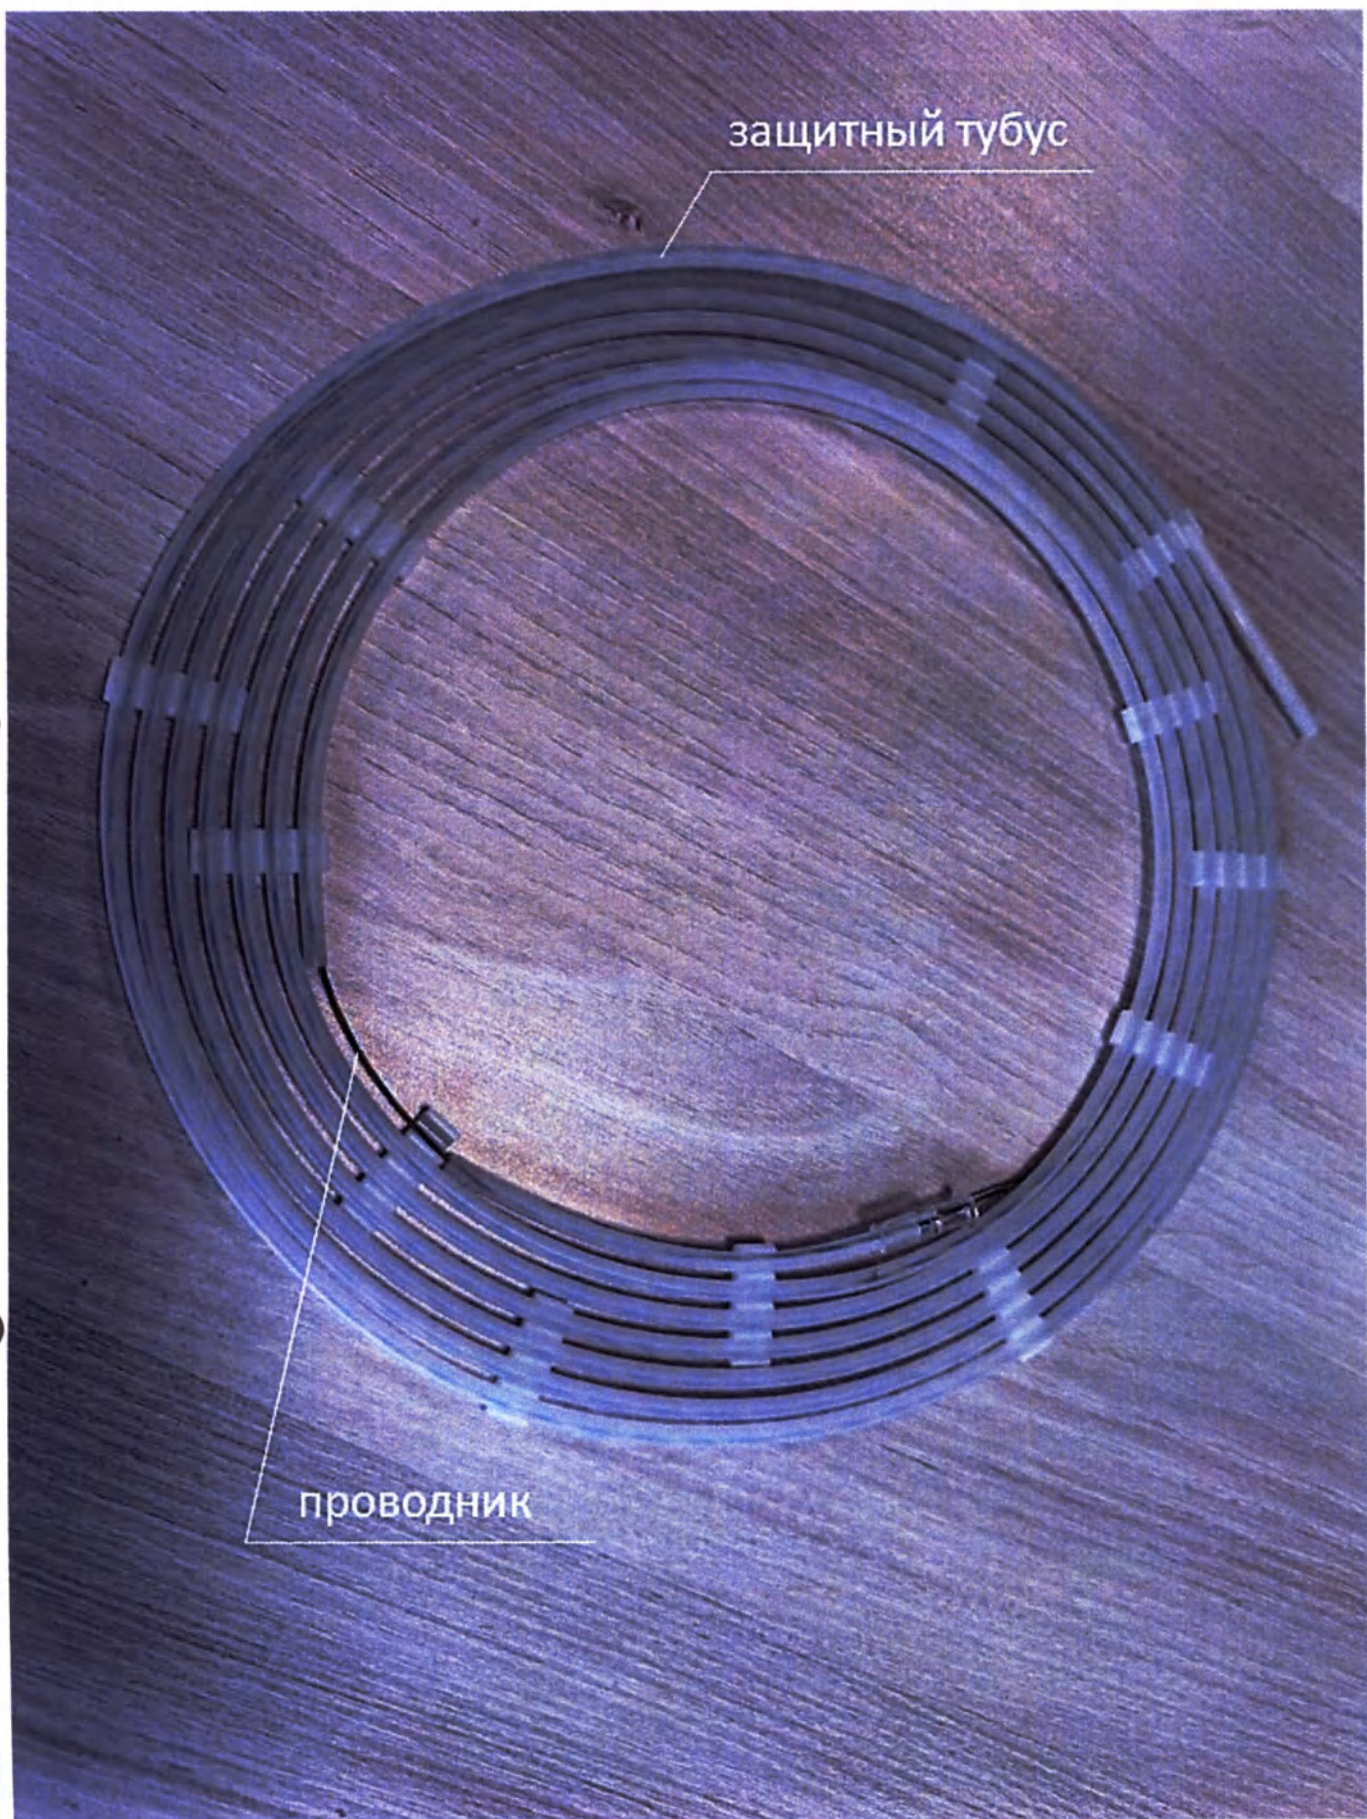

Проводник эндоскопический стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022 в защитном тубусе (все варианты исполнения)

Проводник эндоскопический

Проводник эндоскопический
стерильный однократного применения
в вариантах исполнения

4

по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022

№ РЗН XXXXXX от XXXXXX

REF

GW400ST-08

LOT

2303109130N

Материал: сталь

Прямой

Длина 400 см

Диаметр 0,889 мм

Сделано в России



2024-03

STERILE EO



2027-02



GW400ST-08




ООО «Эндо Старс» (Россия)
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 27А, 12Н
тел.: 8(800) 555-56-57,
+7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

EndoStars®
...all you need for endoscopy!

Проводник эндоскопический стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022 (Пример маркировки)



Проводник эндоскопический стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022 (Пример стерильной упаковки)

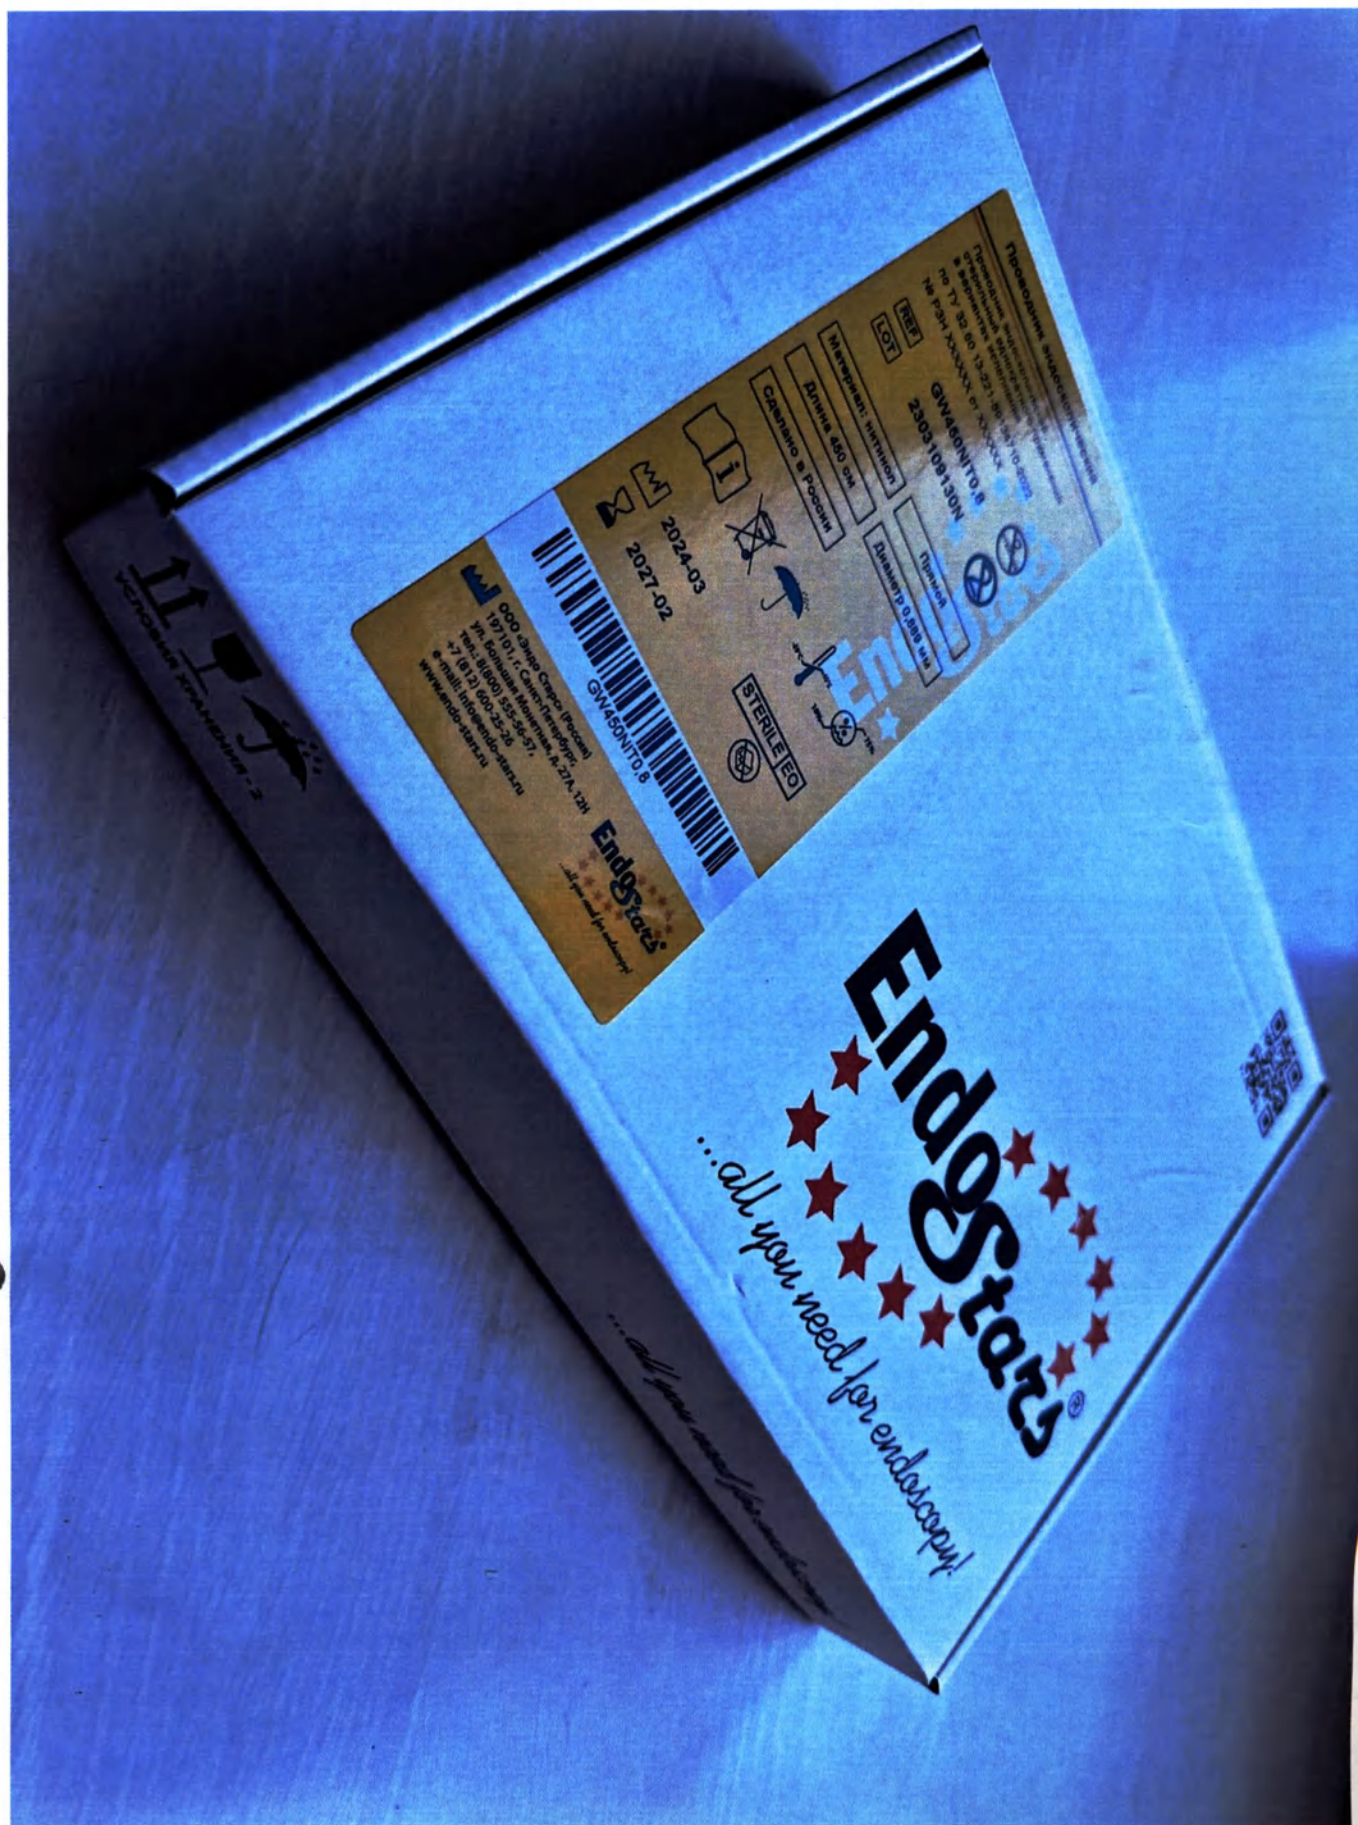

Проводник эндоскопический стерильный однократного применения по ТУ 32.50.13-221-89134710-2022 (Пример транспортной упаковки)

ООО «Эндо Старс»
Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью

шесть ⁶ листа(ов)

Генеральный директор
Самарец В.С.

