


**Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия:
Тест-полоски GLUCOCARD W к системе мониторинга глюкозы в крови GLUCOCARD W**



Заместитель директора по качеству ООО «АРКРЭЙ» Семенова М. Ю.

(по доверенности от 28 ноября 2018 года).

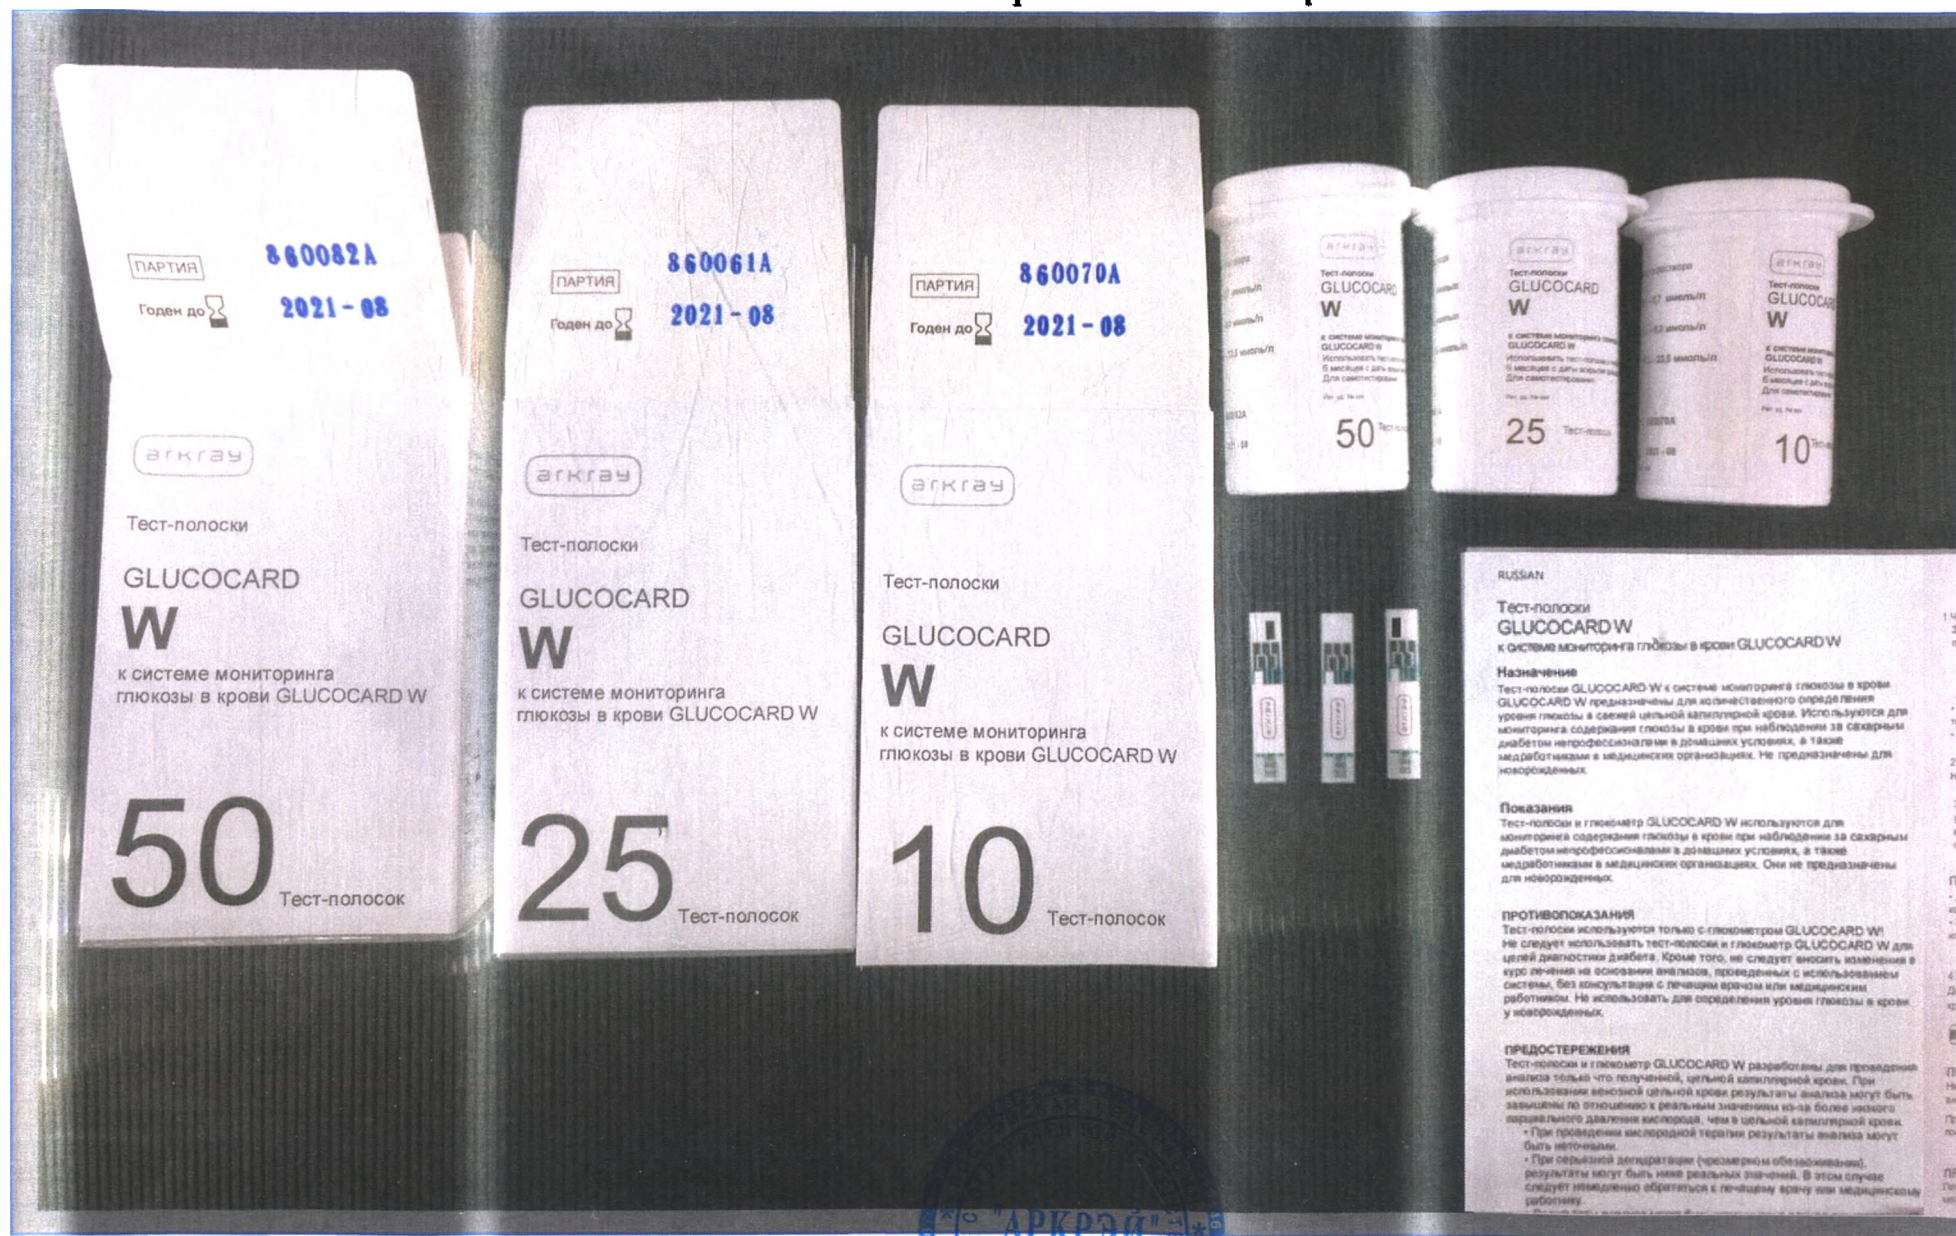