

Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия:
Система мониторинга глюкозы в крови GLUCOCARD W.

Комплект № 1 (Общий вид)

GLUCOCARD W	Комплект №1	/Изготовлен : 2018-01		ARKRAY Factory, Inc 1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi, Shiga 520- 3306, Japan
Система мониторинга глюкозы в крови	Глюкометр	/Сер. Номер : 7210LR700008		
Для диагностики <i>in vitro</i>	GLUCOCARD W	/Партия : 287374A	Рег. уд. № xxx	
Единица измерения: ммоль/л	Тест-полоски (10 шт.)	/Годен до : 2019-05		
Батарея CR2032 установлена в прибор	GLUCOCARD W	/Партия : 15C2303		
	Ланцеты	/Годен до : 2020-02		
	MultiJet Super Soft (10 шт.)	/Партия : P6A		
	Прокалывающее устр.		REF xxx	
	Multi-Lancet Device2		Сделано в России	
	Чехол			
	Организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 Тел. 8(499) 703-34-92			

SELF-TESTING




arkray

GLUCOCARD
W

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 7 СЕКУНД
ОБЪЕМ ПРОБЫ 0,5 МКЛ
БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ТЕСТ-ПОЛОСКИ



GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №1

Глюкометр

GLUCOCARD W

Тест-полоски (10 шт.)

GLUCOCARD W

Ланцеты

Multilet Super Soft (10 шт.)

Прокалывающее устр.

Multi-Lancet Device2

Чехол

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92

/Изготовлен 2018-01

/Сер. Номер 7210LR700008

/Партия 287374A

/Годен до 2019-05

/Партия 15C2303

/Годен до 2020-02

/Партия P6A



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Рег. уд. № xxx

REF xxx

Сделано в России

Комплект № 1 (Состав)

① Глюкометр

GLUCOCARD W - 1 шт.;

② Тест-полоски


GLUCOCARD W - 1 уп. (10 шт.);

③ Прокалывающее

устройство Multi-Lancet
Device2 (рег.уд. № РЗН
2015/3329) – 1 шт;

④ Ланцеты Multilet Super
Soft (рег. уд. № РЗН
2013/179) – 1 уп. (10 шт.);

⑤ Чехол – 1 шт.

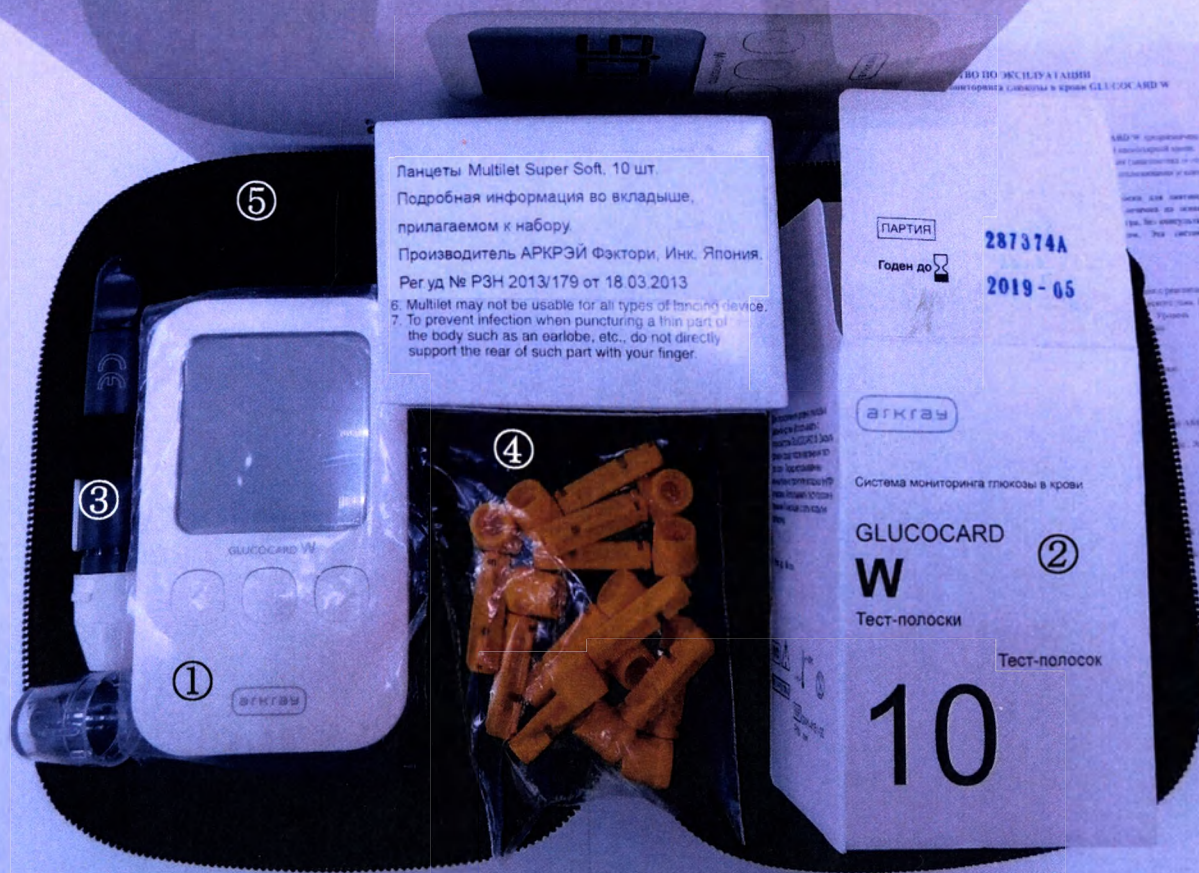

Комплект № 1 (Маркировка)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*
Единица измерения: ммоль/л
Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №1	/Изготовлен	2018-01
Глюкометр	/Сер. Номер	7210LR700008
GLUCOCARD W		
Тест-полоски (10шт.)	/Партия	287374A
GLUCOCARD W	/Годен до	2019-05
Ланцеты	/Партия	15C2303
Multilet Super Soft (10 шт.)	/Годен до	2020-02
Прокалывающее устр.	/Партия	P6A
Multi-Lancet Device2		
Чехол		

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Рег. уд. № xxx

REF xxx

Сделано в России



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставить ланцет Multilet в прокалывающее устройство.
2. Удалить защитный колпачок.
3. После применения надеть защитный колпачок на место для утилизации ланцета.
4. Подробное описание применения ланцета см. в руководстве.

ПРИМЕНЕНИЕ
Защитный колпачок
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

LOT

15C2303

Exp.

2020-02



GLUCOCARD W GT-7210

ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi,
Shiga 520-3306, Япония

7210LR700008

Сделано в России

ммоль/л



mmol/L

ПАРТИЯ

287374A

Годен до

2019-05

ВКЛГВА

Система мониторинга глюкозы в крови

GLUCOCARD

W

Тест-полоски

Тест-полосок

10

Комплект № 2 (Общий вид)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови

Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №2

Глюкометр

GLUCOCARD W

Тест-полоски (25 шт.)

GLUCOCARD W

Ланцеты

Multi-Soft Super Soft (10 шт.)

Прокалывающее устр.

Multi-Lancet Device2

Чехол

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92

/Изготовлен : 2018-01

/Сер. Номер : 7210LR700009

/Партия : 287373A

/Годен до : 2019-05

/Партия : 15C2303

/Годен до : 2020-02

/Партия : P6A



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Per. уд. № xxx

REF XXX


Сделано в России

arkray

GLUCOCARD W

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 7 СЕКУНД
ОБЪЕМ ПРОБЫ 0,5 МКЛ
БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ТЕСТ-ПОЛОСКИ




GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №2	/Изготовлен	2018-01
Глюкометр	/Сер. Номер	7210LR700009
GLUCOCARD W		
Тест-полоски (25 шт.)	/Партия	287373A
GLUCOCARD W	/Годен до	2019-05
Ланцеты	/Партия	15C2303
MultiJet Super Soft (10 шт.)	/Годен до	2020-02
Прокалывающее устр.	/Партия	P6A
Multi-Lancet Device2		
Чехол		

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел: 8(499) 703-34-92



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan


Рег. уд. № xxx

REF XXX

Сделано в России

Комплект № 2 (Состав)

- 1 Глюкометр GLUCOCARD W - 1 шт.;
- 2 Тест-полоски GLUCOCARD W - 1 уп. (25 шт.);
- 3 Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2 (рег.уд. № РЗН 2015/3329) – 1шт;
- 4 Ланцеты Multilet Super Soft (рег. уд. № РЗН 2013/179) – 1 уп. (10 шт.);
- 5 Чехол – 1 шт.

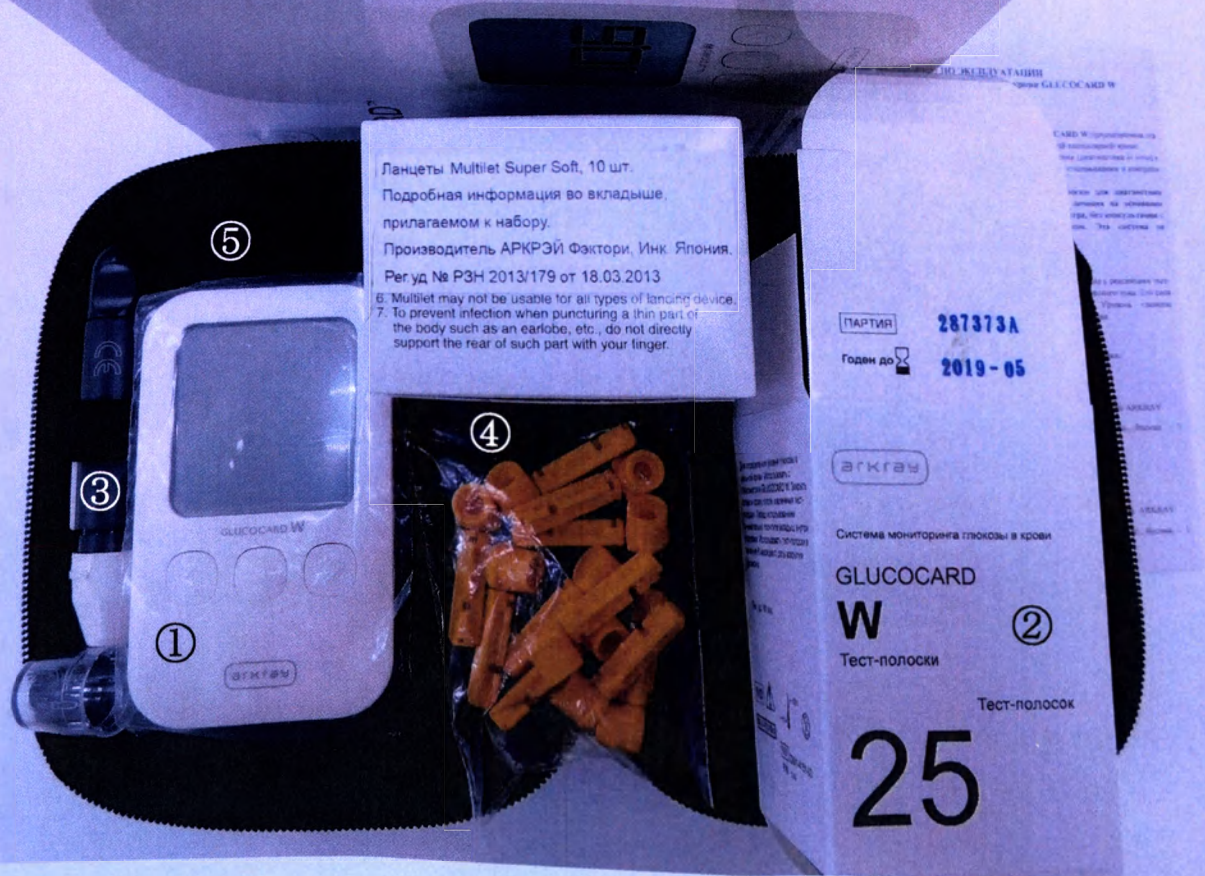

Комплект № 2 (Маркировка)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови

Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №2

Глюкометр

GLUCOCARD W

Тест-полоски (25 шт.)

GLUCOCARD W

Ланцеты

Multilet Super Soft (10 шт.)

Прокалывающее устр.

Multi-Lancet Device2

Чехол

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.

Программистов, д. 4

Тел: 8(499) 703-34-92

/Изготовлен 2018-01

/Сер. Номер 7210LR700009

/Партия 287373A

/Годен до 2019-05

/Партия 15C2303

/Годен до 2020-02

/Партия P6A



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Per. уд. № xxx

REF XXX

Сделано в России

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставить ланцет Multilet в прокалывающее устройство.
2. Удалить защитный колпачок.
3. После применения надеть защитный колпачок на место для утилизации ланцета.
4. Подробное описание применения ланцета см. в руководстве.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защитный колпачок

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

LOT

15C2303

Exp.

2020-02

ПАРТИЯ

287373A

Годен до

2019-05

ARKRAY

Система мониторинга глюкозы в крови

GLUCOCARD

W

Тест-полоски

Тест-полосок

25

Комплект № 3 (Общий вид)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови

Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №3

Глюкометр

GLUCOCARD W

Тест-полоски (50 шт.)

GLUCOCARD W

Ланцеты

Multilet Super Soft (10 шт.)

Прокалывающее устр.

Multi-Lancet Device2

Чехол

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.

Программистов, д. 4

Тел. 8(499) 703-34-92

/Изготовлен : 2018-01

/Сер. Номер : 7210LR700010

/Партия : 287370A

/Годен до : 2019-05

/Партия : 15C2303

/Годен до : 2020-02

/Партия : P6A



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Рег. уд. № xxx

REF xxx



Сделано в России

arkray

GLUCOCARD W

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 7 СЕКУНД
ОБЪЕМ ПРОБЫ 0,5 МКЛ
БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ТЕСТ-ПОЛОСКИ

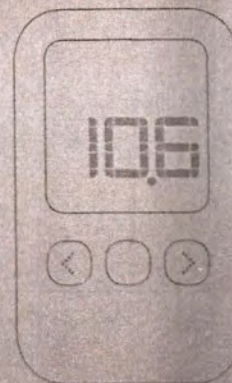

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*
Единица измерения: ммоль/л
Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №3	/Изготовлен	: 2018-01
Глюкометр	/Сер. Номер	: 7210LR700010
GLUCOCARD W		
Тест-полоски (50 шт.)	/Партия	: 287370A
GLUCOCARD W	/Годен до	: 2019-05
Ланцеты	/Партия	: 15C2303
MultiLett Super Soft (10 шт.)	/Годен до	: 2020-02
Прокалывающее устр.	/Партия	: P6A
Multi-Lancet Device2		
Чехол		

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Per. уд. № xxx

REF xxx

Сделано в России

Комплект № 3 (Состав)


① Глюкометр GLUCOCARD W - 1 шт.;

② Тест-полоски GLUCOCARD W - 1 уп. (50 шт.);

③ Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2 (рег.уд. № РЗН 2015/3329) – 1 шт.;

④ Ланцеты MultiLett Super Soft (рег. уд. № РЗН 2013/179) – 1 уп. (10 шт.);

⑤ Чехол – 1 шт.

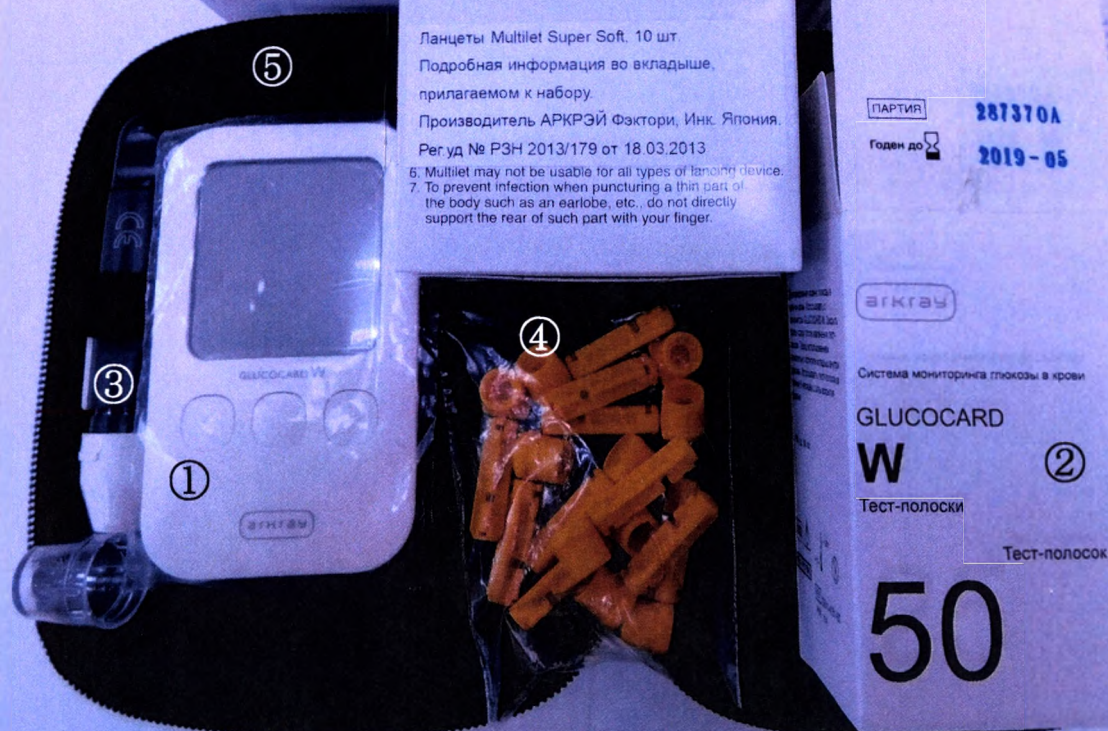

Ланцеты MultiLett Super Soft. 10 шт.
Подробная информация во вкладыше,
прилагаемом к набору.
Производитель АРКРЭЙ Фактори, Инк. Япония.
Рег.уд № РЗН 2013/179 от 18.03.2013
6. MultiLett may not be usable for all types of lancet device.
7. To prevent infection when puncturing a thin part of
the body such as an earlobe, etc., do not directly
support the rear of such part with your finger.

ПАРТИЯ

287370A

Годен до

2019-05

arkray

Система мониторинга глюкозы в крови

GLUCOCARD
W

Тест-полоски

Тест-полосок

50

Комплект № 3 (Маркировка)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*
Единица измерения: ммоль/л
Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №3
Глюкометр
GLUCOCARD W
Тест-полоски (50 шт.)
GLUCOCARD W
Ланцеты
Multilet Super Soft (10 шт.)
Прокалывающее устр.
Multi-Lancet Device2
Чехол

/Изготовлен : 2018-01
/Сер. Номер : 7210LR700010
/Партия : 287370A
/Годен до : 2019-05
/Партия : 15C2303
/Годен до : 2020-02
/Партия : P6A

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ» 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho.
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Per. уд. № xxx

REF XXX

Сделано в России

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставить ланцет Multilet в прокалывающее устройство.
2. Удалить защитный колпачок.
3. После применения надеть защитный колпачок на место для утилизации ланцета.
4. Подробное описание применения ланцета см. в руководстве.

ПРИМЕНЕНИЕ



Защитный колпачок

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

LOT

15C2303

Exp

2020-02

ПАРТИЯ

287370A

Годен до

2019-05

arkray

Система мониторинга глюкозы в крови

GLUCOCARD

W

Тест-полоски

Тест-полосок

50

GLUCOCARD W GT-7210

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho.
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

7210LR700010

Сделано в России



ммоль/л

Комплект № 4 (Общий вид)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови

Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Комплект №4

Глюкометр

GLUCOCARD W

Тест-полоски (10 шт.)

GLUCOCARD W

Чехол

/Изготовлен : 2018-01

/Сер. Номер : 7210LR700008

/Партия : 287374A

/Годен до : 2019-05



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Per. уд. № xxx

SELF-TESTING

REF xxx



Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92


Сделано в России

arkray

GLUCOCARD W

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 7 СЕКУНД
ОБЪЕМ ПРОБЫ 0,5 МКЛ
БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ТЕСТ-ПОЛОСКИ



GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*
Единица измерения: ммоль/л
Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4
Тел. 8(499) 703-34-92

Комплект №4
Глюкометр
GLUCOCARD W
Тест-полоски (10 шт.)
GLUCOCARD W
Чехол

/Изготовлен 2018-01
/Сер. Номер 7210LR700008
/Партия 287374A
/Годен до 2019-05



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Рег. уд. № xxx

REF xxx

Сделано в России

Комплект № 4 (Состав)

- ① Глюкометр GLUCOCARD W - 1 шт.;
- ② Тест-полоски GLUCOCARD W - 1 уп. (10 шт.);
- ③ Чехол – 1 шт.



Комплект № 4 (Маркировка)

GLUCOCARD W

Система мониторинга глюкозы в крови
Для диагностики *in vitro*

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

SELF-TESTING



Комплект №4
Глюкометр
GLUCOCARD W
Тест-полоски (10шт.)
GLUCOCARD W
Чехол

/Изготовлен 2018-01
/Сер. Номер 7210LR700008
/Партия 287374A
/Годен до 2019-05



ARKRAY Factory, Inc
1480 Koji, Konan-cho,
Koka-shi, Shiga 520-
3306, Japan

Per. уд. № xxx

REF xxx

Сделано в России

Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «АРКРЭЙ», 141983, Россия, г. Дубна, ул.
Программистов, д.4
Тел. 8(499) 703-34-92



ПАРТИЯ

287374A

Годен до

2019-05

arkray

Система мониторинга глюкозы в крови

GLUCOCARD
W

Тест-полоски

Тест-полосок

10

Заместитель директора по качеству ООО «АРКРЭЙ»

Семенова М. Ю. (по доверенности от 24 ноября 2018 года)

Пронумеровано и прошнуровано
16 листа (ов)

Зам. директора по качеству
ООО АРКРЭЙ
Семенова М.Ю.

