
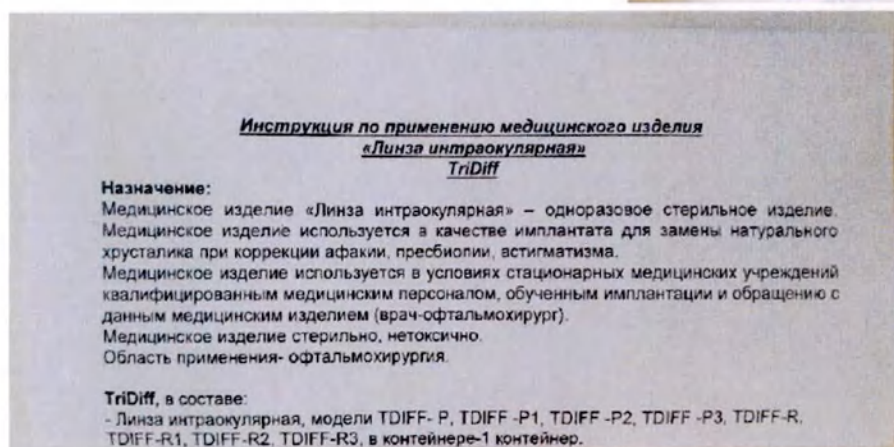


**Фотографические изображения и макеты маркировки
медицинского изделия
«Линза интраокулярная»**

Варианты исполнения:

- 1. TriDiff**
- 2. TriDiff Toric**
- 3. Ultima Smart Toric**
- 4. Ultima Smart Toric Multifoca**
- 5. Ultima Natural**
- 6. TriPhobic**
- 7. TriPhobic Toric**
- 8. Magnificent**
- 9. Magnificent Toric**
- 10. Magnificent Panfocal**
- 11. Magnificent Panfocal Toric**
- 12. Acriol EC Versatile**
- 13. Acriol EC Versatile Preloaded**

Caregroup Sight Solution Private Limited, India.

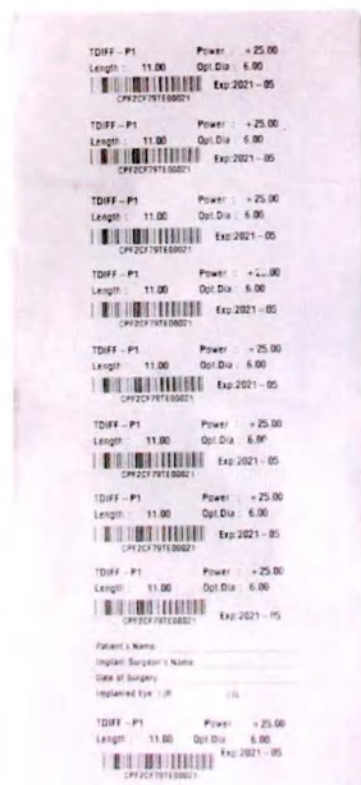

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **TriDiff**, в составе:

Линза интраокулярная, модели TDIFF- P, TDIFF -P1, TDIFF -P2, TDIFF -P3, TDIFF-R, TDIFF-R1, TDIFF-R2, TDIFF-R3, в контейнере -1 контейнер.

- Инжектор в блистерной упаковке-1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке-1 уп
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.


A - Constant: 118.0
Theoretical
Length : 11.00
Opt. Dia. : 6.00

- One sterile intraocular lens with UV absorber. Do not use if the packaging is damaged or is not intact.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.
- Ein sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist, oder wenn Sie nicht intakt ist.

Contents:
- One (1) Sterile **TriDiff** Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens, Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet
- Patient Lens Implant Identification Card
- Patient Record Labels

MTG Lic. No. 0728/1321
Manufactured By
CARE GROUP OPTIC SOLUTION LLP
Block No. 312/C&B Village Gahana, Taluka - Padar
Dist. - Kollam - 691 440, Kerala, India
Customer Care: caregroupindia.com
www.caregroupindia.com | www.caregroupoptics.com

EUROPEAN Representative
BIOVISTA LIMITED
Wayide, Tolly Road, Waltham
Dorset, Dorset, UK B20 2JX



Rev on 09/2017



ADD N : +3.5D
ADD I : +1.8D
A.Power : +24.9D
LOT : CPF2C
CVD : 2021



TDIFF - P1
+25.00



Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)



For Near, Intermediate and Distance Vision


- Refractive - Diffractive Optic • Slanted Transition Zones
- 360° Square Edge • Aberration Neutral





CPF2CF79TE00021


IMPLANT BEFORE: MAY 2021

Press to tear



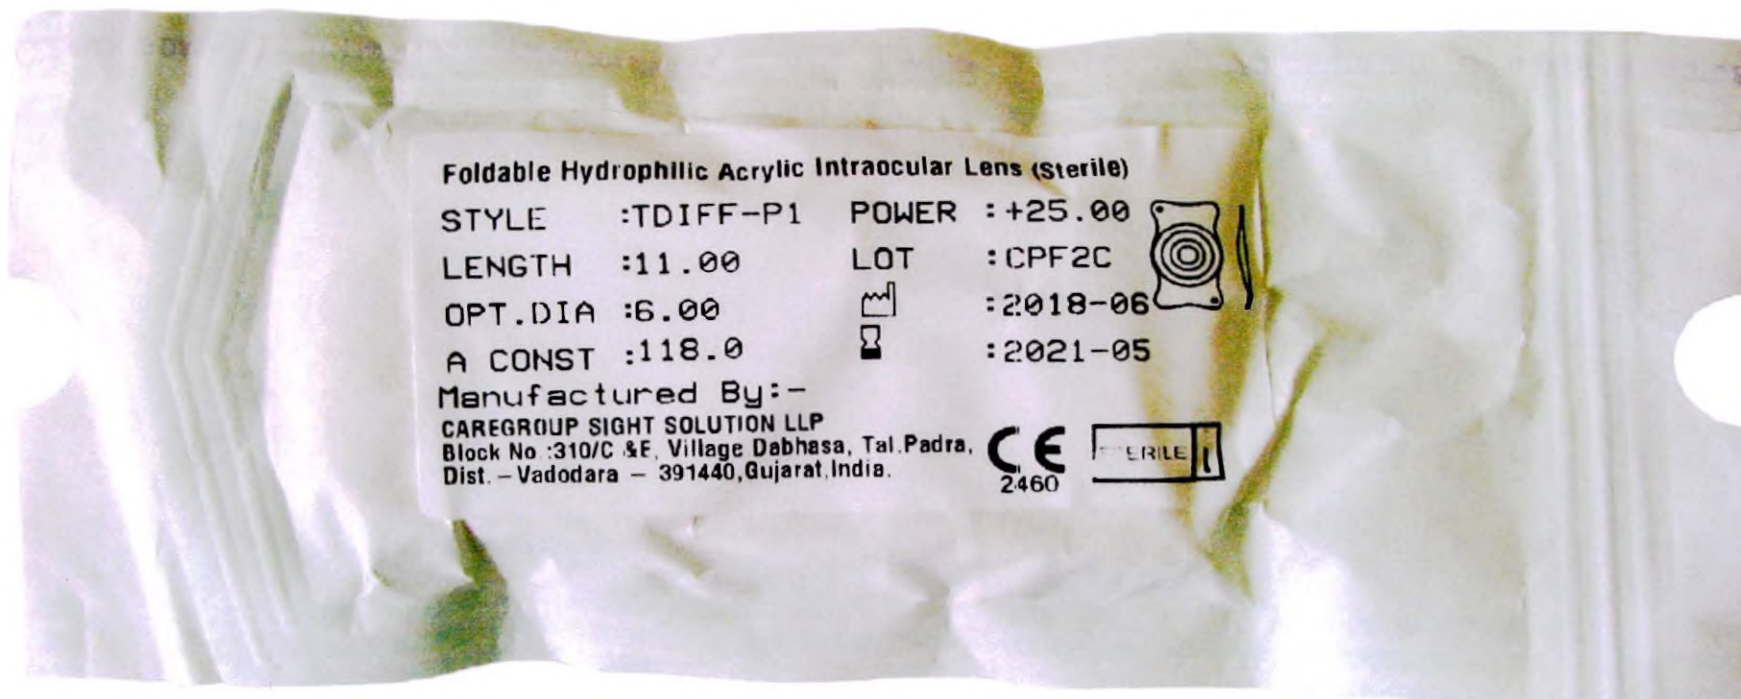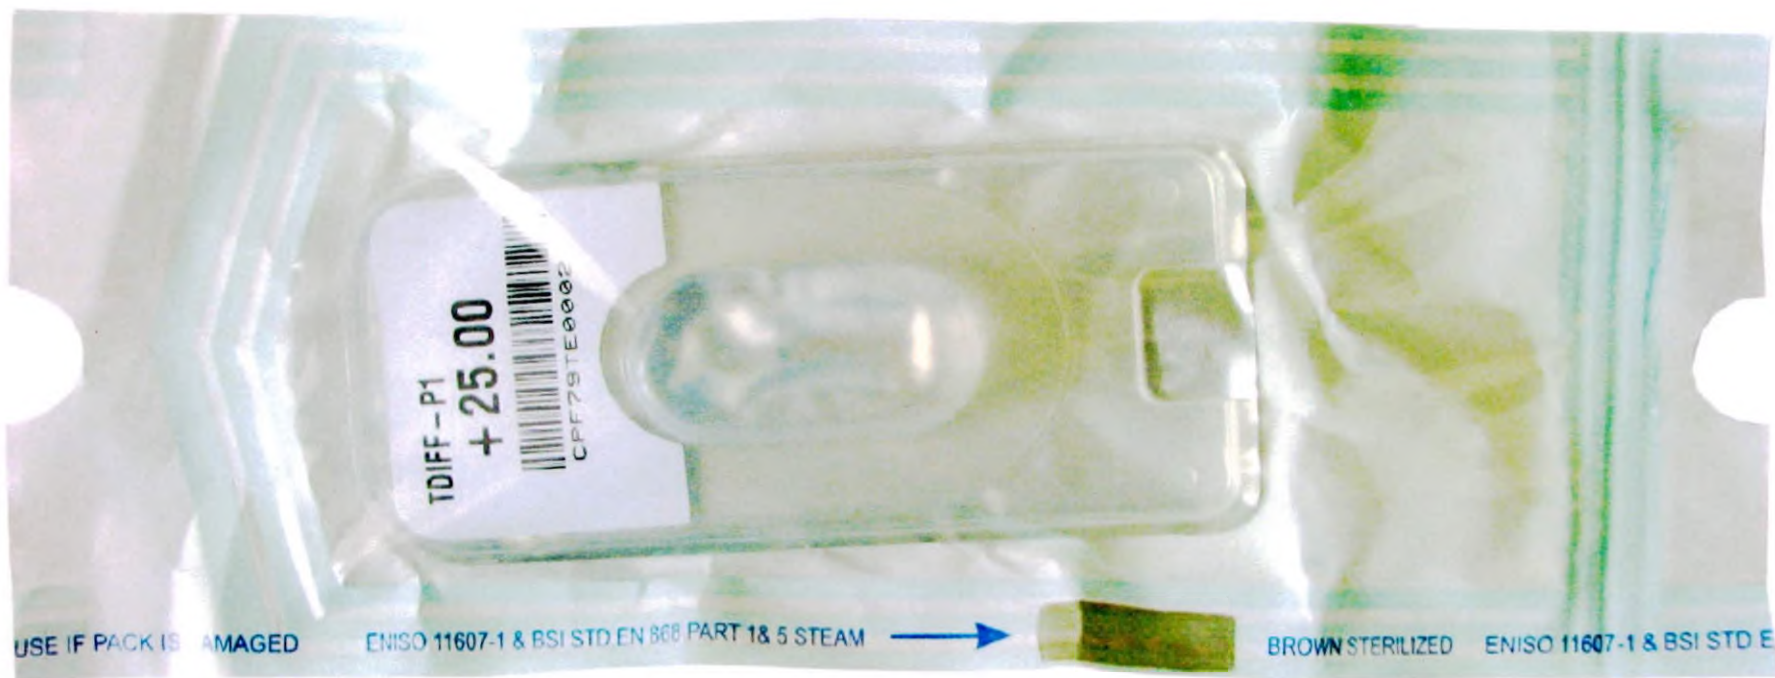

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка (блистер)

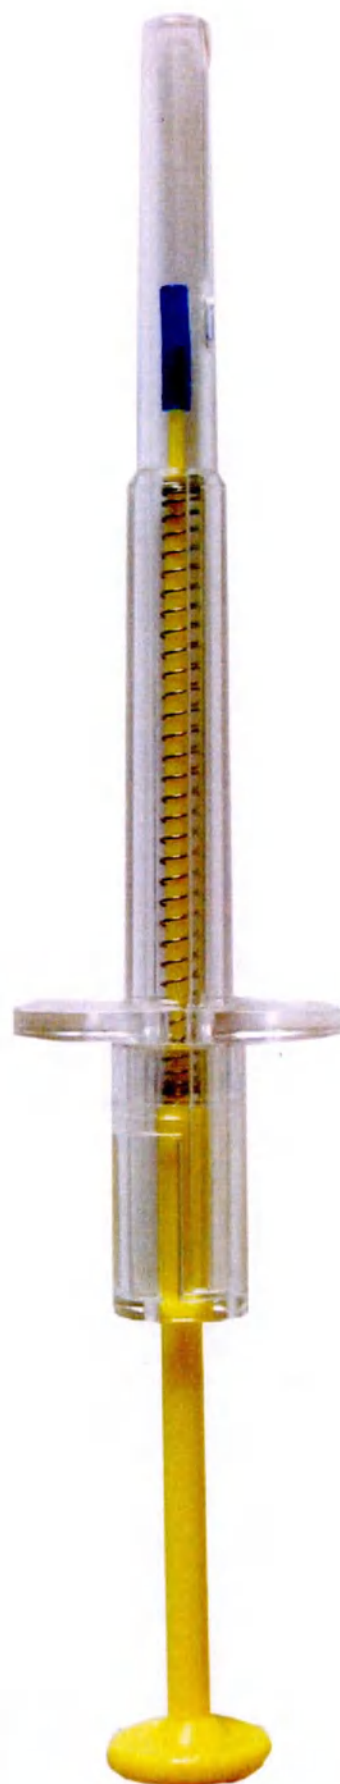


Контейнер с линзой, инжектор, картридж


TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021


TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name: _____
Implant Surgeon's Name: _____
Date of Surgery: _____
Implanted Eye: ()R ()L

TDIFF - P1 Power : +25.00
Length : 11.00 Opt.Dia : 6.00
 Exp:2021-05
CPF2CF79TE00021

Наклейка пациента



MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0 ADD N +3.5 ADD
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD I +1.800
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03

Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Implanted Eye : () R () L
MODEL : TDIFFT - R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CT06A ADD N +3.5 ADD
OPT DIA : 6.50 MFG : 2022 - 04 ADD I +1.800
LENGTH : 12.50 EXP : 2025 - 03
SK CTFADYSSJE000016

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» TriDiff Toric

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия

TriDiff Toric в составе:


- Линза интраокулярная, модели TDIFFT-P, TDIFFT-P1, TDIFFT-P2, TDIFFT-P3
TDIFFT-R, TDIFFT-R1, TDIFFT-R2, TDIFFT-R3, в контейнере-1 контейнер

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения TriDiff Toric в составе:

- Линза интраокулярная, модели TDIFFT-P, TDIFFT-P1, TDIFFT-P2, TDIFFT-P3

TDIFFT-R, TDIFFT-R1, TDIFFT-R2, TDIFFT-R3, в контейнере-1 контейнер.

- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

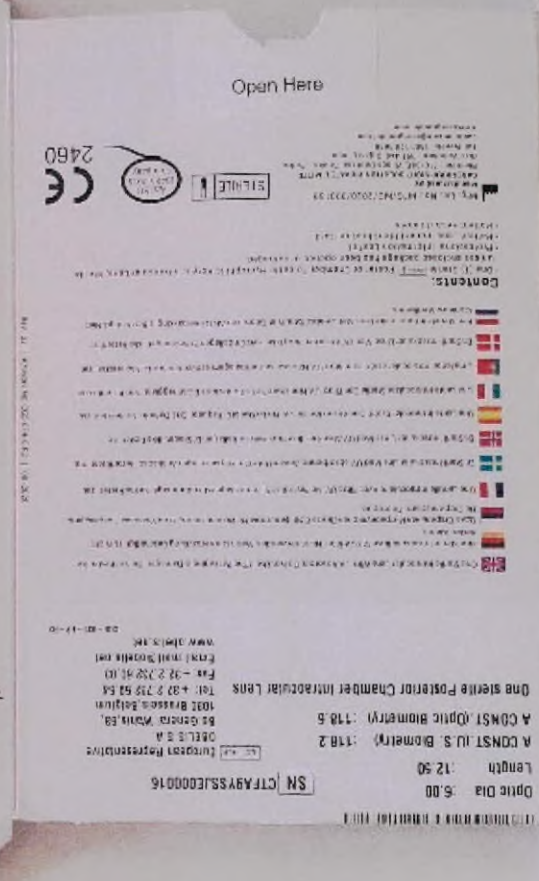

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016



TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016

TRIDIFF TORIC
Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Implanted Eye : () R () L
MODEL : TDIFFT-R CYL 3.0
POWER : +22.00 LOT : CTD6A Add N : +3.5 ADD
OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-04 Add I : +1.80D
LENGTH : 12.50 EXP : 2025-03
SN CTFASYSSJE000016
CE 2460

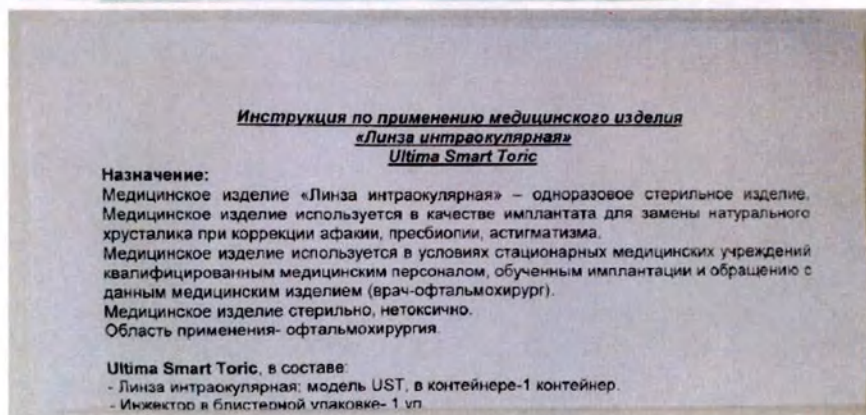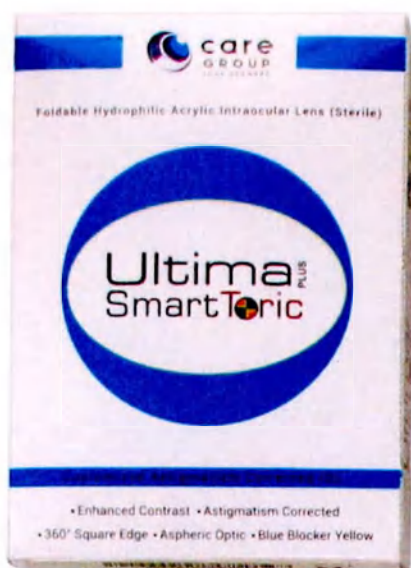

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Ultima SmartToric**, в составе:

- Линза интраокулярная: модель UST, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

doi:10.1017/S0022292412001914

	One start installatie vers. Met U/V absorber. Do not use if the packaging is damaged. Do not reinsert.
	Eine Starte installieren. Mit U/V Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Nicht einsetzen.
	Časový interval mezi instalacemi: 10 minut. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
	Une série installations entre. Avec filtre U/V. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas réinsérer.
	En serie installera till. Med U/V absorber. Använd inte om förpackningen är skadad. Sätt inte tillbaka in.
	Ein Starte installieren. Mit U/V Filter. Mit kein setzen, falls einbeblagen ist. Einsetzen ist verboten.
	Una serie instalar entre. Con filtro U/V. No usar si el paquete está dañado. No reinsertar.
	Una serie installare serie. Con filtro U/V. Non usare se l'imballaggio è danneggiato. Non reinsertare.
	Uma serie entre-outro entre. Com filtro U/V. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não volte a instalar.
	Εάν είναι στην σειρά-μετα. Με το U/V φίλτρο. Μην βάζετε, hvis εμβολισμένη ή βλάβη. Μην βάζετε ξανά.
	En sorozat telepíteni kell. A UV szűrővel. Ne használja, ha a csomagolás sérült. Ne tegye vissza.




Contents:

- One (1) Sterile ~~2002~~ Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens. Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet.
- Patient Lens Implant Identification Card.
- Patient Record Labels.

■ Mfg Lic No G-2841321

Manufactured By:
CARBONUP SIGHT SOLUTION LLP
Block No. 1101/ICA, village Shakhra, Taluka - Padra
Dist. Vadodra - 391 340, Gujarat, India
Customer@carbonup.com | www.carbonup.com
www.carbonupindia.com | www.carbonupindia.com

European Representative
BROVIAN LIMITED
Wayside, Tring Road, Welstead
Dunstable, Beds LU8 2JH, UK



Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)

Ultima SmartToric

Customized Astigmatism Corrected IOL

- Enhanced Contrast • Astigmatism Corrected
- 360° Square Edge • Aspheric Optic • Blue Blocker Yellow




2018-05

2021-04



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения **Ultima Smart Toric**,
потребительская упаковка

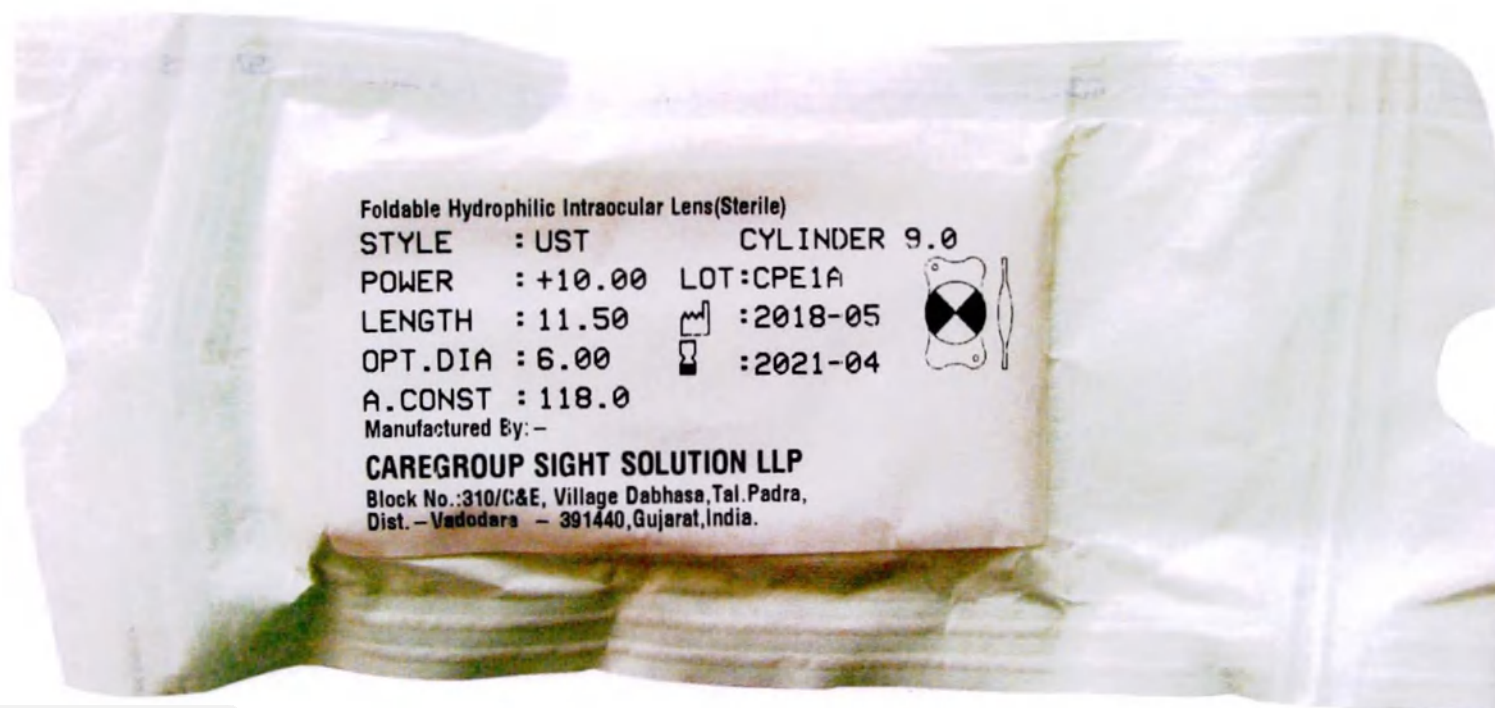

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка (блистер)



Контейнер с линзой, инжектор и картридж

STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



STYLE:UST CYLINDER 9.0
LENGTH :11.50 POWER :+10.00
OPT.DIA :6.00 Exp:2021-04



Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name :-----

Implant Surgeon's Name :-----

Date of Surgery :-----

Implanted Eye : () R () L

STYLE : UST CYLINDER 9.0

LENGTH : 11.50 POWER : +10.00

OPT.DIA : 6.00 Exp:2021-04



Наклейка пациента



Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Ultima Smart Toric Multifocal

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Ultima Smart Toric Multifocal, в составе:

- Линза интраокулярная: модели USTM, iDIFFT-P, iDIFFT-P1, iDIFFT-P2, iDIFFT-P3 iDIFFT-R, iDIFFT-R1, iDIFFT-R2, iDIFFT-R3, в контейнере-1 контейнер.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения

Ultima Smart Toric Multifocal, в составе:

- Линза интраокулярная: модели USTM, iDIFFT-P, iDIFFT-P1, iDIFFT-P2, iDIFFT-P3 iDIFFT-R, iDIFFT-R1, iDIFFT-R2, iDIFFT-R3, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.

Length : 12.50
Opt. Dia. : 6.00

	One sterile intracutaneous line. With UV absorber. Do not use if the packaging is damaged. Do not reinsert.
	Eine sterile intracutaneale Linie. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Sterilisieren Sie nicht wieder.
	Composé intracutané à usage unique. Avec fil UV. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas réinsérer.
	En steril intracutan linje. Med UV-absorber. Använd inte om förpackningen är skadad. Använd inte återigen.
	Yksi steriili intrakutaaninen linja. Mukana UV-suojaa. Älä käytä jos pakkaus on vaurioitunut. Älä uudelleenkäsitellä.
	En steril intracutan linje. Med UV filter. Ikke benyttes hvis emballagen er beskadiget. Må ikke reinsertes igen.
	En steril intracutan linje. Med UV filter. Ikke benyttes hvis emballagen er beskadiget. Må ikke reinsertes igjen.
	Een steriele intracutanale lijn. Met UV filter. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet reinserteren.


Contents:

- One (1) Sterile **OneView**® Posterior Chamber Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens, Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet
- Patient Lens Implant Identification Card
- Patient Record Labels

Mfg. Lic. No. G/28/1321

Manufactured By
CAREGROUP SIGHT SOLUTION LLP
Block No. 716/C&L Village Gashash, Taluka - Paldi
Dist. Vadodra - 391 449, Gujarat, India
Customercare@caregroupindia.com
www.caregroup-india.com | www.caregroupindia.com

European Representative
BIOVISION LIMITED
Wayside, Treg Road, Wellhead
Durham, BD23 1JF, U.K.



Rev. on. 09/2012



Ultima
SmartToric
Multifocal




!DIFF--R1 CYLINDER 2.0 +9.50
Ser#: CPE2CFST0U00003
A.Power : +9.34
+ 3.5 ADDITION
Exp Date: 2021-05
LOT CPE2F

care
GROUP
LOOK FORWARD

Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (Sterile)



Press
to tear

Ultima
SmartTonic

Customized Astigmatism Correcting Presbyopic IOL


- Refractive - Diffractive Optic • Astigmatism Correcting
- 360° Square Edge • Aspheric Optic • Enhanced Contrast



+ 3.5 ADDITION

CPF2CFSTQU00003

IMPLANT RECORD, MAY 2021

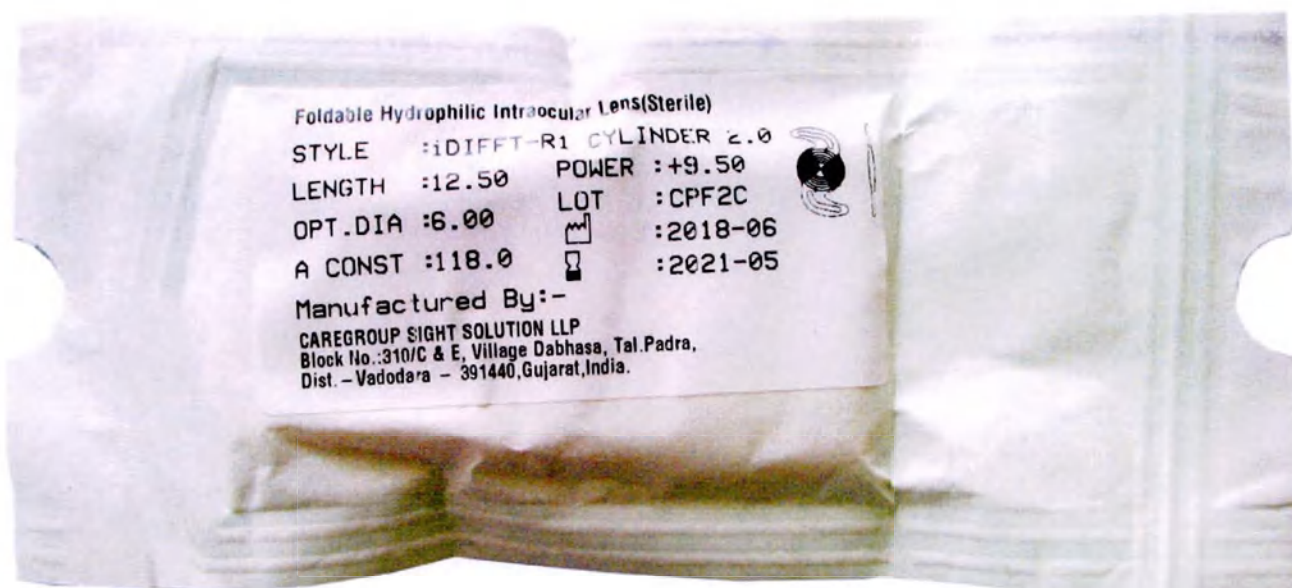

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка (блистер)



IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00

CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00

CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00


CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00


CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00


CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00

CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00

CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50



Opt.Dia : 6.00

CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

Наклейки для контроля имплантации

Patient's Name: _____

Implant Surgeon's Name: _____

Date of Surgery: _____


Implanted Eye: () R

() L

IDIFFT - R1 CYLINDER 2.0

Length : 12.50

Power : +9.50




Opt.Dia : 6.00

CPF2CFSTQU00003

EXP:2021-05

Наклейка пациента

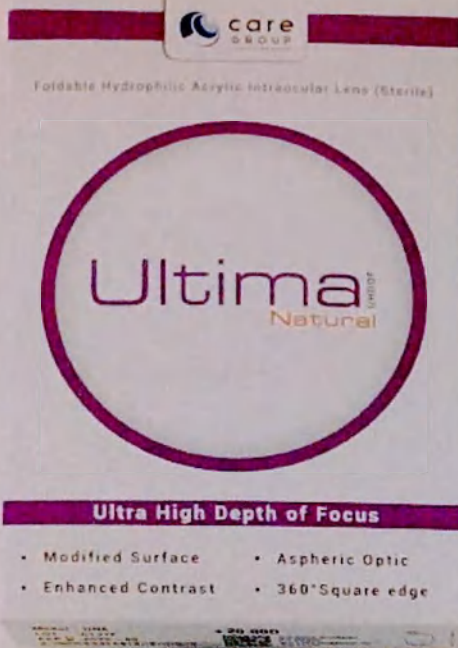

ULTIMA NATURAL

MODEL: UNA
POWER: +20.00
OPT. DIA: 6.00
LENGTH: 12.50

LOT: CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP: 2025-09

SN: CTEAJASXXXX00137

ULTIMA NATURAL

MODEL: UNA
POWER: +20.00
OPT. DIA: 6.00
LENGTH: 12.50

LOT: CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP: 2025-09

SN: CTEAJASXXXX00137

ULTIMA NATURAL

MODEL: UNA
POWER: +20.00
OPT. DIA: 6.00
LENGTH: 12.50

LOT: CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP: 2025-09

SN: CTEAJASXXXX00137

Patient's Name: ULTIMA NATURAL

Implant Surgeon's Name: _____


Date of Surgery: _____

Implanted Eye: () R () L

MODEL: UNA
POWER: +20.00
OPT. DIA: 6.00
LENGTH: 12.50

LOT: CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP: 2025-09

SN: CTEAJASXXXX00137

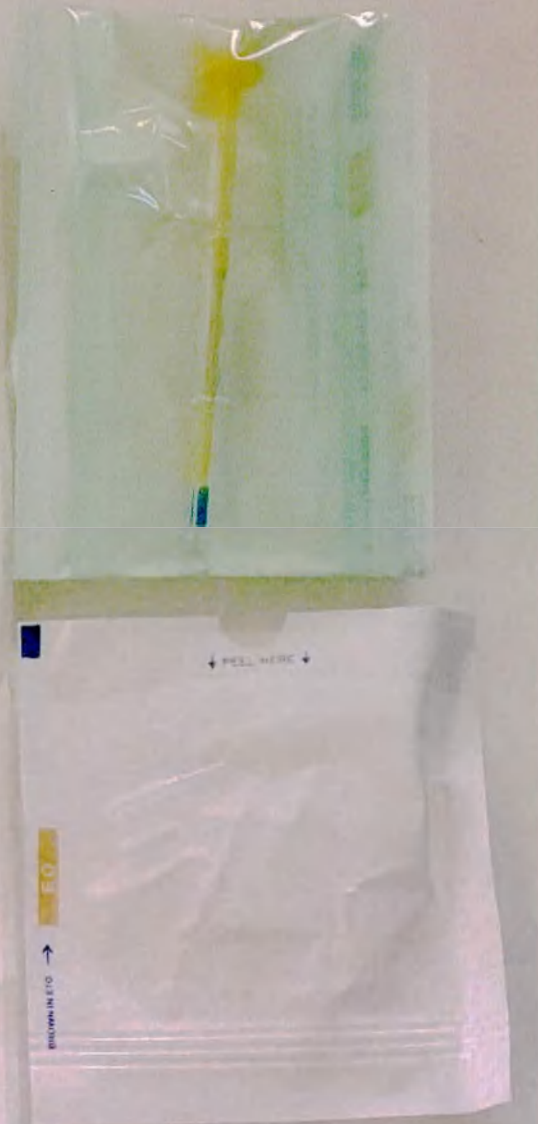

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Ultima Natural

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Ultima Natural в составе:

- Линза интраокулярная: модель UNA, в контейнере - 1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке - 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения Ultima Natural в составе:


- Линза интраокулярная: модель UNA, в контейнере - 1 контейнер
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения **Ultima Natural**,
 потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка

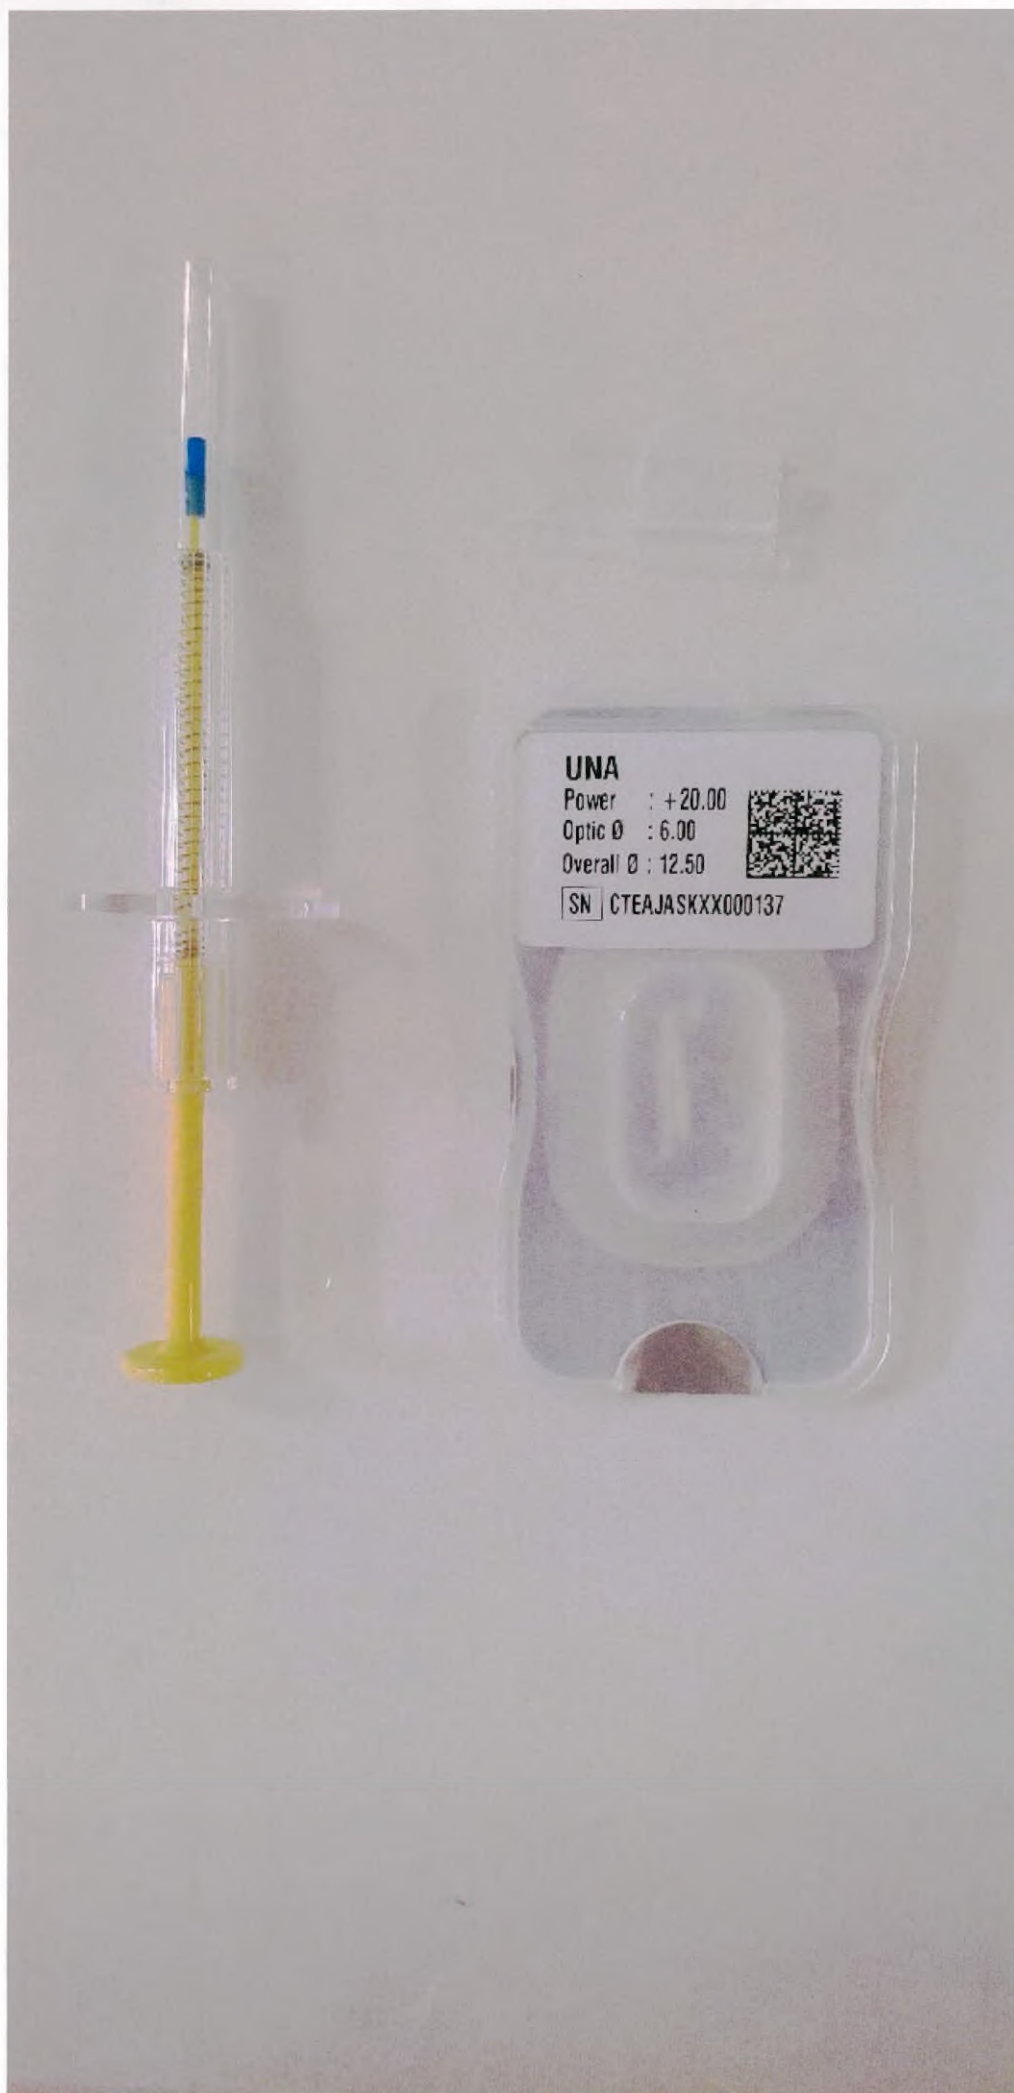

MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



MODEL :UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

ULTIMA NATURAL

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137



Patient's Name : ULTIMA NATURAL
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :

Implanted Eye : () R () L

MODEL : UNA
POWER : +20.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 12.50

LOT : CTJ7F
MFG: 2022-10
EXP : 2025-09

SN CTEAJASKXX000137





Foldable Hydrophobic Intraocular Lens (Sterile)
Synchronised Cast Moulded IOL

TriPhobic
HD
True Trifocal Hydrophobic MICL

For Near, Intermediate and Distance Vision

- Refractive - Diffractive Optic
- Slanted Transition Zones
- Abberation Controlled
- Blue Blocker Yellow
- Enhanced Contrast
- Square Edge



TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50

TRIPHOBIC
Patient's Name
Implant Surgeon's Name
Date of Surgery
Implanted Eye () R () L
MODEL AS-6TD
POWER +23.50
OPT DIA 6.00
LENGTH 13.00
LOT CTCH1
MFG 2022-03
EXP 2027-02
Add N +3.50
A Power +23.77
CE

Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» TriPhobic

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» — одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения: офтальмохирургия.

TriPhobic в составе:


- Линза интраокулярная: модель AS-6TD, в контейнере-1 контейнер.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения TriPhobic в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6TD, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации — не более 10 шт.
- Инструкция по использованию

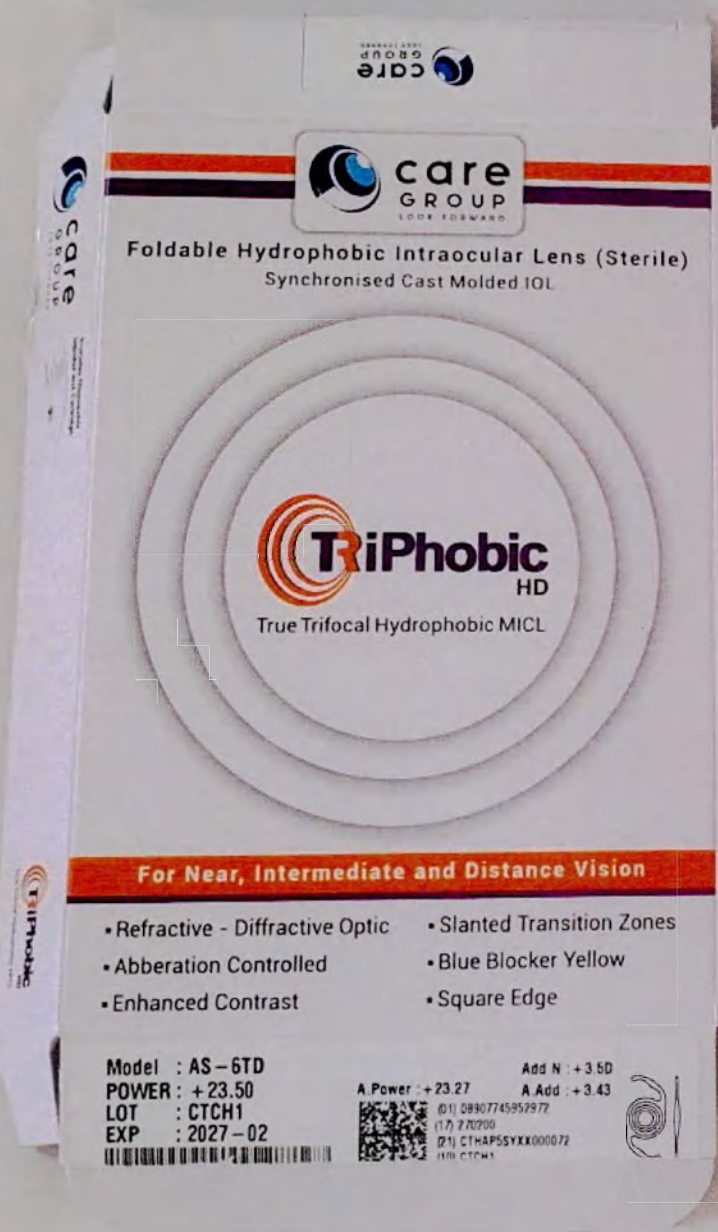

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения TriPhobic,
 потребительская упаковка

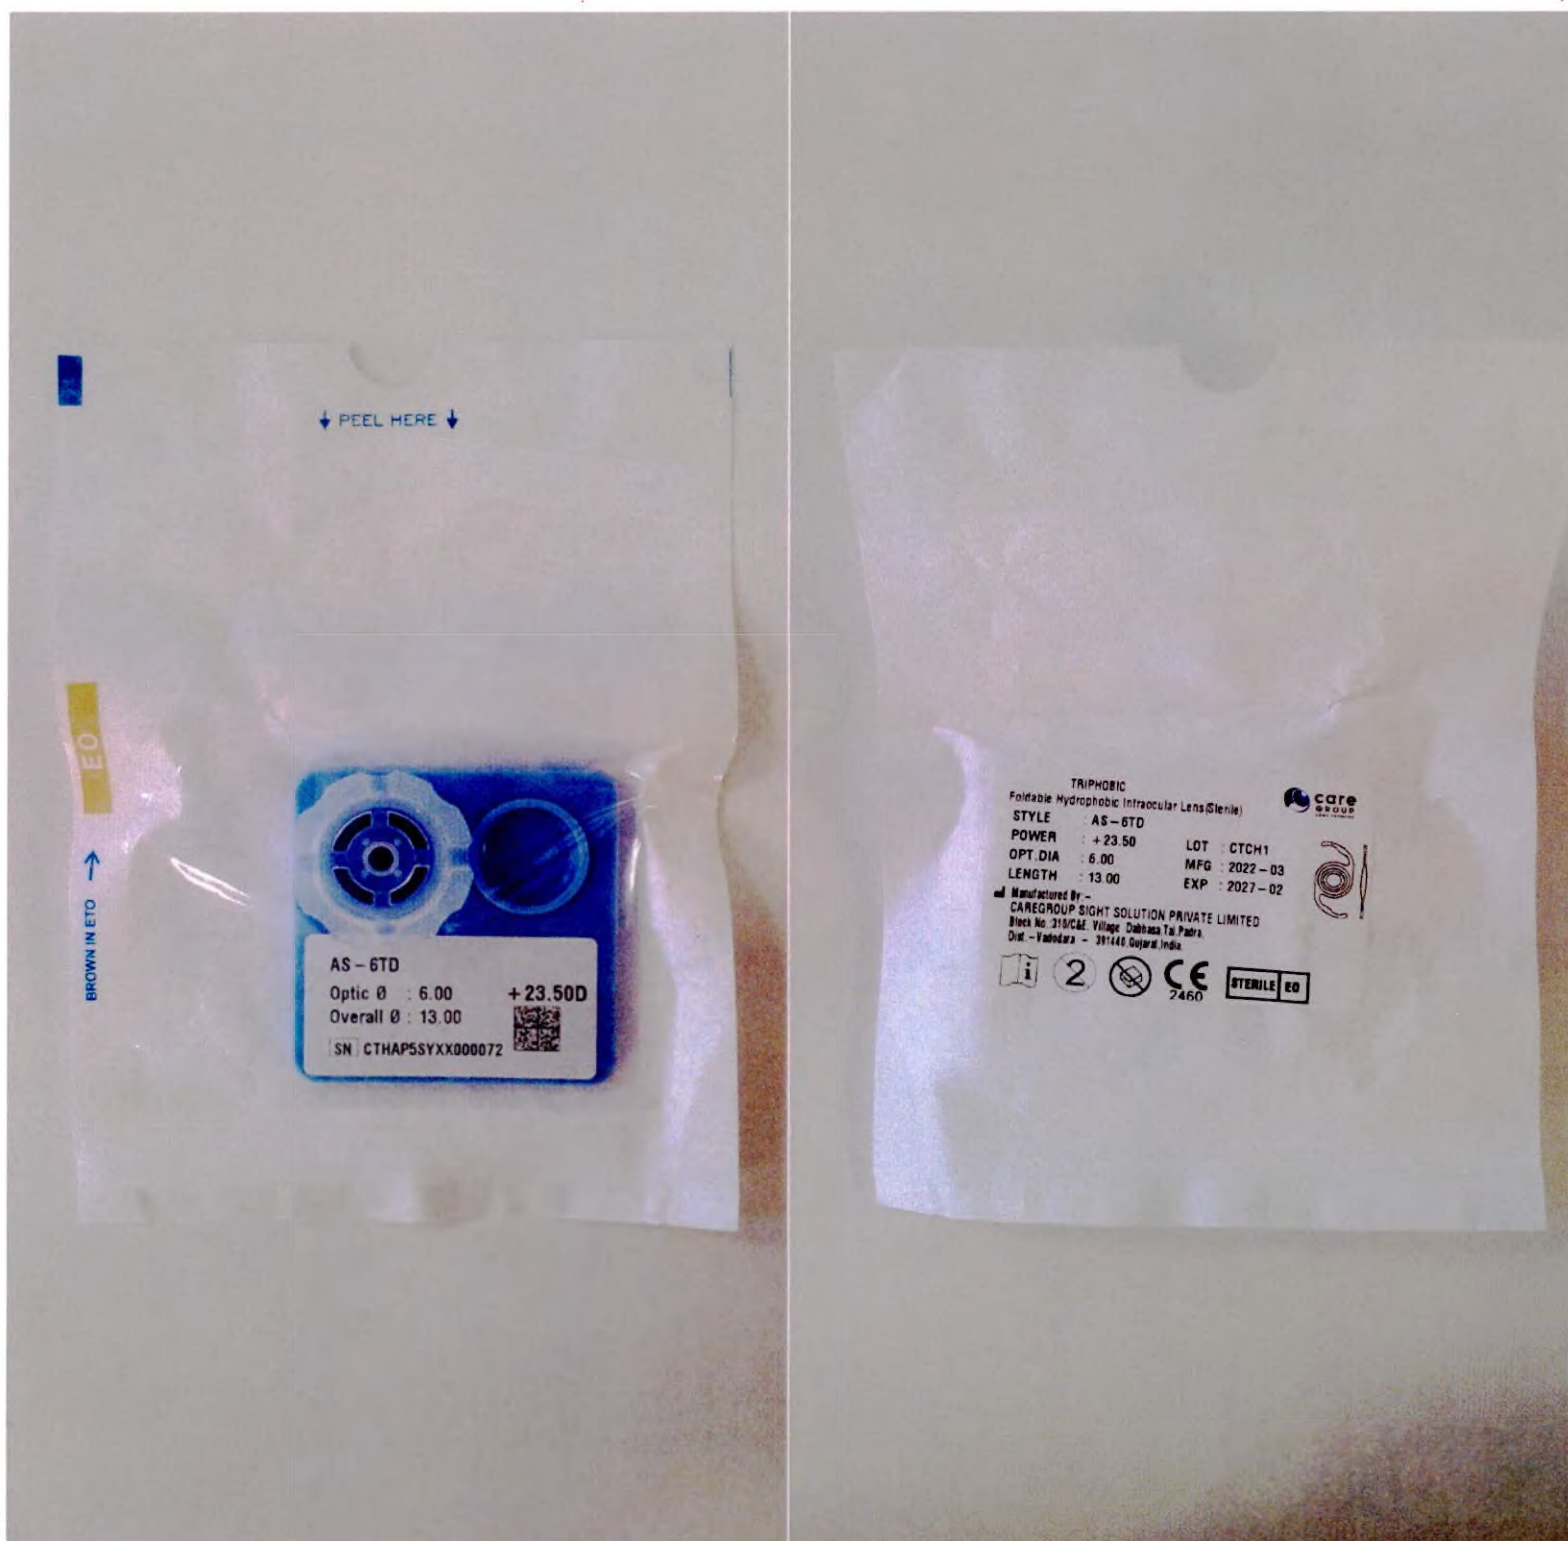

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка




Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

TRIPHOBC


LOT : CTCH1 Add N : +3.50
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02



patient's Name :
Surgeon's Name :
Date of Surgery :
Implanted Eye : () R () L
MODEL : AS-6TD
POWER : +23.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00
LOT : CTCH1
MFG : 2022-03
EXP : 2027-02
[SN] CTHAP6SYXX000072

Add N : +3.50
A.Power : +23.27



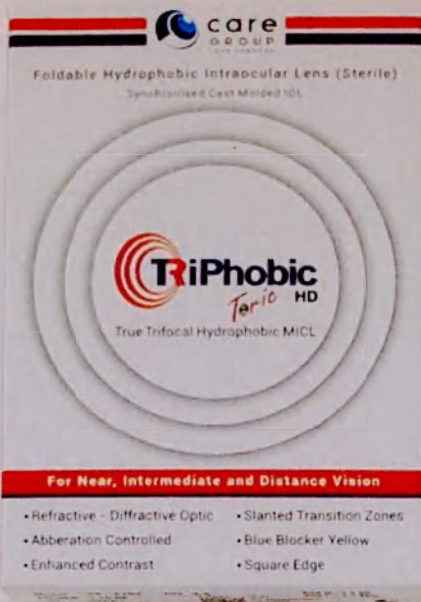

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

TRIPHOBIC HD TORIC
MODEL AS-6TDT CYL 2.5 ADD N +3.50
POWER +15.00 LOT: CTCH1 ADD I +1.800
OPT DIA 6.00 MFG: 2022-03
LENGTH 13.00 EXP: 2027-02 SN: CSD08H0KX00001

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
TriPhobic Toric

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия

TriPhobic Toric в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6TDT, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения TriPhobic Toric в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6TDT, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.

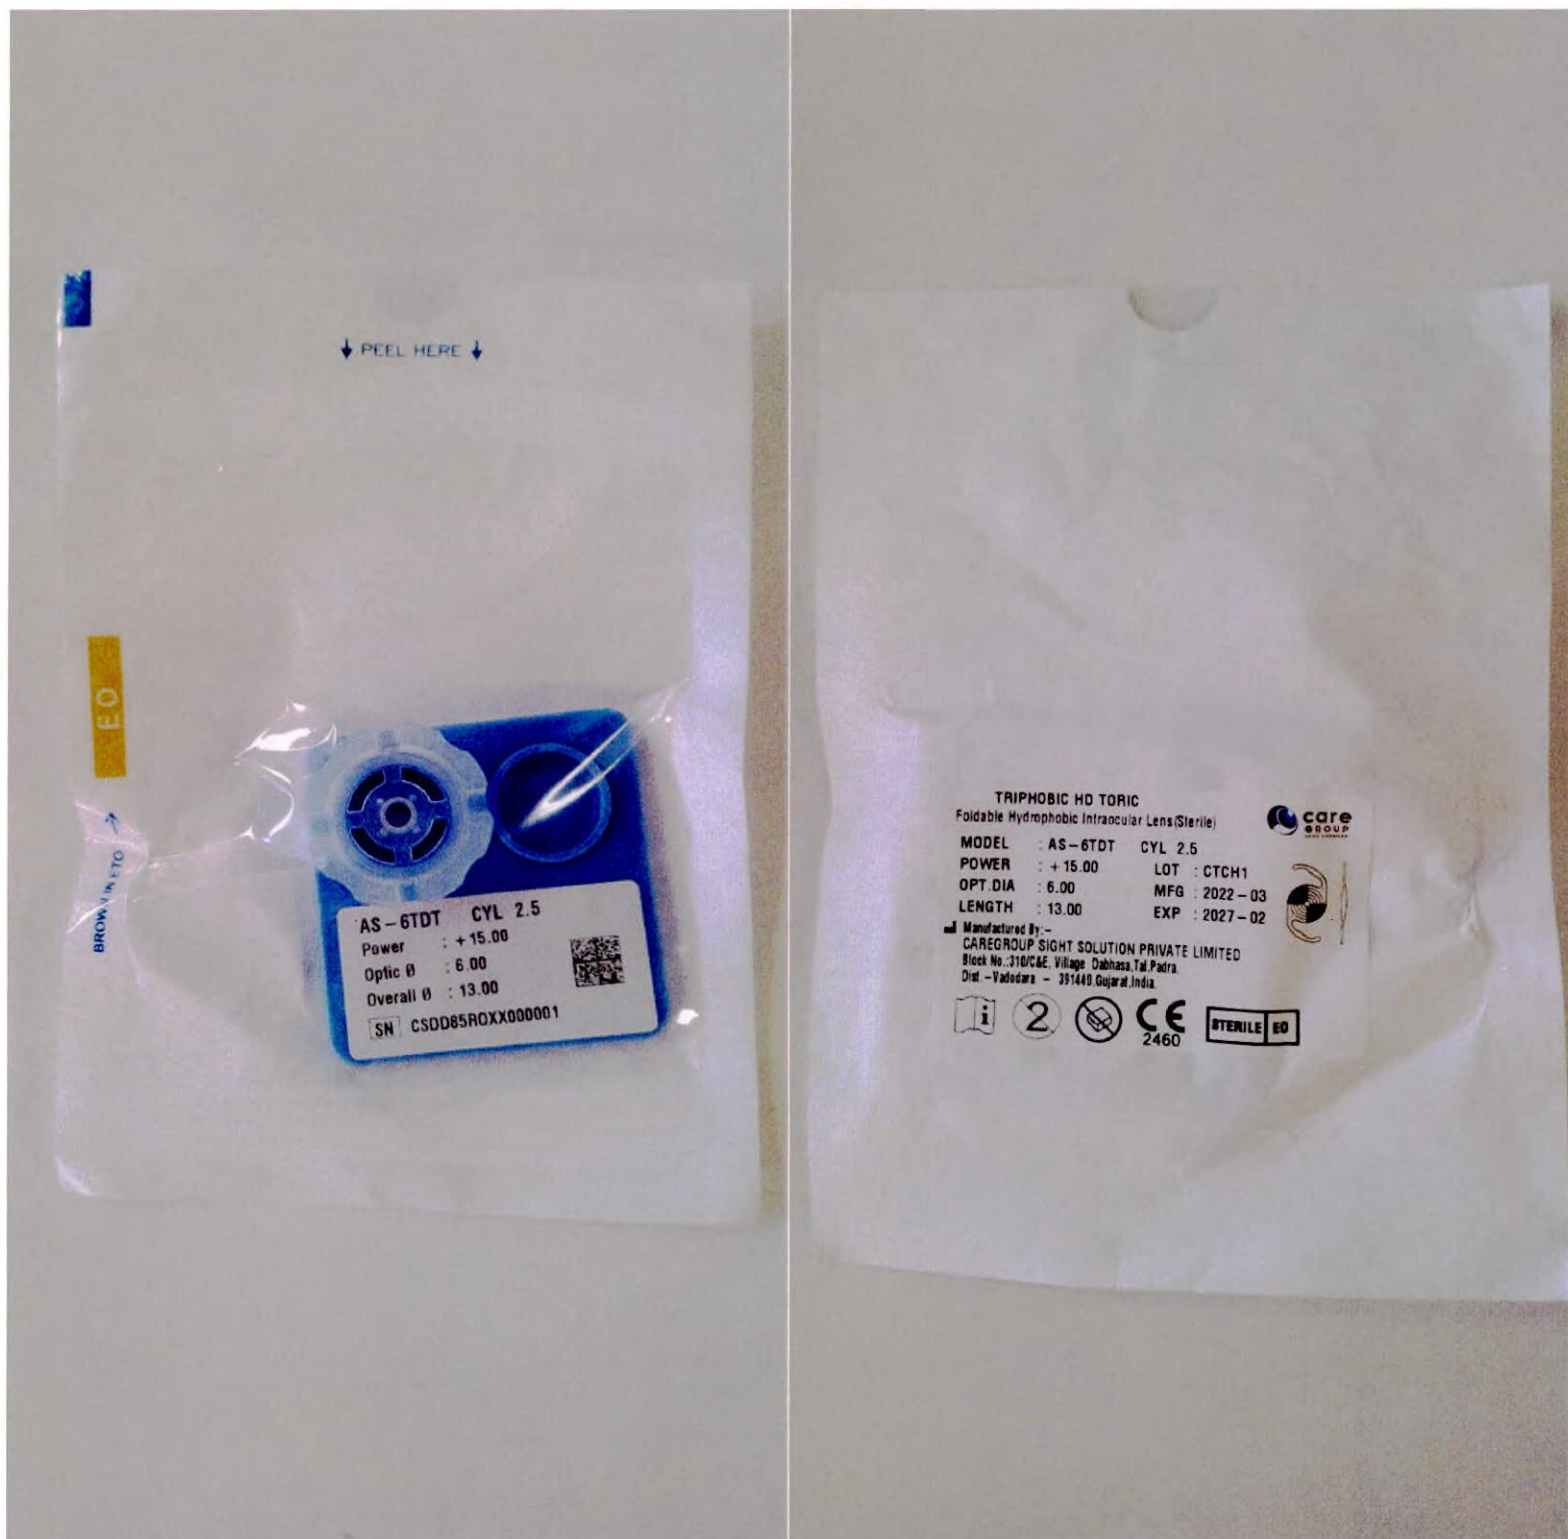

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка



Контейнер с линзой, инжектор, картридж

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

TRIPHOBIC HD TORIC

Patient's Name :
 Implant Surgeon's Name :
 Date of Surgery :
 Implanted Eye : () R () L
 MODEL : AS-6TDT CYL 2.5 Add N : +3.5D
 POWER : +15.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.80D
 OPT.DIA : 6.00 MFG: 2022-03
 LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02

SN CSD085RQXX000001

CE 2460



**Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
Magnificent**

Назначение:


Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Magnificent в составе:

- Линза интраокулярная: модели AS-6A, AS-6CA, AS-7, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Magnificent** в составе:

- Линза интраокулярная: модели AS-6A, AS-6CA, AS-7, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

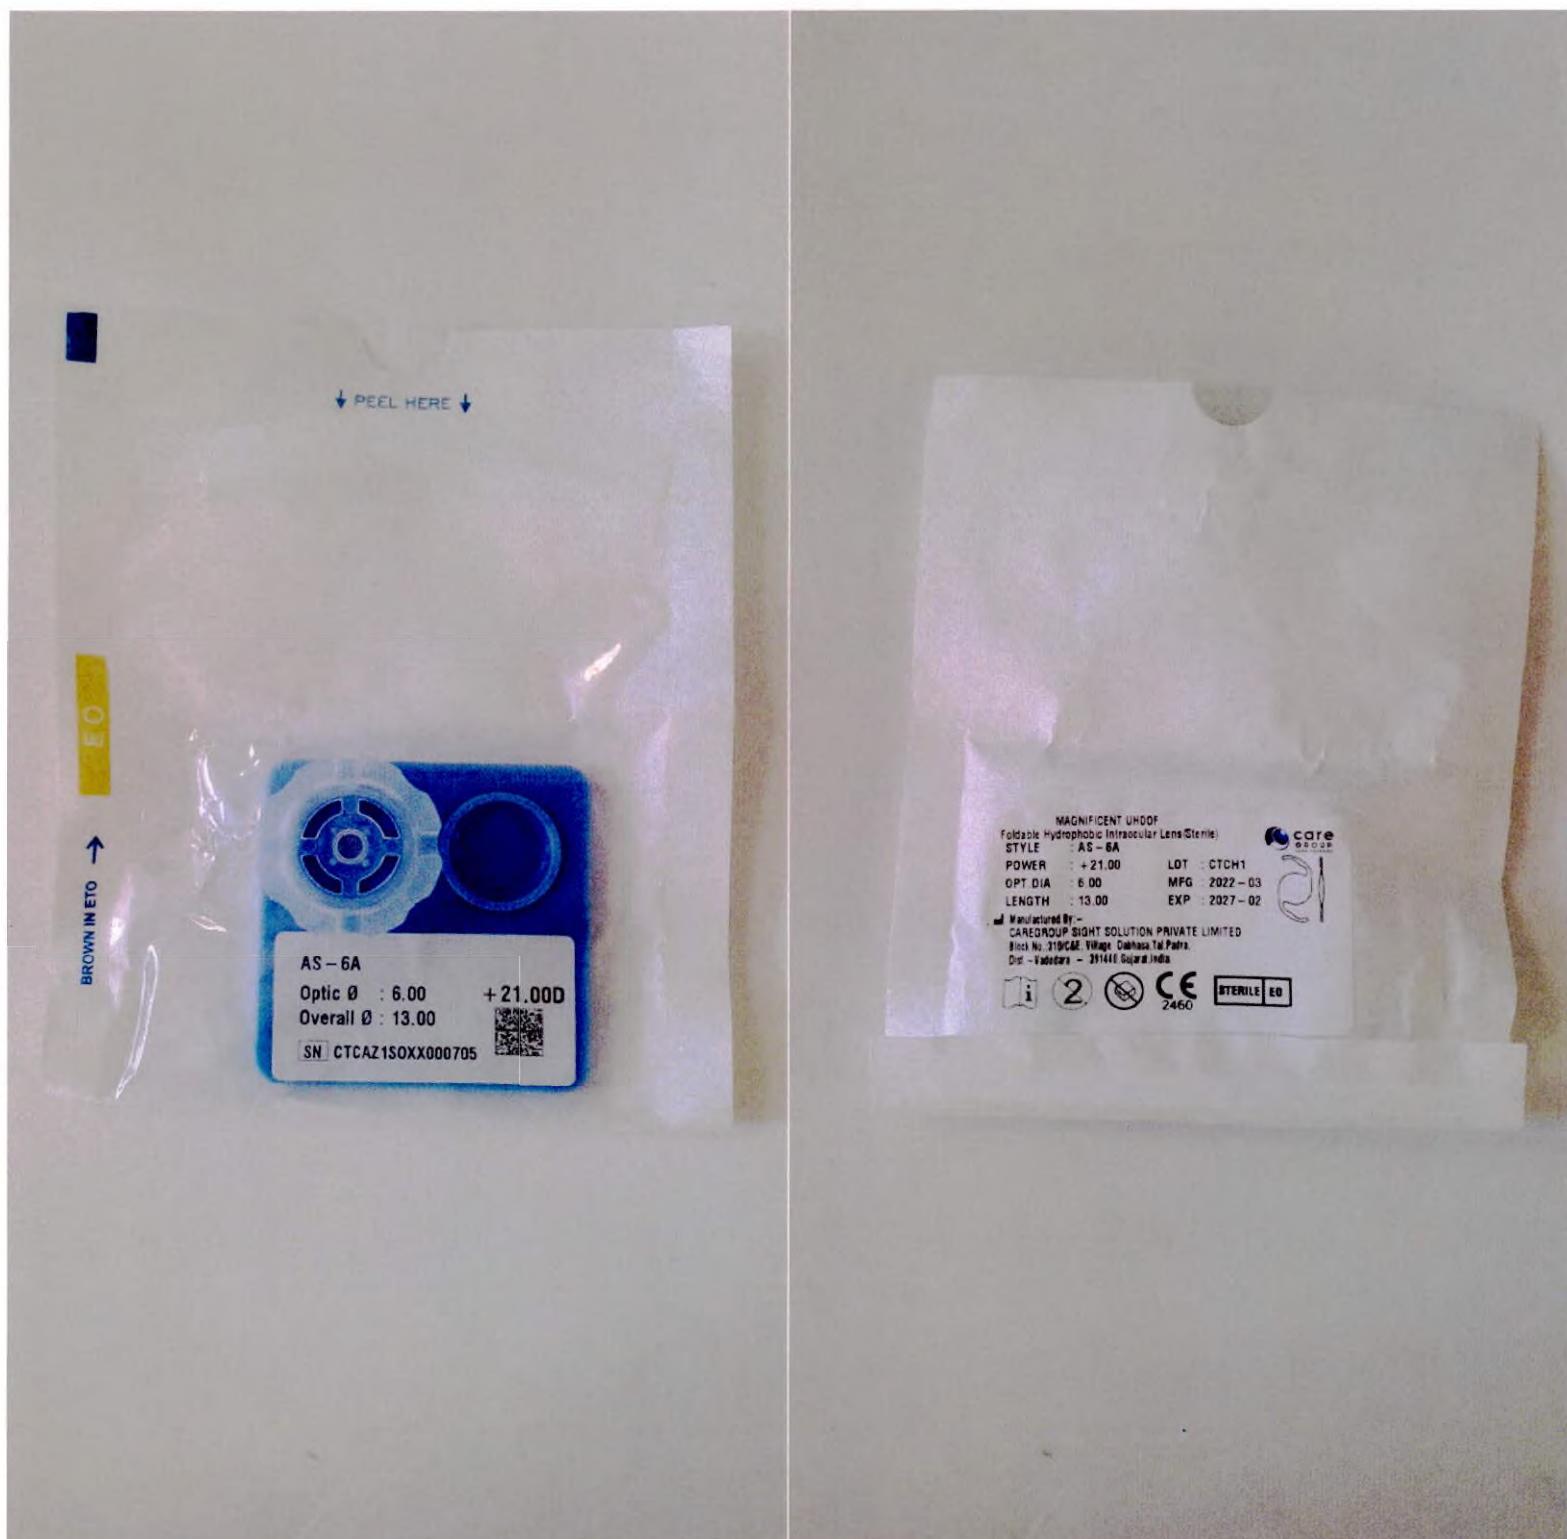

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка




MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02




SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02




SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02




SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02




SN CTCAZ150XX000705

MODEL : AS-6A
POWER : +21.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF



LOT : CTCH1
MFG: 2022-03
EXP : 2027-02



SN CTCAZ150XX000705

MAGNIFICENT UHDOF



Patient's Name :
Implant Surgeon's Name :
Date of Surgery :


Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6A LOT : CTCH1
POWER : +21.00 MFG : 2022-03
OPT.DIA : 6.00 EXP : 2027-02
LENGTH : 13.00



SN CTCAZ150XX000705



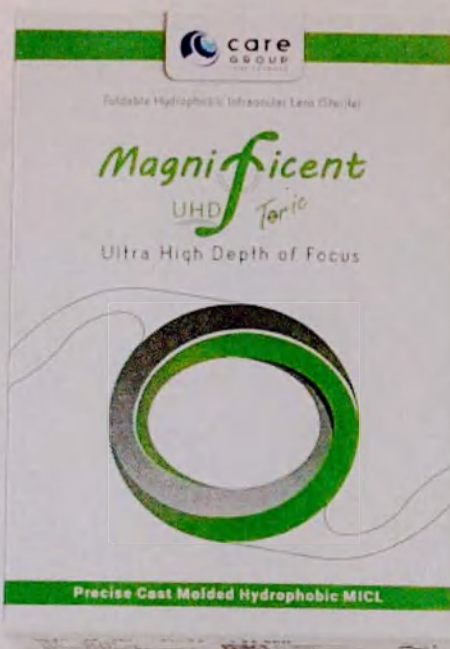

MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033
MODEL : AS-6AT POWER : +24.50 OPT DIA : 6.00 LENGTH : 13.00	MAGNIFICENT TORIC CYL 3.0 LOT : CTJES MFG: 2022-10 EXP: 2027-09 [SN] CT00827CKX00033

Patient's Name _____
 Implant Surgeon's Name _____
 Date of Surgery _____
 Implanted Eye : () R () L
 MODEL : AS-6AT CYL 3.0
 POWER : +24.50 LOT : CTJES
 OPT DIA : 6.00 MFG: 2022-10
 LENGTH : 13.00 EXP: 2027-09
 [SN] CT00827CKX00033



Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
Magnificent Toric

Назначение:



Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Magnificent Toric в составе:

- Линза интраокулярная: модели AS-6AT, AS-6CAT, AS-7T, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Magnificent Toric** в составе:


- Линза интраокулярная: модели AS-6AT, AS-6CAT, AS-7T, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1 шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.
- Коробка - 1 шт.

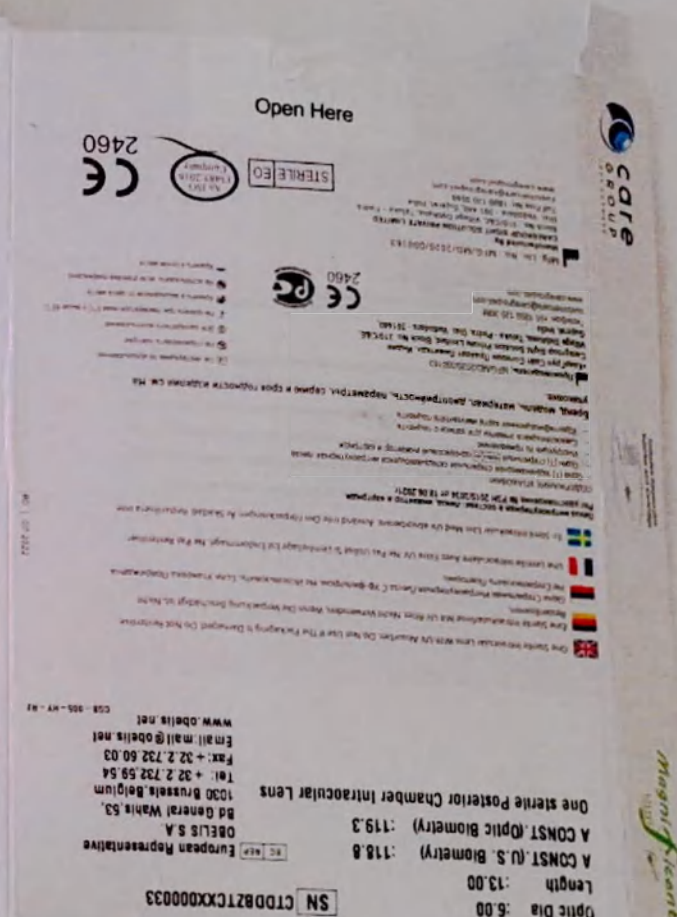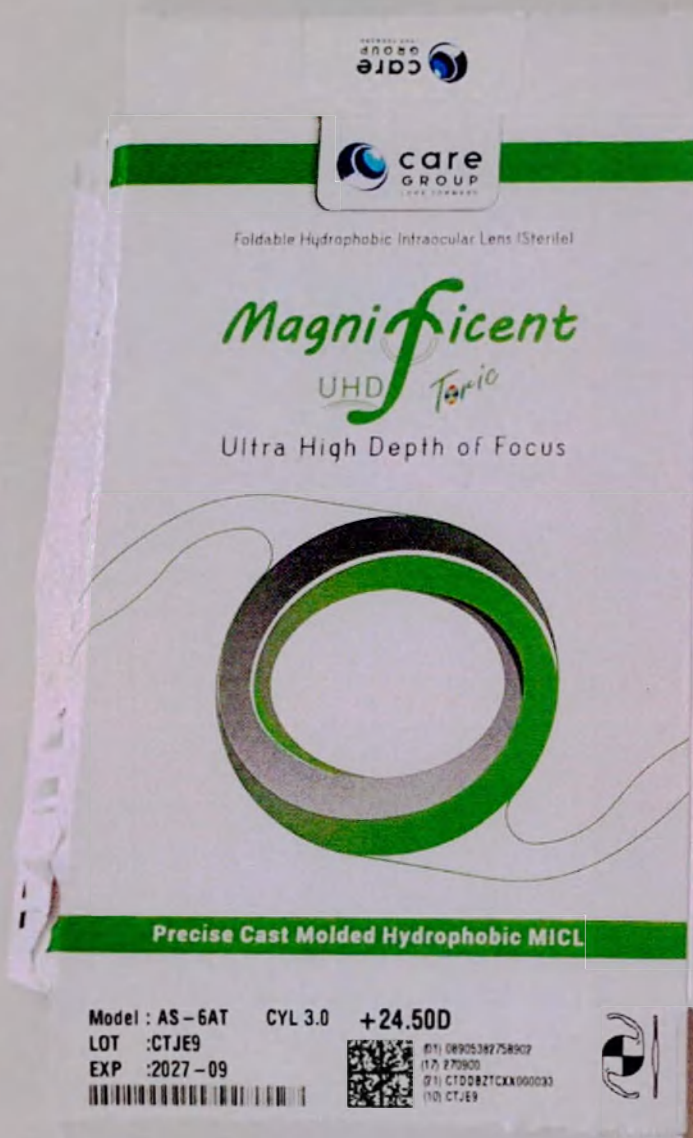

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
 вариант исполнения **Magnificent Toric**,
 потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка

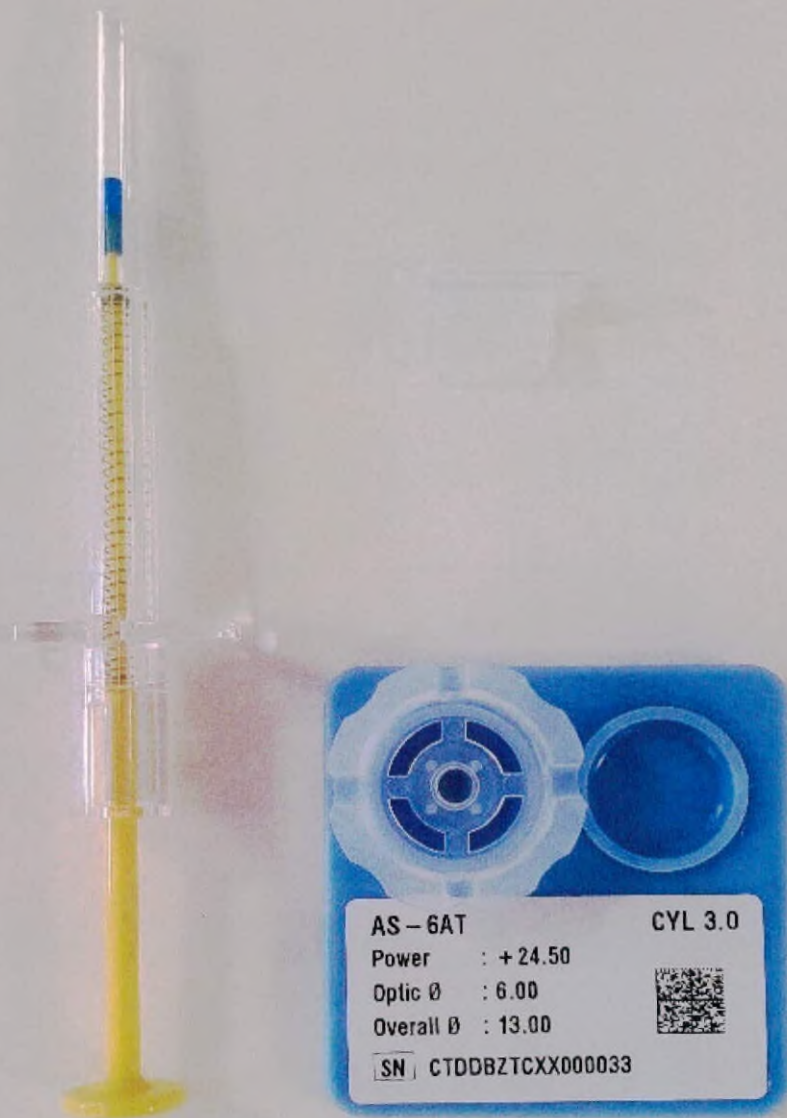

Контейнер с линзой, инъектор, картридж

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MODEL : AS-6AT
POWER : +24.50
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT TORIC
CYL 3.0
LOT : CTJE9
MFG: 2022-10
EXP : 2027-09

care
GROUP

SN CTDBZTCXX000033

MAGNIFICENT TORIC

Patient's Name : _____

Implant Surgeon's Name : _____

Date of Surgery : _____

Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6AT CYL 3.0



POWER : +24.50 LOT : CTJE9

OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-10


LENGTH : 13.00 EXP : 2027-09

SN CTDBZTCXX000033


CE
2460

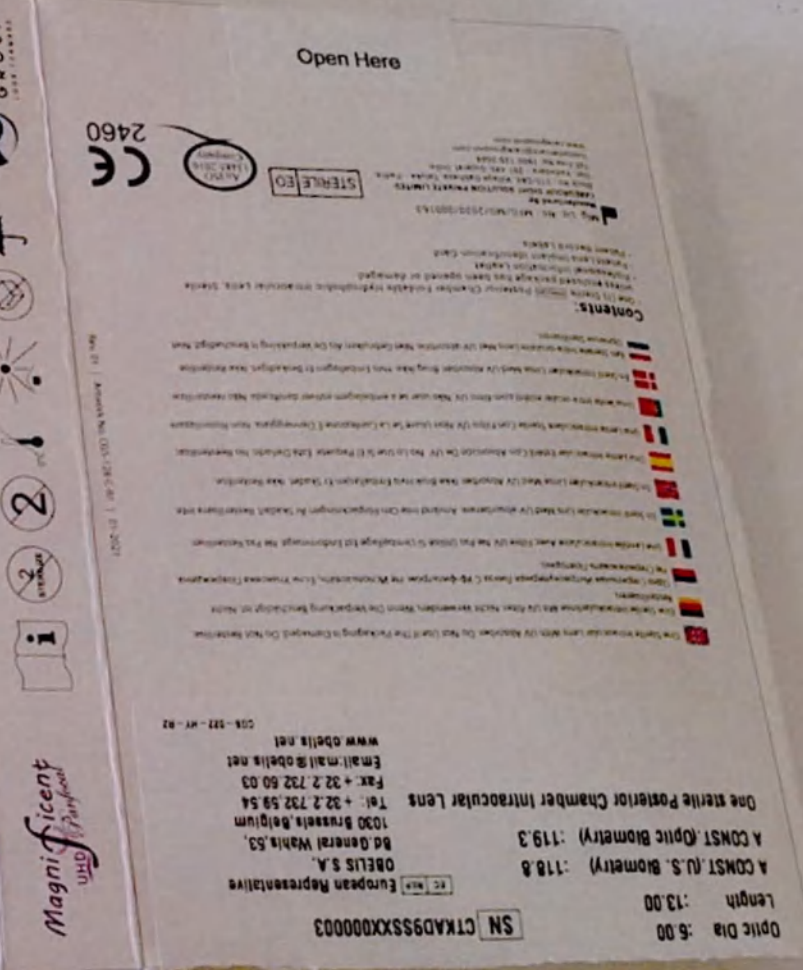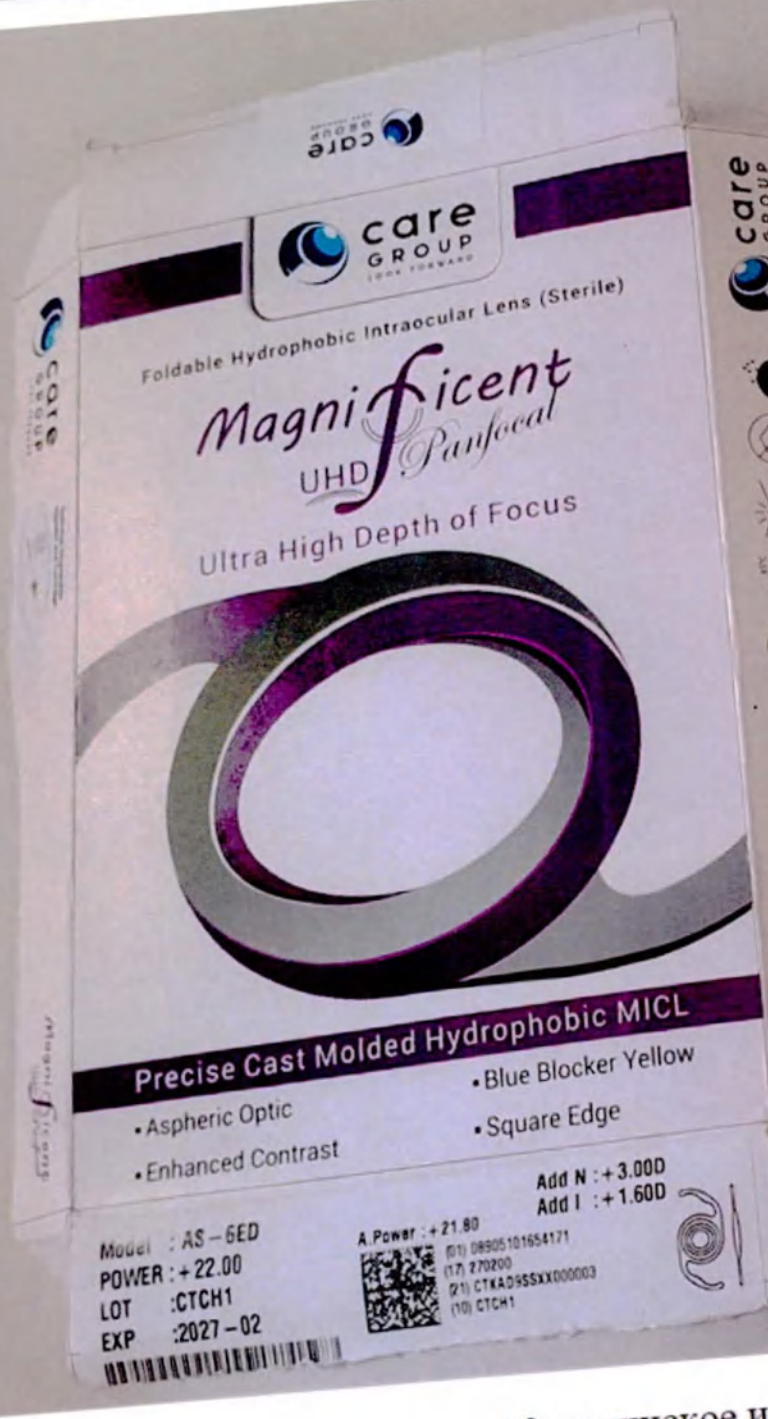

Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения **Magnificent Panfocal**,
потребительская упаковка

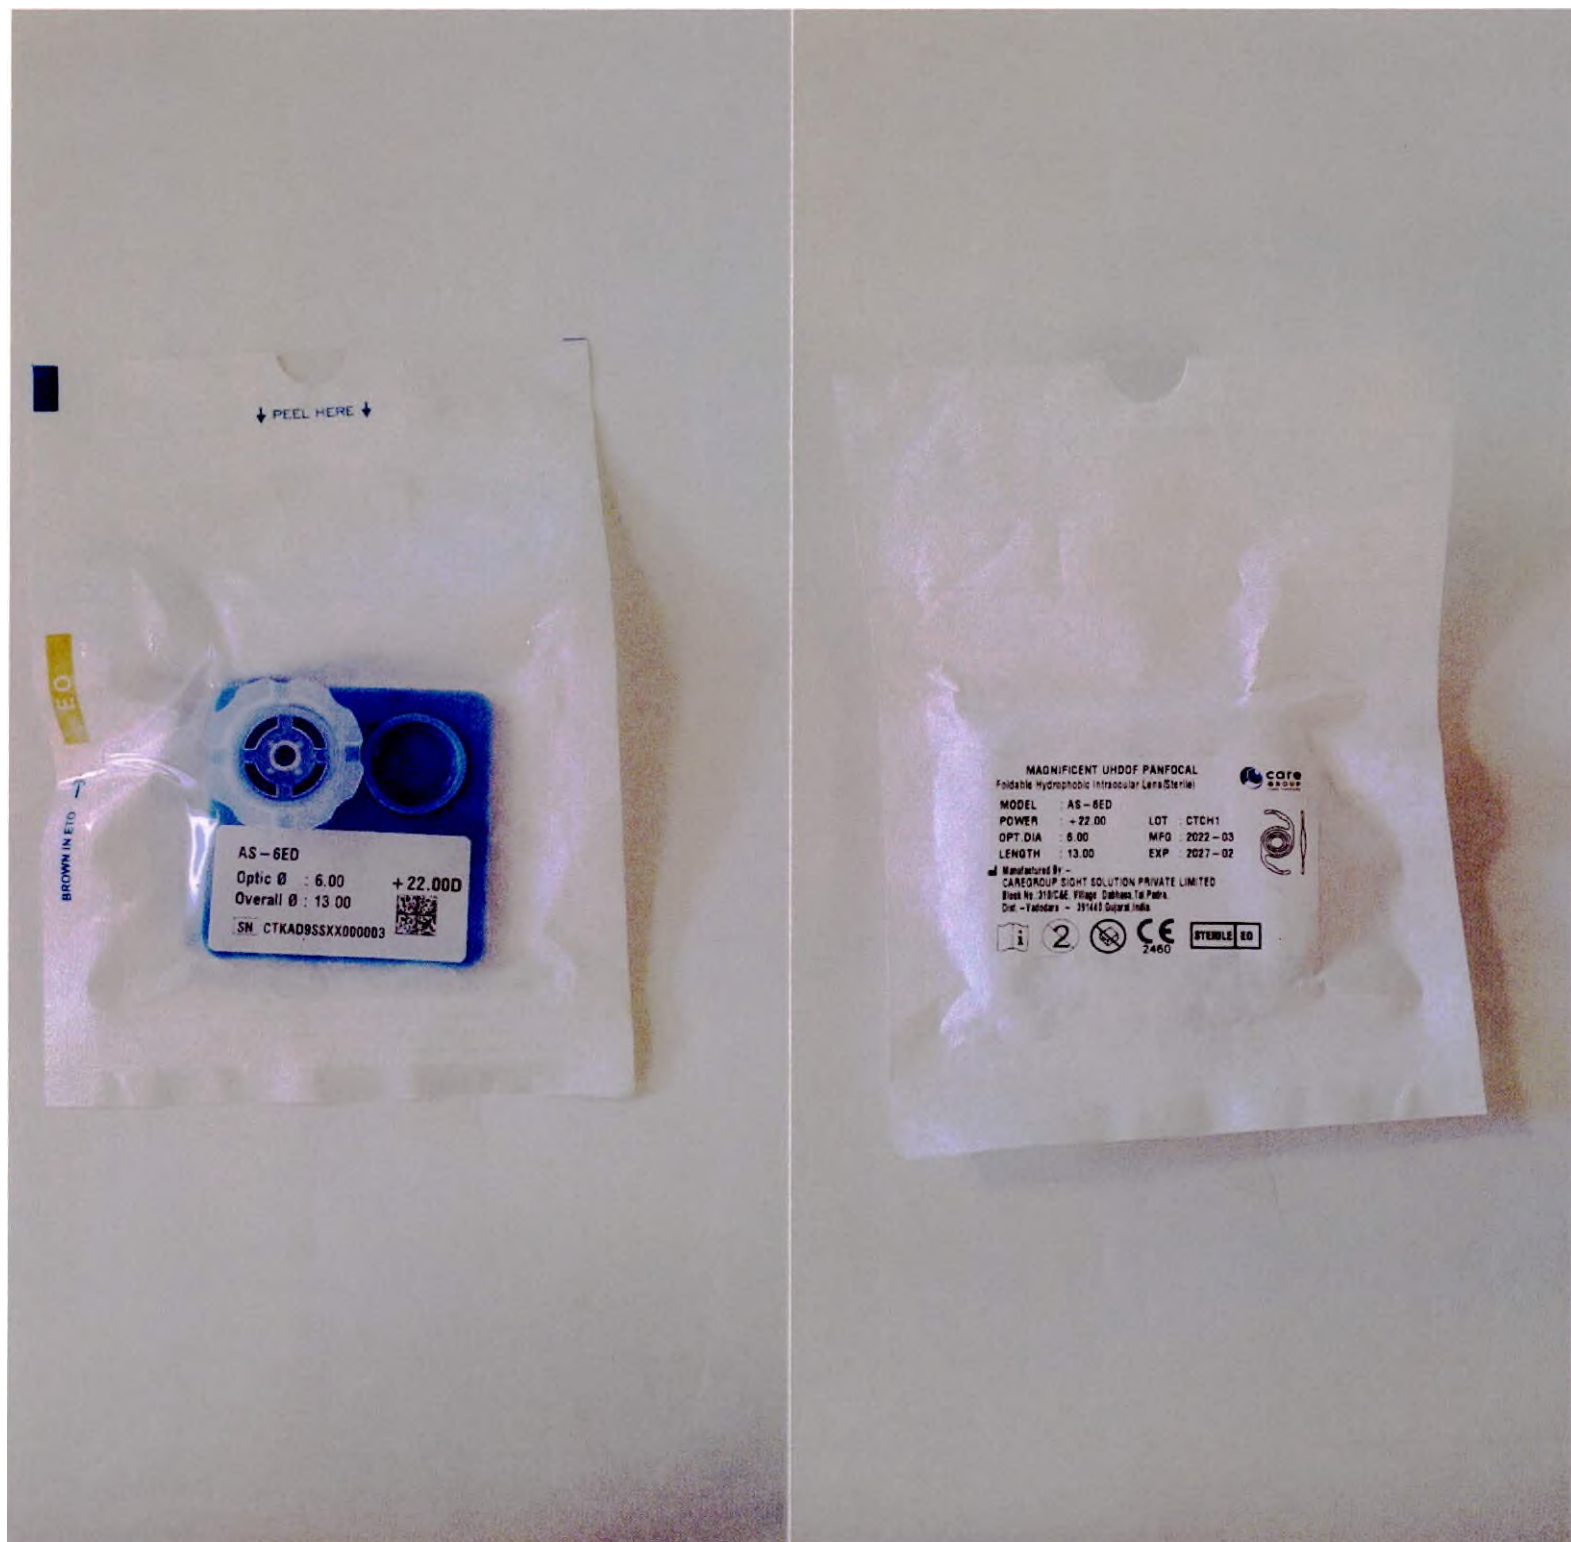

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка

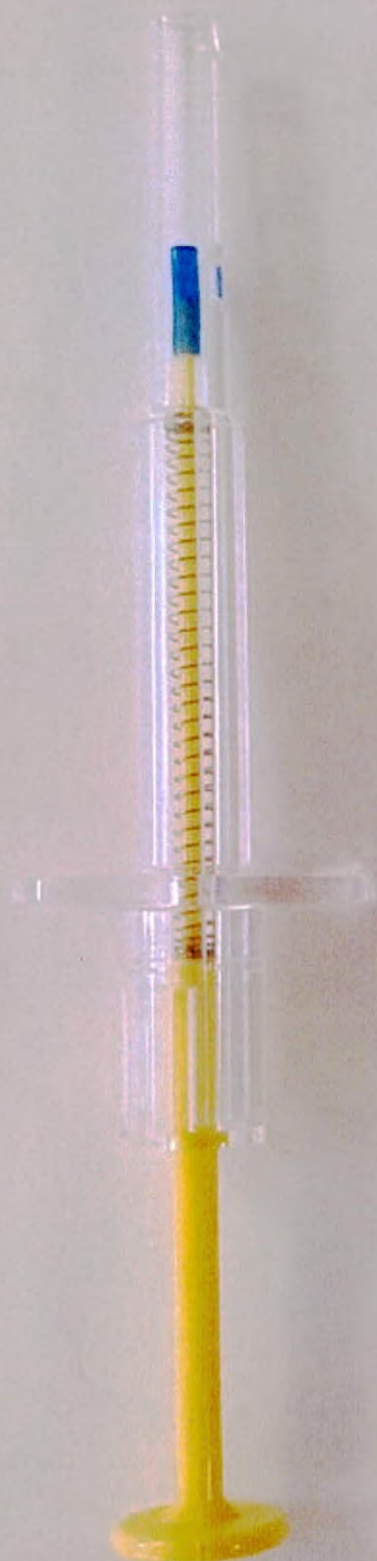

Контейнер с линзой, инжектор, картридж

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

MODEL : AS-6ED
POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL 
LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

POWER : +22.00
OPT.DIA : 6.00
LENGTH : 13.00

LOT : CTCH1 Add N : +3.00D
MFG: 2022-03 Add I : +1.60D
EXP : 2027-02
SN CTKAD9S5XX000003

Patient's Name : _____

Implant Surgeon's Name : _____

Date of Surgery : _____

Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6ED

POWER : +22.00

OPT.DIA : 6.00

LENGTH : 13.00

LOT : CTCH1

MFG : 2022-03

EXP : 2027-02

Add N : +3.00D

Add I : +1.60D

SN CTKAD9S5XX000003

CE
2460



MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

MODEL	AS-6EDT	CYL	2.0	ADD N	+3.000
POWER	+23.00	LOT	CTCH1	ADD I	+1.600
OPT DIA	6.00	MFG	2022-03		
LENGTH	13.00	EXP	2027-02		

MAGNIFICENT UHOOF PANFOCAL TORIC

Patient's Name: _____
 Implant Surgeon's Name: _____
 Date of Surgery: _____
 Implanted Eye: () R () L
 MODEL AS-6EDT CYL 2.0 ADD N +3.000
 POWER +23.00 LOT CTCH1 ADD I +1.600
 OPT DIA 6.00 MFG 2022-03
 LENGTH 13.00 EXP 2027-02
 SN CTKADSWX000912

Инструкция по применению медицинского изделия
«Линза интраокулярная»
Magnificent Panfocal Toric

Назначение:
 Медицинское изделие «Линза интраокулярная» — одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом, обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием (врач-офтальмохирург). Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Magnificent Panfocal Toric в составе:
 - Линза интраокулярная: модель AS-6EDT, в контейнере-1 контейнер.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения **Magnificent Panfocal Toric** в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6EDT, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации — не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.



Медицинское изделие «Линза интраокулярная»
вариант исполнения Magnificent Panfocal Toric,
потребительская упаковка



Контейнер с линзой, индивидуальная



AS-6ED1

T+2.0

Power : +23.00

Optic Ø : 6.00

Overall Ø : 13.00



SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC
MODEL : AS-6EDT CYL 2.0 Add N : +3.00D
POWER : +23.00 LOT : CTCH1 Add I : +1.60D
OPT.DIA : 6.00 MFG : 2022-03
LENGTH : 13.00 EXP : 2027-02
SN CTKAD9SWXX000012

MAGNIFICENT UHDOF PANFOCAL TORIC

Patient's Name :

Implant Surgeon's Name :

Date of Surgery :

Implanted Eye : () R () L

MODEL : AS-6EDT CYL 2.0

POWER : +23.00

OPT.DIA : 6.00

LENGTH : 13.00

LOT : CTCH1

MFG : 2022-03




EXP : 2027-02

Add N : +3.00D

Add I : +1.60D

CE
2460

SN CTKAD9SWXX000012

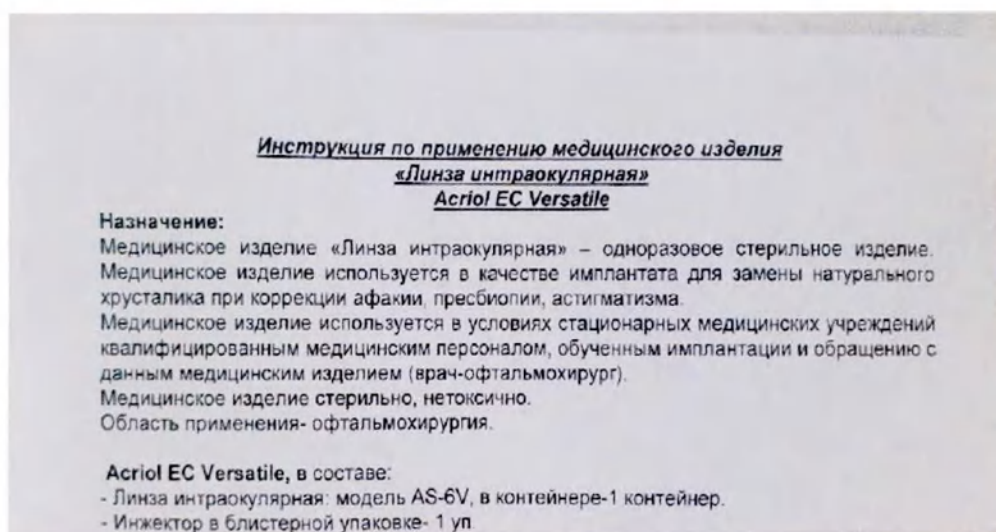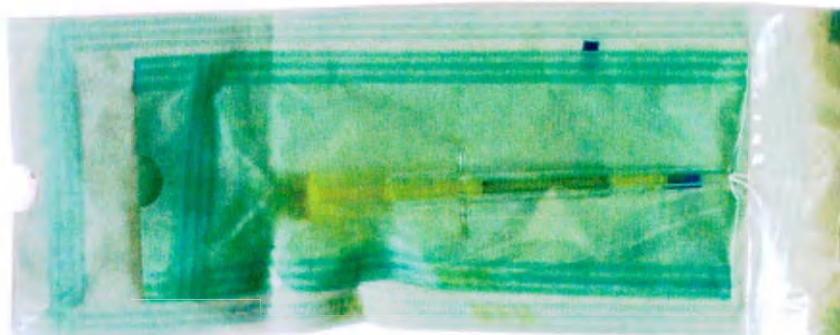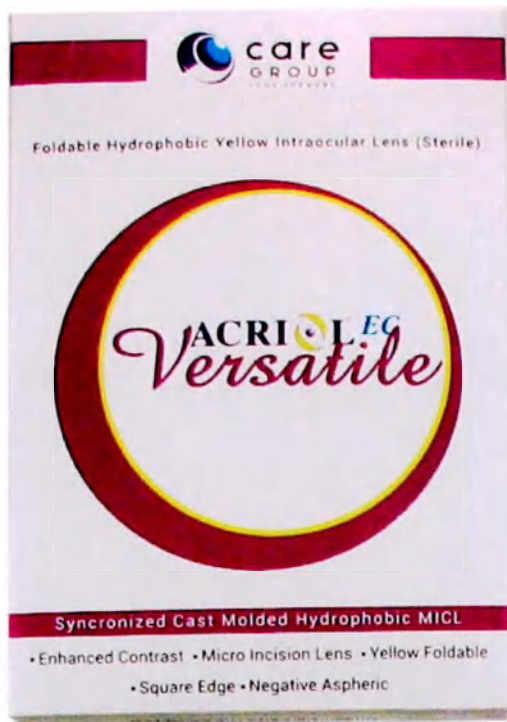

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» вариант исполнения

Acriol EC Versatile, в составе:

- Линза интраокулярная: модель AS-6V, в контейнере-1 контейнер.
- Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп.
- Картридж в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.

One sterile intraocular lens. With UV absorber. Do not use if the packaging is damaged.
Do not re-sterilize.

Eine sterile intraokuläre Linse. Mit UV-Absorber. Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist. Sterilisieren Sie nicht wiederholt.

Одну стерильную внутримножественную линзу. С УФ-поглощающим фильтром. Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.

Une lentille intraoculaire stérile. Avec filtre UV. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas re-stériliser.

En sterilt intrakulär lins. Med UV-absorber. Använd inte om förpackningen är skadad. Skäl inte sterilisera om.

En sterilt intraokulær linse. Med UV-filter. Må ikke brukes hvis emballeringen er skadet. Må ikke steriliseres om igjen.

Una lente intraoculare sterile. Con filtro UV. Non usare se il pacchetto è stato danneggiato. Non re-sterilizzare.

Uma lente intra-ocular estéril. Com filtro UV. Não usar se a embalagem estiver danificada. Não volte a esterilizar.

En sterilt inern okularlinse. Med UV filter. Må ikke bruges, hvis emballeringen er beskadiget. Må ikke steriliseres igen.

Een steriele intraoculaire lens. Met UV filter. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet heresteriliseren.


Contents:

- One (1) Sterile (PHU) Posterior Chamber Foldable Hydrophobic Yellow Intraocular Lens; Sterile unless enclosed package has been opened or damaged.
- Professional Information Leaflet
- Patient Lens Implant Identification Card
- Patient Record Labels


Mfg. Lic. No. G/28/1321

Manufactured By:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION LLP
Block No. 316/CAR, Village Dabhaha, Taluka - Padra,
Dist. Vadodara - 391 440, Gujarat, India.
customer@caregroupindia.com
www.caregroupindia.com | www.caregroupindia.com

EC REP European Representative
BIOVISION LIMITED
Wayside, Tring Road, Weltham,
Dunstable, BEDS LU6 2JU, U.K.



Rev. on: 01/2018



Versatile




Foldable Hydrophobic Yellow Intraocular Lens (Sterile)



Synchronized Cast Molded Hydrophobic MICH


- Enhanced Contrast • Micro Incision Lens • Yellow Foldable
- Square Edge • Negative Aspheric



CPDB0802TA00015


2018-04 2023-03

STYLE : AS-6V
LENGTH : 11.00
A CONST: 118.8
EXP. Date : 2023-03
LOT : CPDB0
OPT. DIA: 6.00
POWER : +24.00




CPDB0802TA00015

Press to tear



Versatile

Линза интраокулярная Acriol EC Versatile, маркировка потребительской упаковки

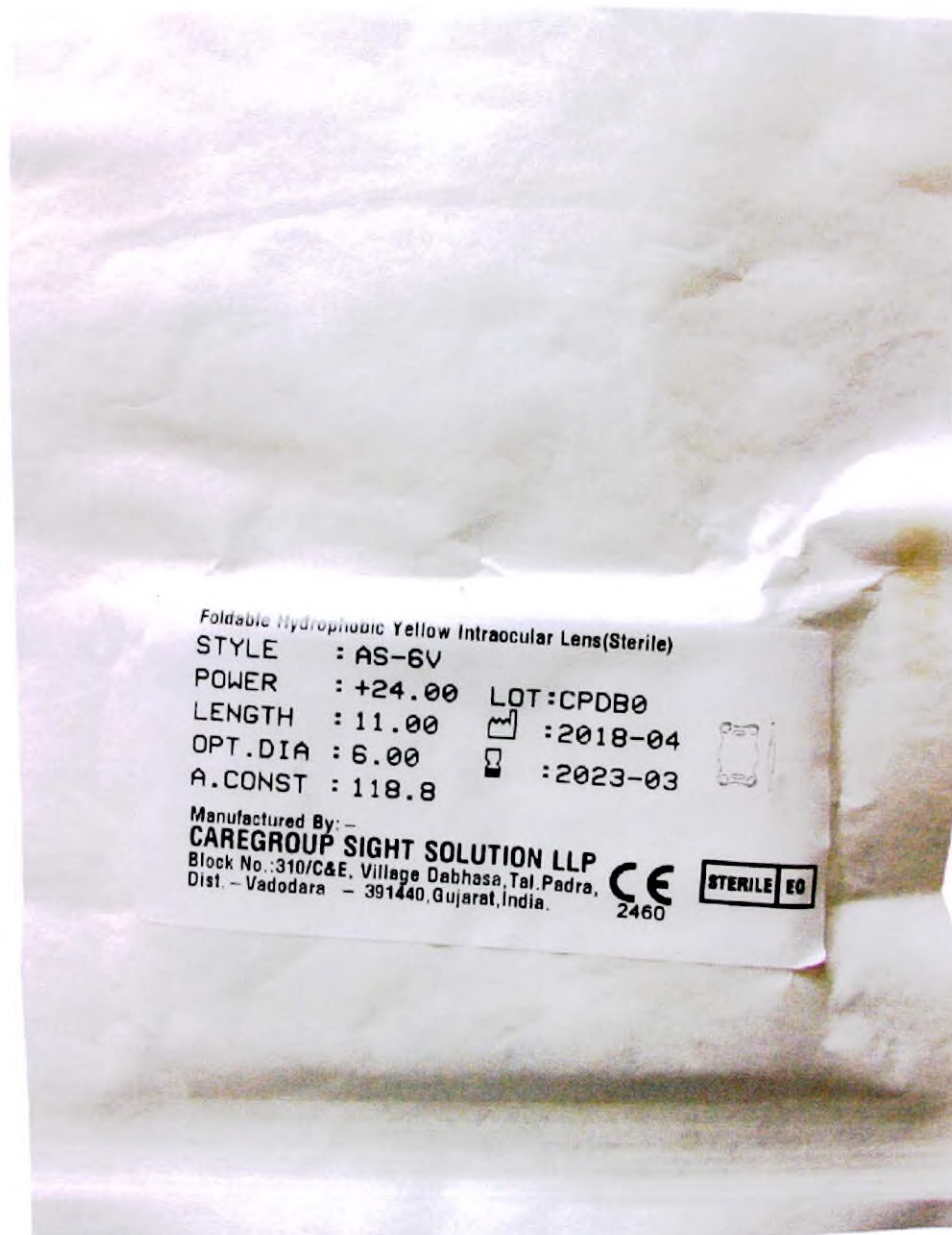

Контейнер с линзой, индивидуальная упаковка (блистер)



MODEL: AS-6V

OPTIC DIA :6.00

LENGTH :11.00

+24.00D




CPB02TA00015

Контейнер с линзой



Инжектор и картридж без упаковки

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V
 Implanted Eye : () R () L
 Date of Surgery : -----
 Implant Surgeon's Name : -----
 Patient's Name : -----

Наклейка для контроля имплантации

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915


 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V


CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V

CPDB88821A99915

 OPT.DIA : 6.00 Exp: 2023-03
 LENGTH : 11.00 POWER : +24.00
 STYLE : AS-6V



Инструкция по применению медицинского изделия «Линза интраокулярная» Acriol EC Versatile Preloaded

Назначение:

Медицинское изделие «Линза интраокулярная» – одноразовое стерильное изделие. Медицинское изделие используется в качестве имплантата для замены натурального хрусталика при коррекции афакии, пресбиопии, астигматизма. Медицинское изделие используется в условиях стационарных медицинских учреждений квалифицированным медицинским персоналом (врач-офтальмохирург), обученным имплантации и обращению с данным медицинским изделием. Медицинское изделие стерильно, нетоксично. Область применения- офтальмохирургия.

Acriol EC Versatile Preloaded, в составе:

- Линза интраокулярная, модель AS-6VP (предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор), в блистерной упаковке- 1 уп.

Медицинское изделие «Линза интраокулярная», вариант исполнения **Acriol EC Versatile Preloaded**, в составе:

- Линза интраокулярная, модель AS-6VP (предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор), в блистерной упаковке- 1 уп.
- Наклейка пациента- 1шт.
- Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт.
- Инструкция по использованию- 1 шт.

Линза интраокулярная Акриол ЕС Versatile Preloaded, потребительская упаковка

Optic Dia :6.00
Length :11.00
A Const :118.8



Approval No. G03-003-C-80

Mfg. Lic. No. 0128/1321
Manufactured by:
CAREGROUP VISION SOLUTION LLP
Block No. 310/C&L, Vignar Dabha, Tuluva, Padra,
Karnataka 575 001, India
customerservice@caregroup.com
www.caregroup.com | www.caregroupindia.com

EUROPEAN REPRESENTATIVE
BIOVISION LIMITED
Weyford, Tingford, Leighton
Donkirk, MK20 1SA, UK

STERILE EO



- Contents:
- One (1) Sterile **STIMUL EO** Preloaded Posterior Chamber Foldable Hydrophobic Yellow Intraocular Lens in One (1) Sterile **STIMUL EO** Disposable Injector & Cartridge
 - Professional Information Leaflet.
 - Patient Lens Implant Identification Card.
 - Patient Record Labels.



Versatile

CPEJ2C2YSW00285



Style : AS - 6VP
Lot : CPEJ2
+23.00
: 2018-05
: 2023-04




Foldable Hydrophobic Yellow Intraocular Lens (Sterile)

ACRIOL ^{EC} Versatile




Rev. On 09-2017

Press to Tear









Versatile

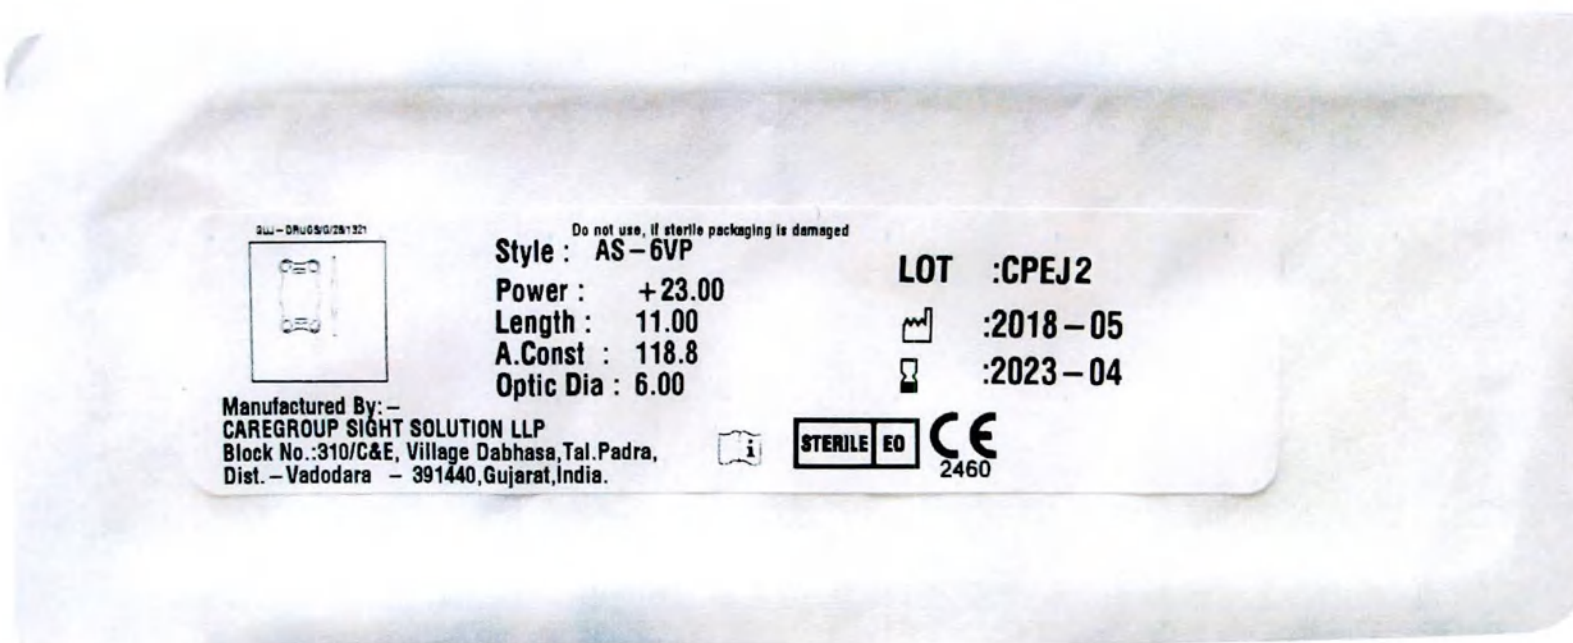

Линза, предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор, блистерная упаковка



Линза интраокулярная, предустановленная в картридж, который заправлен в инжектор

Patient's Name: _____ Surgeon's Name: _____ Surgery Date: _____ Eye: () R () L Style: AS-6VP Power: +23.00  CPEJ2C2YSW00285	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 	
	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 
	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 	Style : AS-6VP Power : +23.00 Length: 11.00 EXP : 2023-04 Opt. Dia: 6.00 Serial No: CPEJ2C2YSW00285 


Наклейка пациента

Наклейки для контроля имплантации

Наименование изделия Линза интраокулярная		РУ _____	Схематическое изображение медицинского изделия Штрих-код
Модель Общий диаметр А-константа Цилиндрическая сила Диоптрийность Диаметр оптики	   		
  STERILE  STERILE EO NON-TOXIC 45°C  0°C 2 2     			
Медицинское изделие (одного из вариантов исполнения TriDiff, TriDiff Toric, Ultima Smart Toric, Ultima Smart Toric Multifocal, Ultima Natural, TriPhobic, TriPhobic Toric, Magnificent, Magnificent Toric, Magnificent Panfocal, Magnificent Panfocal Toric, Acriol EC Versatile) в составе: Линза одного из вариантов исполнения в контейнере - 1 контейнер. Инжектор в блистерной упаковке- 1 уп. Картридж в блистерной упаковке- 1 уп. Наклейка для пациента- 1шт. Наклейки для контроля имплантации – не более 10 шт. Инструкция по использованию- 1 шт. Коробка - 1 шт.			
 Производитель Caregroup Sight Solution Private Limited, Адрес места производства: Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India. www.caregroupiol.com e-mail: Customercare@caregroupindia.com Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «КОМ СПАН» Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2. Тел./ факс: (495) 434 45 06			

Макет маркировки потребительской упаковки для вариантов исполнения

TriDiff, TriDiff Toric, Ultima Smart Toric, Ultima Smart Toric Multifocal, Ultima Natural, TriPhobic, TriPhobic Toric, Magnificent, Magnificent Toric, Magnificent Panfocal, Magnificent Panfocal Toric, Acriol EC Versatile

Линза интраокулярная Вариант исполнения: _____		Схематическое изображение	
Модель Диоптрийность Общий диаметр Диаметр оптики А-константа Цилиндрическая сила	LOT REF  	ШТРИХ-КОД	
 2460 STERILE STERILE NON-TOXIC 0°C 45°C        SN			
 Производитель Caregroup Sight Solution Private Limited, Адрес места производства: Caregroup Sight Solution Private Limited, Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India. Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «КОМ СПАН» Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2. Тел./ факс: (495) 434 45 06			

Макет маркировки индивидуальной упаковки линзы (блистера).

Схематическое изображение	Наименование изделия Стерильный картридж для Линзы интраокулярной/ Стерильный инжектор для Линзы интраокулярной РУ _____	
	LOT  	SN REF
	ШТРИХ-КОД	

 2460

STERILE EO

NON-TOXIC

 0°C — 45°C




SN









Производитель
 Caregroup Sight Solution Private Limited

Адрес места производства:
 Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist, Vadodara-391440, Gujarat, India.
www.caregroupiol.com | e-mail: Customercare@caregroupindia.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:
 ООО «КОМ СПАН» Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3, эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2. Тел./ факс: (495) 434 45 06

Макет маркировки индивидуальной упаковки инжектора и картриджа (блистера).

Наименование изделия, вариант исполнения





Производитель

Caregroup Sight Solution Private Limited,
Block No. 310/C&E, Village Dabhasa, Taluka-Padra, Dist,
Vadodara-391440, Gujarat, India
www.caregroupiol.com | e-mail: Customercare@caregroupindia.com

XX шт

брутто XX кг/нетто XX кг

ШТРИХ-КОД



Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «КОМ СПАН»

Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3,

эт 1 пом. XVII, ком. 1, оф 2.

Тел./ факс: (495) 434 45 06

Макет маркировки транспортной упаковки

Макет маркировки наклейки пациента.

Данные пациента _____

(фамилия, имя)

- модель _____

- дата имплантации _____

- Какой глаз имплантировали () правый

() левый

общий диаметр / диаметр оптики / диоптрийность / цилиндрическая сила

Макет маркировки наклейки врача.

-модель, общий диаметр, диаметр оптики, диоптрийность,
цилиндрическая сила (для торических линз)

-штрих-код

Макет маркировки наклейки контейнера с линзой

-модель, общий диаметр, диаметр оптики, диоптрийность

-штрих-код

Примено и сакрелено
керативо JS



Генеральный
директор
Павел ДКЧ