

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий-индивидуальный
предприниматель
ООО «БИ Плюс»
Потака В.Ф.
«22» сентября 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

Коффердам DENTAL FORMULA®



г. Санкт-Петербург

**Фотографические изображения общего вида вариантов исполнения медицинского изделия
Коффердам DENTAL FORMULA® в цветах: голубой, зеленый, розовый, черный, синий.**


Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий / средней толщины / плотный / особо плотный без аромата / с ароматом мяты, цвет: голубой, синий, зелёный, чёрный, розовый, размер: 5" x 5", 6" x 6", в упаковке по 10/20/30/36/52 шт.

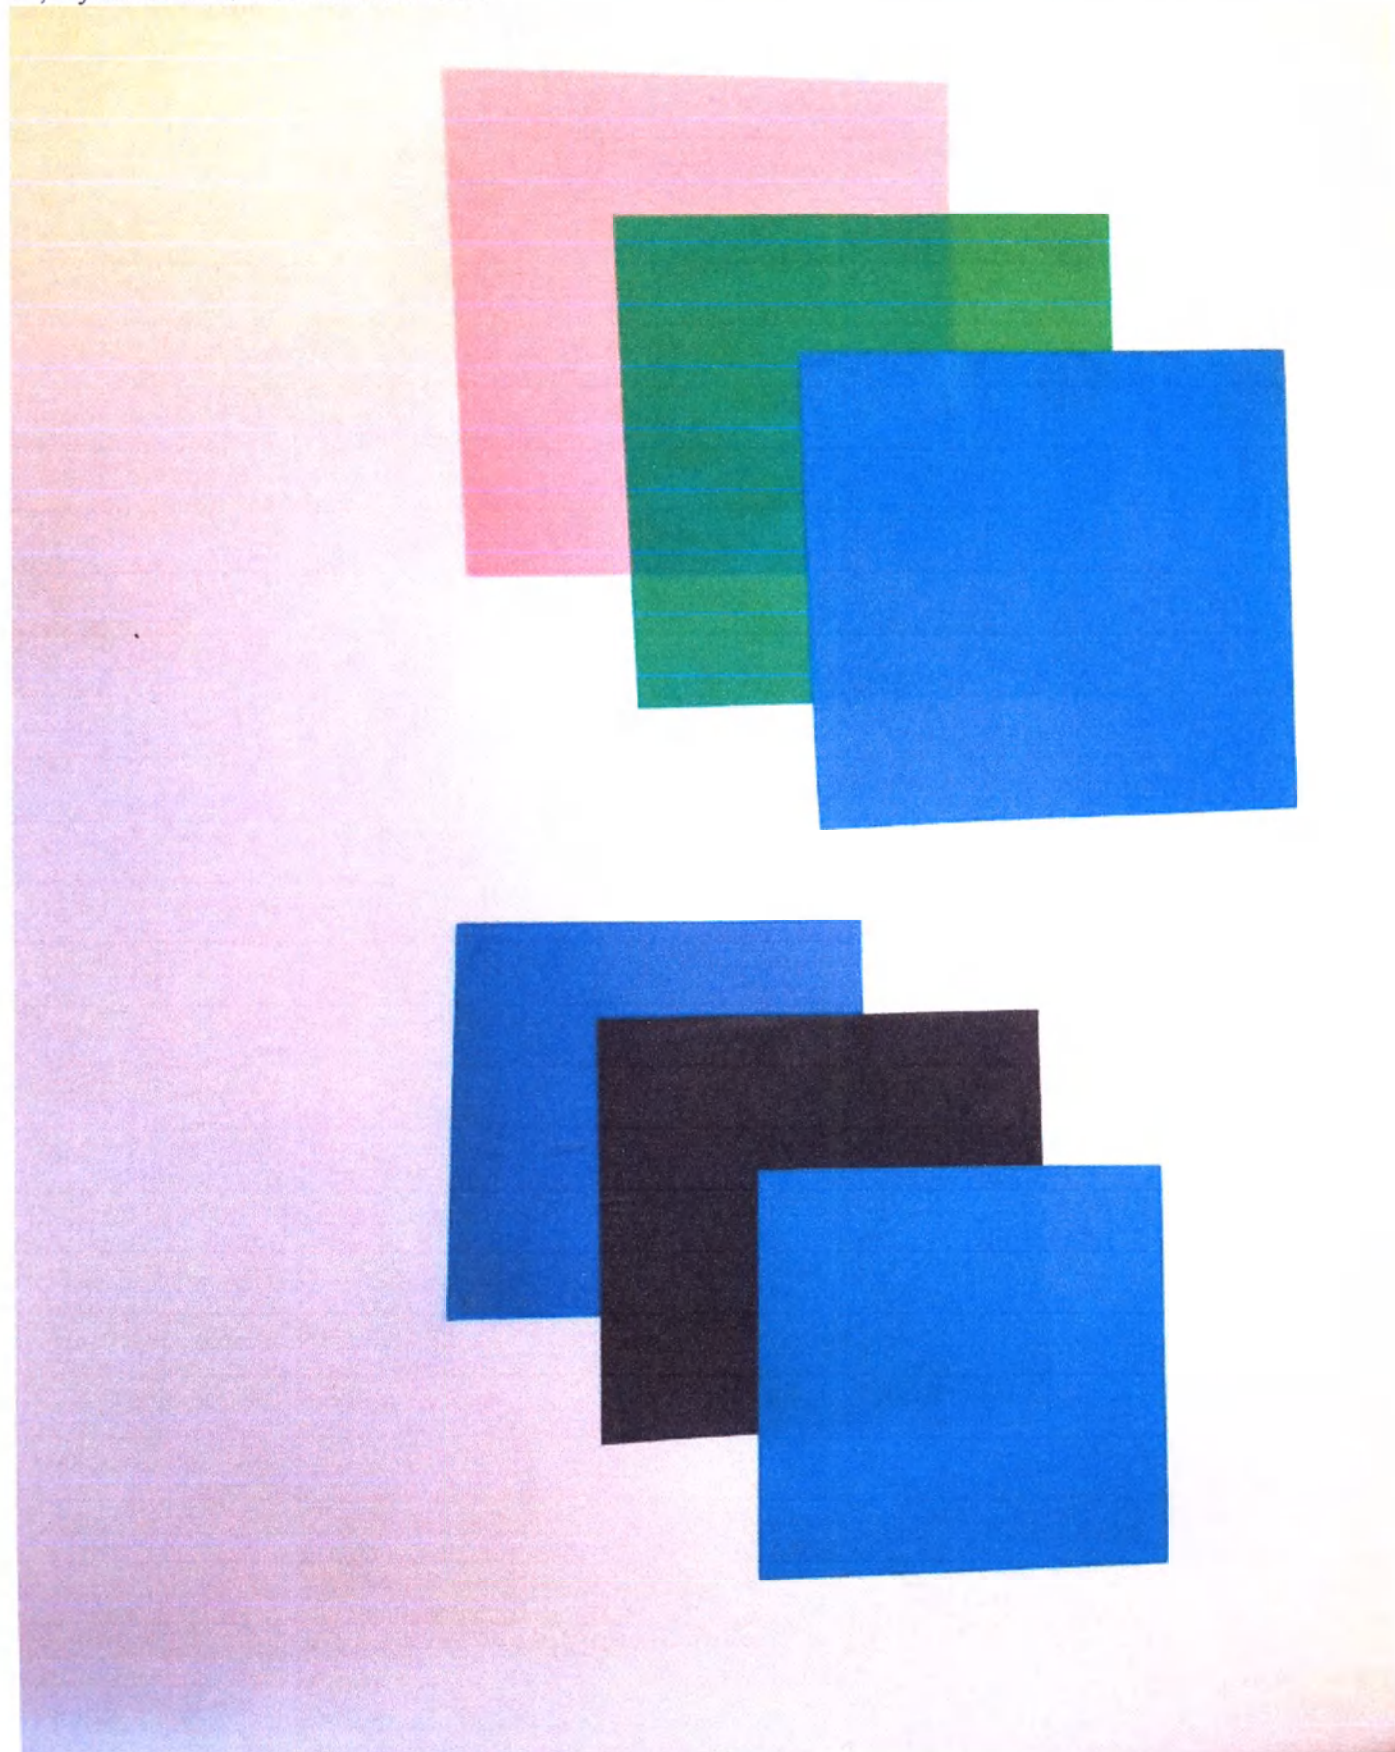


1. Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий / средней толщины / плотный / особо плотный без аромата / с ароматом мяты, цвет: голубой, размер: 5" x 5", 6" x 6".

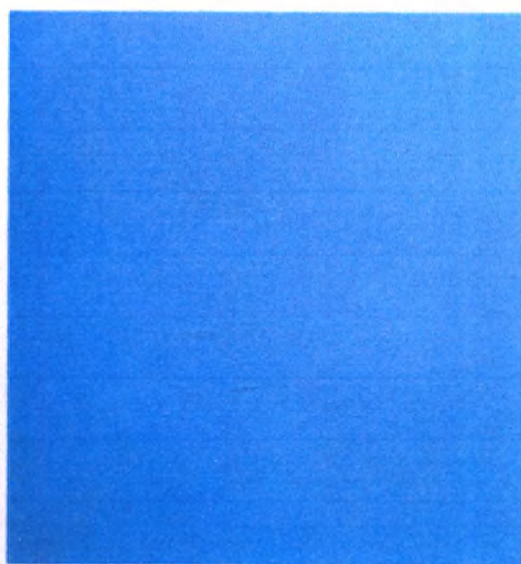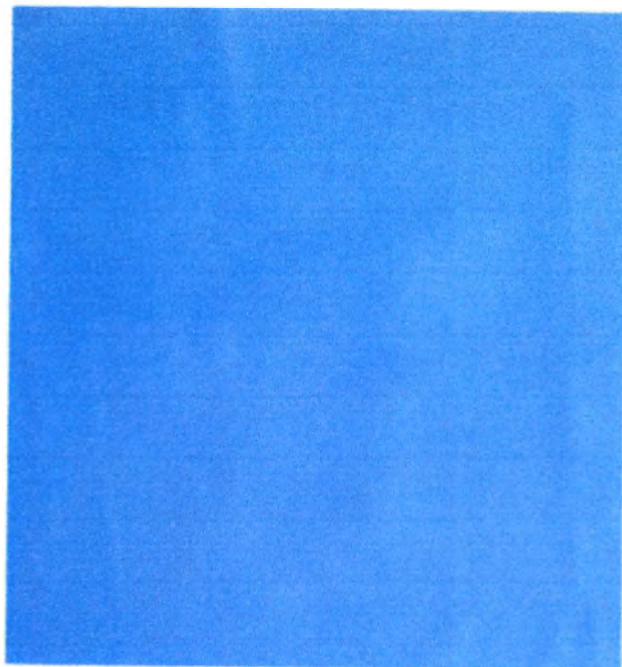


2. Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий / средней толщины / плотный / особо плотный без аромата / с ароматом мяты, цвет: зеленый, размер: 5" x 5", 6" x 6".

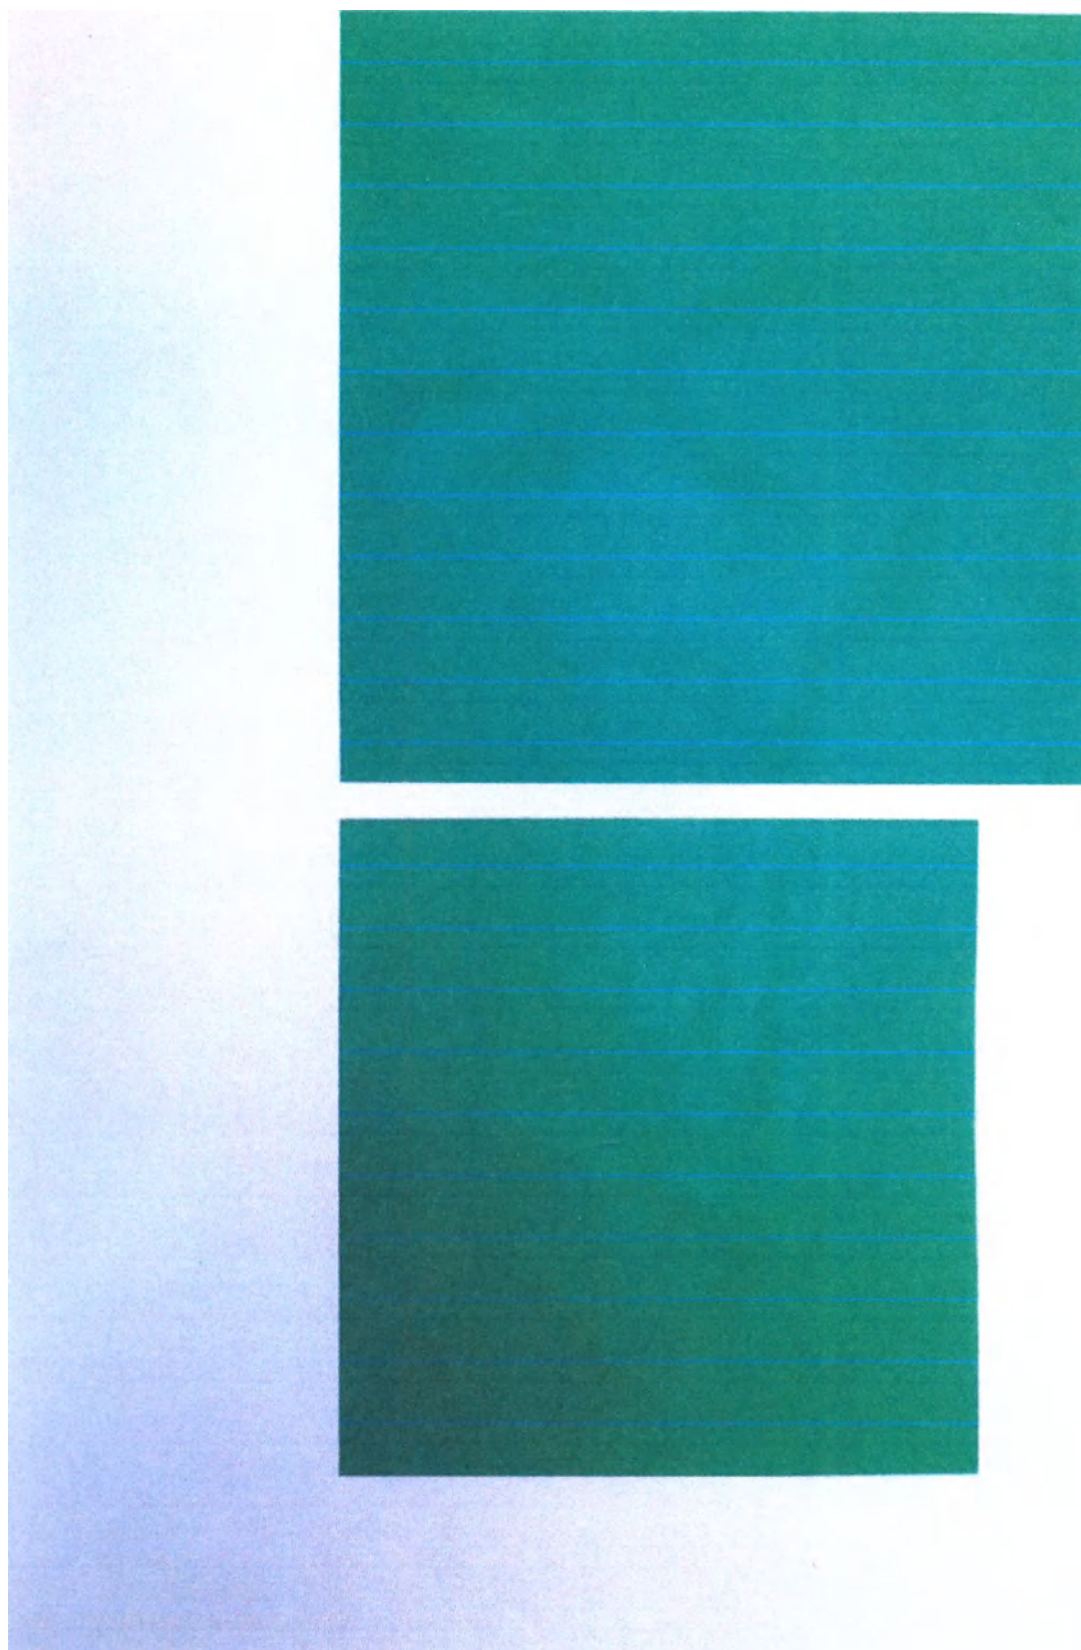


3. Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий / средней толщины / плотный / особо плотный без аромата / с ароматом мяты, цвет: синий, размер: 5" x 5", 6" x 6".

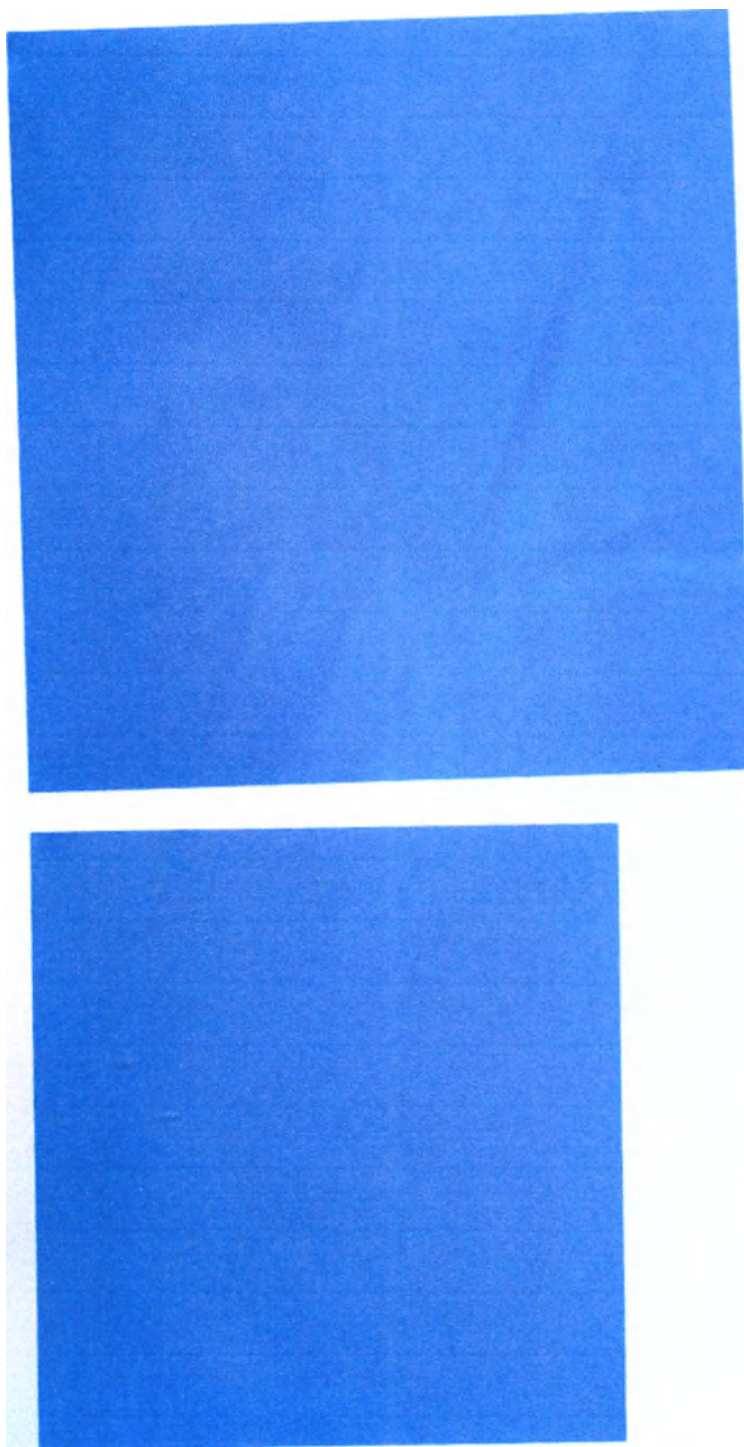

4. Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий / средней толщины / плотный / особо плотный без аромата / с ароматом мяты, цвет: розовый, размер: 5" x 5", 6" x 6".

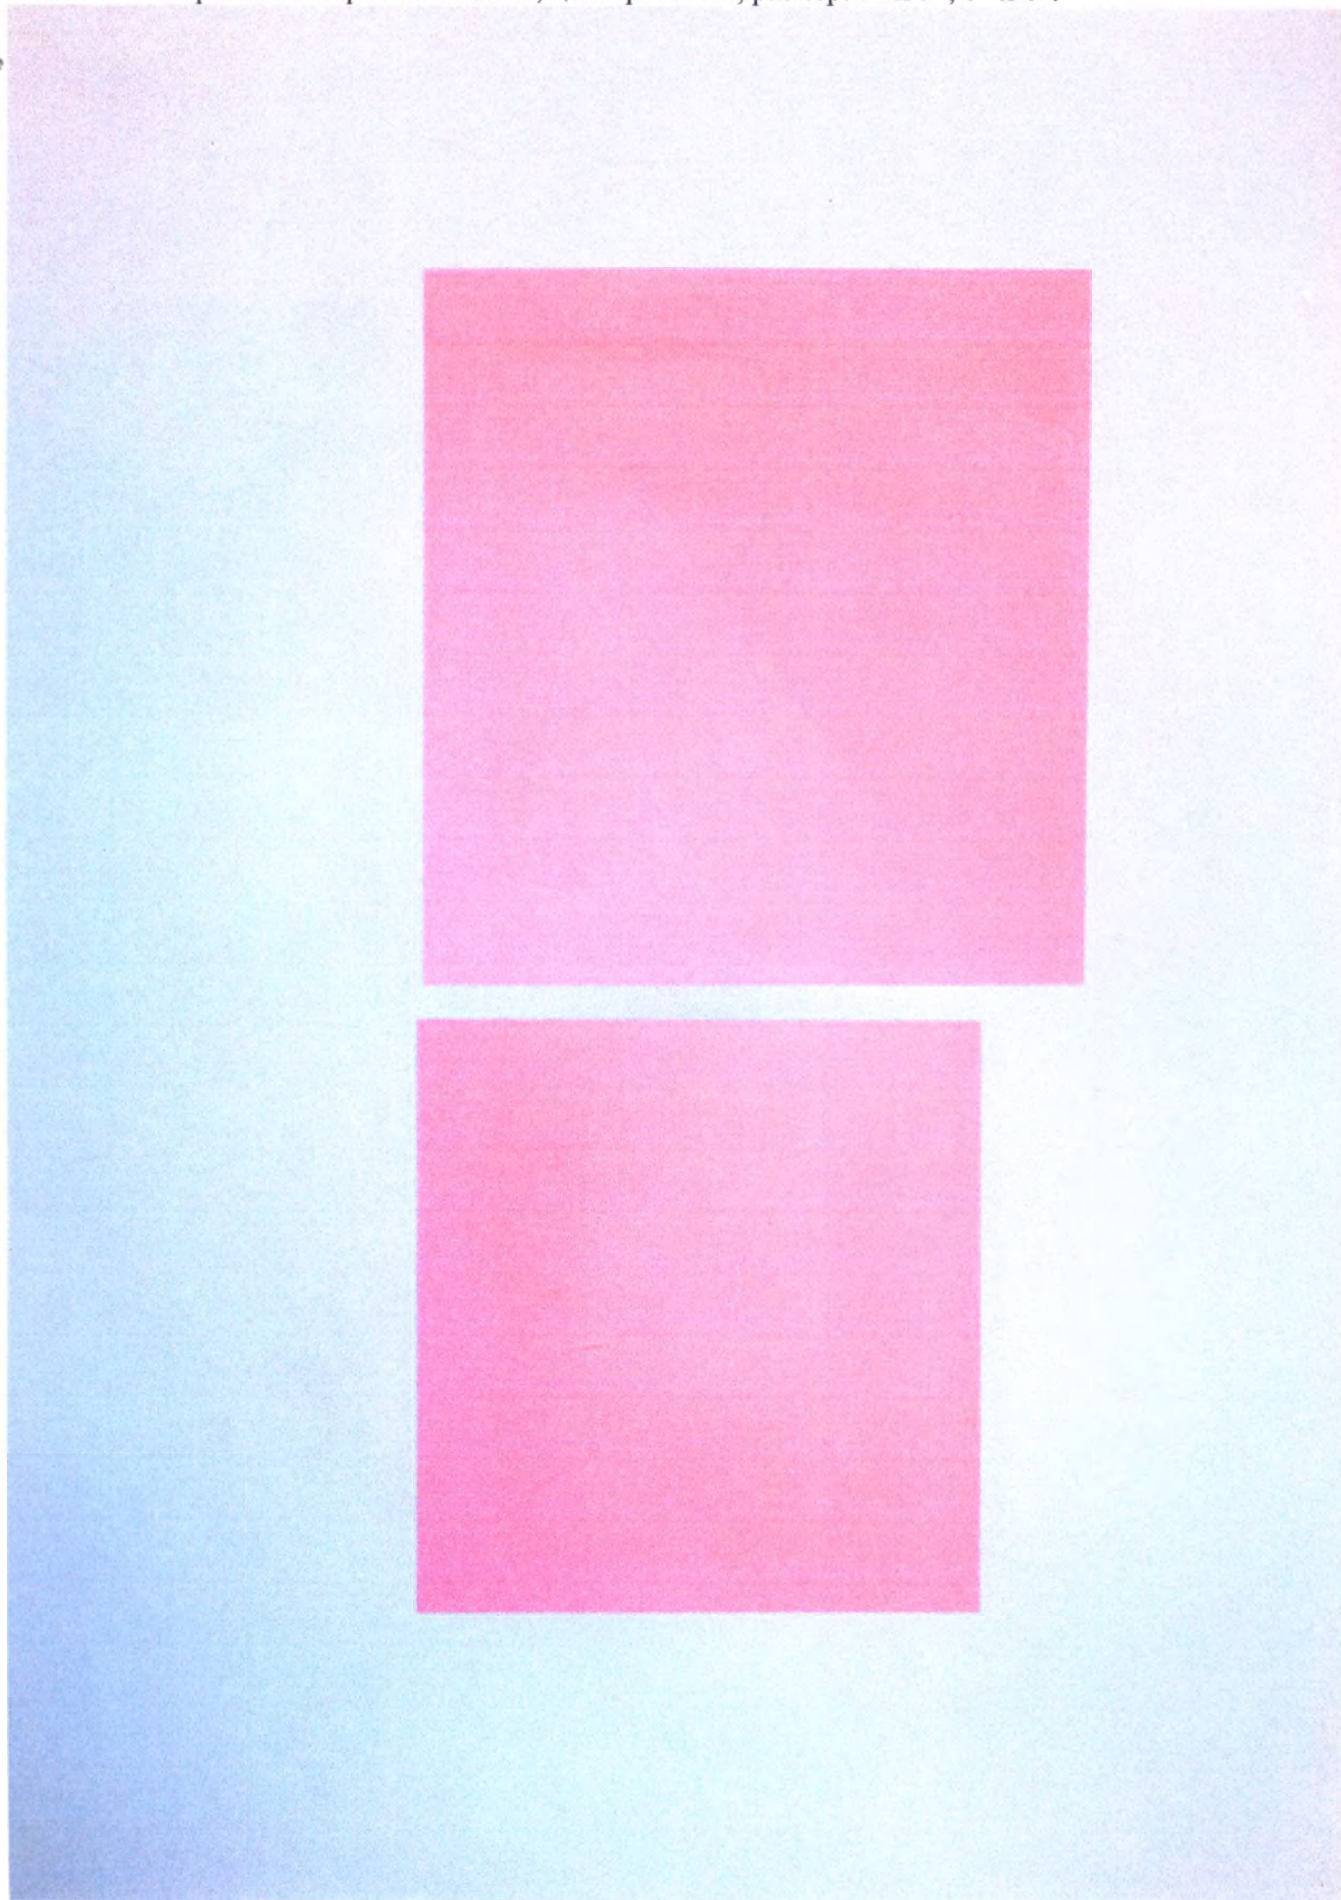

5. Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий / средней толщины / плотный / особо плотный без аромата / с ароматом мяты, цвет: чёрный, размер: 5" x 5", 6" x 6".

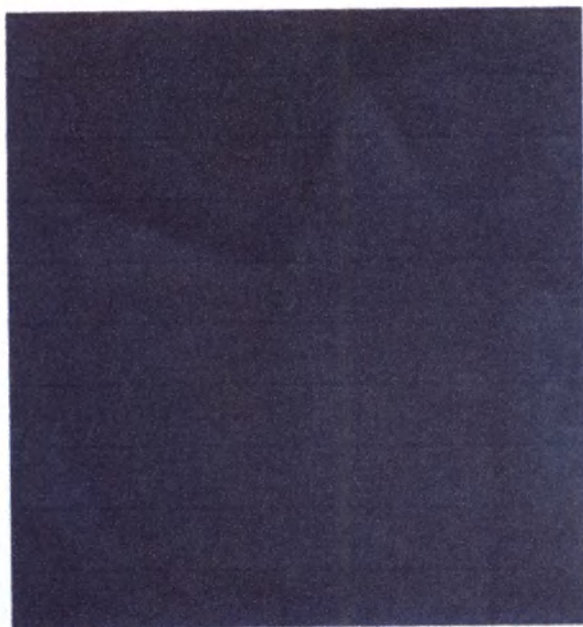



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель
ООО «БИ Плюс»



В.Ф. Потака

«13» ноября 2023 г.

МАКЕТ УПАКОВКИ
медицинского изделия

Коффердам DENTAL FORMULA®

г. Санкт-Петербург

DENTAL
D FORMULA

КОФФЕРДАМ
Тонкий (thin)
5 x 5"
С аэрозольной массой (mint)
Toothcol (light blue)
Количество: XX air./prs.

КОФФЕРДАМ DENTAL FORMULA® ЛАТВИСКИЙ
ТОНКИЙ 5 x 5" (127 мм х 127 мм), цвет: Toon/col.

КОФФЕРДАМ® предназначено для изготовления искусственных зубов стоматологическим способом. Оно имеет форму и цвет натуральных зубов, поэтому не требует дополнительной окраски и полировки для обеспечения хорошего внешнего вида.

Материал не требует специальной обработки. Устойчив к истиранию. Не имеет неприятного запаха. В готовом виде, после отпрессовки, имеет вид, соответствующий температуре от +10 °C до +20 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на упаковке изделия.

Используется на протяжении. Окружающая среда не оказывает воздействия на изделие. Изделие не требует специальной обработки. Оно имеет форму и цвет натуральных зубов, поэтому не требует дополнительной окраски и полировки для обеспечения хорошего внешнего вида.

Устойчив к истиранию. Не имеет неприятного запаха. В готовом виде, после отпрессовки, имеет вид, соответствующий температуре от +10 °C до +20 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на упаковке изделия.

Используется на протяжении. Окружающая среда не оказывает воздействия на изделие. Изделие не требует специальной обработки. Оно имеет форму и цвет натуральных зубов, поэтому не требует дополнительной окраски и полировки для обеспечения хорошего внешнего вида.

Устойчив к истиранию. Не имеет неприятного запаха. В готовом виде, после отпрессовки, имеет вид, соответствующий температуре от +10 °C до +20 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на упаковке изделия.

Используется на протяжении. Окружающая среда не оказывает воздействия на изделие. Изделие не требует специальной обработки. Оно имеет форму и цвет натуральных зубов, поэтому не требует дополнительной окраски и полировки для обеспечения хорошего внешнего вида.

Устойчив к истиранию. Не имеет неприятного запаха. В готовом виде, после отпрессовки, имеет вид, соответствующий температуре от +10 °C до +20 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на упаковке изделия.

Только при использовании в соответствии с инструкцией.

ПРОИЗВЕДЕНА В СССР
Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Министерство здравоохранения СССР
Институт стоматологии
Москва, 119002, Ленинградский пр., 100
Удостоверенный патентом на изобретение № 000-58119000,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194026, 194026,
ул. Л. Кавказа, 1, литер А, корпус 1, этаж 5, п. 11 (11) 300-34-40,
белый телефон 300-11, безвозмездно и/или

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий с ароматом мяты, цвет: голубой, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.




РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX



LOT

XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX



[illegible]

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий с ароматом мяты, цвет: синий, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

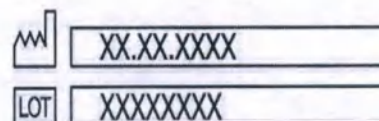

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий с ароматом мяты, цвет: зелёный, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

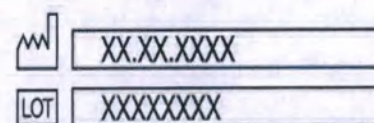

DENTAL F FORMULA

КОФФЕРДАН
Тонкий (thin)
5 x 5
С ароматом икры (in fish)
Черный (black)
Количество: XX шт./пач.

КОФФЕРДАН ДЕНТАЛ ФОРМУЛА® ПАТЕНСКИЙ
ТОНКИЙ С АРОМАТОМ ИКРЫ, ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ,
РАЗМЕР: 5 x 5 (127 мм x 127 мм).

Кодифицированный продукт для предотвращения нежелательных последствий при употреблении для похудения. Содержит 50% экстракта черного перца для усиления эффекта похудения.

Материал: натуральный латекс.
Условия применения. Изделие применяется в соответствии с инструкцией. Рекомендуется использовать в сухую часть, далее от греться солнцем 10-15 мин. при температуре от +10 °C до +30 °C, в относительной влажности воздуха от 45 % до 65 %, в соответствии с инструкцией не применять изделие.

Материал по применению. Орудия на коффердане используются для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Материал транспортируется в упаковке. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Упаковка. Изделие коффердан используется для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Применение. Изделие коффердан используется для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Только для индивидуального применения.
Изделие не подлежит общественной обработке.

ЧЕРНЫЙ ПАТЕНСКИЙ
Латекс. Изделие коффердан используется для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Материал по применению. Орудия на коффердане используются для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Материал транспортируется в упаковке. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Упаковка. Изделие коффердан используется для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Применение. Изделие коффердан используется для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

ЧЕРНЫЙ ПАТЕНСКИЙ
Латекс. Изделие коффердан используется для нанесения, давления, специальной обработки. Изделие коффердан не от латекса, поэтому его можно использовать с помощью шпателя. Записывать коффердан с внешней стороны для, используя специальную форму. Использование коффердана при нанесении и обработке поверхности.

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий с ароматом мяты, цвет: чёрный, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

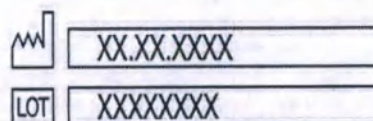

5) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий с ароматом мяты, цвет: розовый, размер: 5" x 5".

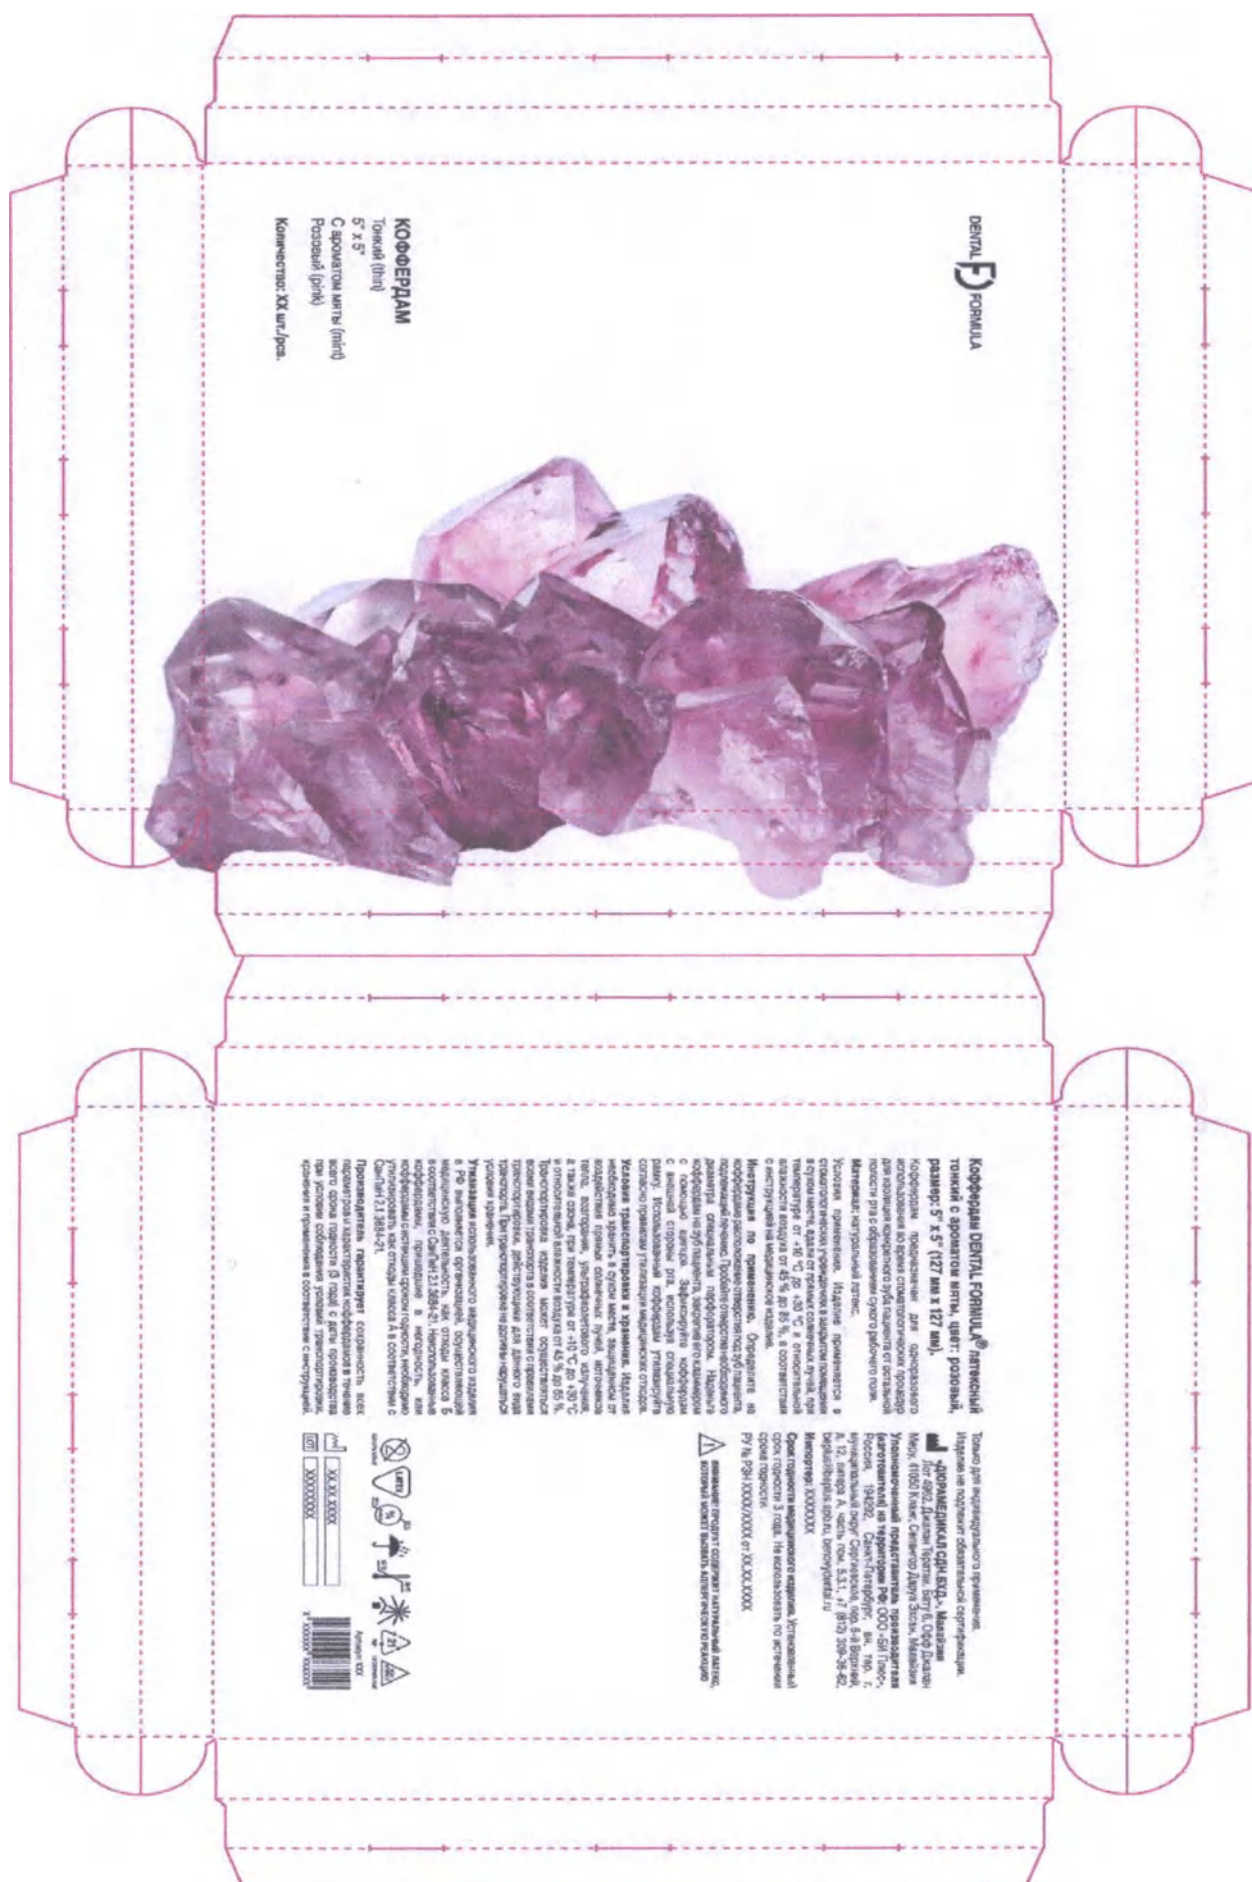

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий с ароматом мяты, цвет: розовый, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

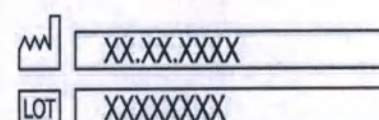

6) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: голубой, размер: 6" x 6".



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: голубой, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробеите отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

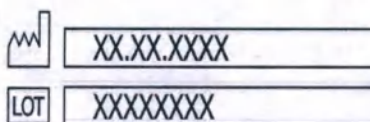

6"



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: синий, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovy dental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.



РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX




XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX



8) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: зелёный, размер: 6" x 6".

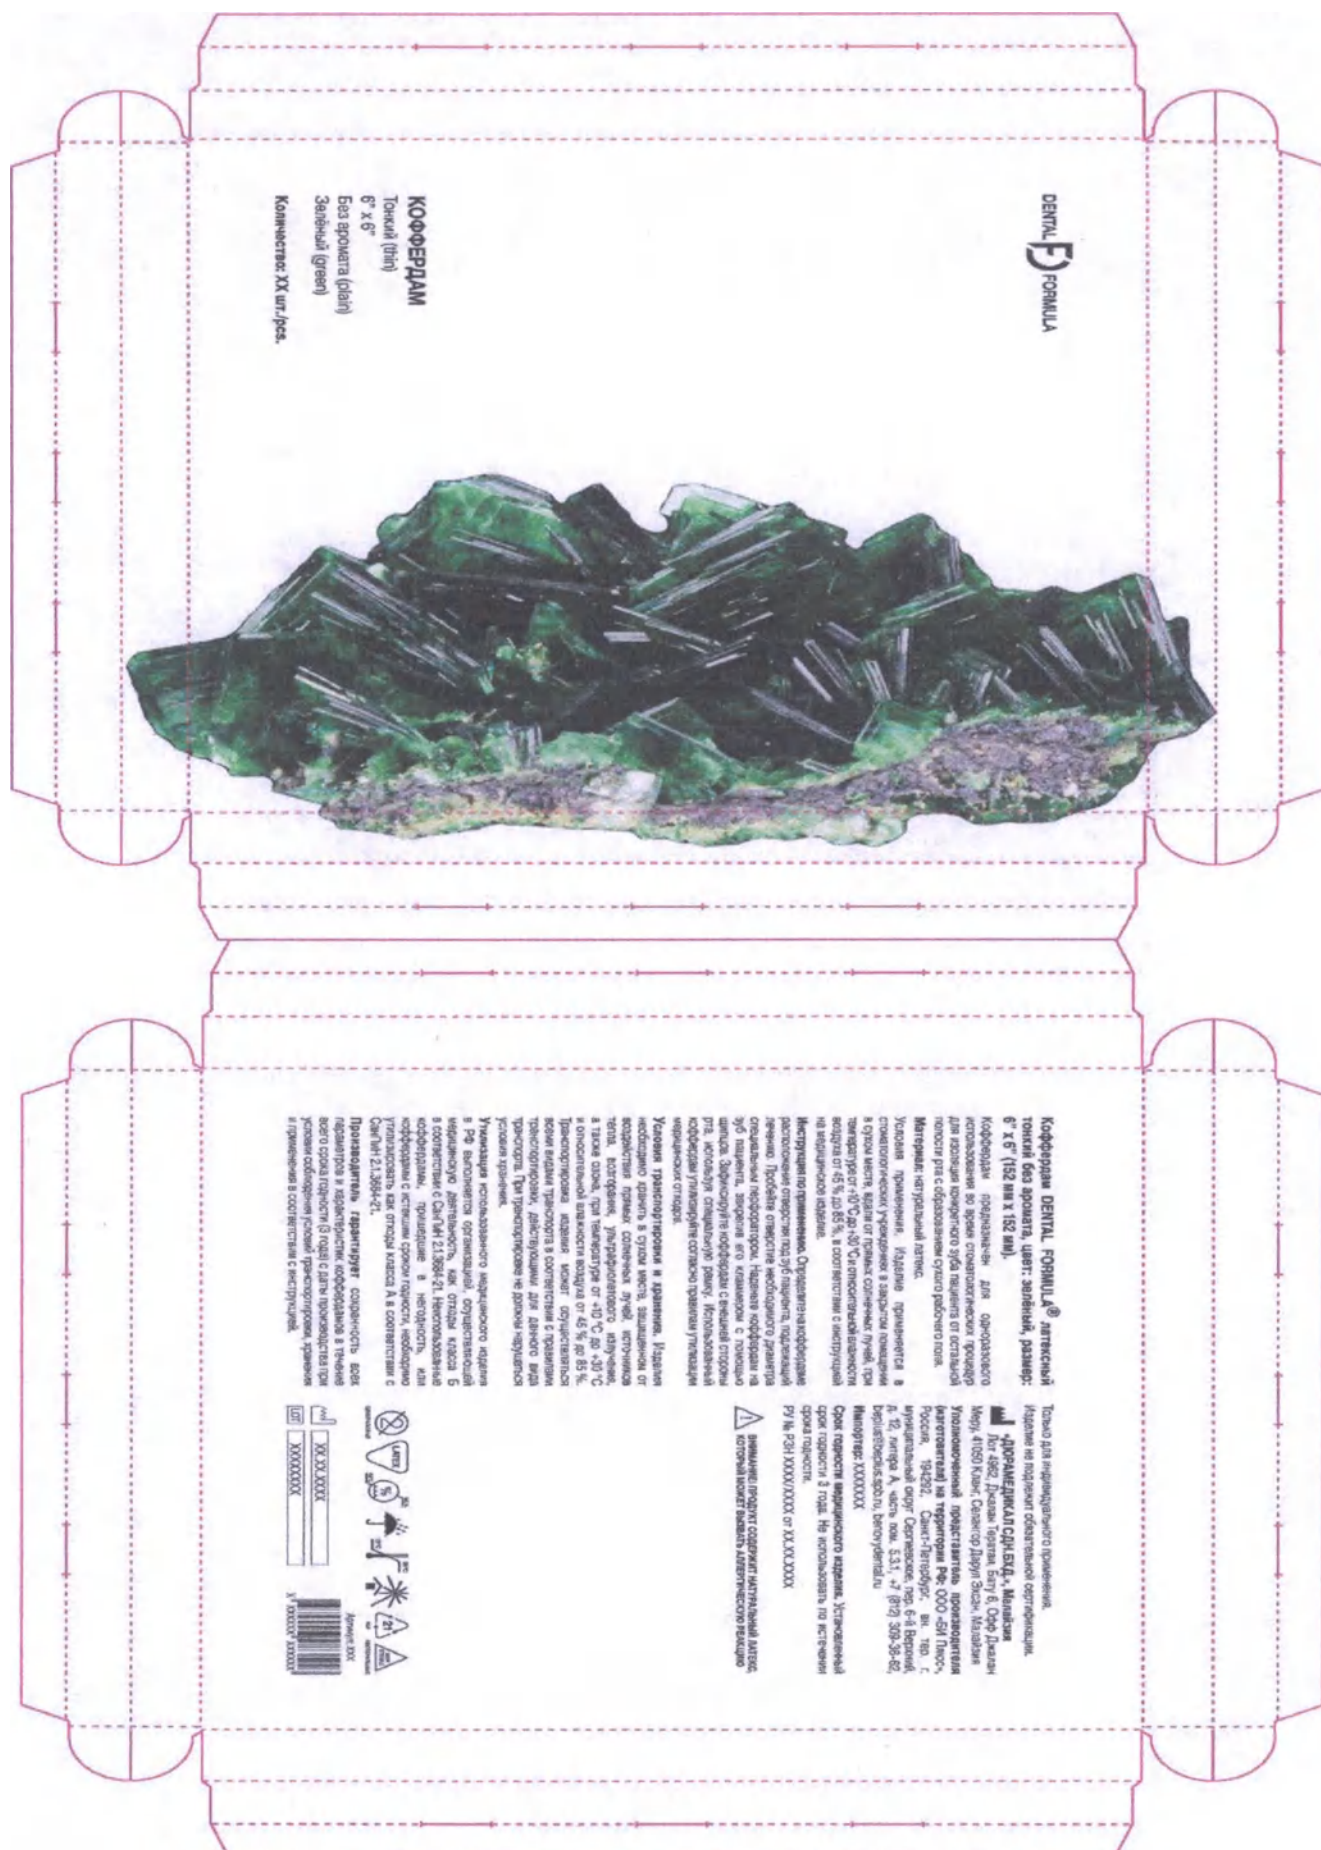

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: зелёный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovy dental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



XX.XX.XXXX




XXXXXXXXXX

Артикул: XXX



9) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: чёрный, размер: 6" x 6".

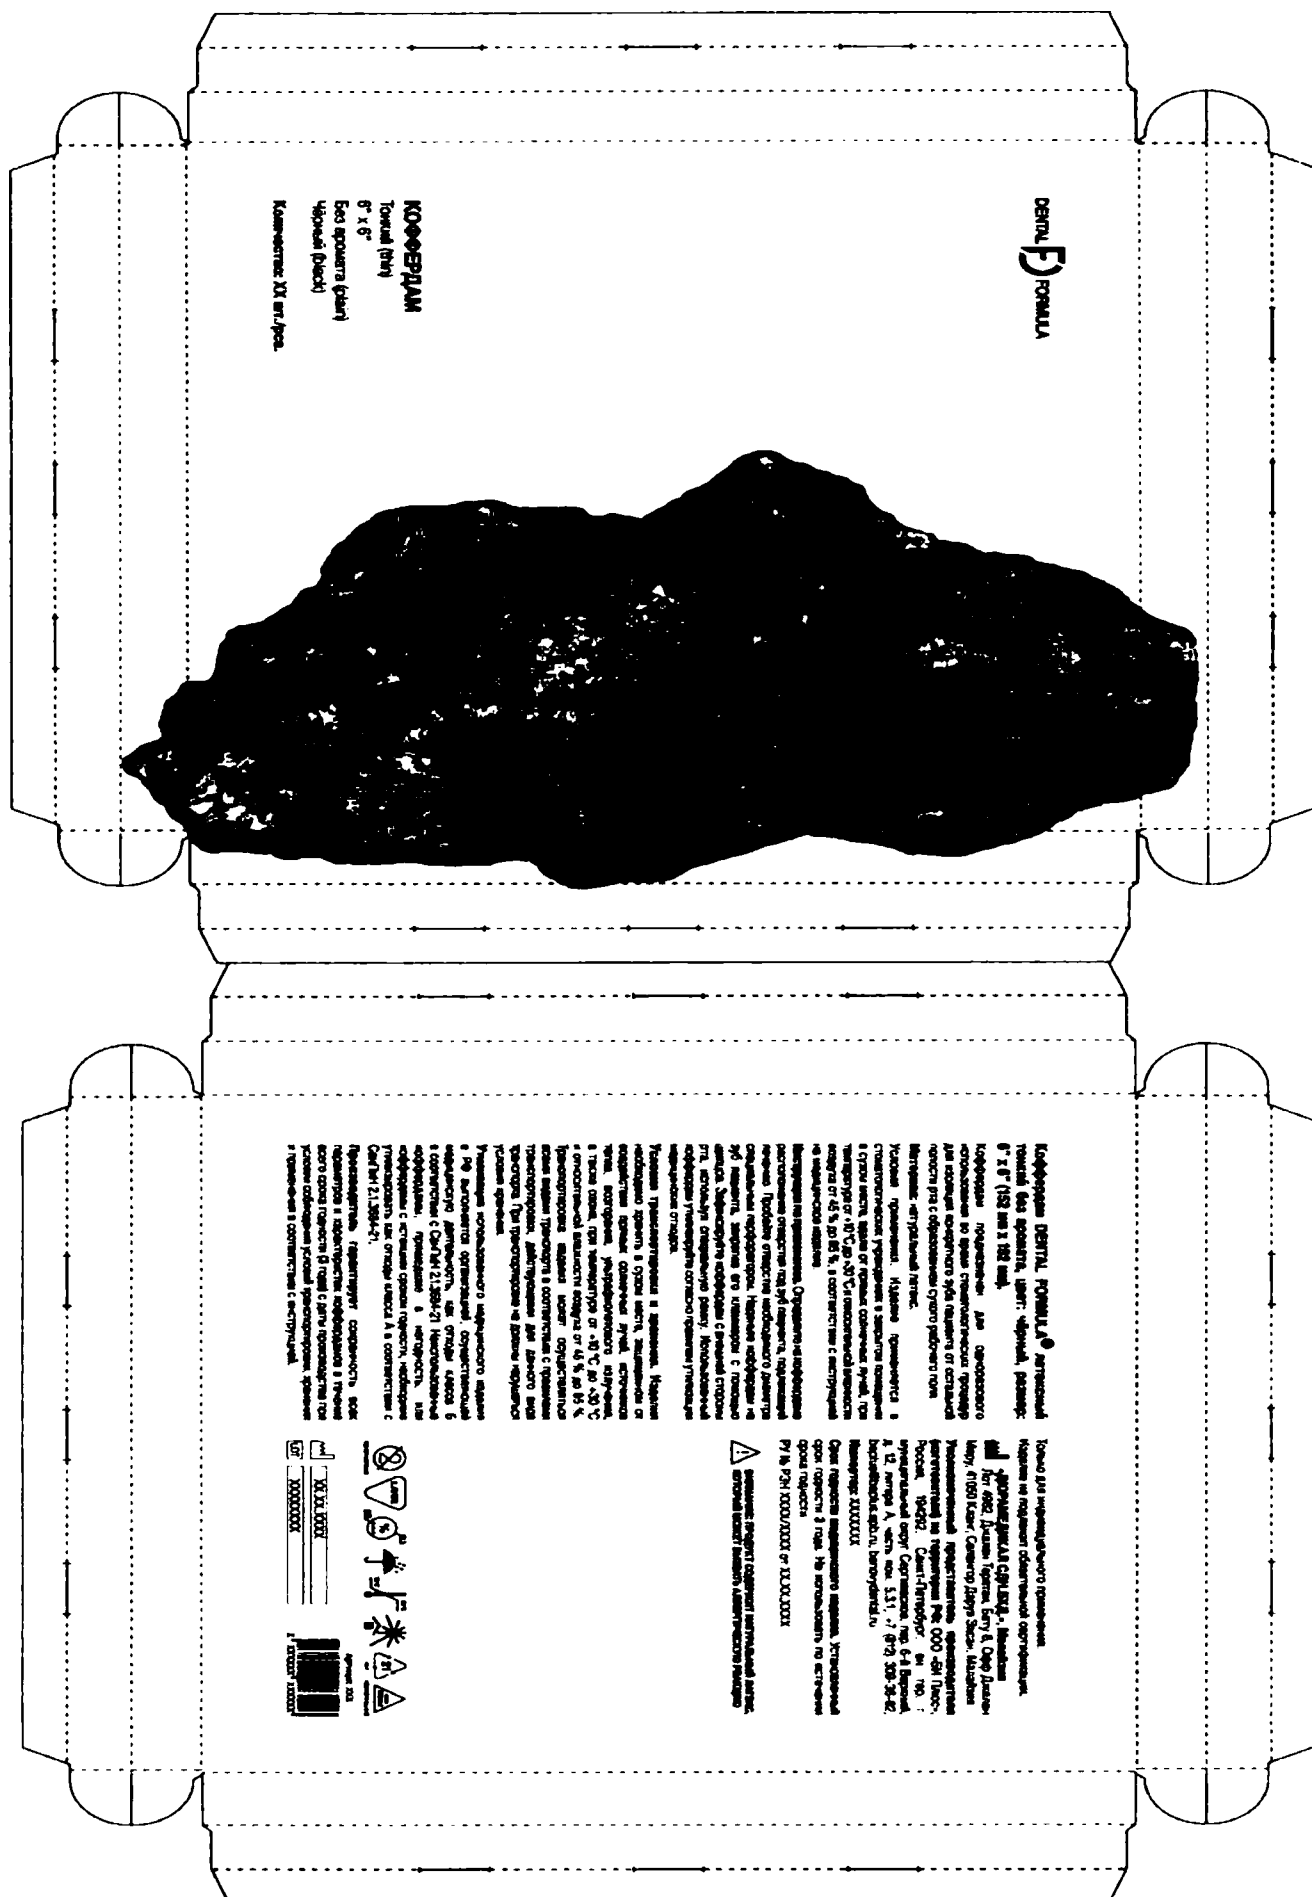

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: чёрный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.



РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный тонкий без аромата, цвет: розовый, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru


Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет:
голубой, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru


Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ

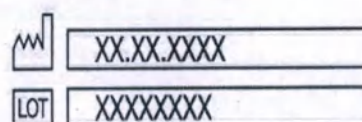

Артикул: XXX



12) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: синий, размер: 5" x 5".

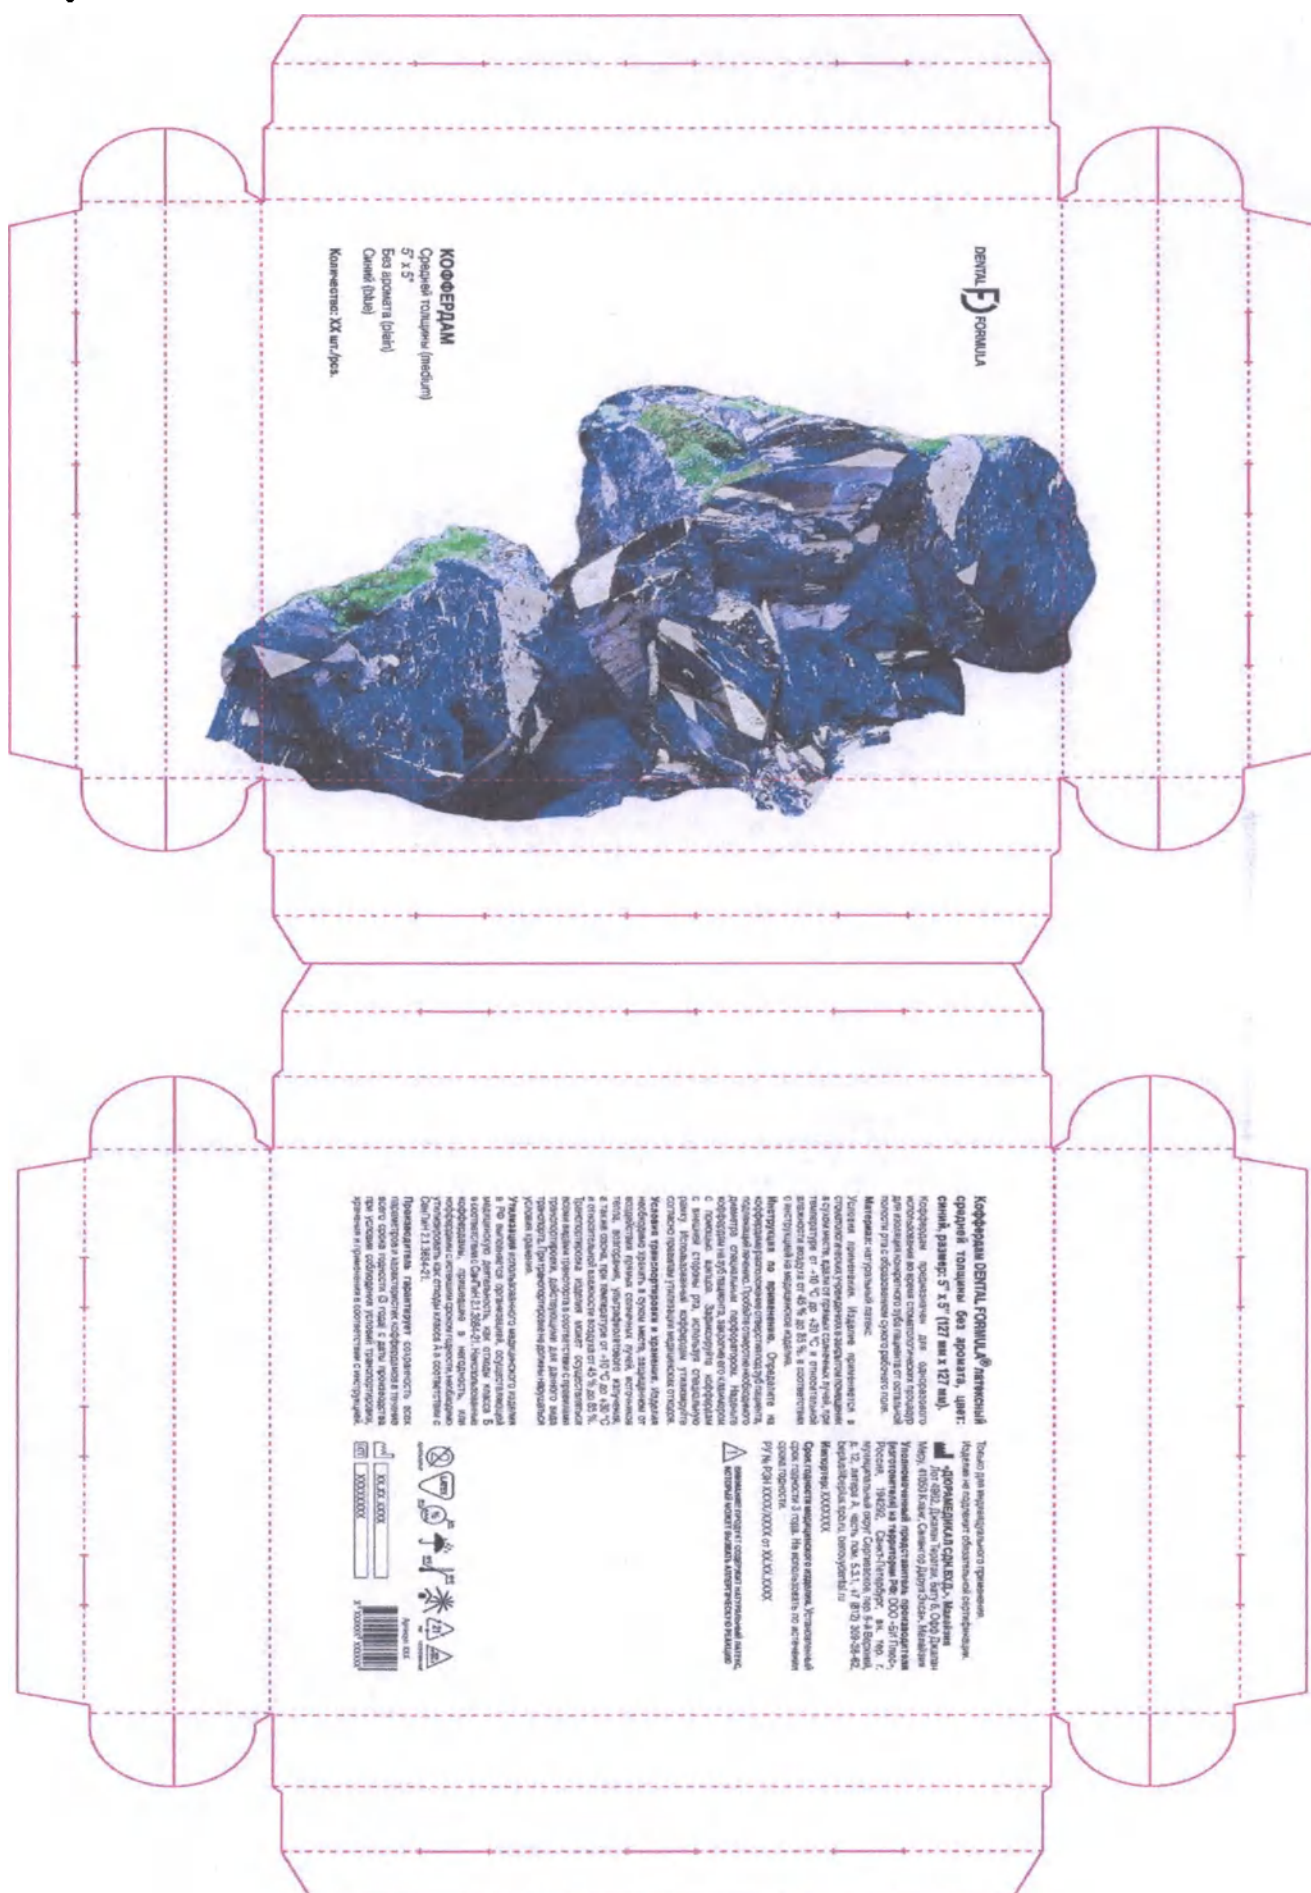

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет:
синий, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

**Уполномоченный представитель производителя
(изготовителя) на территории РФ:** ООО «БИ Плюс»,
Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний,
д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62,
beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный
срок годности 3 года. Не использовать по истечении
срока годности.



РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



**ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ**



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX



XX.XX.XXXX




XXXXXXXXXX



X XXXXXX XXXXXX

13) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: зелёный, размер: 5" x 5".

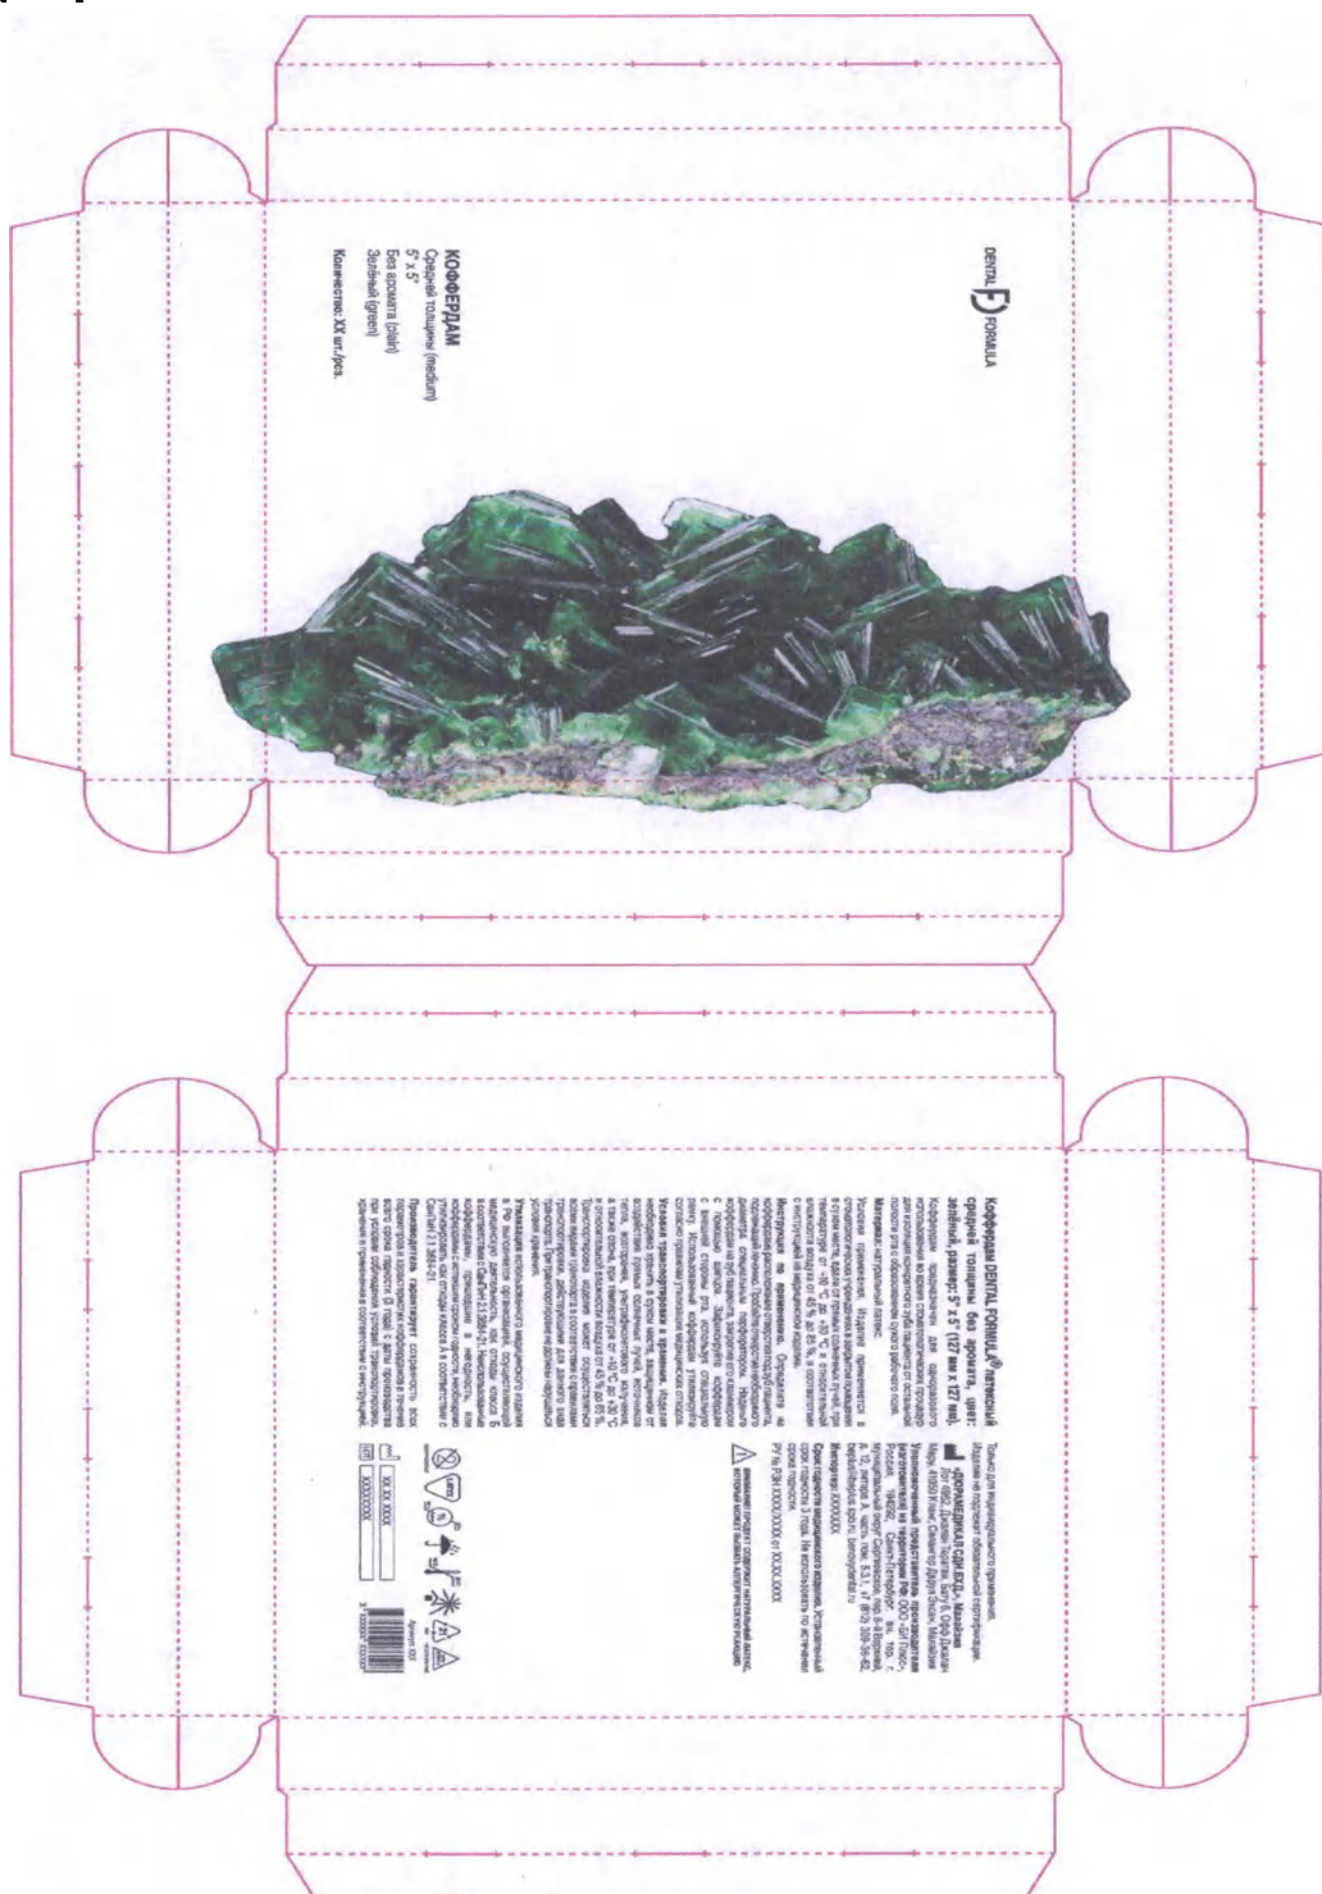

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет:
зелёный, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

**Уполномоченный представитель производителя
(изготовителя) на территории РФ:** ООО «БИ Плюс»,
Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний,
д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62,
beplus@beplus.spb.ru, benovydenal.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный
срок годности 3 года. Не использовать по истечении
срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



**ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ**



LOT

XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX

Артикул: XXX



X XXXXXX XXXXXX

КОСЕПАН
Original formula (medium)
5 x 5"
Без аромата (плът)
Универсал (белок)
Косеопан: 100 гр./пак.



Neofluon Dental Formula (Neofluon Dental, Inc., 10000 E. 15th Ave., Denver, CO 80231) is a new, water-soluble, nonfluorinated dental restorative material. It is a composite of a resin matrix and a filler. The resin matrix is a bisphenol A-based epoxy resin. The filler is a mixture of silica and glass particles. The material is available in a variety of shades to match natural teeth. It is indicated for use in the restoration of anterior and posterior teeth. The material is easy to mix and place, and it cures quickly. It has a high strength and is resistant to wear and tear. It is also resistant to staining and discoloration. The material is available in a variety of shades to match natural teeth. It is indicated for use in the restoration of anterior and posterior teeth. The material is easy to mix and place, and it cures quickly. It has a high strength and is resistant to wear and tear. It is also resistant to staining and discoloration.

1. **GENERAL INFORMATION** Name of the company: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 2. **CONTACT INFORMATION** Name of the contact person: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 3. **ADDRESS** Street: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** City: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 4. **TELEPHONE** Telephone: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 5. **E-MAIL** E-mail: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 6. **WEBSITE** Website: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 7. **PRODUCTS** Name of the product: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 8. **DESCRIPTION** Description of the product: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 9. **PRICE** Price: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 10. **TERMS** Terms: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 11. **NOTES** Notes: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 12. **SIGNATURE** Signature: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 13. **DATE** Date: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 14. **REMARKS** Remarks: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 15. **REFERENCE** Reference: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 16. **STATUS** Status: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 17. **COMMENTS** Comments: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 18. **INTERNAL USE** Internal use: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 19. **EXTERNAL USE** External use: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 20. **OTHER** Other: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

















**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет:
чёрный, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



XX.XX.XXXX




XXXXXXXX

Артикул: XXX



15) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: розовый, размер: 5" x 5".

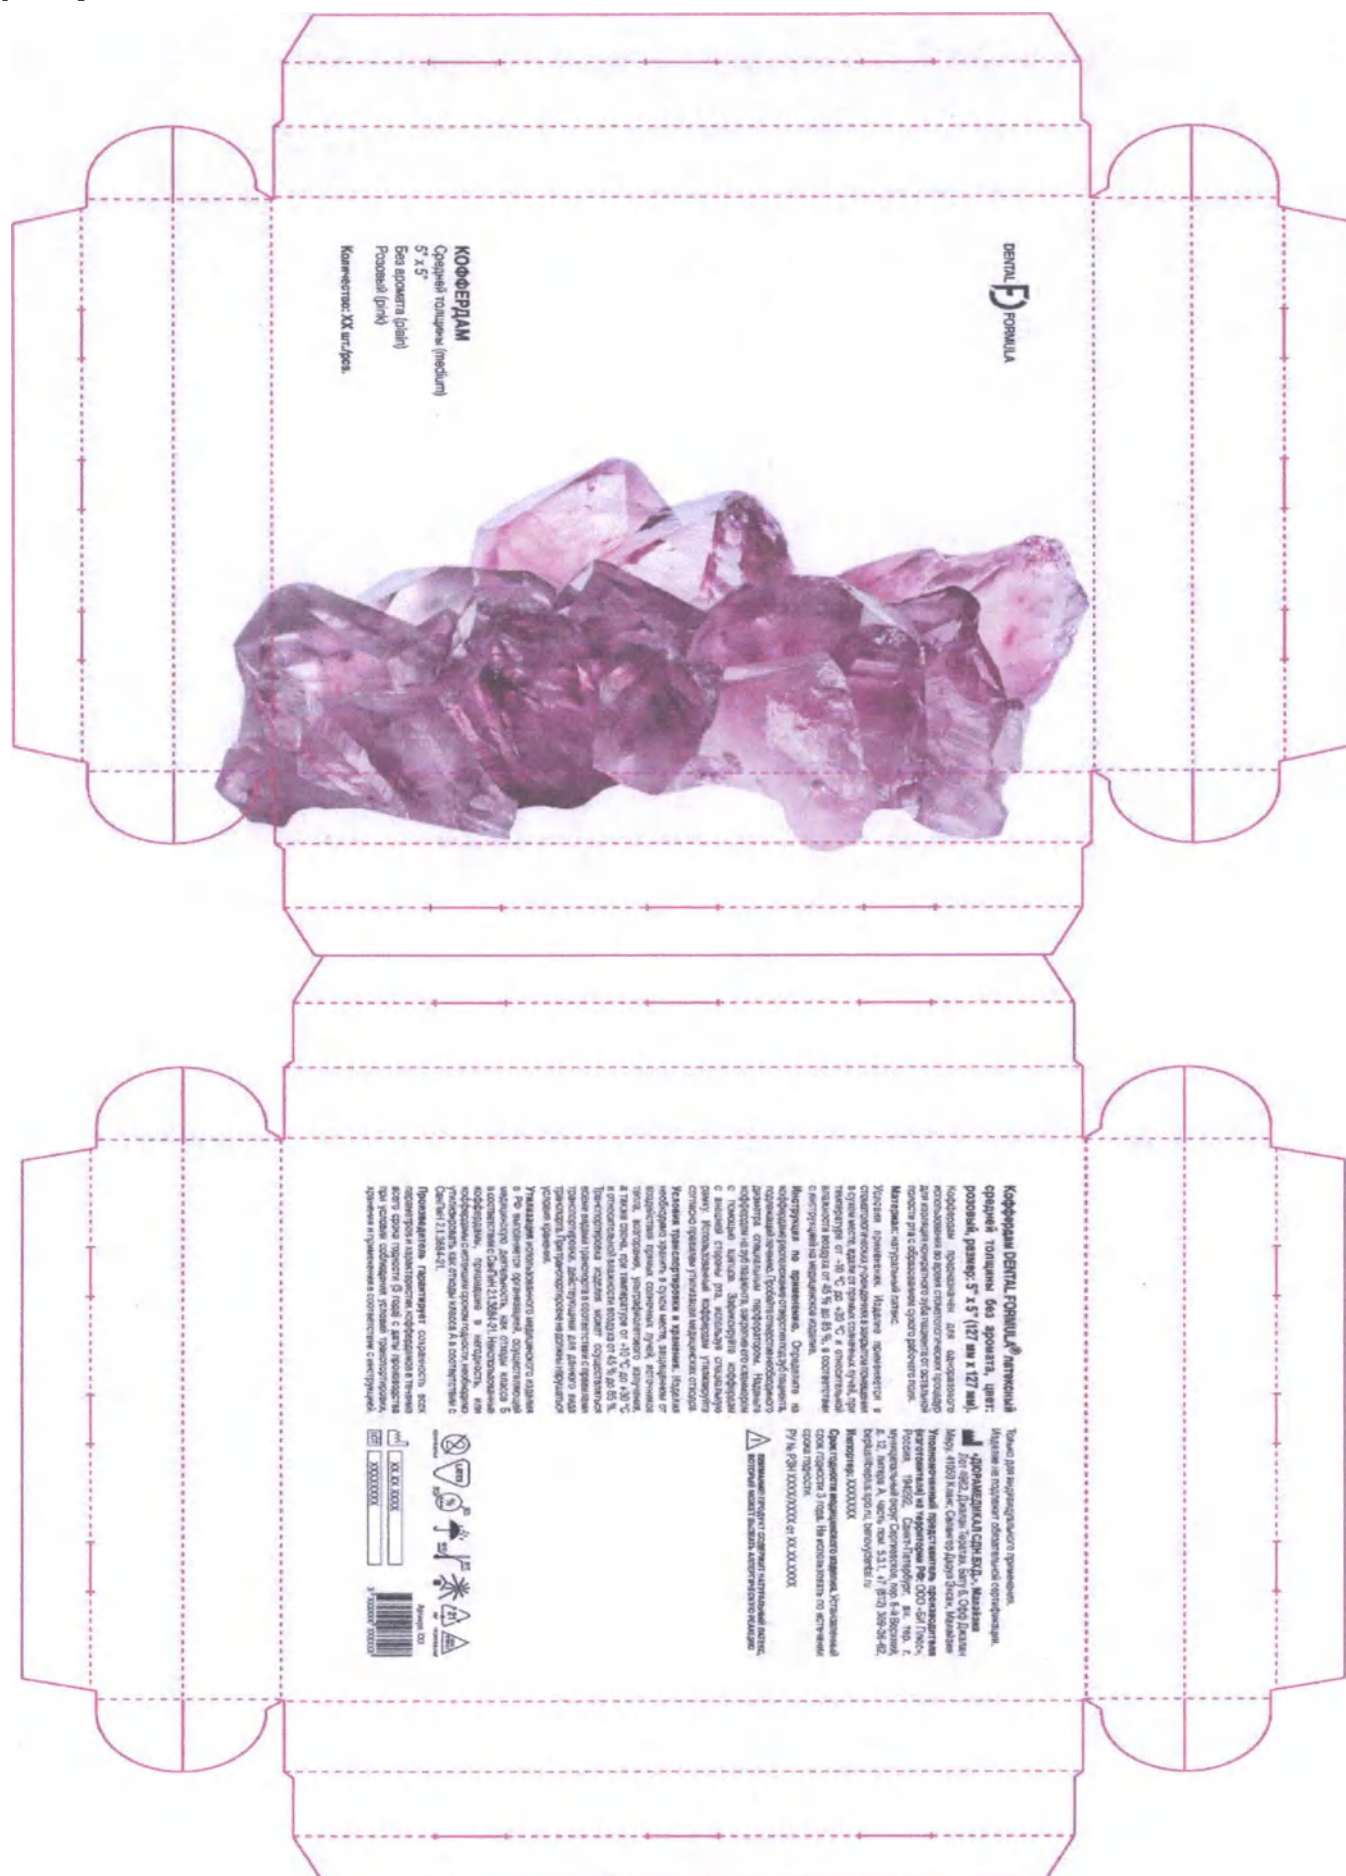

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет:
розовый, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.



РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX



XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX





Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет: голубой,
размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXXXX

Артикул: XXX



17) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: синий, размер: 6" x 6".



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: синий, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

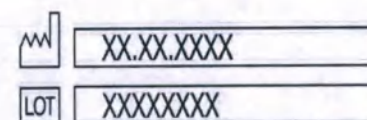

18) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: зелёный, размер: 6" x 6".



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: зелёный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для однократного использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovy dental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



19) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: чёрный, размер: 6" x 6".



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
средней толщины без аромата, цвет: чёрный,
размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя
(изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс»,
Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний,
д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62,
beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный
срок годности 3 года. Не использовать по истечении
срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



XX.XX.XXXX


LOT

XXXXXXXXXX

Артикул: XXX



20) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: розовый, размер: 6" x 6".

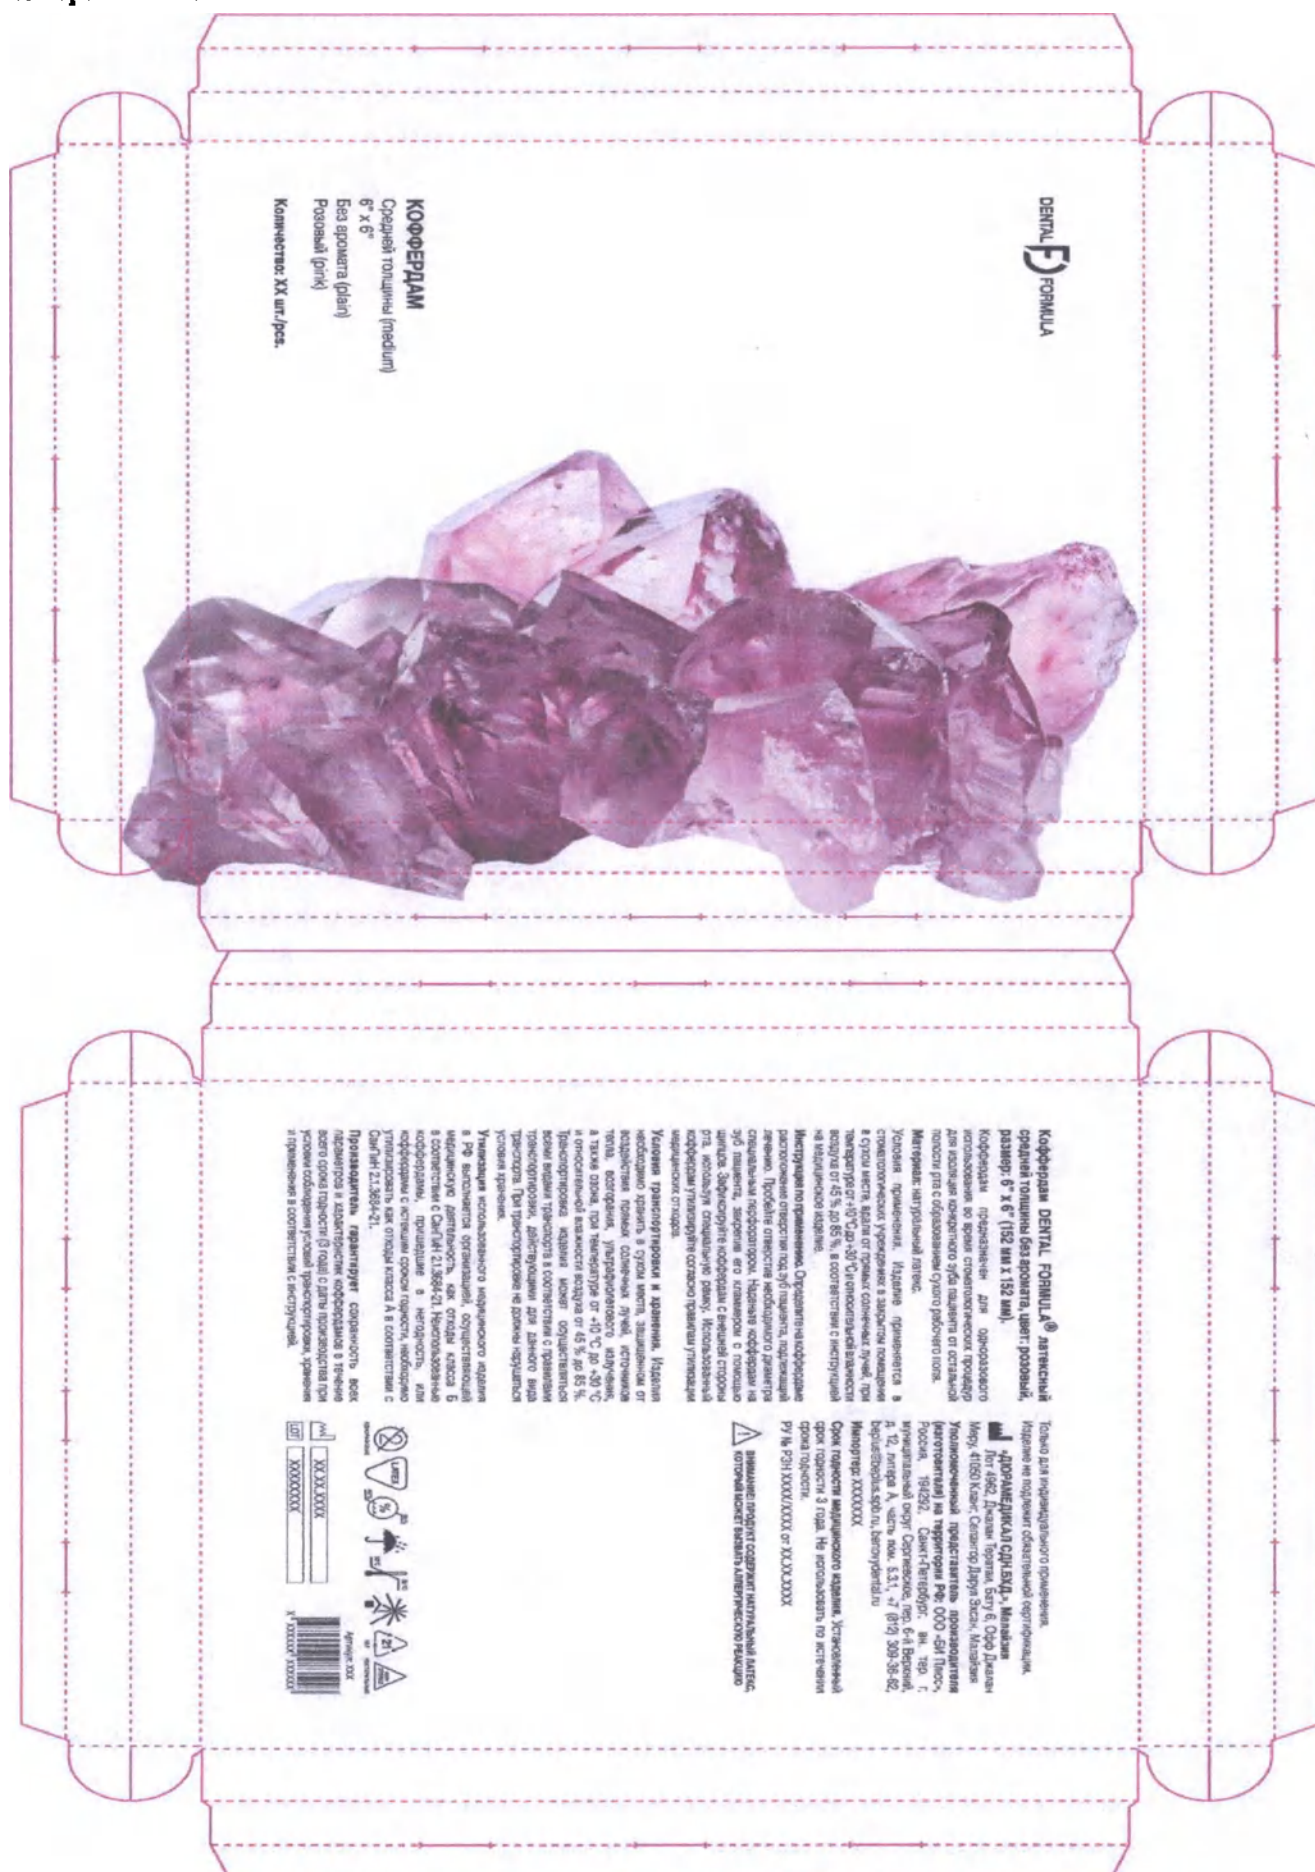

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный средней толщины без аромата, цвет: розовый, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ

Артикул: XXX



XX.XX.XXXX


LOT

XXXXXXXXXX



X XXXXXX XXXXXX

21) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: голубой, размер: 5" x 5".

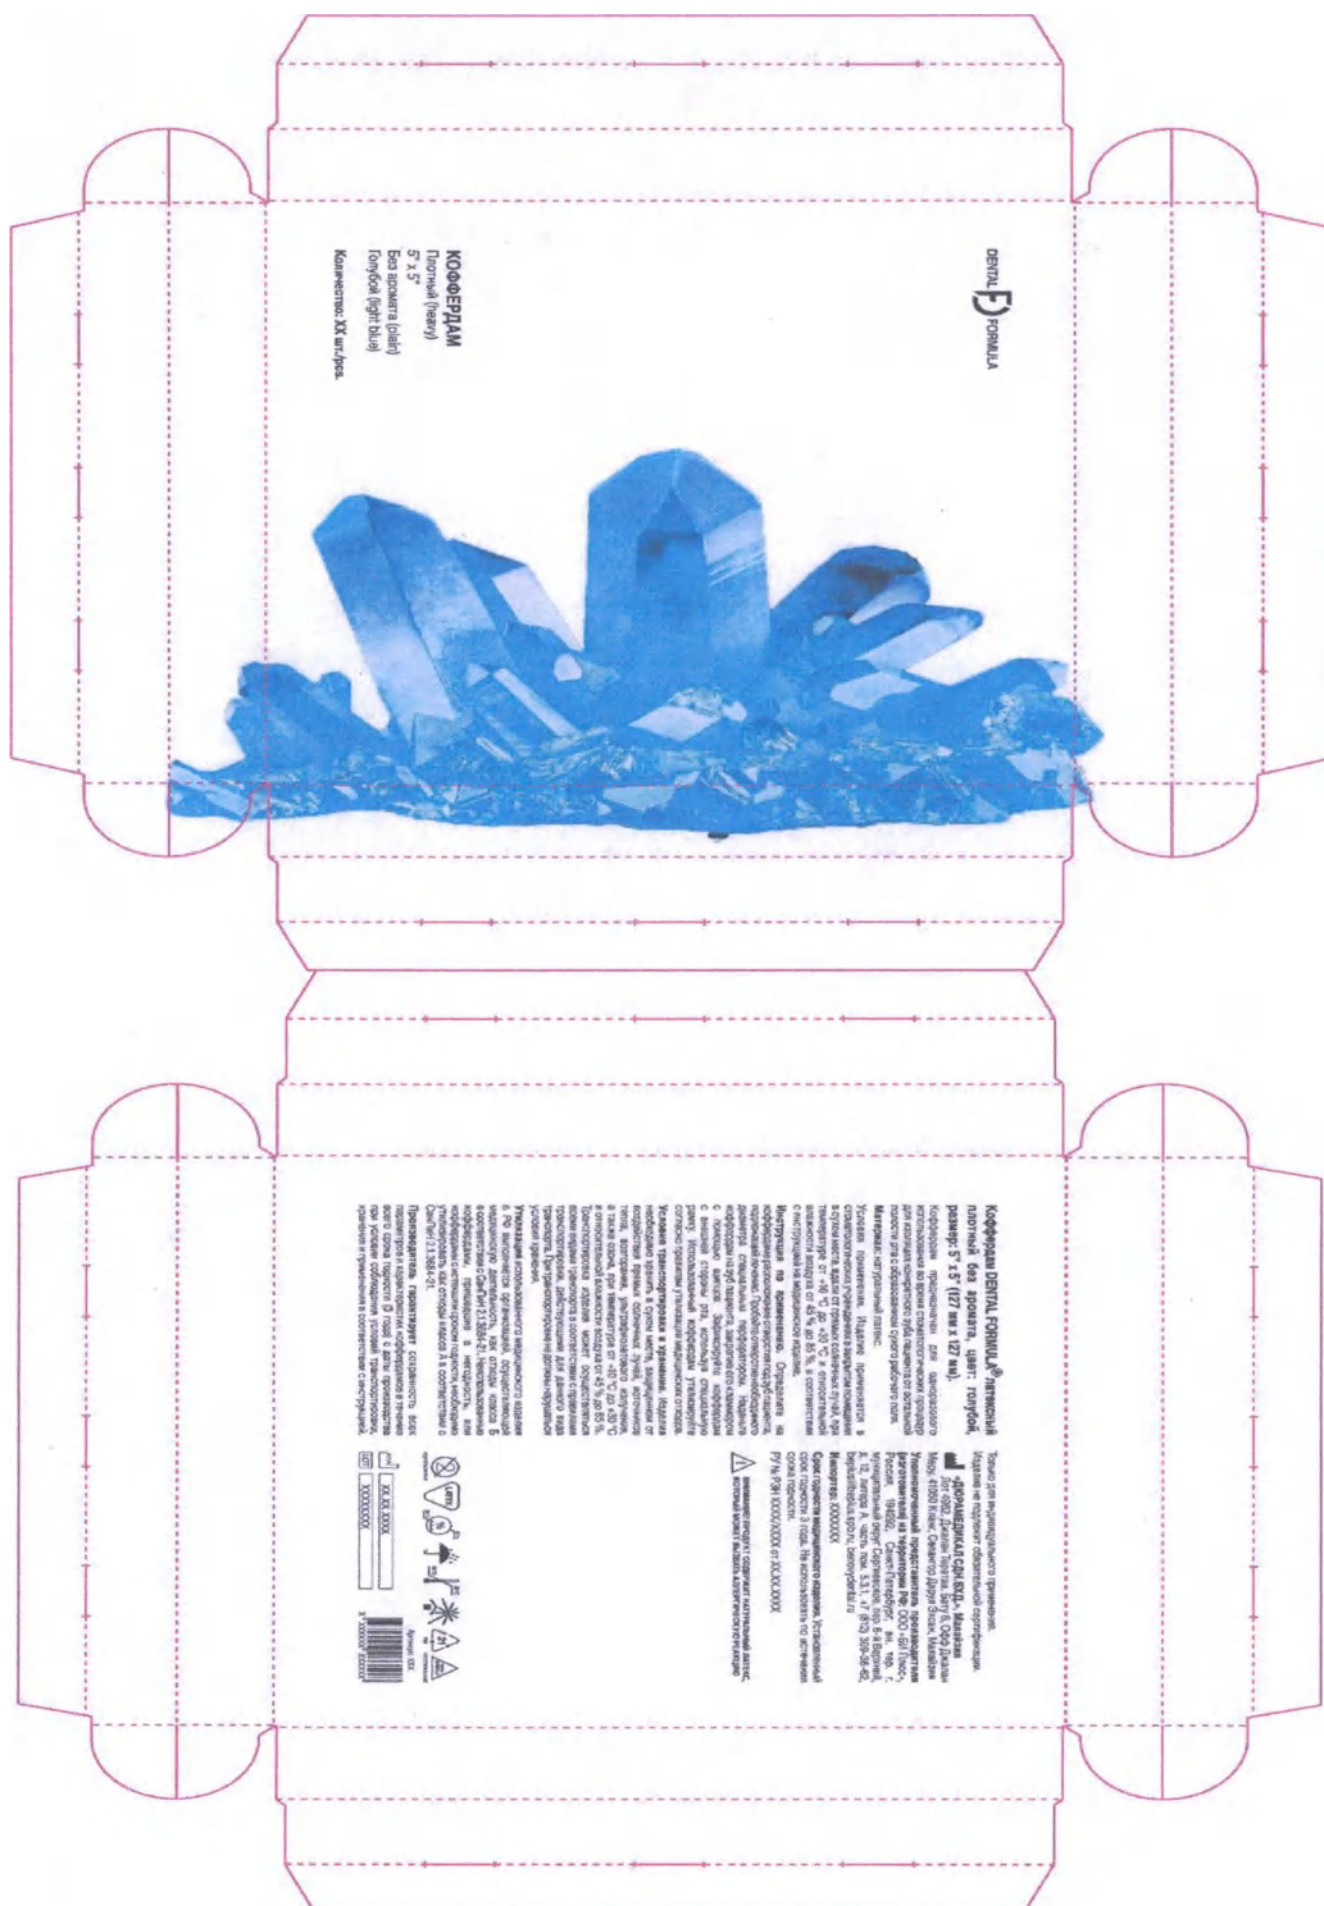

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
плотный без аромата, цвет: голубой,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

**Уполномоченный представитель производителя
(изготовителя) на территории РФ:** ООО «БИ Плюс»,
Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний,
д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62,
beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортёр: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный
срок годности 3 года. Не использовать по истечении
срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



**ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ**



XX.XX.XXXX




XXXXXXXXXX

Артикул: XXX



X XXXXXX XXXXXX

22) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: синий, размер: 5" x 5".

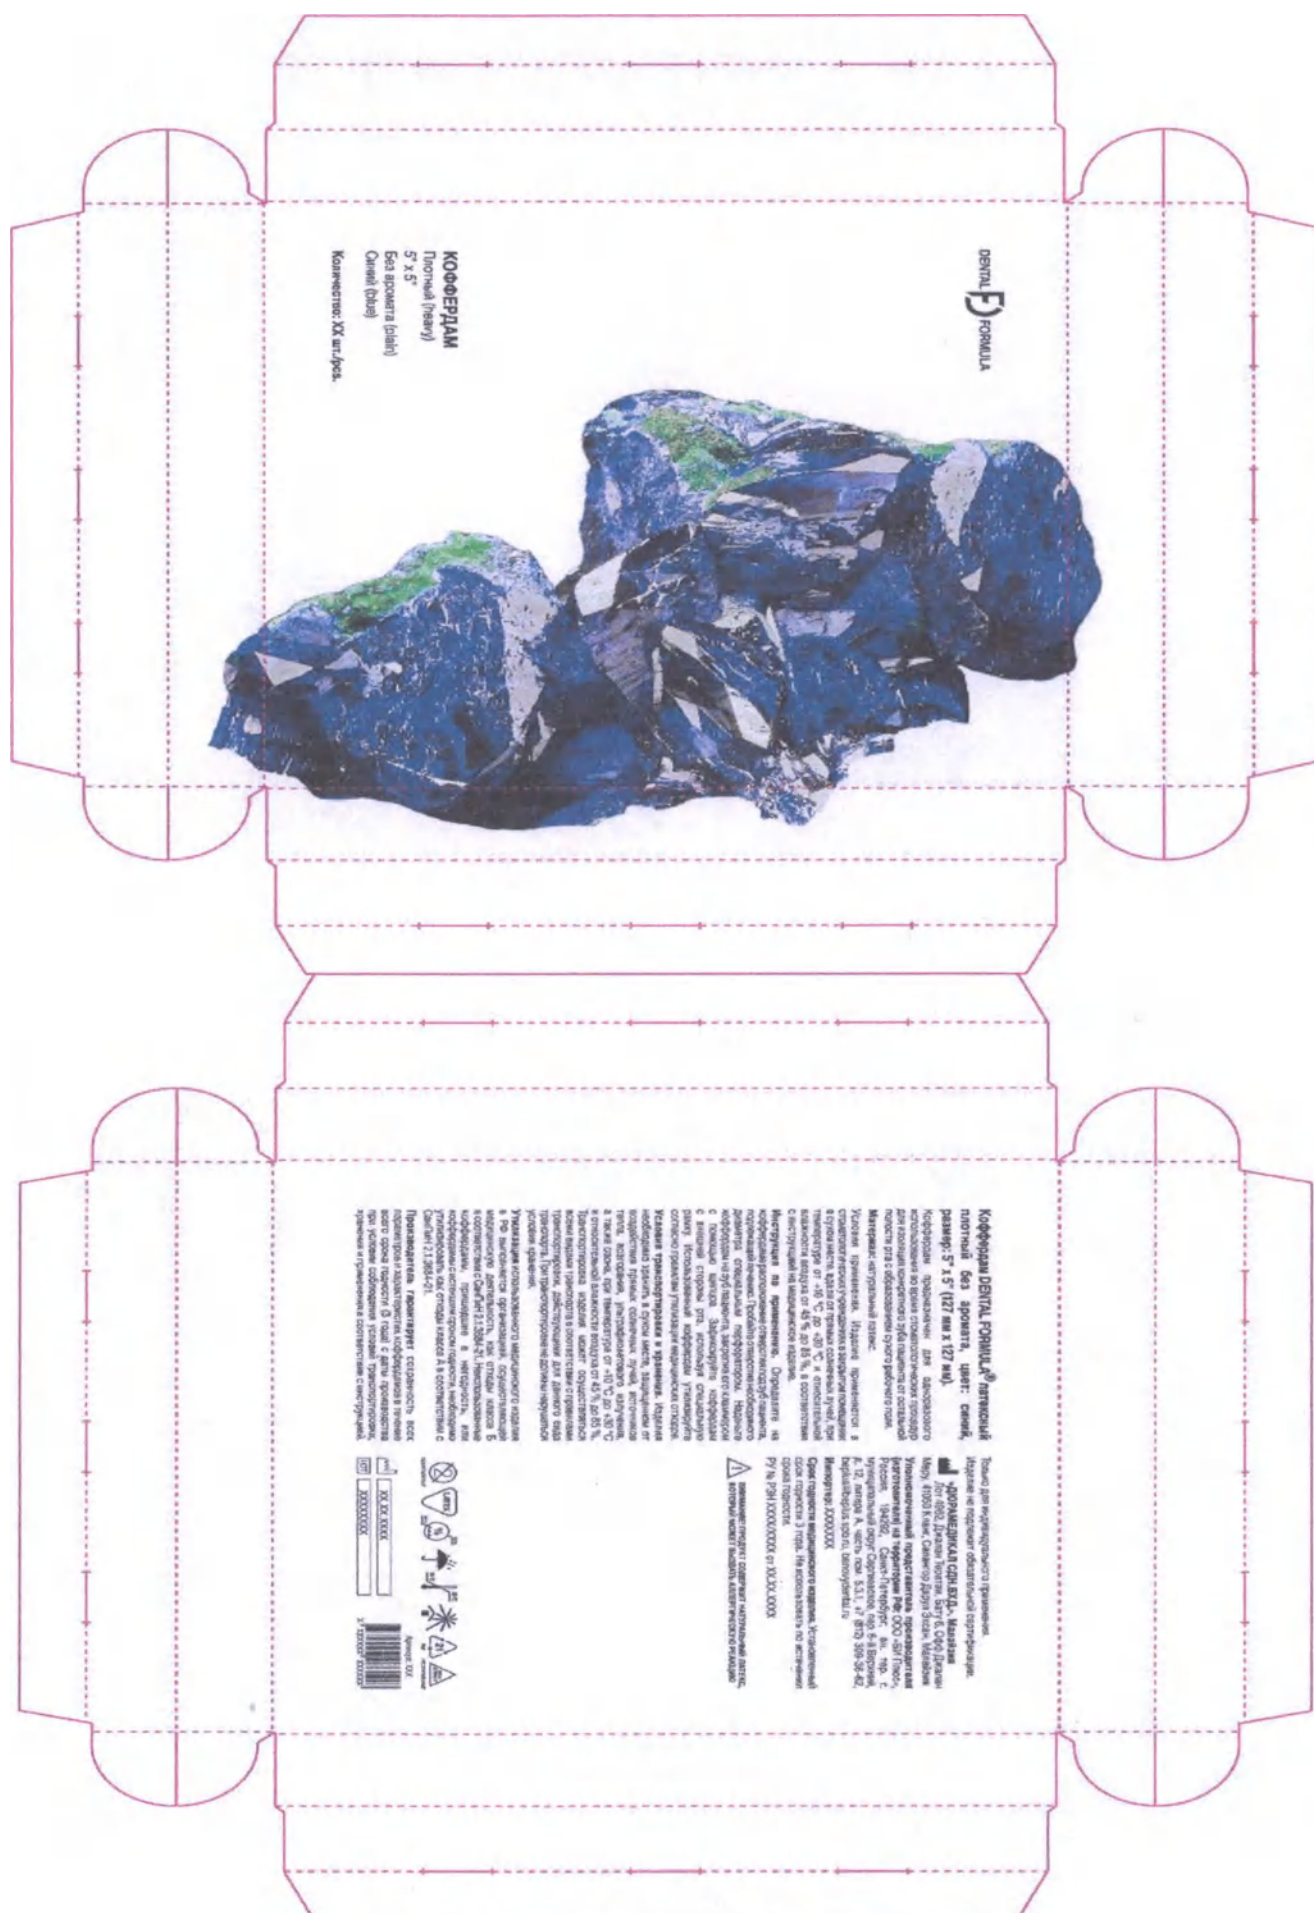

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: синий, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru


Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.




РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX




XX.XX.XXXX
XXXXXXX



X XXXXX XXXXX

23) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: зелёный, размер: 5" x 5".

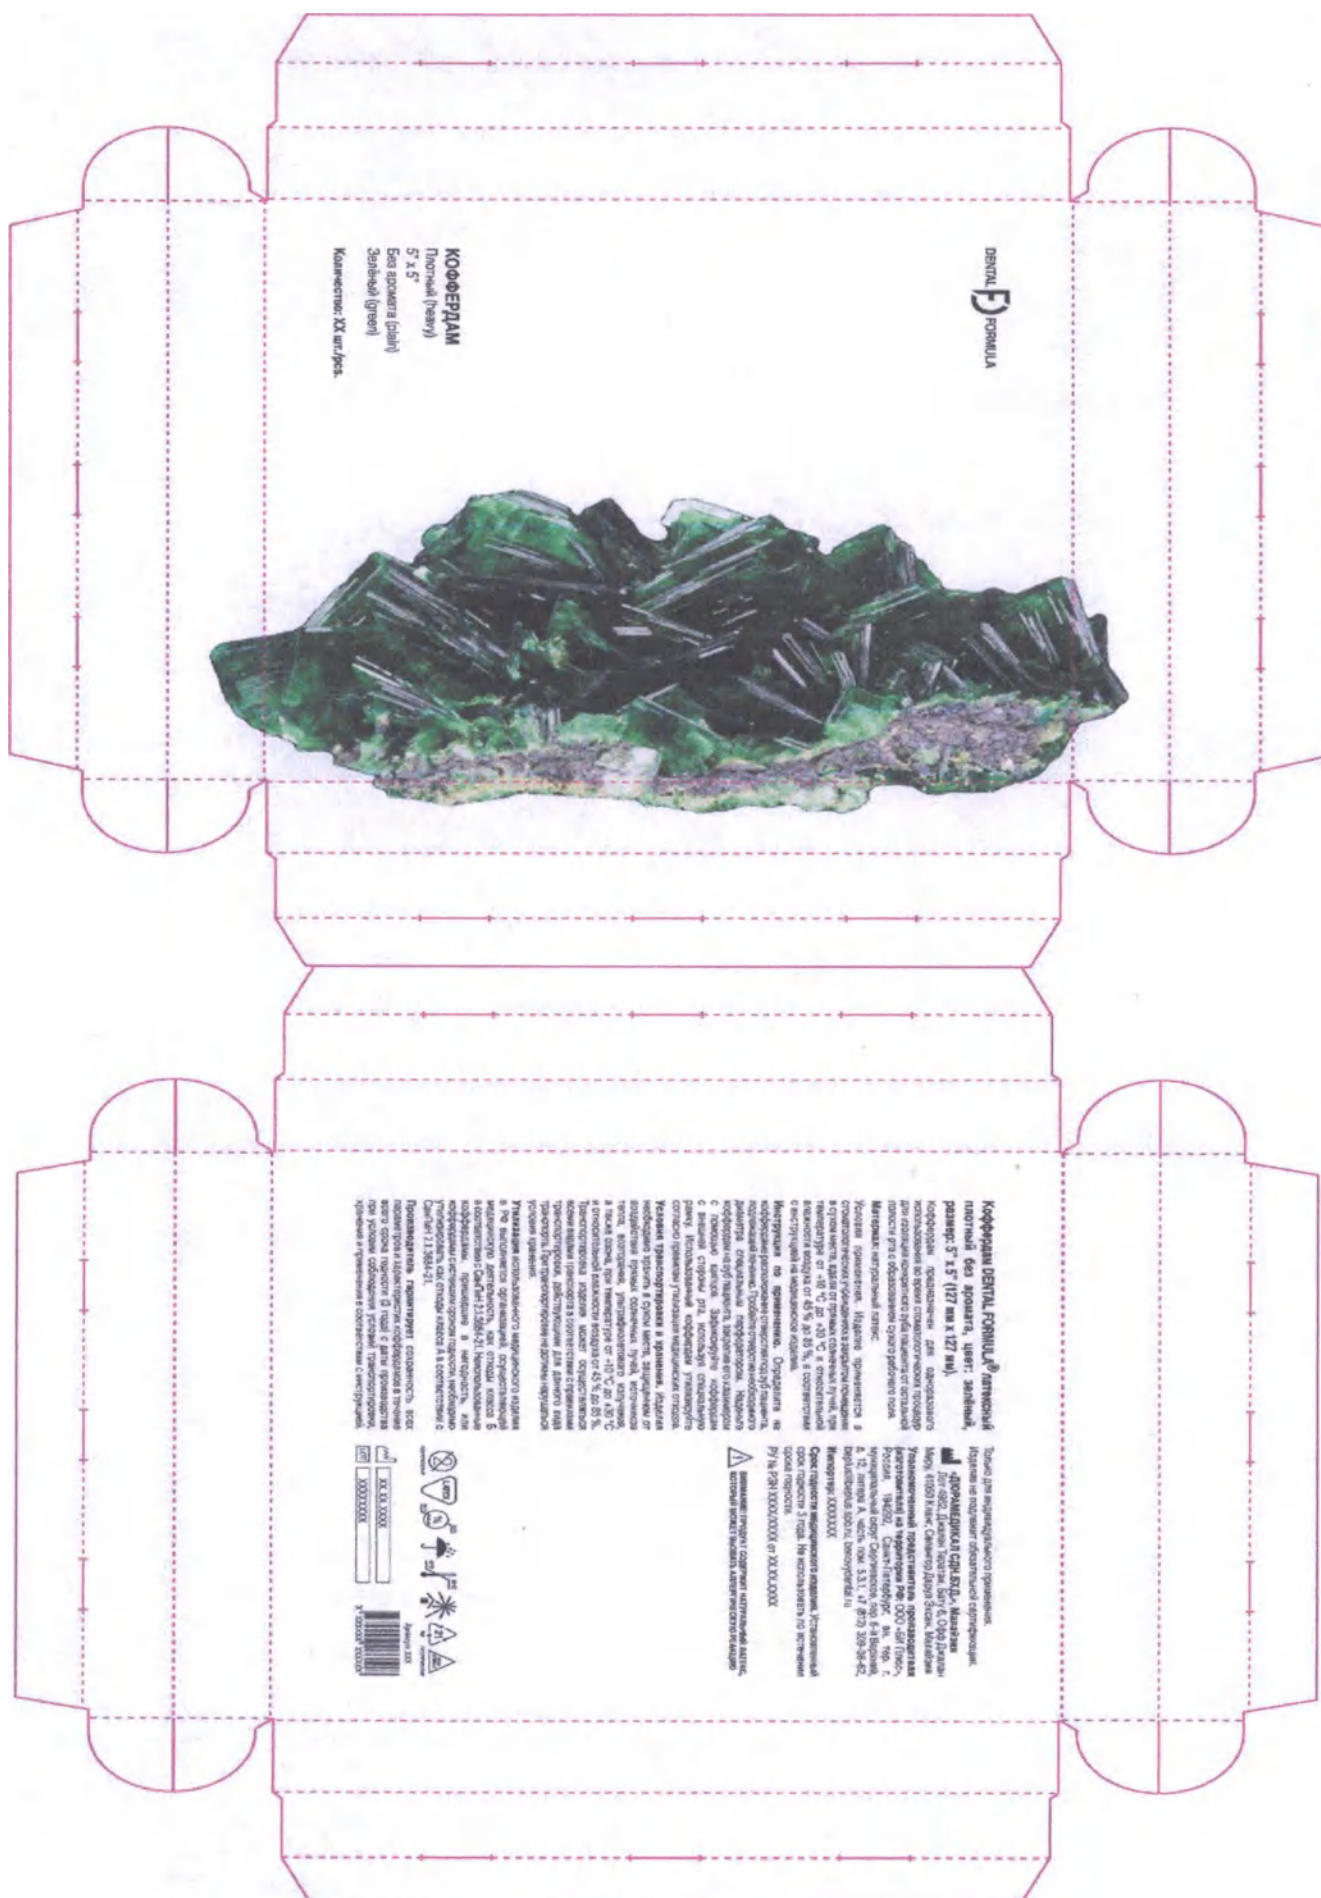

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
плотный без аромата, цвет: зелёный,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляция конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovy dental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



24) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: чёрный, размер: 5" x 5".

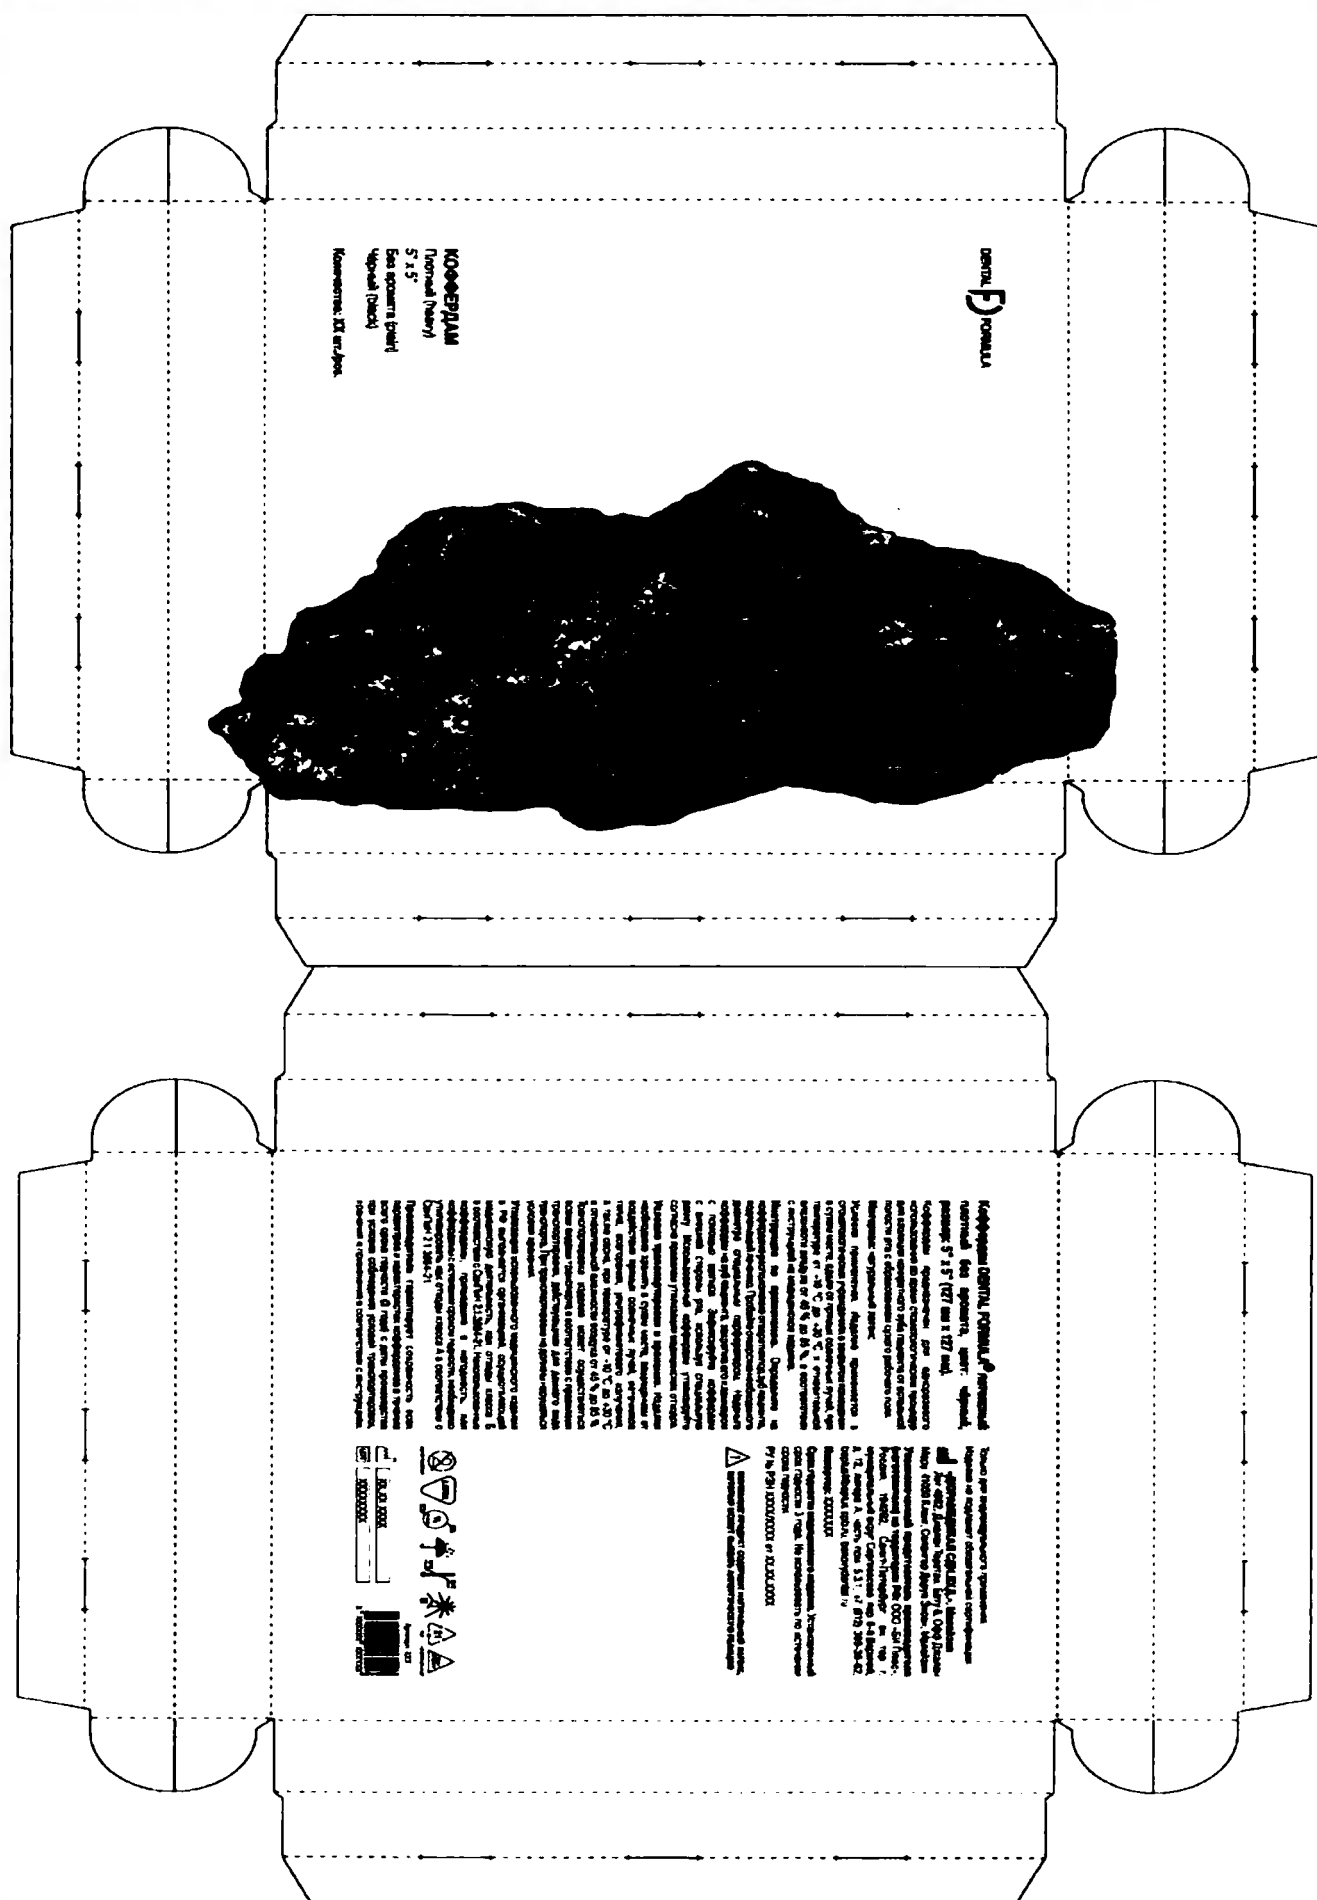

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: чёрный, размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



LOT


XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX



X XXXXXX XXXXXX

25) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: розовый, размер: 5" x 5".

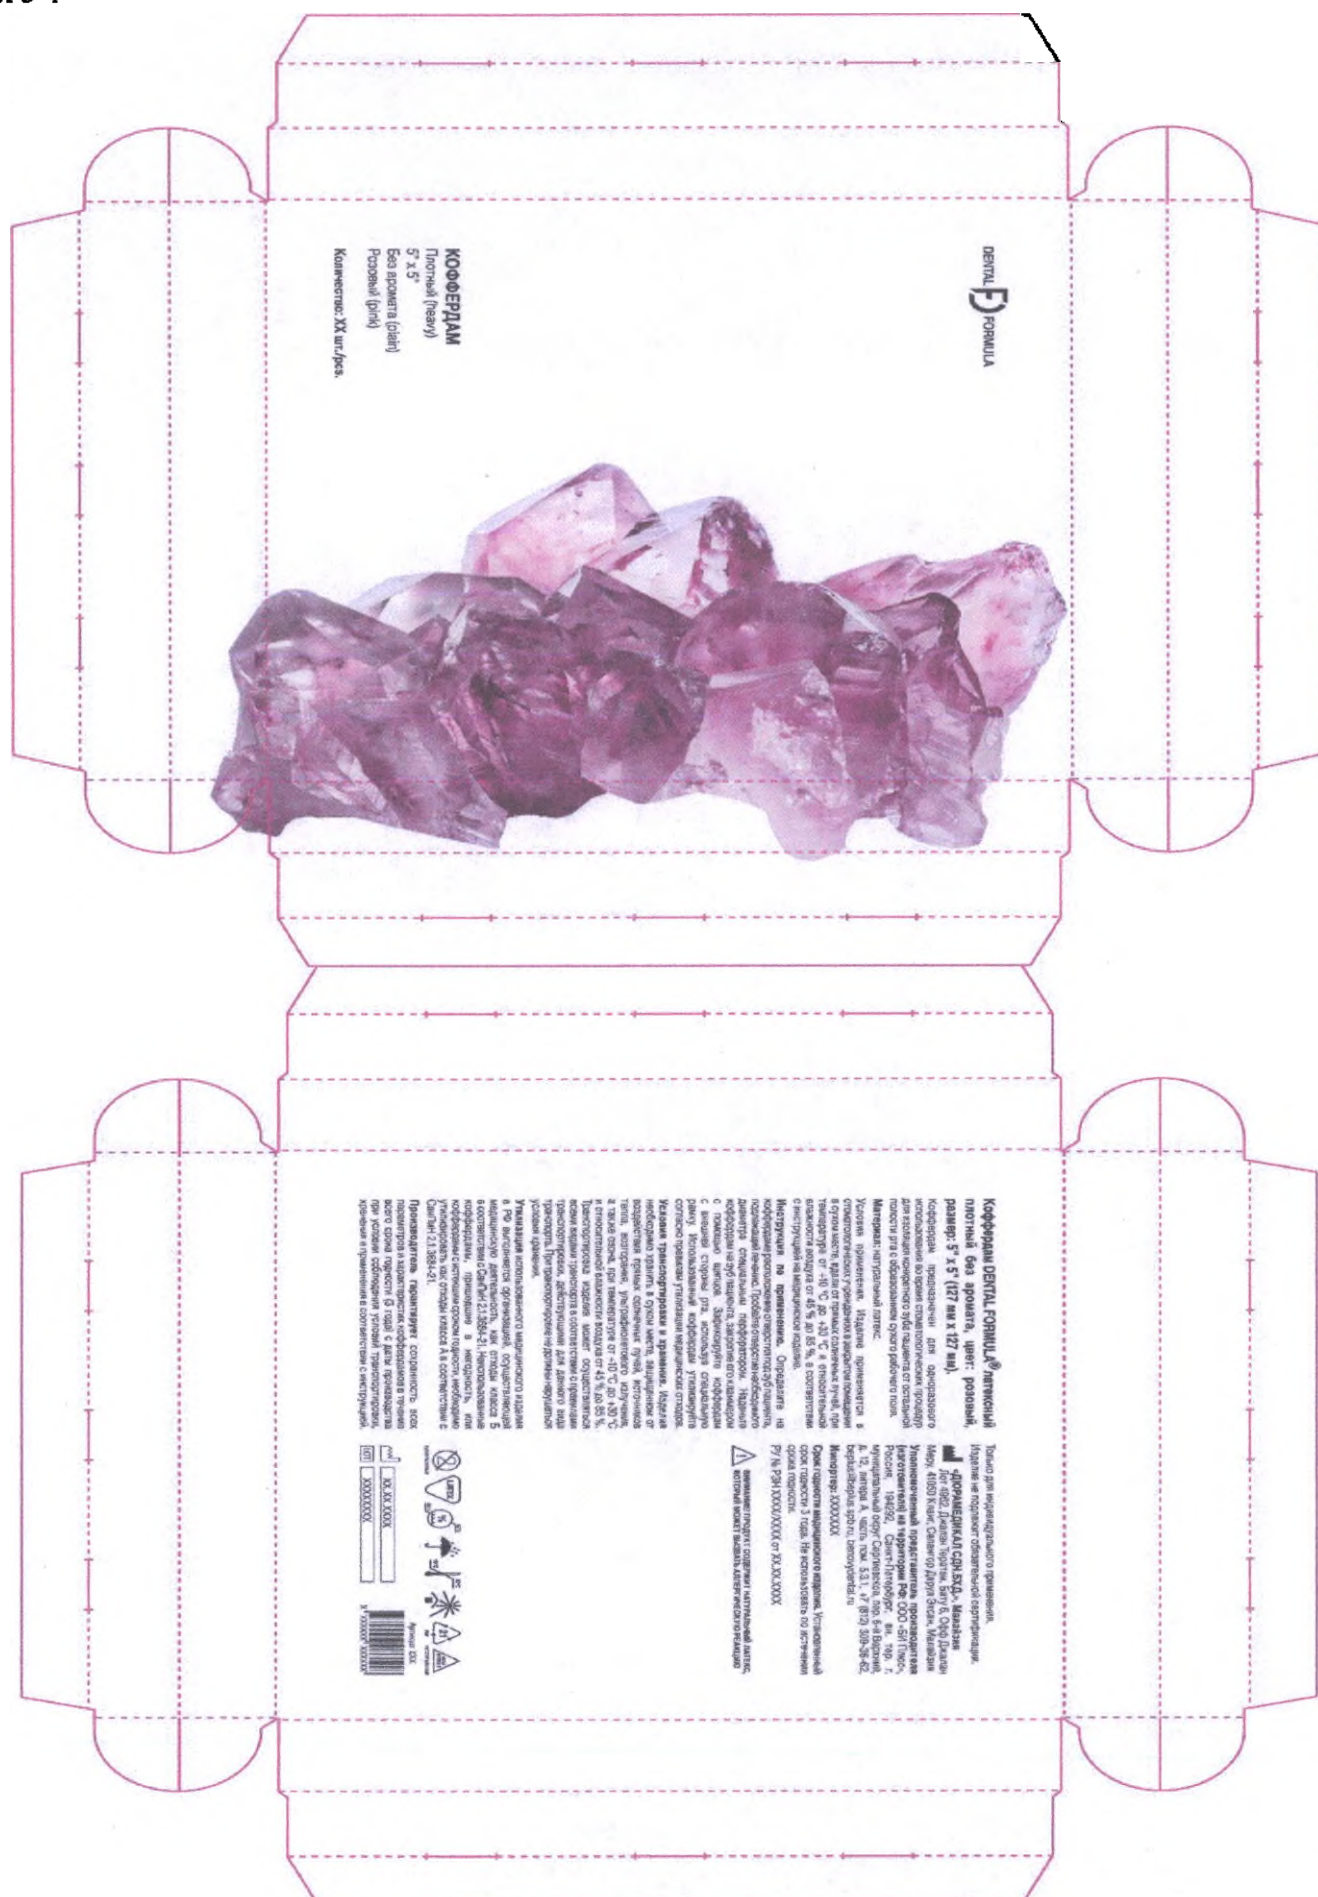

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
плотный без аромата, цвет: розовый,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный с ароматом мяты, цвет: голубой, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

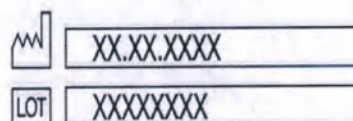

27) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный без аромата, цвет: синий, размер: 6" x 6".

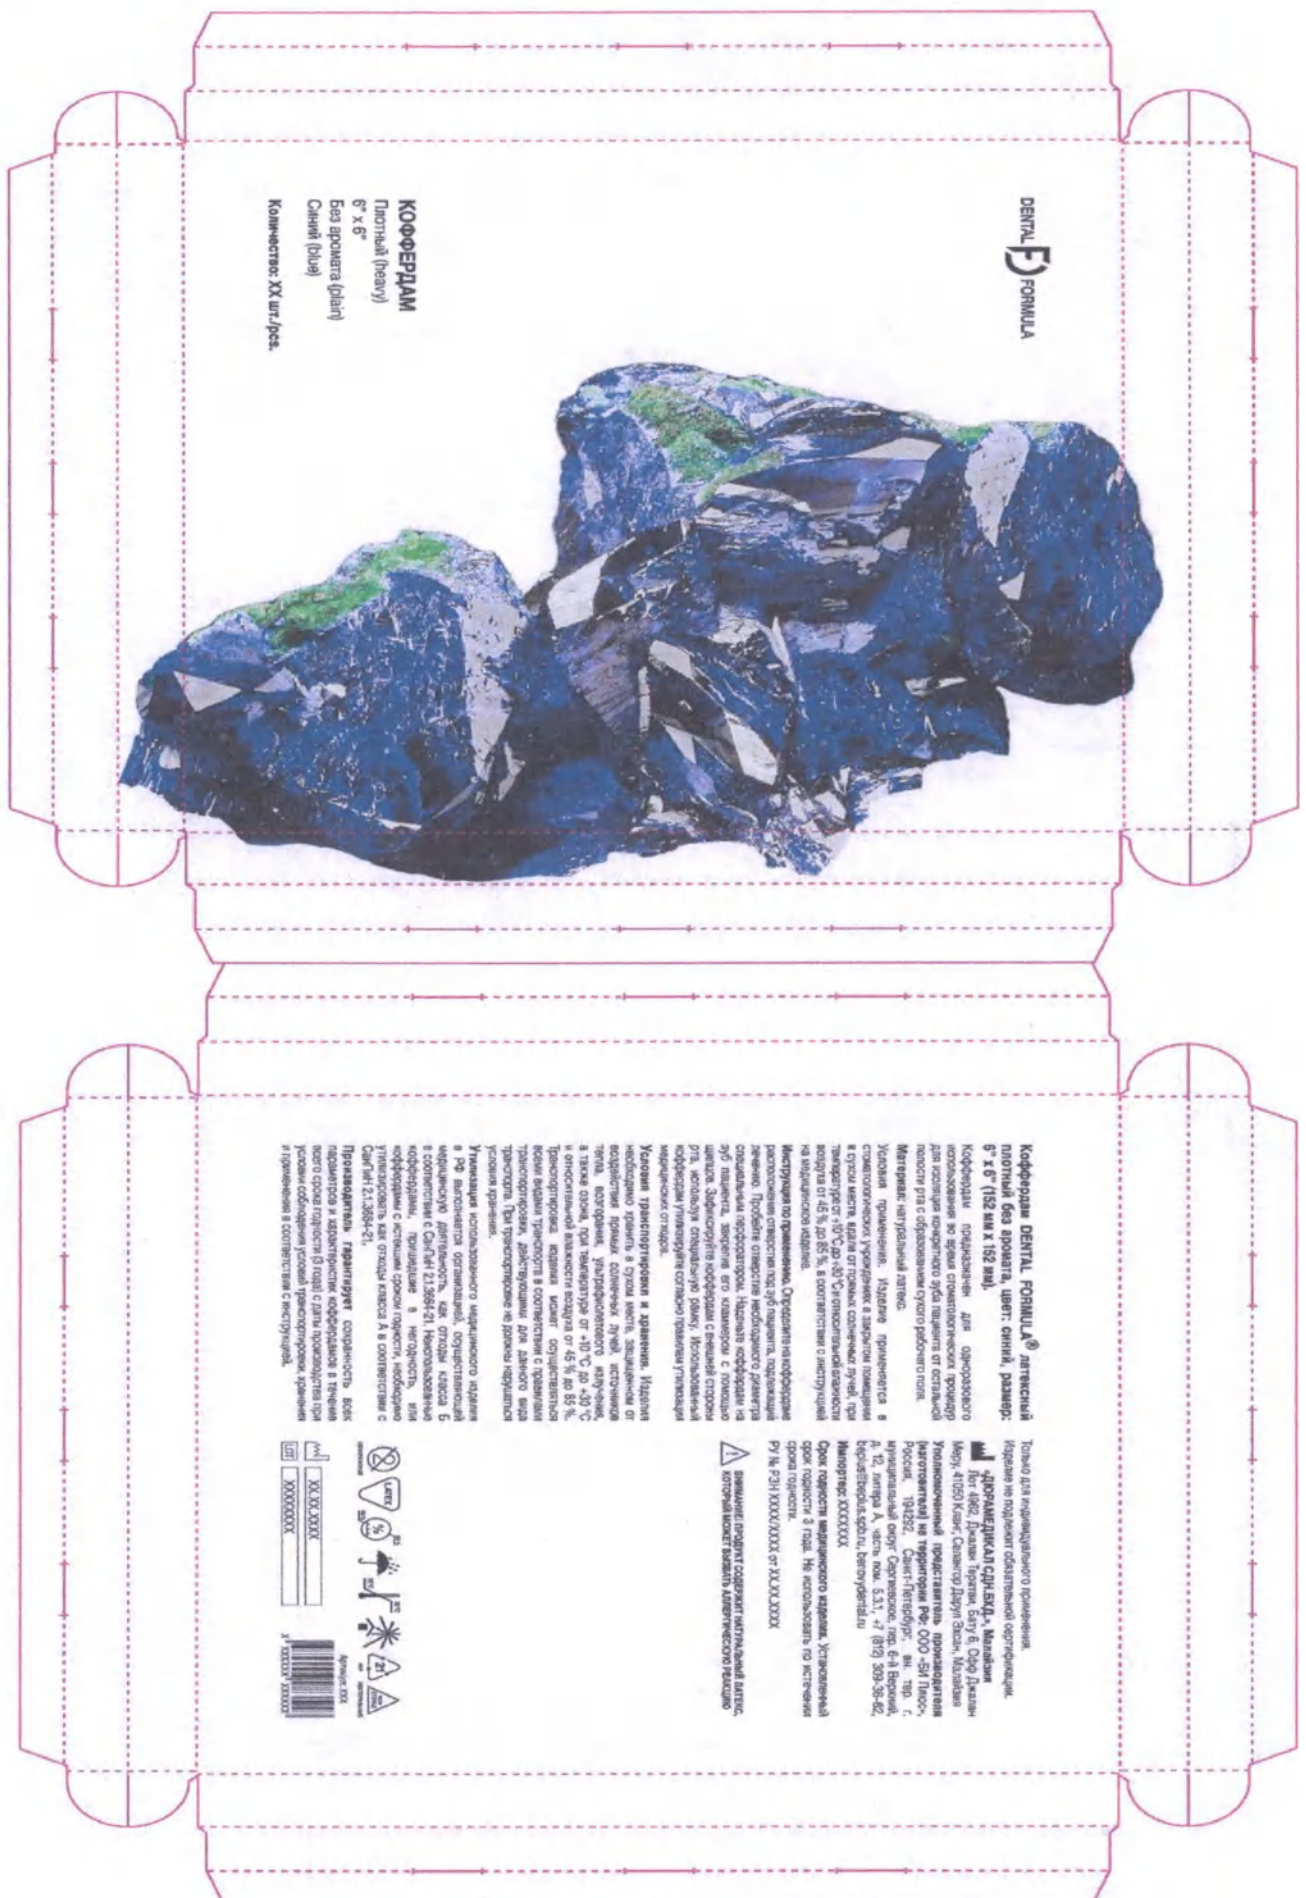

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
плотный без аромата, цвет: синий, размер:
6" x 6" (152 мм x 152 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

 «ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovy dental.ru


Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ

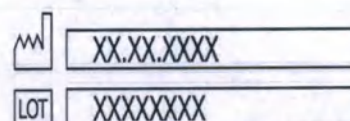

Артикул: XXX



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный с ароматом мяты, цвет: зелёный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одnorазового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



29) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный с ароматом мяты, цвет: чёрный, размер: 6" x 6".

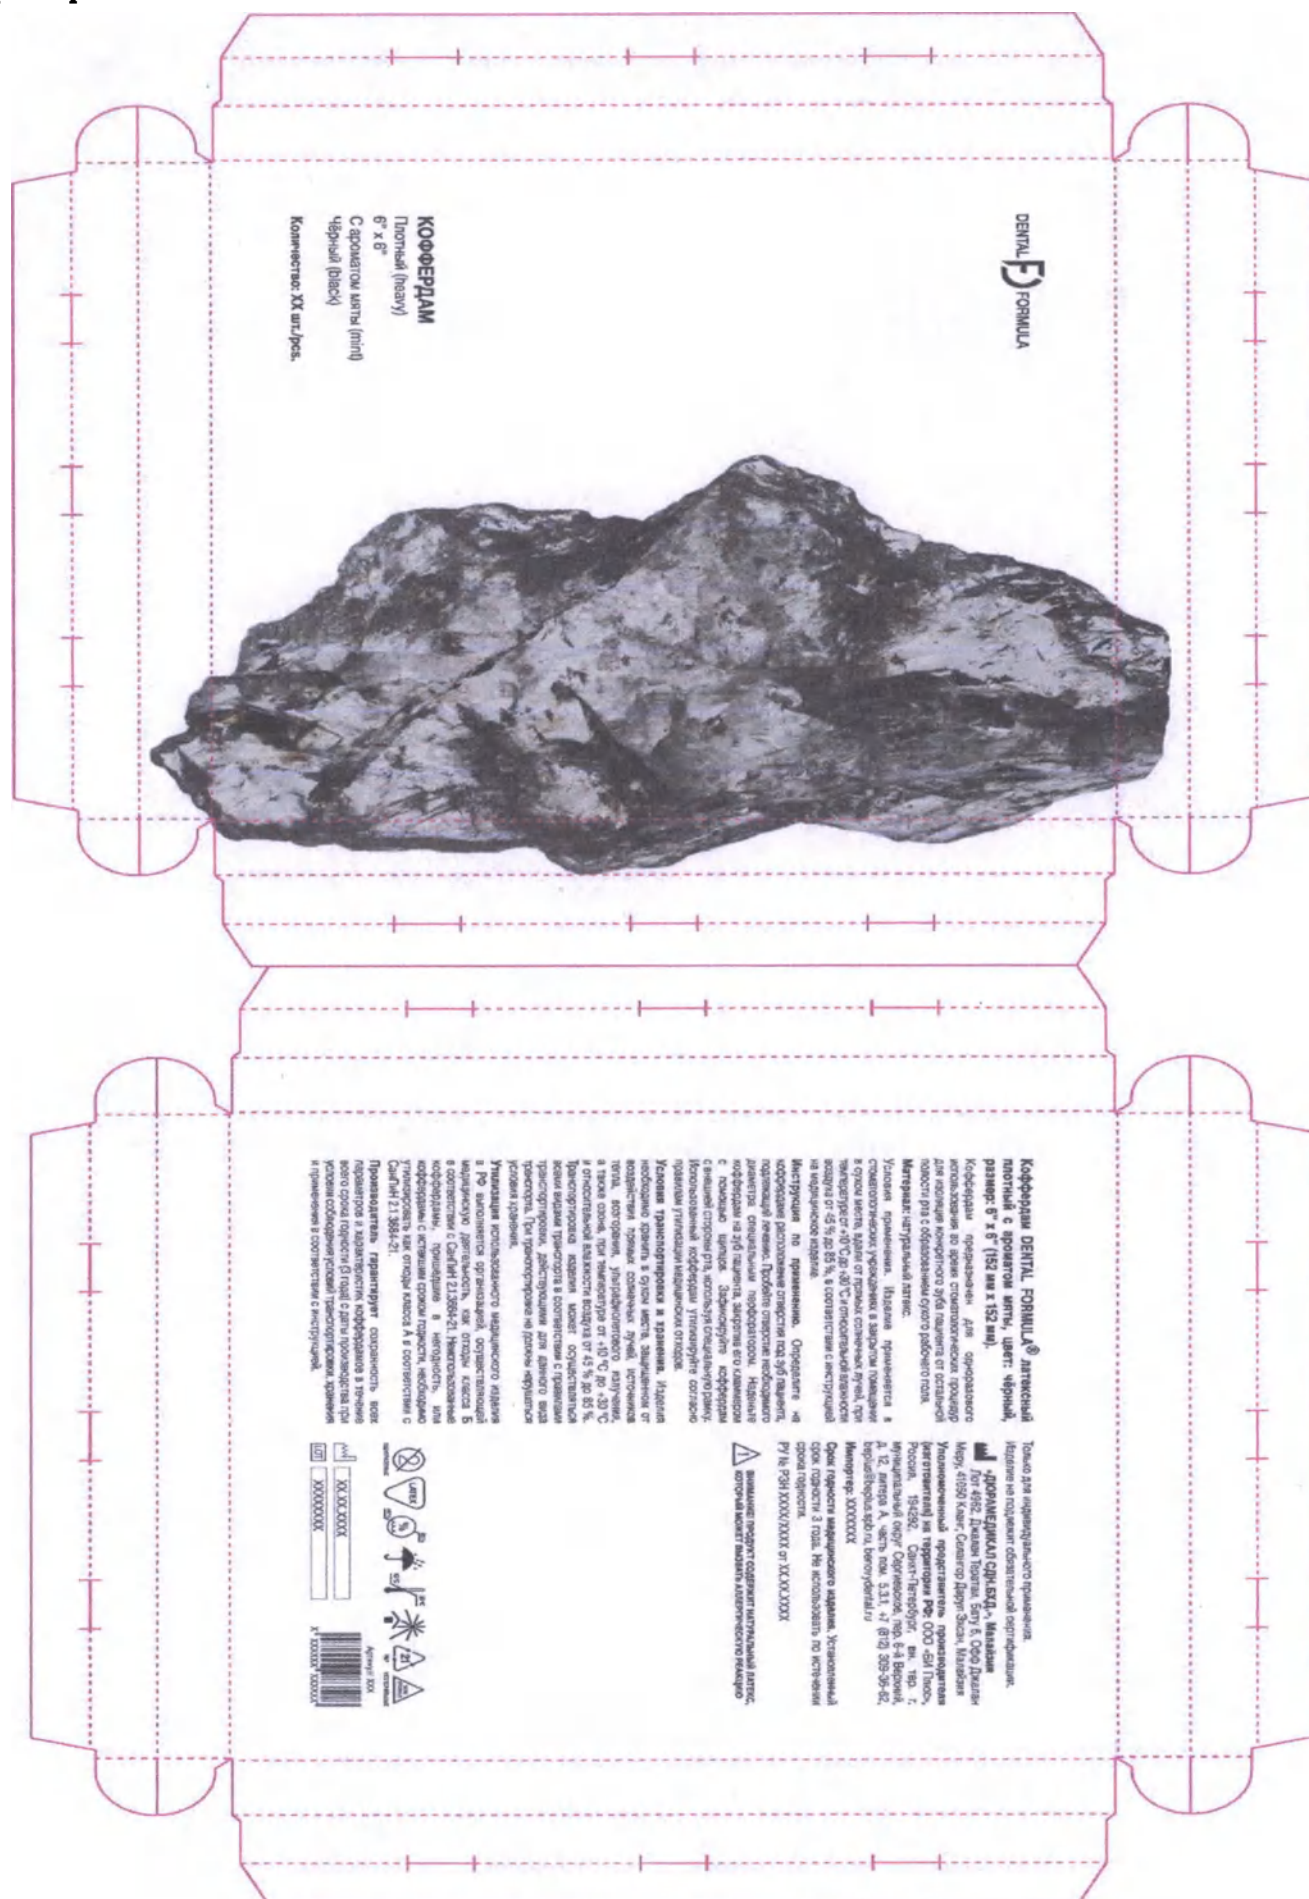

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный с ароматом мяты, цвет: чёрный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для однократного использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

 «ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ




	XX.XX.XXXX
	XXXXXXXXX

Артикул: XXX



30) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный с ароматом мяты, цвет: розовый, размер: 6" x 6".

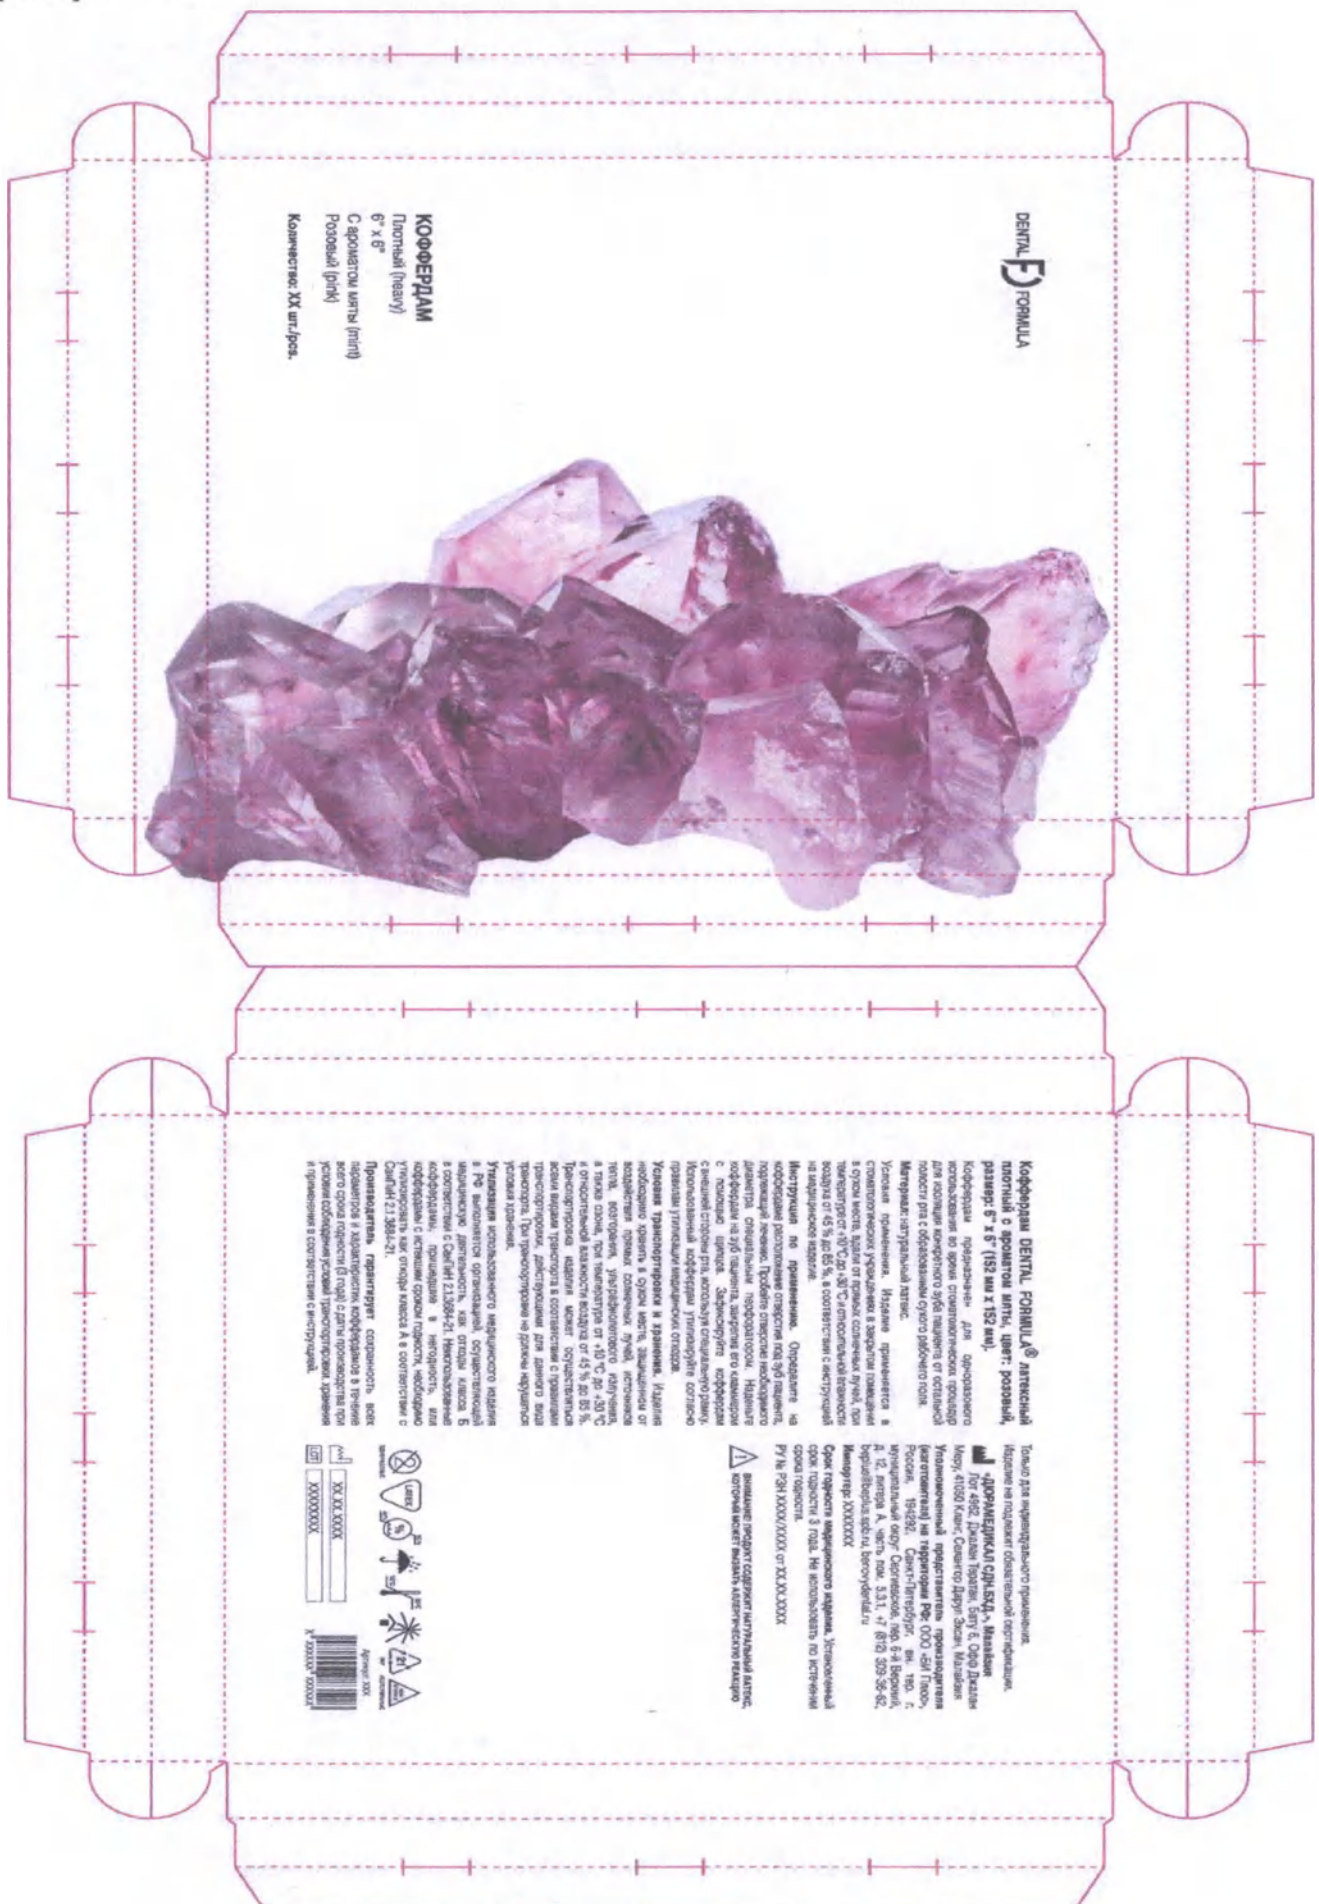

DENTAL
FORMULA

КОФФЕРДАМ
Плотный (heavy)
6" x 6"
С ароматом мяты (mint)
Розовый (pink)
Количество: XX шт./роз.

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
плотный с ароматом мяты, цвет: розовый,
размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердамы предназначены для одностороннего использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба/падения от остальной полости рта с обработанным другим рабочим полем.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Материал применяется в стоматологических учреждениях в закрытых помещениях в сухом месте, удален от прямых солнечных лучей, при температуре от +10°C до +30°C, относительная влажность воздуха от 45% до 55%, в соответствии с инструкцией на упаковочном картоне.

Инструкции по применению. Определите, на какой стороне расположено отверстие под зуб/падение, подвесьте ленточку. Проверьте отсутствие необходимости подвешивания ленточки. Проверьте, чтобы ленточка была правильно подвешена. Проверьте, чтобы ленточка была правильно подвешена. Проверьте, чтобы ленточка была правильно подвешена.

Условия транспортирования и хранения. Материал необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, влаги, пыли, загрязняющего воздуха, в темном месте, при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха от 45% до 55%. Транспортировать материал можно в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида продукции. При транспортировке не должно нарушаться целостность упаковки.

Упаковка. Упаковка используется для хранения материала в виде ленточки. Упаковка должна быть герметичной. В упаковке должно находиться 152 мм x 152 мм. Упаковка должна быть герметичной. В упаковке должно находиться 152 мм x 152 мм.

Противопоказания, предостережения. Все материалы и компоненты коффердама в течение всего срока годности (6 лет) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для профессионального применения.
Использование не подлежит обязательной сертификации.

«ДЕНТАЛ ФОРМУЛА» С.П.О.О.

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

г. Москва, ул. Давыдовская, д. 10, стр. 1

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный плотный с ароматом мяты, цвет: розовый, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия


Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 **ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ**

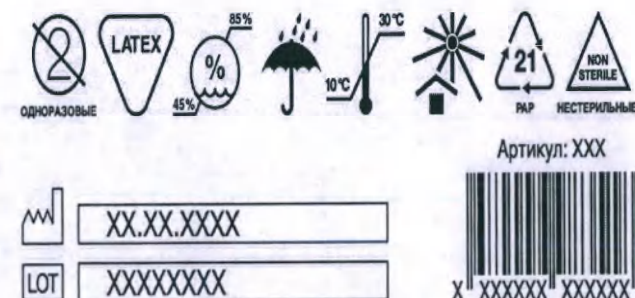

31) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный без аромата, цвет: голубой, размер: 5" x 5".



**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный без аромата, цвет: голубой,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



ОДНОРАЗОВЫЕ



Артикул: XXX



LOT

XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX



**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный без аромата, цвет: синий,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



XX.XX.XXXX




XXXXXXXXX

Артикул: XXX



33) Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный без аромата, цвет: зелёный, размер: 5" x 5".

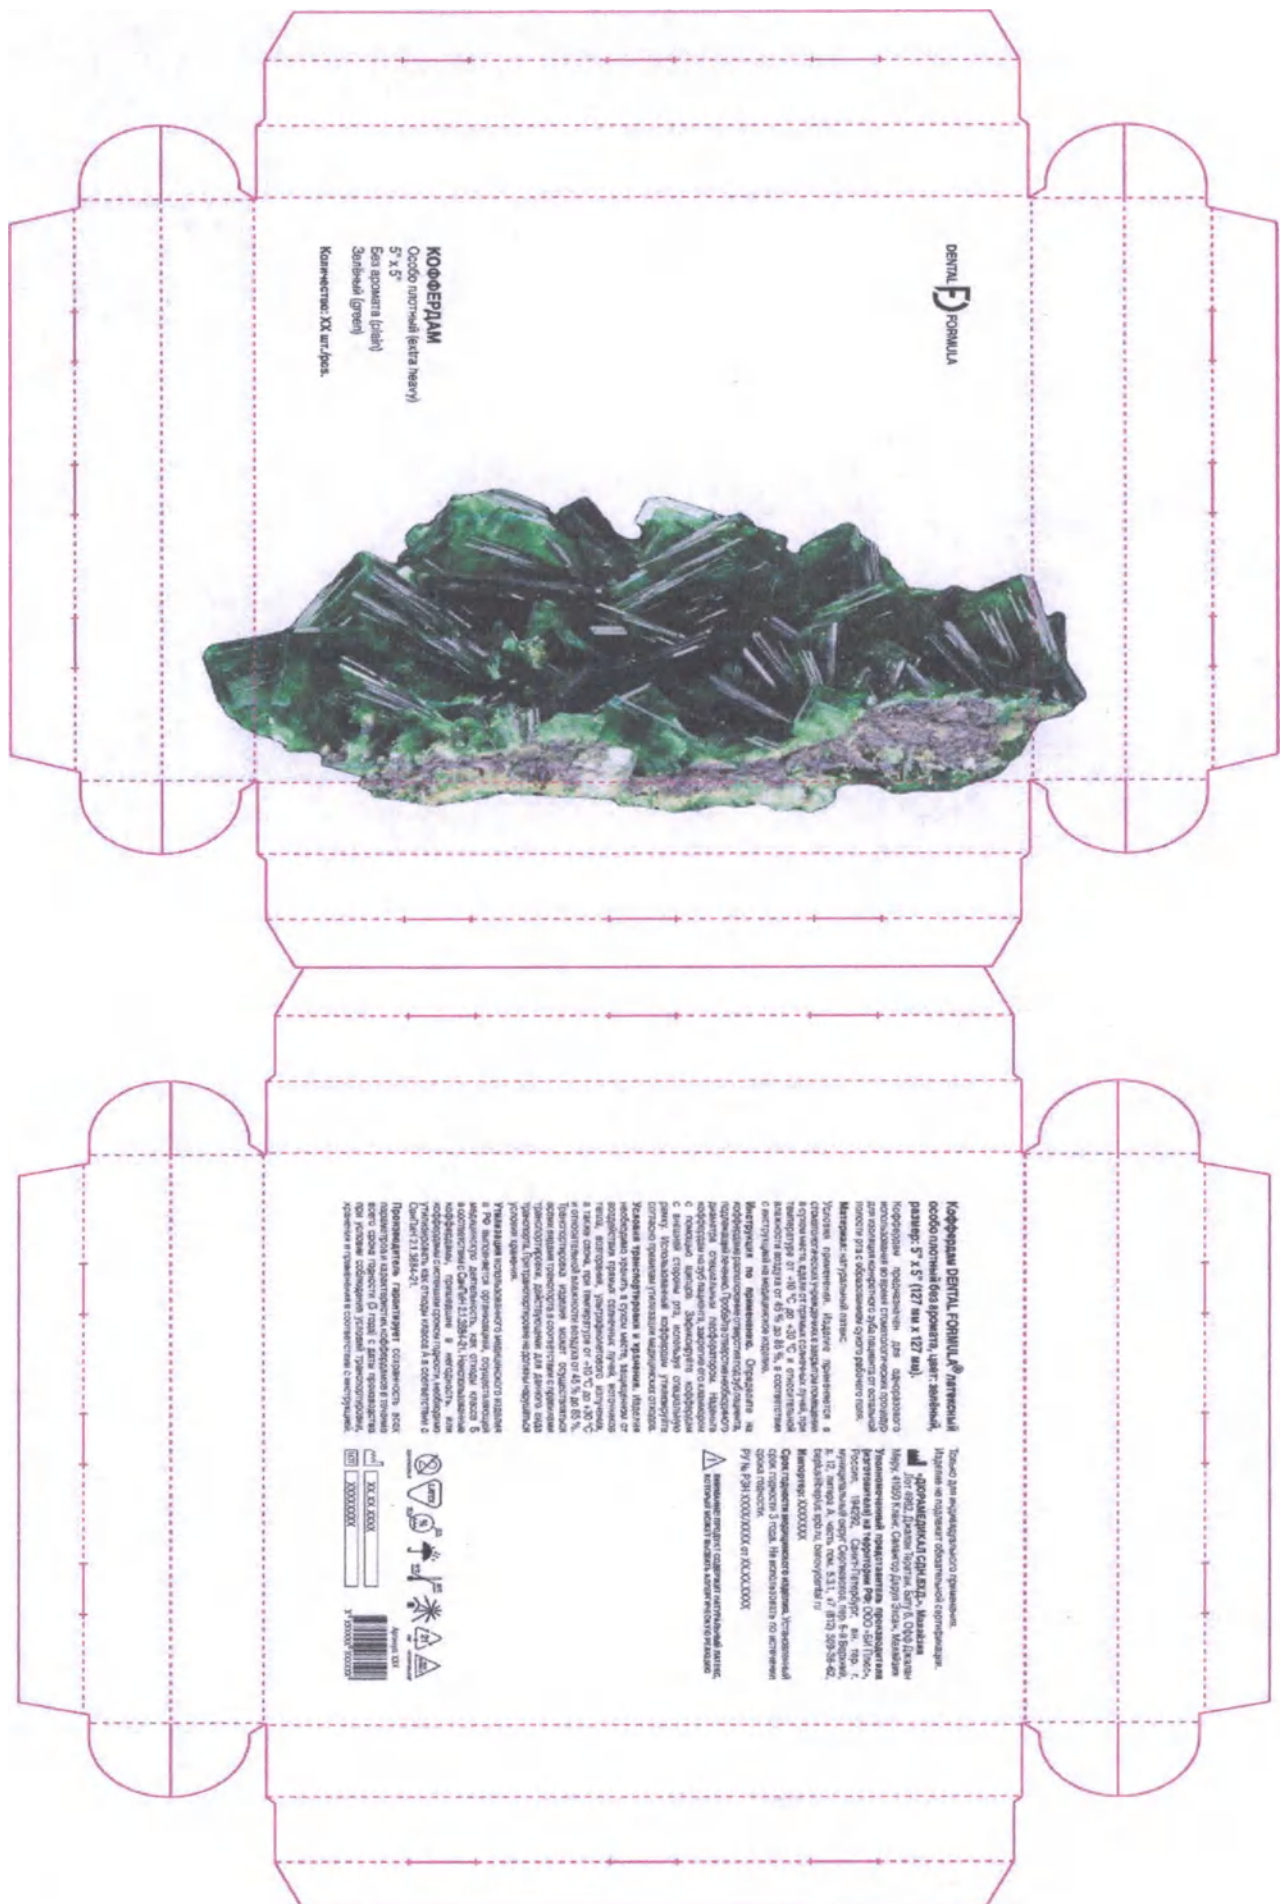

DENTAL
FORMULA

КОФЕРДАМ
Особо плотный (extra heavy)
5" x 5"
Без аромата (flavor)
Зелёный (green)
Количество: XX шт./уп.



Кoffердам DENTAL FORMULA® латексный,
особо плотный без аромата, цвет: зелёный,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).

Кoffердамы предназначены для однократного
использования в качестве барьерного материала
при проведении стоматологических процедур.
После использования кoffердамы должны быть
утилизированы в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм.

Материал: натуральный латекс.
Упаковка: картонная коробка.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

Инструкция по применению. Осторожно!
Кoffердамы предназначены для однократного
использования в качестве барьерного материала
при проведении стоматологических процедур.
После использования кoffердамы должны быть
утилизированы в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм.

Упаковка: картонная коробка.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.

Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.

Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.

Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.

Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.
Срок годности: 2 года.
Срок хранения: 2 года.

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный без аромата, цвет: зелёный,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX

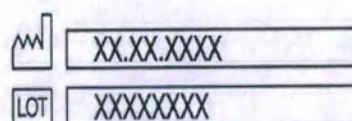

34) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный без аромата, цвет: чёрный, размер: 5" x 5".

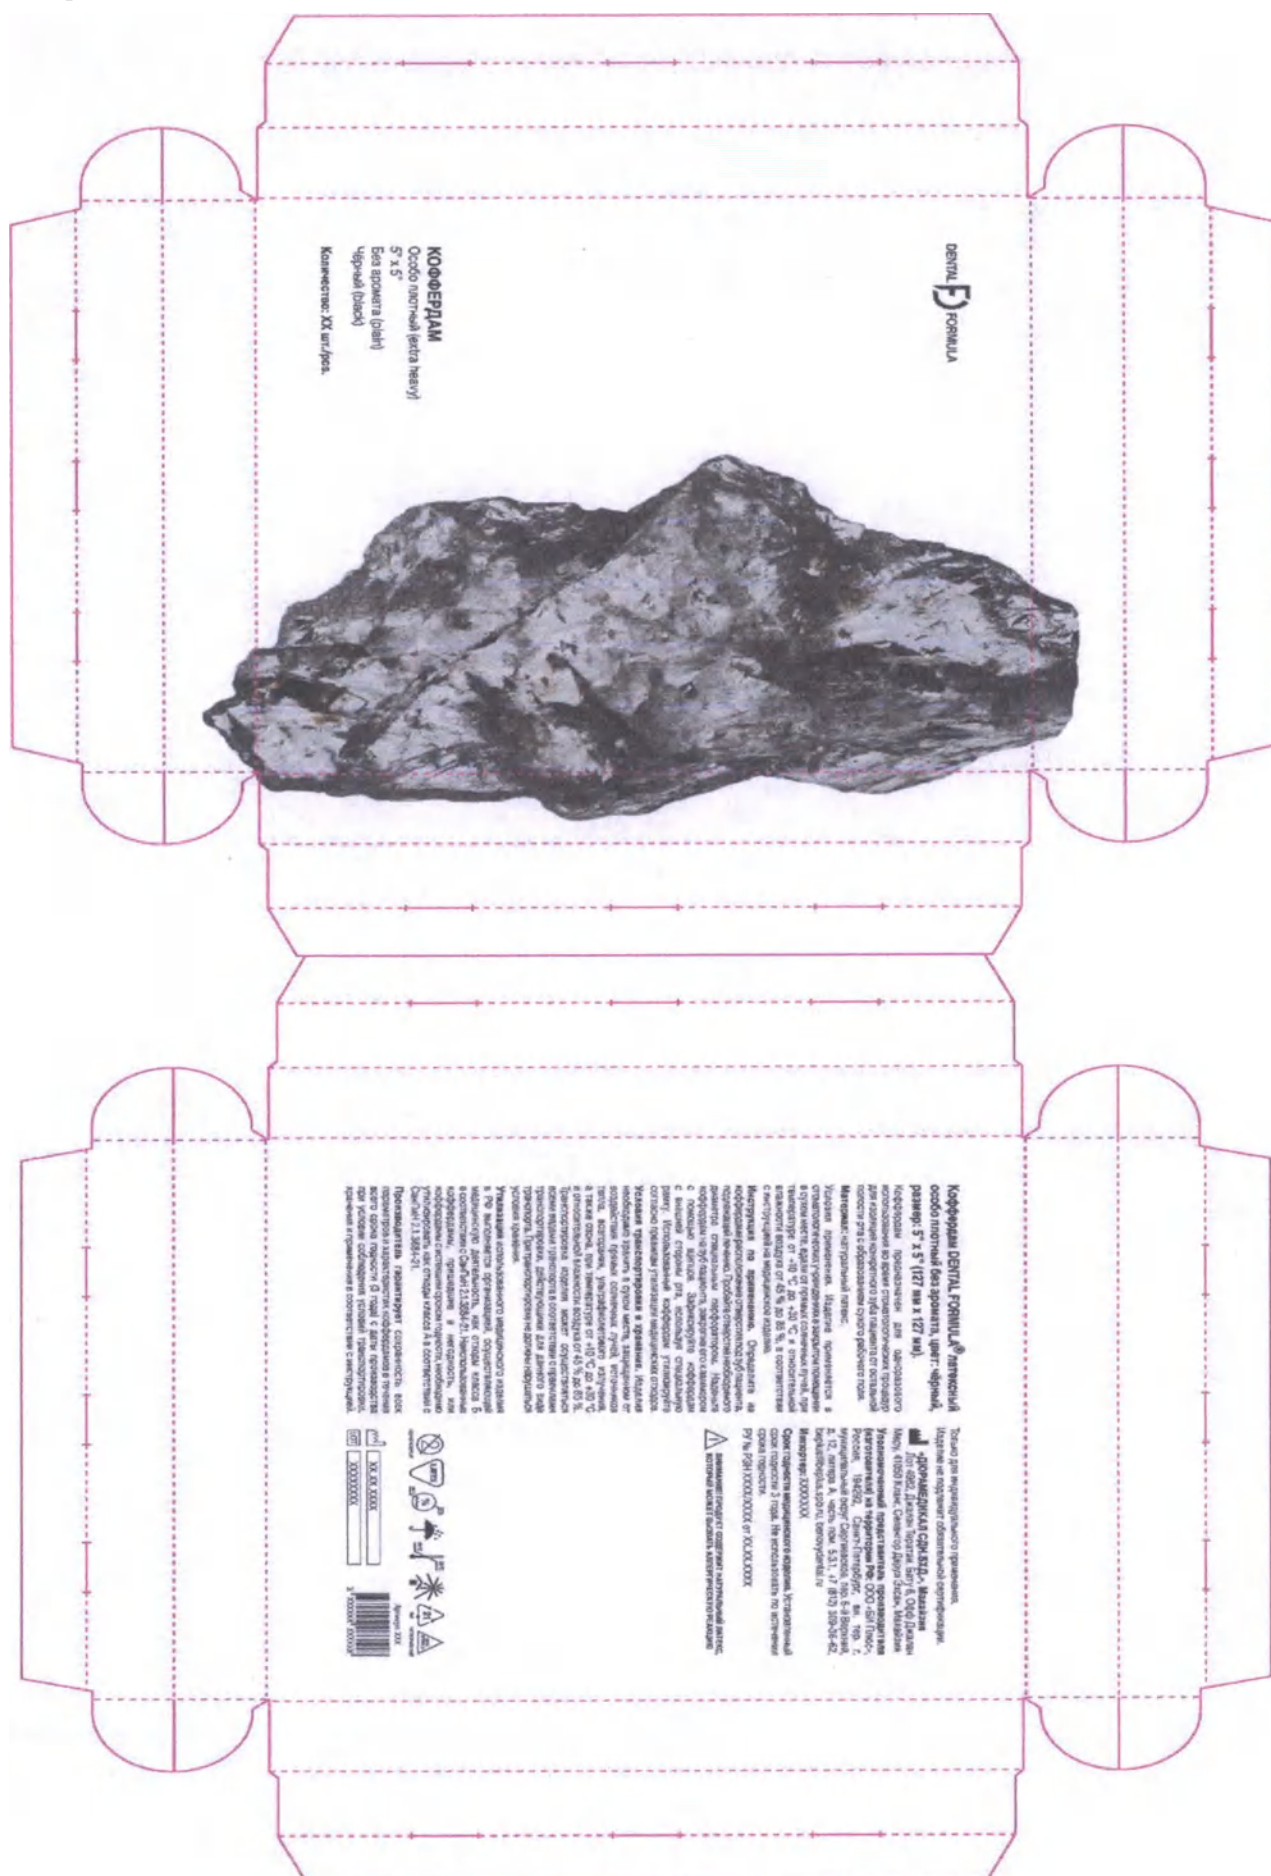

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный без аромата, цвет: чёрный,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovyddental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



LOT


XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX



X XXXXXX XXXXXX

35) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный без аромата, цвет: розовый, размер: 5" x 5".

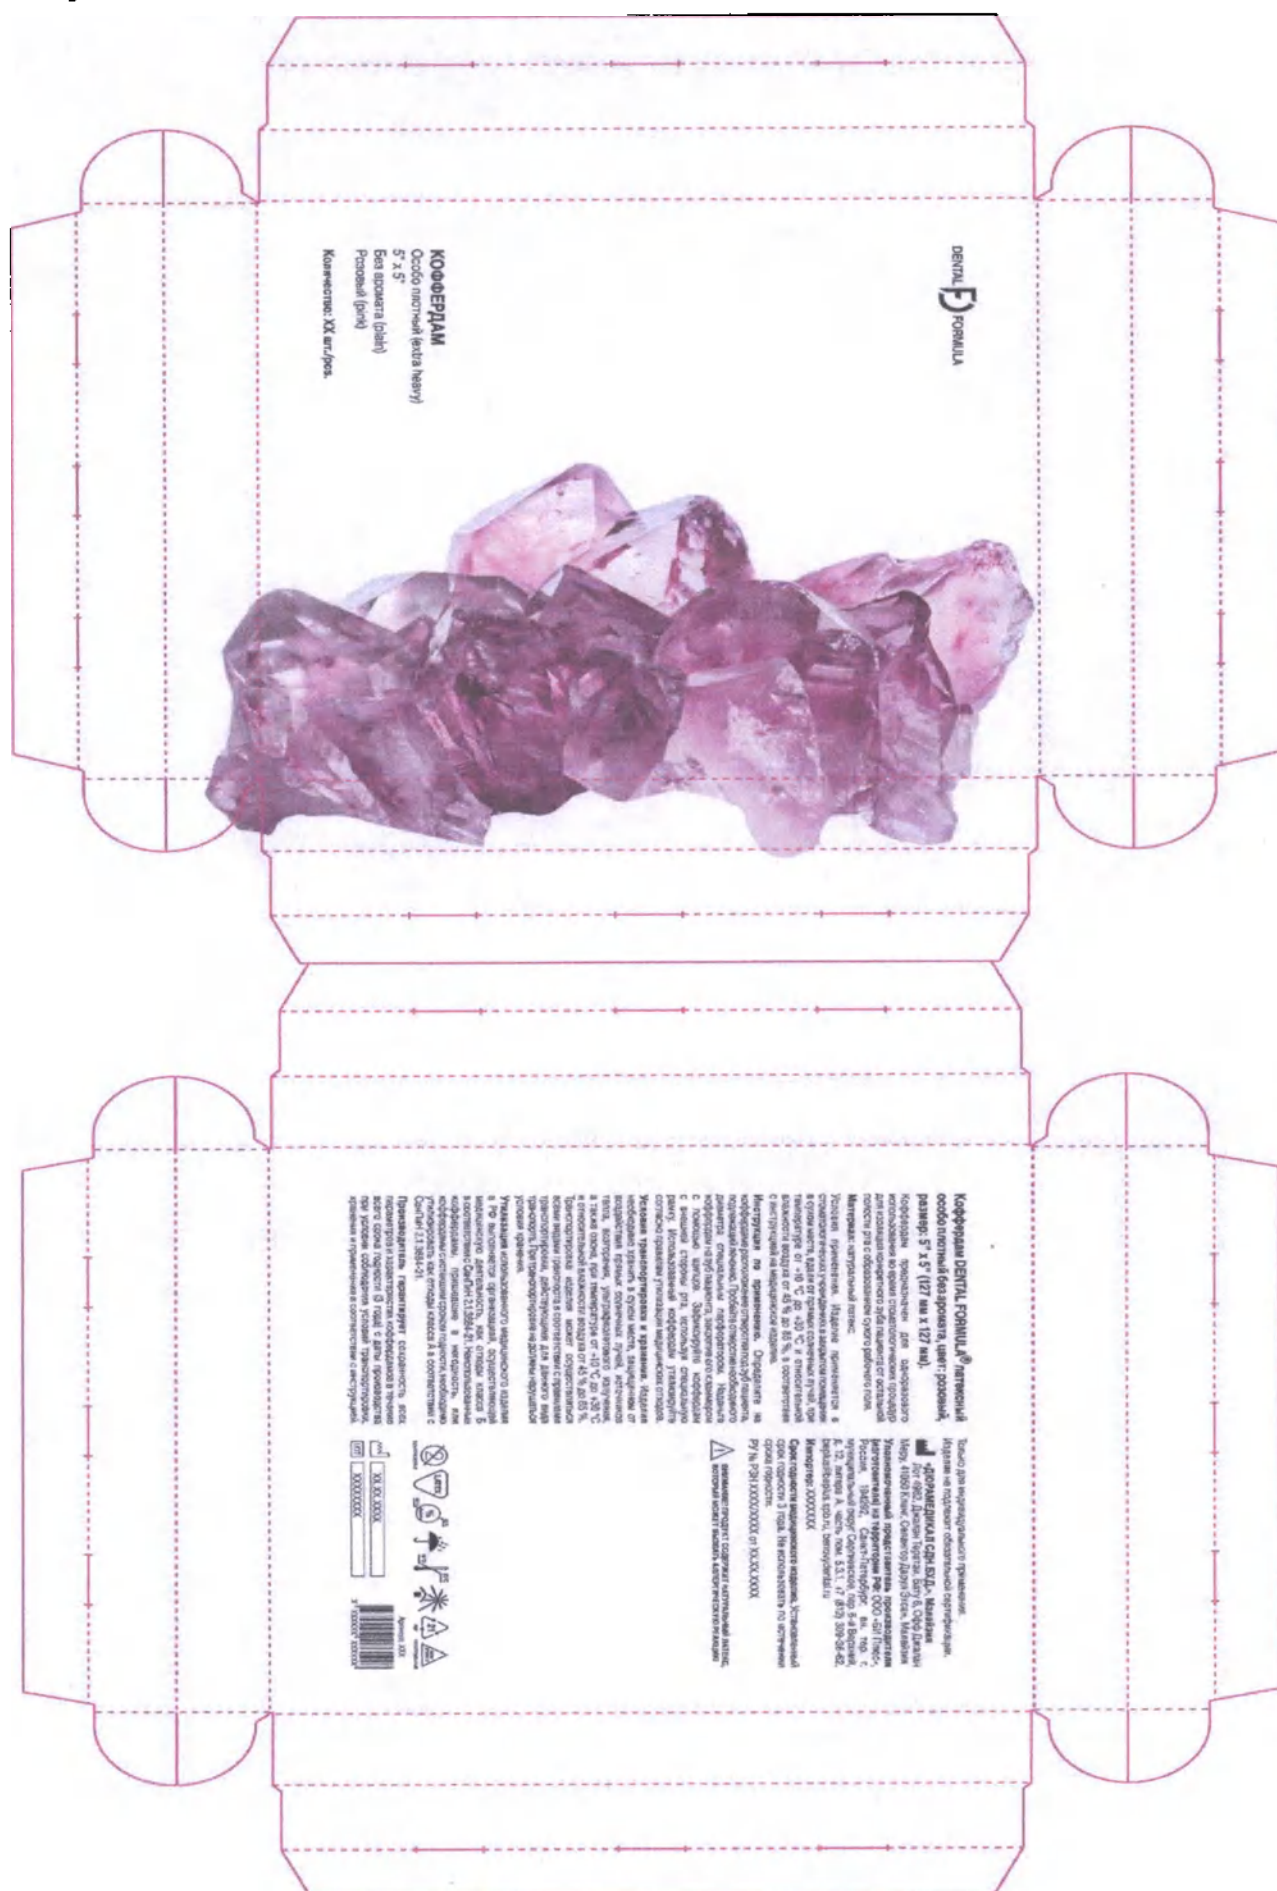

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный без аромата, цвет: розовый,
размер: 5" x 5" (127 мм x 127 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

**Уполномоченный представитель производителя
(изготовителя) на территории РФ:** ООО «БИ Плюс»,
Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний,
д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62,
beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный
срок годности 3 года. Не использовать по истечении
срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



**ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ**



Артикул: XXX

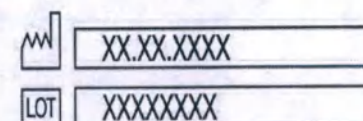

36) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный с ароматом мяты, цвет: голубой, размер: 6" x 6".



Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный с ароматом мяты, цвет:
голубой, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для однократного использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия
Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovyndental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



ДЕНТАЛ
ФОРМУЛА

КОФФЕРДАМ
Особо плотный (extra heavy)
6" x 6"
С ароматом икры (mink)
Синий (blue)
Количество: XX шт./пач.

Коффердам ДЕНТАЛ ФОРМУЛА® латексный, особо плотный с ароматом икры, цвет: синий, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердамы предназначены для предотвращения попадания во время стоматологических процедур для изоляции операционного зуба полости от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: латексный латекс.

Упаковка: прозрачная. Упаковку применяется в стоматологическом учреждении в закрытом положении в сухом месте. Материал от гримов со временем гниет, при температуре от +10°C до +30°C относительная влажность воздуха от 45% до 85%, в соответствии с инструкцией на индивидуальное изделие.

Инструкция по применению. Обеспечение коффердама расположено относительно зуба пациента, подлежащий лечению. Процедура состоит из нескольких этапов: установка коффердама, закрепление его клеммами с помощью шпателя, закрепление коффердама с внешней стороны рта, установка специального рамы. Использование коффердама универсально для любых процедур, включая эндодонтические процедуры.

Упаковка: прозрачная и прочная. Упаковку необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия влаги. Срок годности: 3 года. Температура хранения: от +10°C до +30°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 85%. Транспортировка: коффердам можно транспортировать в упаковке в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не допускать нарушения условий хранения.

Упаковка: прозрачная и прочная. Упаковку необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия влаги. Срок годности: 3 года. Температура хранения: от +10°C до +30°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 85%. Транспортировка: коффердам можно транспортировать в упаковке в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не допускать нарушения условий хранения.

Только для индивидуального применения. Упаковку не подвергать воздействию окружающей среды.

ПРОИЗВЕДЕНА В КИТАЕ
Лот 4982, Дунгань, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай

Уполномоченный представитель производителя (экспортная) на территории РФ: ООО «Мед. Тех.», Россия, 194292, Санкт-Петербург, ул. Троицкая, д. 12, литера А, этаж 5-й, кв. 5.11, 7 (812) 309-56-62, бухгалтерия@medtech.ru, безвозмездно.

Мини-порт: XXXXXXXX

Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛИБЕРАЦИОННОЕ РАСТВОРЕНИЕ.

**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный с ароматом мяты, цвет:
синий, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



38) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный с ароматом мяты, цвет: зелёный, размер: 6" x 6".

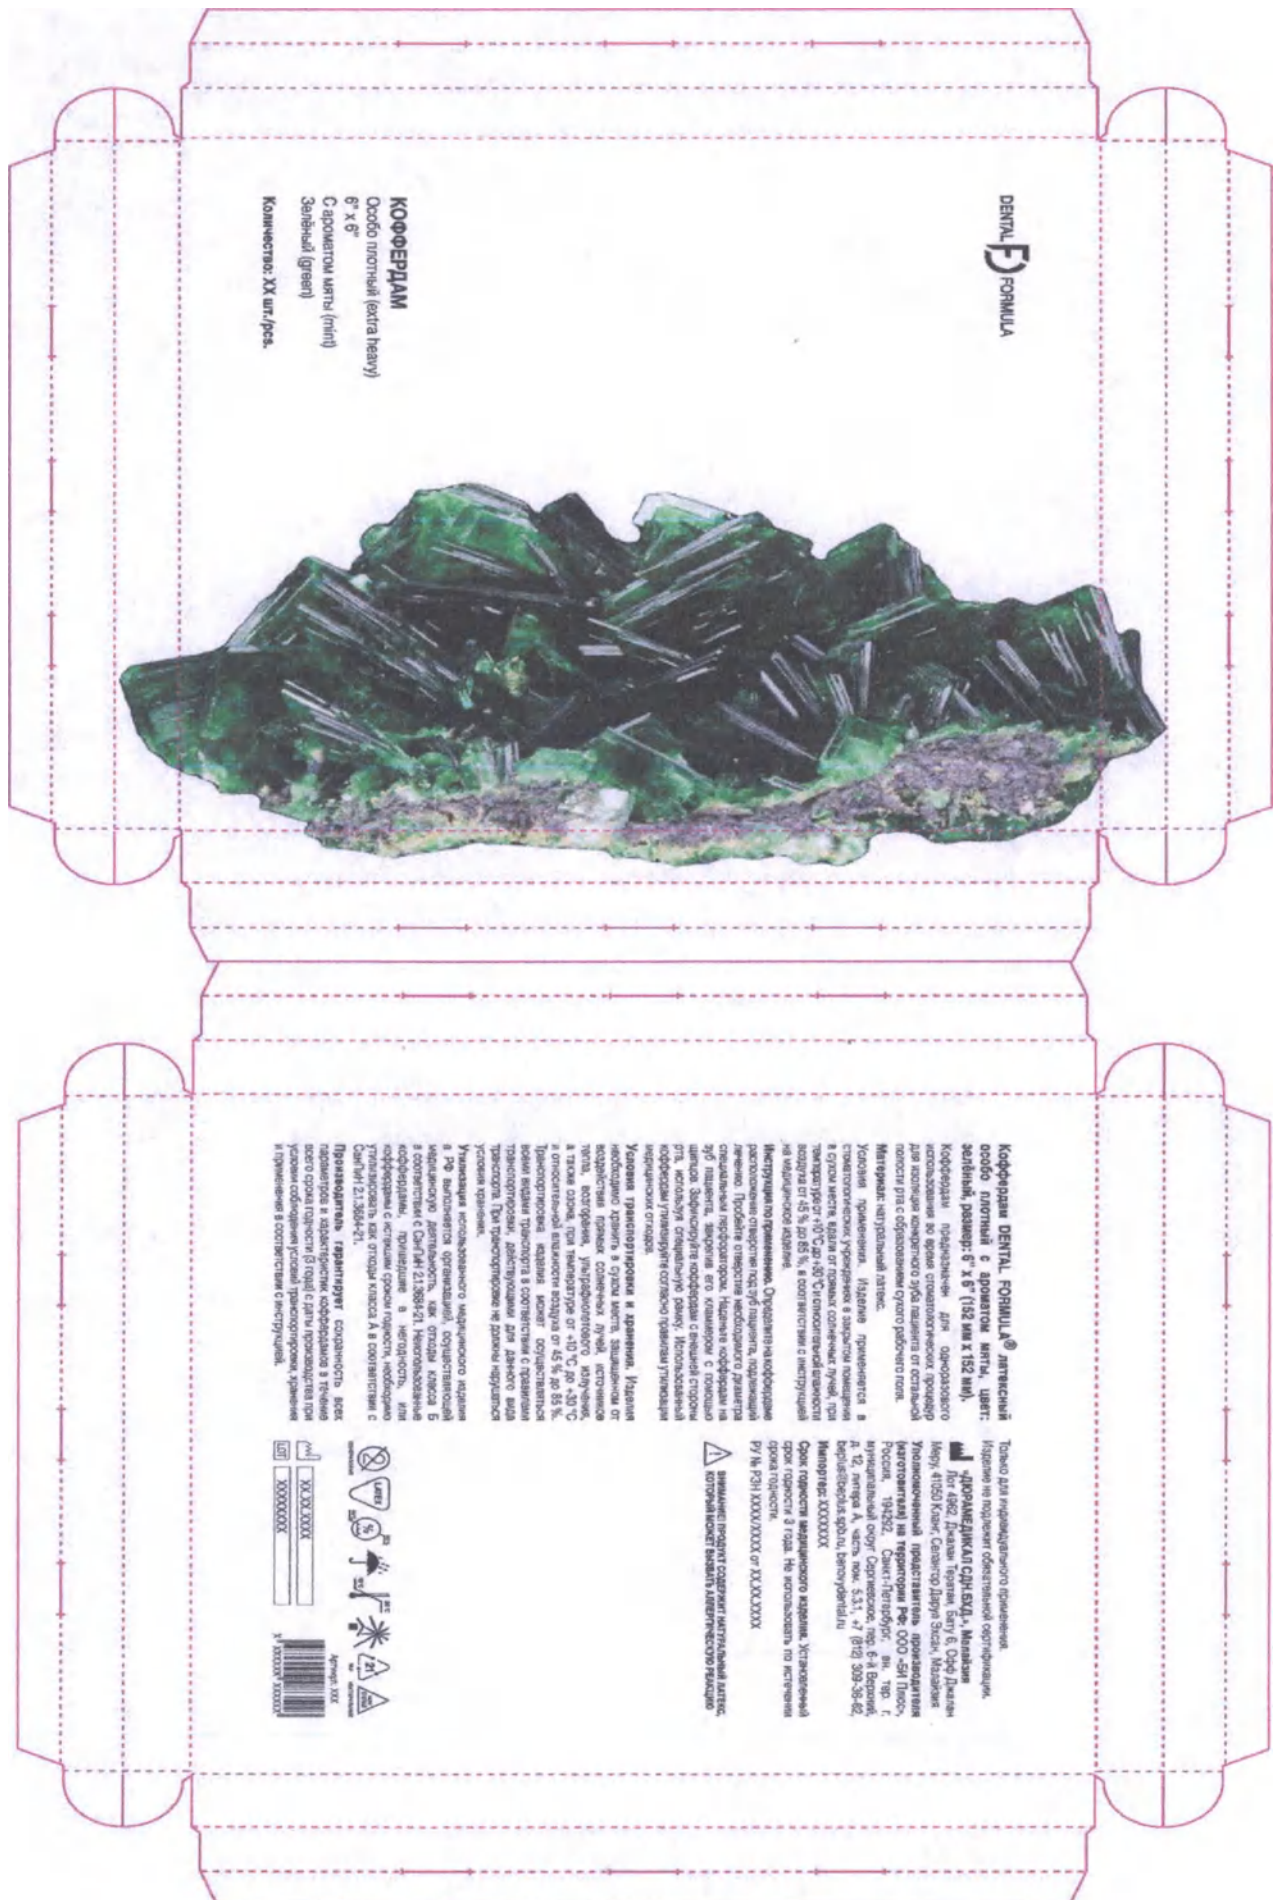

Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный с ароматом мяты, цвет:
зелёный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovyndental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный с ароматом мяты, цвет:
чёрный, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

 **«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.»**, Малайзия
Лот 4962, Джалан Теракаи, Бату 6, Офф Джалан
Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

**Уполномоченный представитель производителя
(изготовителя) на территории РФ:** ООО «БИ Плюс»,
Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний,
д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62,
beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный
срок годности 3 года. Не использовать по истечении
срока годности.


РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



**ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ**



Артикул: XXX

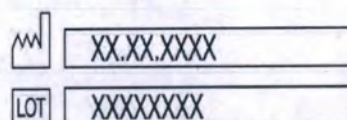

40) Коффердам DENTAL FORMULA® латексный особо плотный с ароматом мяты, цвет: розовый, размер: 6" x 6".



**Коффердам DENTAL FORMULA® латексный
особо плотный с ароматом мяты, цвет:
розовый, размер: 6" x 6" (152 мм x 152 мм).**

Коффердам предназначен для одноразового использования во время стоматологических процедур для изоляции конкретного зуба пациента от остальной полости рта с образованием сухого рабочего поля.

Материал: натуральный латекс.

Условия применения. Изделие применяется в стоматологических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %, в соответствии с инструкцией на медицинское изделие.

Инструкция по применению. Определите на коффердаме расположение отверстия под зуб пациента, подлежащий лечению. Пробейте отверстие необходимого диаметра специальным перфоратором. Наденьте коффердам на зуб пациента, закрепив его кламмером с помощью щипцов. Зафиксируйте коффердам с внешней стороны рта, используя специальную рамку. Использованный коффердам утилизируйте согласно правилам утилизации медицинских отходов.

Условия транспортировки и хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 85 %. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные коффердамы, пришедшие в негодность, или коффердамы с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик коффердамов в течение всего срока годности (3 года) с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Только для индивидуального применения.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.



«ДЮРАМЕДИКАЛ СДН.БХД.», Малайзия

Лот 4962, Джалан Тератаи, Бату 6, Офф Джалан Меру, 41050 Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru, benovydental.ru

Импортер: XXXXXXXX

Срок годности медицинского изделия. Установленный срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ВНИМАНИЕ! ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ



Артикул: XXX



LOT

XX.XX.XXXX

XXXXXXXXXX



X XXXXXX XXXXXX

ВСЕГО ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 81 ЛИСТА/ОВ/
Управляющий-ИП
ПОТАПА В.Ф.

