

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
2023 г.

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV»,
по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Электронная копия
формы № 1

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 200-25

На коробку:

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

В006 F1

ЛЕТ
E012Z1
2024-06-22

ГепатитИФА-анти-HCV

Для профессионального применения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

ГепатитИФА-анти-HCV
Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV»
по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

234567 890128

ГепатитИФА-анти-HCV

2024-06-22

ЛЕТ
E012Z1

Для профессионального применения

В006 F1

www.alkorbio.ru

LOT E012Z1 2023-03-22 +2⁺8 °C

REF 200-25 2024-06-22

IVD 96

ТУ 21.20.23-686-98539446-2023
ПУ №

Состав набора:

1. Стрипы с рекомбинантными антигенами вируса гепатита С	1 упак.	8. Стоп-реагент	1 фл. (50 мл)
2. Отрицательная контрольная проба	1 фл. (2,2 мл)	9. Одноразовые ванночки	2 шт.
3. Положительная контрольная проба	1 фл. (1,6 мл)	10. Одноразовые наконечники	16 шт.
4. Буфер А	1 фл. (10 мл)	11. Пленка для ИФА планшетов	2 шт.
5. Конъюгат Е	1 фл. (14 мл)	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	1 шт.
6. Буфер Н (20Х)	1 фл. (50 мл)	13. Инструкция по применению	1 шт.
7. Раствор ТМБ	1 фл. (14 мл)	14. Паспорт	1 шт.

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток



На флаконы:

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантными антигенами вируса гепатита С
ГепатитИФА-анти-HCV
серия № **E012**
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Отрицательная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-HCV
годен до 2024-06-22
объем 2,2 мл хранить при +2...+8°C
серия № E012 готова к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Положительная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-HCV
годен до 2024-06-22
объем 1,6 мл хранить при +2...+8°C
серия № E012 готова к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Буфер А
ГепатитИФА-анти-HCV
объем 10 мл
серия № E012
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
ГепатитИФА-анти-HCV
объем 14 мл
серия № E012
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V003

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)

объем 50 мл
серия № E012
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8°C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ

объем 14 мл
серия № E012
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Стоп-реагент

объем 50 мл
серия № E012
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 200-29

На коробку:

ГепатитИФА-анти-HCV

LOT E012Z2

2024-06-22

ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

ПУ №

Для профессионального применения

V006 F1

АЛКОР БИО

www.alkorbio.ru

2 000027 742318

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

ГепатитИФА-анти-HCV

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

Состав набора:

1. Стрипы с рекомбинантными антигенами вируса гепатита С	2 упак.	8. Стоп-реагент	2 фл. (по 50 мл)
2. Отрицательная контрольная проба	1 фл. (2,2 мл)	9. Одноразовые ванночки	2 шт.
3. Положительная контрольная проба	1 фл. (1,6 мл)	10. Одноразовые наконечники	16 шт.
4. Буфер А	2 фл. (по 10 мл)	11. Пленка для ИФА планшетов	4 шт.
5. Конъюгат Е	2 фл. (по 14 мл)	12. Пакет закрывающийся полистиленовый	2 шт.
6. Буфер Н (20Х)	2 фл. (по 50 мл)	13. Инструкция по применению	1 шт.
7. Раствор ТМБ	2 фл. (по 14 мл)	14. Паспорт	1 шт.

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

LOT E012Z2

REF 200-29

2023-03-22

2024-06-22

IVD

+2...+8 °C

192

Биобезопасность

ГепатитИФА-анти-HCV

LOT E012Z2

2024-06-22

ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

ПУ №

Для профессионального применения

V006

F1

2 000027 742318

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

www.alkorbio.ru

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-НСV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток



На флаконы:

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантными
антигенами вируса гепатита С

ГепатитИФА-анти-НСV

серия № **E012**

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готовы к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-2 шт.

АЛКОР БИО
Отрицательная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-НСV

годен до 2024-06-22

объем 2,2 мл хранить при +2...+8°C

серия № E012 готова к использованию

только для диагностики in vitro



-1 шт.

АЛКОР БИО
Положительная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-НСV

годен до 2024-06-22

объем 1,6 мл хранить при +2...+8°C

серия № E012 готова к использованию

только для диагностики in vitro



-1 шт.

АЛКОР БИО
Буфер А
ГепатитИФА-анти-НСV

объем 10 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8°C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V003

-2 шт.

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
ГепатитИФА-анти-НСV

объем 14 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8°C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V003

-2 шт.

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)

объем 50 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8°C

950 мл дист. воды

только для диагностики in vitro

V001

-2 шт.

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ

объем 14 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8°C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-2 шт.

АЛКОР БИО
Стоп-реагент

объем 50 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V001

-2 шт.

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 200-46

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А







ГепатитИФА-анти-HCV

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV»,
по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

Состав набора:

1. Стрипы с рекомбинантными антигенами вируса гепатита С	5 упак.	8. Стоп-реагент	3 фл. (по 100 мл)
2. Отрицательная контрольная проба	2 фл. (по 2,2 мл)	9. Одноразовые ванночки	4 шт.
3. Положительная контрольная проба	2 фл. (по 1,6 мл)	10. Одноразовые наконечники	32 шт.
4. Буфер А	1 фл. (50 мл)	11. Пленка для ИФА планшетов	10 шт.
5. Конъюгат Е	5 фл. (по 14 мл)	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	5 шт.
6. Буфер Н (20Х)	3 фл. (по 100 мл)	13. Инструкция по применению	1 шт.
7. Раствор ТМБ	1 фл. (100 мл)	14. Паспорт	1 шт.

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

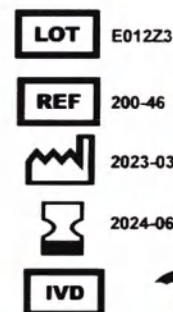

ГепатитИФА-анти-HCV



2024-06-22

E012Z3

ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

РУ №

Для профессионального применения

V003

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток



На флаконы:

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантными
антигенами вируса гепатита С

ГепатитИФА-анти-HCV

серия № **E012**

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готовы к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-5 шт.

АЛКОР БИО
Отрицательная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-HCV

годен до 2024-06-22

объем 2,2 мл хранить при +2...+8 °C

серия № E012 готова к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-2 шт.

АЛКОР БИО
Положительная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-HCV

годен до 2024-06-22

объем 1,6 мл хранить при +2...+8 °C

серия № E012 готова к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-2 шт.

АЛКОР БИО
Буфер А
ГепатитИФА-анти-HCV

объем 50 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-1 шт.

АЛКОР БИО

Конъюгат Е

ГепатитИФА-анти-HCV

объем 14 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V003

-5 шт.

АЛКОР БИО

Буфер Н (20X)

объем 100 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

1900 мл дист. воды

только для диагностики in vitro

V001

-3 шт.

АЛКОР БИО

Раствор ТМБ

объем 100 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-1 шт.

АЛКОР БИО

Стоп-реагент

объем 100 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro



V001

-3 шт.

«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 4

Кат. № 200-86

На коробку:

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А




ГепатитИФА-анти-HCV

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV», по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

Состав набора:

1. Стрипы с рекомбинантными антигенами вируса гепатита С	10 упак.	8. Стоп-реагент	5 фл. (по 100 мл)
2. Отрицательная контрольная проба	4 фл. (по 2,2 мл)	9. Одноразовые ванночки	4 шт.
3. Положительная контрольная проба	4 фл. (по 1,6 мл)	10. Одноразовые наконечники	32 шт.
4. Буфер А	2 фл. (по 50 мл)	11. Пленка для ИФА планшетов	20 шт.
5. Конъюгат Е	10 фл. (по 14 мл)	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	10 шт.
6. Буфер Н (20Х)	5 фл. (по 100 мл)	13. Инструкция по применению	1 шт.
7. Раствор ТМБ	2 фл. (по 100 мл)	14. Паспорт	1 шт.

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

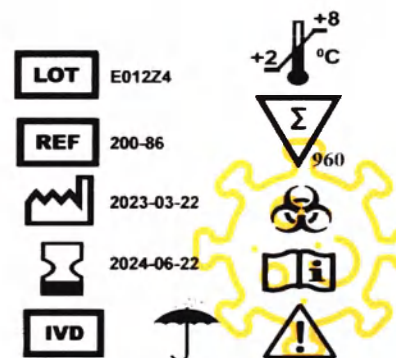

ГепатитИФА-анти-HCV



2024-06-22



E012Z4

LOT

ТУ 21.20.23-686-98539446-2023

РУ №

Для профессионального применения

V001

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

На флаконы:

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантными
антигенами вируса гепатита С

ГепатитИФА-анти-HCV

серия № **E012**

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готовы к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-10 шт.

АЛКОР БИО
Отрицательная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-HCV

годен до 2024-06-22

объем 2,2 мл хранить при +2...+8 °C

серия № E012 готова к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-4 шт.

АЛКОР БИО
Положительная контрольная проба
ГепатитИФА-анти-HCV

годен до 2024-06-22

объем 1,6 мл хранить при +2...+8 °C

серия № E012 готова к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-4 шт.

АЛКОР БИО
Буфер А
ГепатитИФА-анти-HCV

объем 50 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-2 шт.

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
ГепатитИФА-анти-HCV

объем 14 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V003

-10 шт.

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)

объем 100 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

+ 1900 мл дист. воды

только для диагностики in vitro

V001

-5 шт.

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ

объем 100 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-2 шт.

АЛКОР БИО
Стоп-реагент

объем 100 мл

серия № E012

годен до 2024-06-22

хранить при +2...+8 °C

готов к использованию

только для диагностики in vitro

V001

-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

1 (1000) лист

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д. Г. Полинцев





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
20 23 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
антител к вирусу гепатита С «ГепатитИФА-анти-HCV»,
по ТУ 21.20.23-686-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Синтез Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Звенигородский пр., д. 40, лит. А
Телефоны: (812) 671-4759

ПАСПОРТ № ED121

Набор реагентов для качественного иммуноферментного анализа
антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ»
им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023

Кат. № 20623 Серия № ED121. Формирование № 1 Кол-во: 50 шт.
Курят (ручная поставка) 0,1

Наименование реагента	Внешний вид / форма	Единица измерения	Срок годности	Состояние при получении
Стрипы с реакционными элементами	Сухие, не требующие подготовки	1 комплект	6012	интактны
Оптический планшет (96 лунок)	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер А	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер В	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Г	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Д	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Е	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ж	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер З	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер И	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер К	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Л	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер М	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Н	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер О	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер П	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Р	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер С	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Т	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер У	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ф	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Х	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ц	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ч	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ш	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Щ	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ъ	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ы	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ь	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Э	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Ю	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	
Буфер Я	1 шт. (1 шт.)	6012	интактны	

«ГепатитФ-Анти-НСУ»
г. Санкт-Петербург, Звенигородский пр., д. 40, лит. А
Телефоны: (812) 671-4759

Набор реагентов для качественного иммуноферментного анализа антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ»
им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Набор реагентов для качественного иммуноферментного анализа антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ» им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023 (далее - набор реагентов) предназначен для качественного иммуноферментного анализа (ИФА) в формате 96 лунок для выявления антител к вирусу гепатита С (Анти-НСУ) в сыворотке крови человека. Набор реагентов предназначен для использования в автоматизированной системе анализа на платформе Abbott Architect i1200 (Abbott Molecular Inc., USA).

2. СОСТАВ НАБОРА
2.1. Состав набора реагентов для качественного иммуноферментного анализа антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ» им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023 (далее - набор реагентов) включает в себя следующие компоненты:

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3.1. Набор реагентов для качественного иммуноферментного анализа антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ» им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023 (далее - набор реагентов) должен храниться в оригинальной упаковке при температуре от +2 до +8 °C.

4. СРОК ГОДНОСТИ
4.1. Срок годности набора реагентов для качественного иммуноферментного анализа антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ» им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023 (далее - набор реагентов) составляет 12 месяцев со дня изготовления.


АЛКОР БИО

ГепатитФ-Анти-НСУ

Набор реагентов для качественного иммуноферментного анализа антител к вирусу гепатита С «ГепатитФ-Анти-НСУ»
им. ТУ 21.20.23-686-9603446-2023

СОСТАВ НАБОРА:

Наименование	Единица измерения	Срок годности
Стрипы с реакционными элементами	1 шт.	6012
Оптический планшет (96 лунок)	1 шт.	6012
Буфер А	1 шт.	6012
Буфер В	1 шт.	6012
Буфер Г	1 шт.	6012
Буфер Д	1 шт.	6012
Буфер Е	1 шт.	6012
Буфер Ж	1 шт.	6012
Буфер З	1 шт.	6012
Буфер И	1 шт.	6012
Буфер К	1 шт.	6012
Буфер Л	1 шт.	6012
Буфер М	1 шт.	6012
Буфер Н	1 шт.	6012
Буфер О	1 шт.	6012
Буфер П	1 шт.	6012
Буфер Р	1 шт.	6012
Буфер С	1 шт.	6012
Буфер Т	1 шт.	6012
Буфер У	1 шт.	6012
Буфер Ф	1 шт.	6012
Буфер Х	1 шт.	6012
Буфер Ц	1 шт.	6012
Буфер Ч	1 шт.	6012
Буфер Ш	1 шт.	6012
Буфер Щ	1 шт.	6012
Буфер Ъ	1 шт.	6012
Буфер Ы	1 шт.	6012
Буфер Ь	1 шт.	6012
Буфер Э	1 шт.	6012
Буфер Ю	1 шт.	6012
Буфер Я	1 шт.	6012

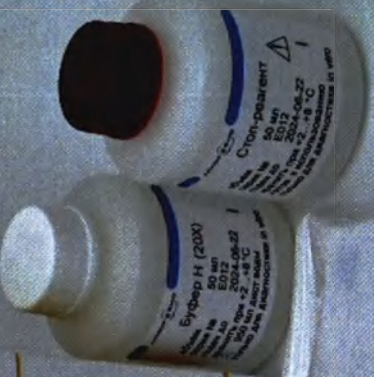

Стрипы с реакционными элементами
ГепатитФ-Анти-НСУ
серия ED12
Каталог № 2024-06-23
Срок годности: 12 мес.
Температура хранения: +2...+8 °C



ООО «Синтез»
 125080, Москва, ул. Мухоморова, д. 10
 Тел: (495) 707-00-00
 E-mail: info@synthesis.ru
 Сайт: www.synthesis.ru

Инструкция по применению
 препарата «Гриппин-анти-НСН»

Параметр	Единица измерения	Значение
Активность	МЕ/мл	1000
Содержание	г/мл	0,1
Срок годности	лет	2
Условия хранения		в холодильнике

ООО «Синтез»
 125080, Москва, ул. Мухоморова, д. 10
 Тел: (495) 707-00-00
 E-mail: info@synthesis.ru
 Сайт: www.synthesis.ru

Инструкция по применению
 препарата «Гриппин-анти-НСН»


Гриппин-анти-НСН
 Гриппин-анти-НСН

Состав: активный компонент, вспомогательные вещества.

Форма выпуска: порошок для приготовления раствора.

Срок годности: 2 года.



Условия хранения: в холодильнике.

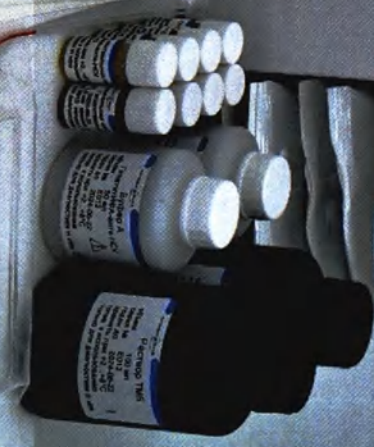



АЛКОР БИО

Стрипы с рекомбинантными
антигенами вируса гепатита С
ГепатитИФА-анти-НСV
серия № **E012**
годен до 2024-06-22
хранить при +2...+8 °С
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

1001

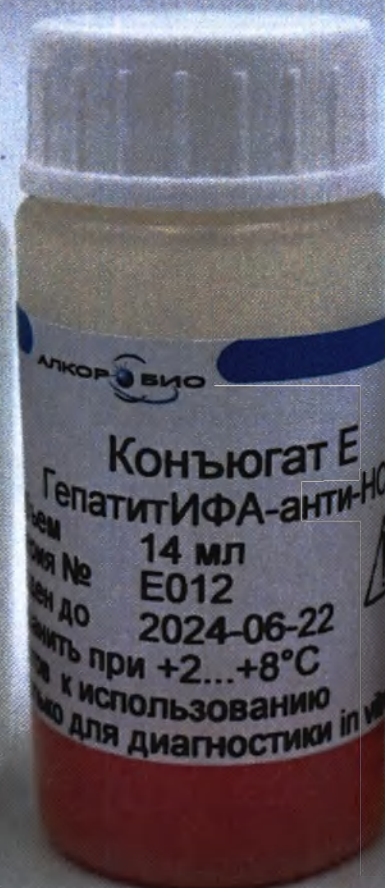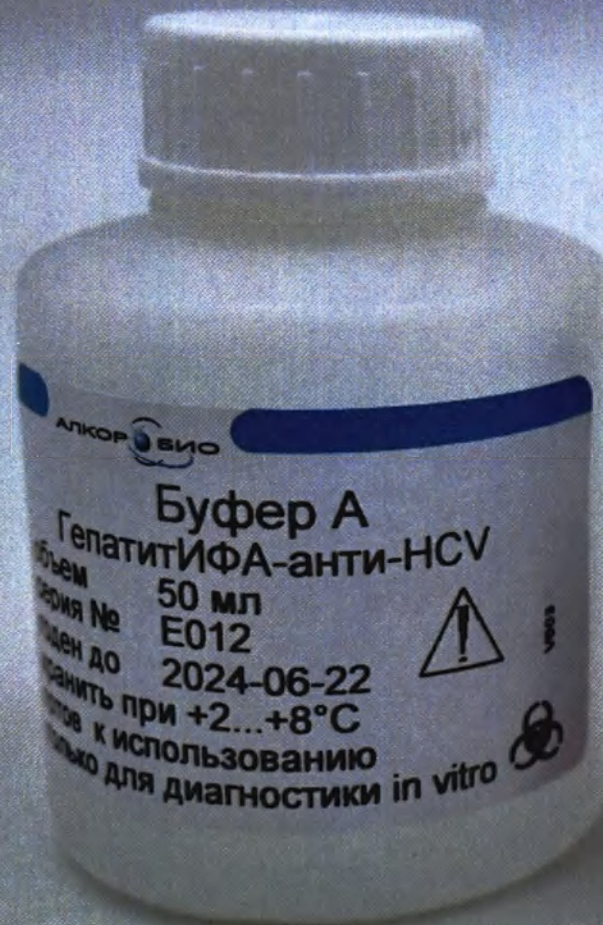

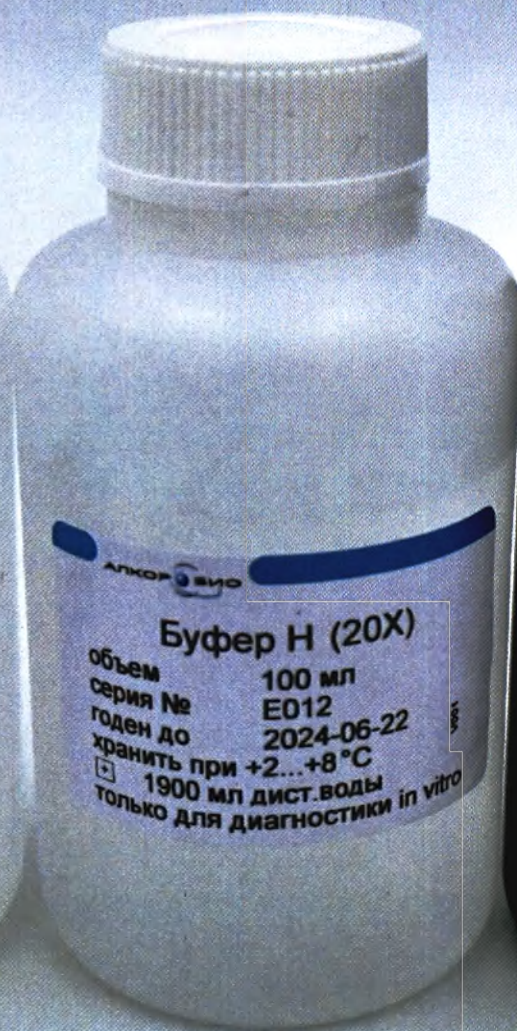

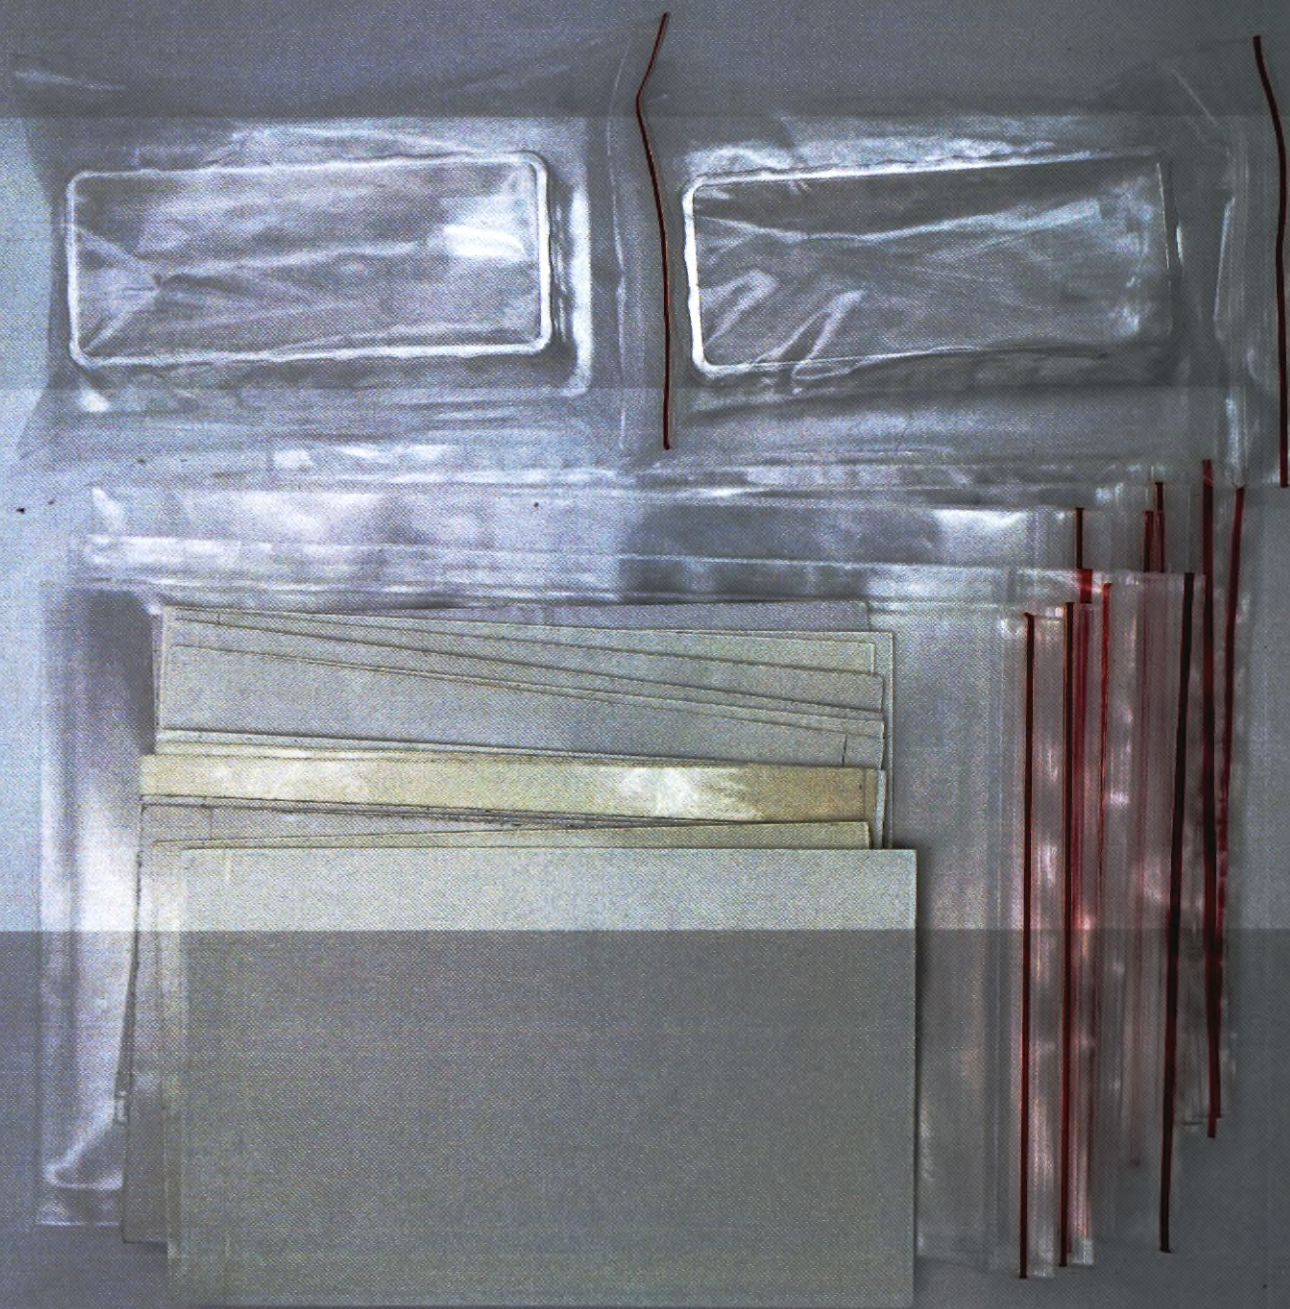

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (*два*) листа *8*

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

