

OK

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с п COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения
производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

BILT3

cobas c111


REF 05795648190

Bilirubin Total Gen.3

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany



H290,H314,H360FD,P201,
P280,P303+P361+P353,
P304+P340+P310,
P305+P351+P338+
P310,P308+P313



CONTENT

R1 REAGENT 4 x 14 mL

SR REAGENT 4 x 4 mL

 4 x 100

IVD

CE 0123


 2-8 °C

 dialog.roche.com

03

cobas®

Вариант1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c 111), 4x100 тестов

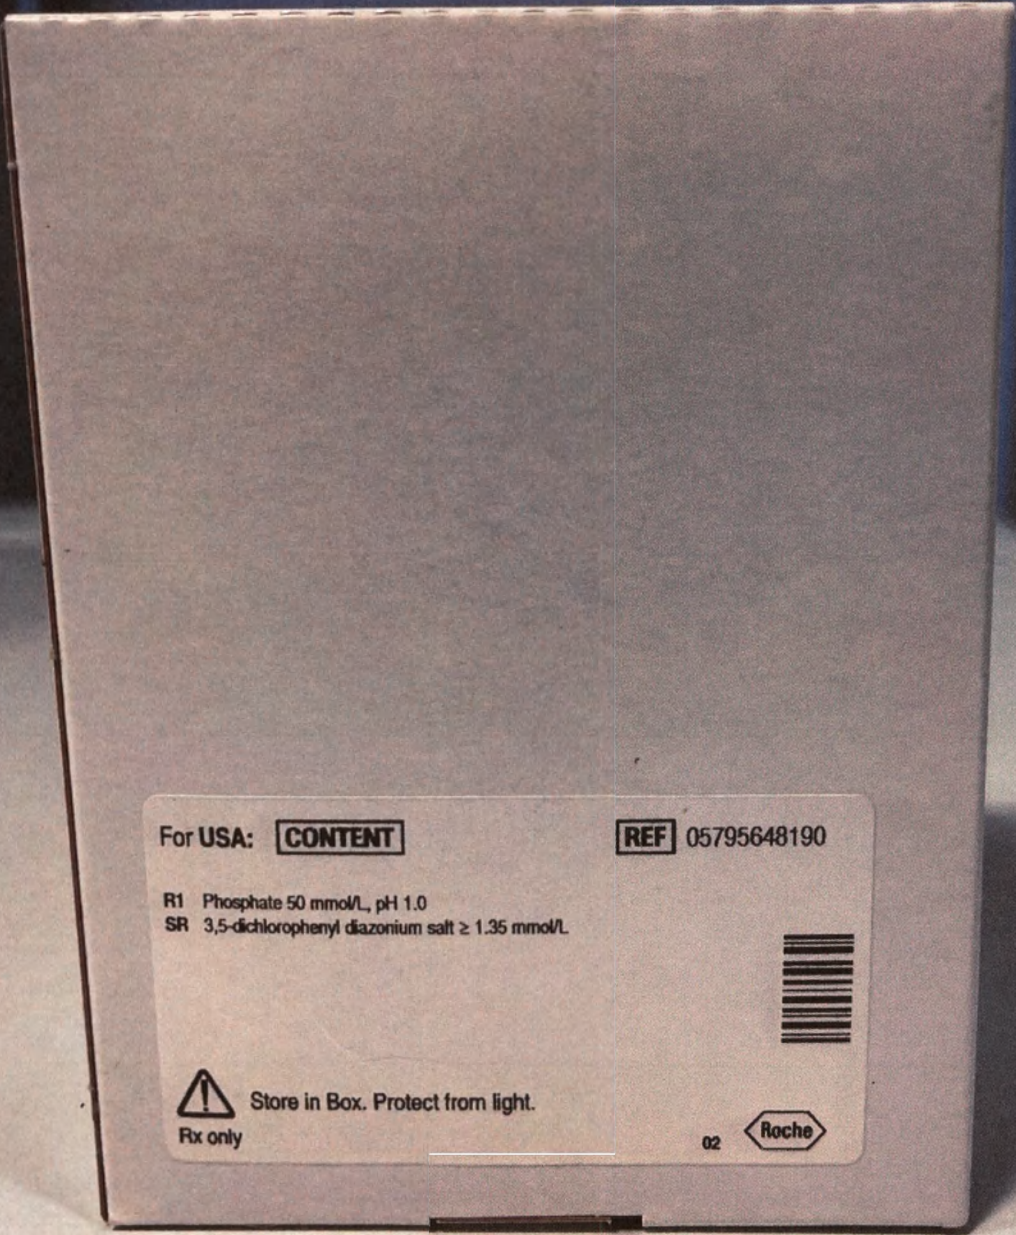

Вариант1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c 111), 4x100 тестов

-Реагент R1, флакон объемом 14 мл, 4 шт.



Вариант 1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c 111), 4x100 тестов

- Реагент SR, флакон объемом 4 мл, 4 шт.



Вариант 1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c 111), 4x100 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c 111), 4x100 тестов, в составе:

- 1. Реагент R1, флакон объемом 14 мл, 4 шт.
- 2. Реагент SR, флакон объемом 4 мл, 4 шт.
- 3. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05795648190

Вариант 1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas с 111), 4x100 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Реагенты во флаконах (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas с 111), 4x100 тестов, в составе:

- 1. Реагент R1, флакон объемом 14 мл, 4 шт.
- 2. Реагент ER, флакон объемом 4 мл, 4 шт.
- 3. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № PZN 20164831 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке


Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Дианостикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Надлежащим образом предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостикс Рус» (ООО «Рох Дианостикс Рус»), 107031, Москва, Трубиня тинашв, д.2 Тит: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кит номер 05795648190

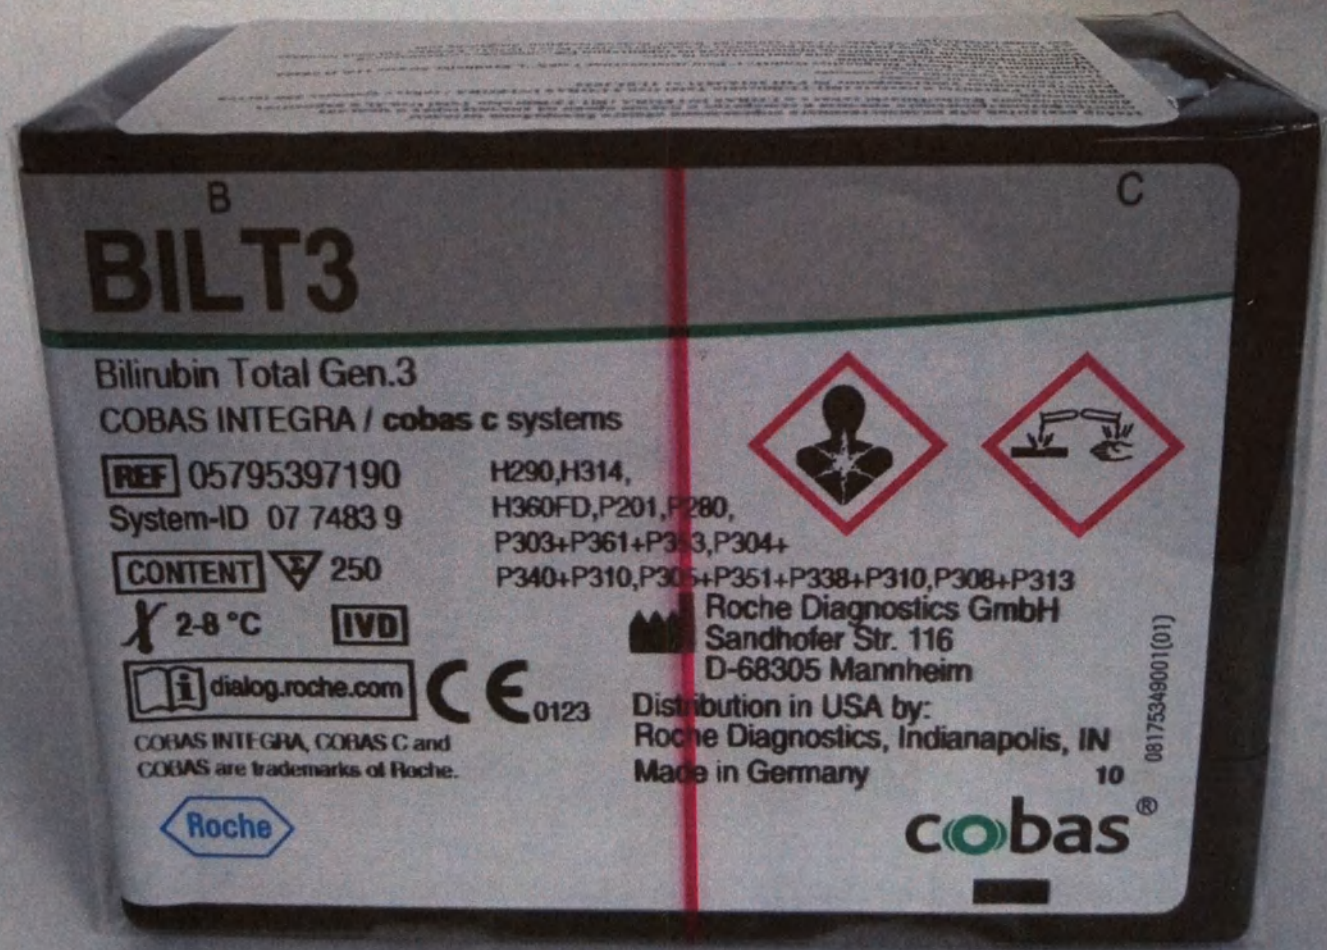

B
BILT3

Bilirubin Total Gen.3
COBAS INTEGRA / **cobas c** systems


REF 05795397190
System-ID 07 7483 9

CONTENT 250

2-8 °C **IVD**

dialog.roche.com

COBAS INTEGRA, COBAS C and COBAS are trademarks of Roche.



H290,H314,
H360FD,P201,P280,
P303+P361+P353,P304+
P340+P310,P305+P351+P338+P310,P308+P313



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

cobas[®]

10

081753A9001(01)





Вариант 2. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems), 250 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems), 250 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от 11.05.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат. номер 05795397190

Вариант 2. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems), 250 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 COBAS INTEGRA / cobas c systems), 250 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05795397190

8

BILT3

Bilirubin Total Gen.3

cobas c systems

REF 05795419190

System-ID 05 7483 9

CONTENT $\Sigma 600$

$\chi_{28^{\circ}\text{C}}$



dialog.roche.com

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.

CE⁰¹²³

0123

H230,H314,
H360FD,P201,P280,
P303+P361+P353,P304+
P340+P310,P305+P351+P338+P310,P308+P313

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

8

cobas®

08175349001(01)

Вариант 3. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 600 тестов



Вариант 3. Реагенты в касете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 соhas с systems), 600 тестов

BILT3

REF (240)05795419190

For USA: Rx Only

LOT (10)70123801

 2024-09-30

 2023-05-08



For USA: Store upright



EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

UDI



GTIN (01)04015630928903



07

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 3. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 600 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от 11.05.2022

Срок годности см. на упаковке,

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer

Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05795419190

Вариант 3. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 600 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 3. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 600 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от _____

Срок годности см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 05795419190

B
BILT3

Bilirubin Total Gen.3

cobas c systems

REF 08056960190

System-ID 20 3100 1

CONTENT  1050

 2-8 °C

IVD

 dialog.roche.com

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.



H290, H314,
H360FD, P201, P280,
P303+P361+P353, P304+
P340+P310, P305+P351+P338+P310, P308+P313

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

CE 0123



cobas [®]

08175349001(01)

Запіант 4. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 1050 тестов



BILT3

[REF] (240)08056960190

For USA: Rx only

[LOT] (10)62228101

 2023-09-30


 2022-05-04

[UDI]



[GTIN] (01)07613336121078

03


For USA: Store upright


EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336



Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 4. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 1050 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от 11.05.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08056960190

Вариант 4. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 1050 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), в вариантах исполнения:

Вариант 4. Реагенты в кассете (BILT3/Bilirubin Total Gen.3 cobas c systems), 1050 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4831 от _____

Срок годности см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08056960190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
23 листа (ов)

