

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»
Кизилова А.М.
2023



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат искусственной вентиляции легких V3
Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал
Инструментс Ко., Лтд.»), Китай.

2023 г.



Блок основной V3. Ракурс 1.



Блок основной V3. Ракурс 2.



Блок основной V3. Ракурс 3.





Фото маркировки изделия: Блок основной V3



Кабель питания

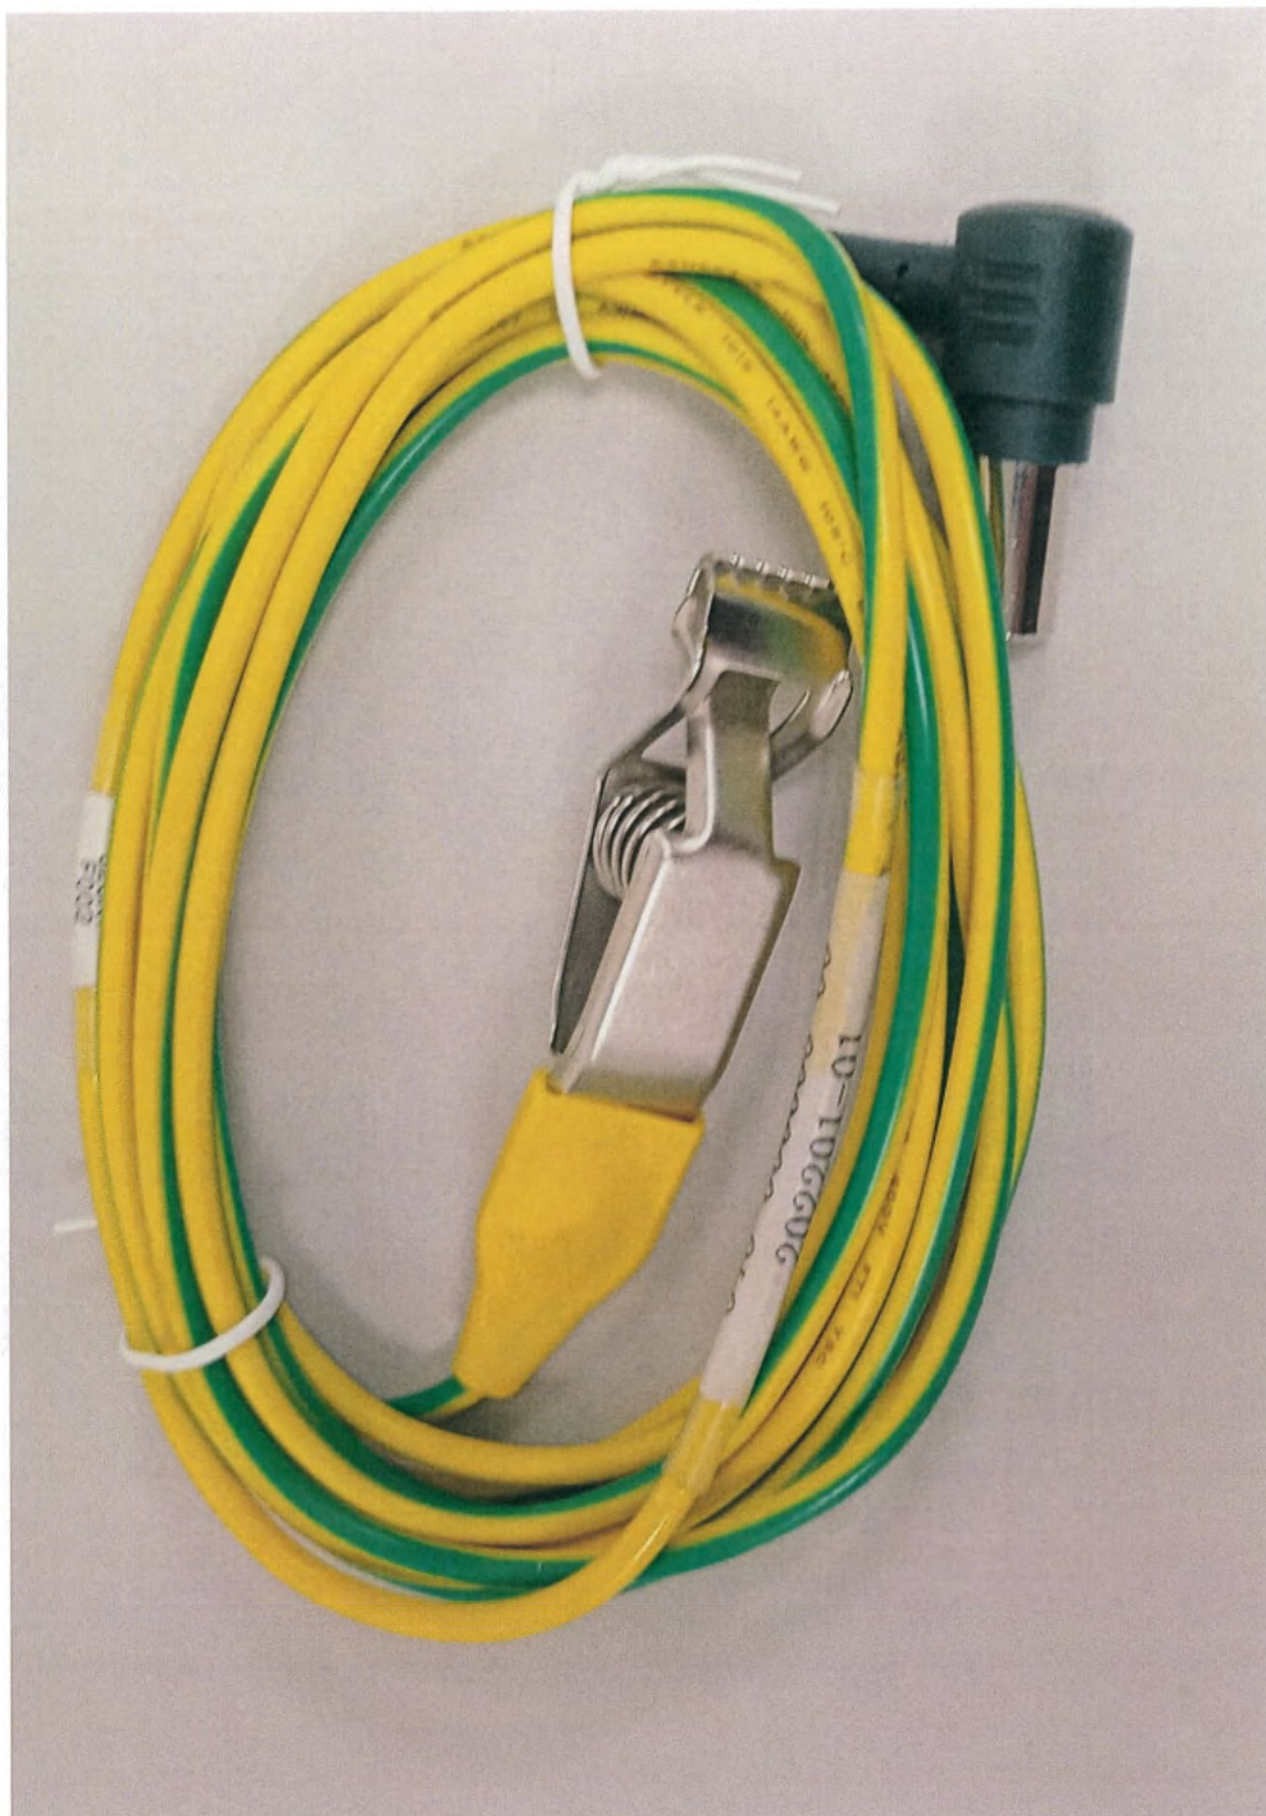

Кабель заземления

Фото маркировки упаковки: Кабель заземления

COMEN 可充电锂电池
Rechargeable Li-ion Battery

Model(型号): CMLI2X4I001B
14.4V === 6700mAh/96.48Wh



4INR19/66-2
中国制造
MADE IN CHINA

警告:


使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。切勿放置于60°C(140°F)以上的高温环境中。在-20°C(-4°F)至60°C(140°F)温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。推荐使用的最高环境温度为45°C(125°F)。

CAUTION:

Risk of fire, explosion, or burns. Do not crush, puncture, disassemble or short circuit the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. Do not place the battery in an environment whose temperature is above 60°C (140°F). Store the battery in the -20°C (-4°F) to 60°C(140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use. Maximum Recommended Ambient is 45°C(125°F).



SN



S/N:LA20210702002224

深圳市科曼医疗设备有限公司
Shenzhen COMEN Medical Instruments Co., Ltd



E-022-000203-00/

4600004211/21090100256

Батарея аккумуляторная

 19.10.2021  19.10.2031  022-000203-00  202240502

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA
Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen,
Guangdong, 518106, P.R.China

Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA
Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen,
Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ» Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21,
ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ. 6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон
+7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79

См. оригинальную маркировку



Тележка

Основание тележки



08.03.2022



08.03.2032



REF 115-00001035-00



LOT 220100168

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»),
Kunshan

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanshan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Tel: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»),
Kunshan


Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanshan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А,
часть помеш. 6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79

Фото маркировки: Основание тележки



Стойка

08.03.2022



08.03.2032



115-00001035-00

LOT 220100168

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236
E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»),
Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Кишиневская, дом 2 литера А,
часть помещ. 6Н с ном. 39/49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79

Фото маркировки: Стойка



Набор винтов



Держатель дыхательных контуров

Держатель для дыхательных контуров

 01.02.2022  01.02.2032  118-00000076-00  4600004197

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:


Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А,
часть помещ. 6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



Корзина

Корзина

 08.03.2022  08.03.2032 **REF** 115-00000562-00 **LOT** V201107016

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд»),
Китай

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А,
часть помещ. 6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



Шланг для кислорода

捷锐工业 (上海) 有限公司
上海 松江区文吉路 499 号
电话: 021-67727123, 021-67727176
传真: 021-67727176, 021-67727176
www.gentec.com

FOR OXYGEN USE

Шланг для кислорода

24.12.2021 24.12.2031 REF 040-000848-00 LOT 4600004159 CE 0123

Gentec (Shanghai) Corporation

Add: No. 499 Wenji Road, Songjiang District, Shanghai 201616, P.R.C

Tel: 021-67727123, 021-67727176 Fax: 021-67727176, 021-67727176

Website: www.gentec.com E-mail: info@gentec.com.cn

EC REP MedNet EC-REP GmbH

Add: Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany

Tel: +49 251 32266-0 Fax: +49 251 32266-22

E-mail: burthe.barms@mednetec.com

CE 0123

Фото маркировки упаковки: Шланг для кислорода



Шланг для воздуха

Шланг для воздуха

 09.01.2022  09.01.2032  REF 082-000387-00  LOT 460005112  i  CE 0123




Gentec (Shanghai) Corporation

Add: No. 499 Wenji Road, Songjiang District, Shanghai 201616, P.R.C

Tel: 021-67727123, 021-67727722 Fax: 021-67727176, 021-67727754

Website: www.gentec.com E-mail: info@gentec.com.cn




MedNet EC-REP GmbH

Add: Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany

Tel: +49 251 32266-0 Fax: +49 251 32266-22

E-mail: birthe.harms@mednet-europe.com





Фильтр одноразовый

Фильтр одноразовый

29.05.2021 29.05.2024 REF 040-001540-00 LOT M-21120817 STERILEO

VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei
VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan
No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan
Tel: +886-3-475-9911
E-mail: sales@vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922
Website: www.vadimedical.com.tw

ec REF Obelis S.A.
Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@obelis.net

код

1. Проверьте, чтобы упаковка была герметичной, в противном случае не используйте.
2. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
3. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.
4. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
5. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.

1. Проверьте, чтобы упаковка была герметичной, в противном случае не используйте.
2. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
3. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.
4. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
5. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.

1. Проверьте, чтобы упаковка была герметичной, в противном случае не используйте.
2. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
3. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.
4. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
5. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.

1. Проверьте, чтобы упаковка была герметичной, в противном случае не используйте.
2. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
3. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.
4. Не используйте продукт, если он поврежден или истек срок годности.
5. Не используйте продукт, если он загрязнен или поврежден.

Фото маркировки упаковки: Фильтр одноразовый



Хомуты для шлангов с червячным приводом

Хомуты для шлангов с червячным приводом

 15.12.2021  15.12.2024  REF 034-000006-01  LOT 20220520-1077

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru


Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ.
6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



Легкое тестовое одноразовое

Фото маркировки упаковки: Легкое тестовое одноразовое

VADI产品名称
产品类型

用途:

规格:

使用说明

1. 将呼吸器
2. 将模式
3. 设定流量
4. 观察流量

注意: 为流量

建议灭菌

生产企业

生产地址

电话: +886-3-475-9911

Website: www.vadimedical.com.tw

E-mail: mail@obelis.net

代理人信息

名称: 杭州恒通医疗设备有限公司

住所: 杭州市上城区九思巷1号

电话: 0571-86024260

保存期限: 自生产日期起三年

生产日期: 请见封口处

生产批号: 请见封口处

Легкое тестовое одноразовое

15.12.2021 15.12.2024 REF 040-001556-00 LOT M-21120103 CE 2460



VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei

No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan

E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911 Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922



Obelis S.A.

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.

Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@obelis.net

Дата изготовления

Срок годности

作 染

VADI

Breathing Reservoir Bag (Test Lung)

Specification:

Inlet Size: 5.5±0.1mmID, 15mmOD

Material: Silicone, PP

Instruction:

1. Connect breathing circuit to ventilator and perform leakage test.

2. Connect test lung to Y-connector of circuit.


3. Set tidal volume to 500ml.

4. Compliance: 22±3 ml/cmH₂O based on 500ml of tidal volume.


Caution:

1. Test lung should be cleaned and sterilized when there is

CE 2460




Легкое тестовое многоразовое





Мешок дыхательный одноразовый

Фото маркировки упаковки: Мешок дыхательный одноразовый





Мешок дыхательный многоразовый


Мешок дыхательный многоразовый

05.07.2021 05.07.2024 REF 040-001557-00 LOT 4600006852



VADI Medical Technology Co., Ltd.
No.492-19, Sec. 1, Wan Shou Rd., Kwei Shan Hsiang., Taoyuan, Taiwan
E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-2-8209-2833

REP Obelis S.A.
General Vahis 53, 1030 Brussels, Belgium.
32-2-731-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail.@obelis.net



Маска дыхательная для новорождённых одноразовая

PAIM
5312/气垫面罩 1号 含气
品名称: 输氧面罩
品编号: 5312-C01
10 082419 (30) 1 (10) 190225
械生产许20120198号
注准2016256071

Маска дыхательная для новорождённых одноразовая

06.12.2021 06.12.2024 REF 040-000700-00 LOT P019020297 2460

GaleMed Corporation
87, Li-gong 2nd Road Wu-jia, I-Lan 268, Taiwan
Производство: GaleMed (Xiamen) Co. Ltd
Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39 Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
www.galemed.com Tel: 86-592-6880588

EC REP Obelis S.A.
Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.



Маска дыхательная одноразовая для детей




Фото маркировки упаковки: Маска дыхательная одноразовая для детей



Маска дыхательная одноразовая для взрослых

Маска дыхательная одноразовая для взрослых

15.11.2021



15.11.2024

REF

040-000702-00

LOT

460004500



2460



GaleMed Corporation

87, Li-gong 2nd Road Wu-jia, 1-Lan 268, Taiwan

Производство: GaleMed (Xiamen) Co. Ltd

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39 Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China

www.galemed.com Tel: 86-592-6880588

EC REP

Obelis S.A.

Bd. General Wakis 55, 1030 Brussels, Belgium.



Контур дыхательный многоразовый для новорождённых

VADI

Контур дыхательный многоразовый для новорождённых

 13.04.2021  13.04.2024 **REF** 040-001522-00 **LOT** QT21122100007 **CE** 2460



VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei

No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan

E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911

Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922



Obelis S.A.

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.


Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail.@obelis.net

Гарантия 3 года


7. Perform the leak test of 
individual operating manual of ventilator.


Sterilization:

1. Dismantle all components except the stainless steel spring attached to the body of ventilator.



Контур дыхательный многоразовый для детей





Контур дыхательный многоразовый для взрослых

VADI

Контур дыхательный многоразовый для взрослых

30.09.2021 30.09.2024

REF

040-001542-00

LOT

22030700038 C€2460



VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei

No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan

E-mail: sales@vadi-medical.com.tw Tel: +886-3-475-9911

Website: www.vadi-medical.com.tw Fax: +886-3-475-9922


CE MDR CE

0304115 S. A.

Rd. General Wabbe 53, 1030 Brussels, Belgium

Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@robella.net

Фото маркировки упаковки: Контур дыхательный многоразовый для взрослых




Контур дыхательный одноразовый для новорождённых

品技术要水编巧 · 国械注许20182080013

VADI

Контур дыхательный одноразовый для новорождённых

30.03.2022 30.03.2024 REF 040-001521-00 LOT M-22030806 C € 2460 STERILE EO



Изделие может использоваться максимум до 7 дней.




VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei

No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan

E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911

Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922



Obelis S.A.

Bd. General Welles 53, 1030 Brussels, Belgium.


Tel: +32-2-725-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@obelis.net

说明书


一次性

产品须经环氧乙烷灭菌，严禁重复使用，严禁在监护仪上使用。产品须经环氧乙烷灭菌，严禁重复使用，严禁在监护仪上使用。

Фото маркировки упаковки: Контур дыхательный одноразовый для новорождённых



Контур дыхательный одноразовый для детей





Контур дыхательный одноразовый для взрослых

VADI

Контур дыхательный одноразовый для взрослых



18.12.2021



18.12.2024




040-001541-00



22011801296

CE 2460



Изделие может использоваться максимум до 7 дней.




VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei

No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan

E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911


Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922




Obelis S.A.

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.

Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail.@obelis.net



Оголовье размер S



Оголовье размер S

18.10.2021 18.10.2026 REF 040-00000051-00 LOT 4600012527 CE 2460

GalleMed Corporation

3, Li-gong 2nd Road Wu-jia, 1-Lan 268, Taiwan

Импортер: GalleMed (Xiamen) Co. Ltd


Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39 Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China

www.gallemed.com Tel: 86-592-6880588

EC REP Obelis S.A.

Bd. General Wabis 53, 1030 Brussels, Belgium.

Фото маркировки упаковки: Оголовье размер S



Оголовье размер L




Фото маркировки упаковки: Оголовок размер L



Канюля назальная размер S





Фото маркировки упаковки: Канюля назальная размер S



Канюля назальная размер М





Фото маркировки упаковки: Канюля назальная размер М



Канюля назальная размер L

Канюля назальная размер L

24.09.2021 24.09.2024 REF 040-001477-00 LOT RR210924N001



Beijing Rongrui-Century Science & Technology Co., Ltd.

Address: 3rd floor, West zone, No. 1 building, No. 7 Yard, Fengxian Middle Road, HaiDian District, Beijing, 100094. P. R. China

Tel: (8610)51658220

Fax: (8610) 58711218




Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany


E-mail: shholding@hotmail.com

Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Models specification and performance:



合格证
QC PASS
RR210924N001

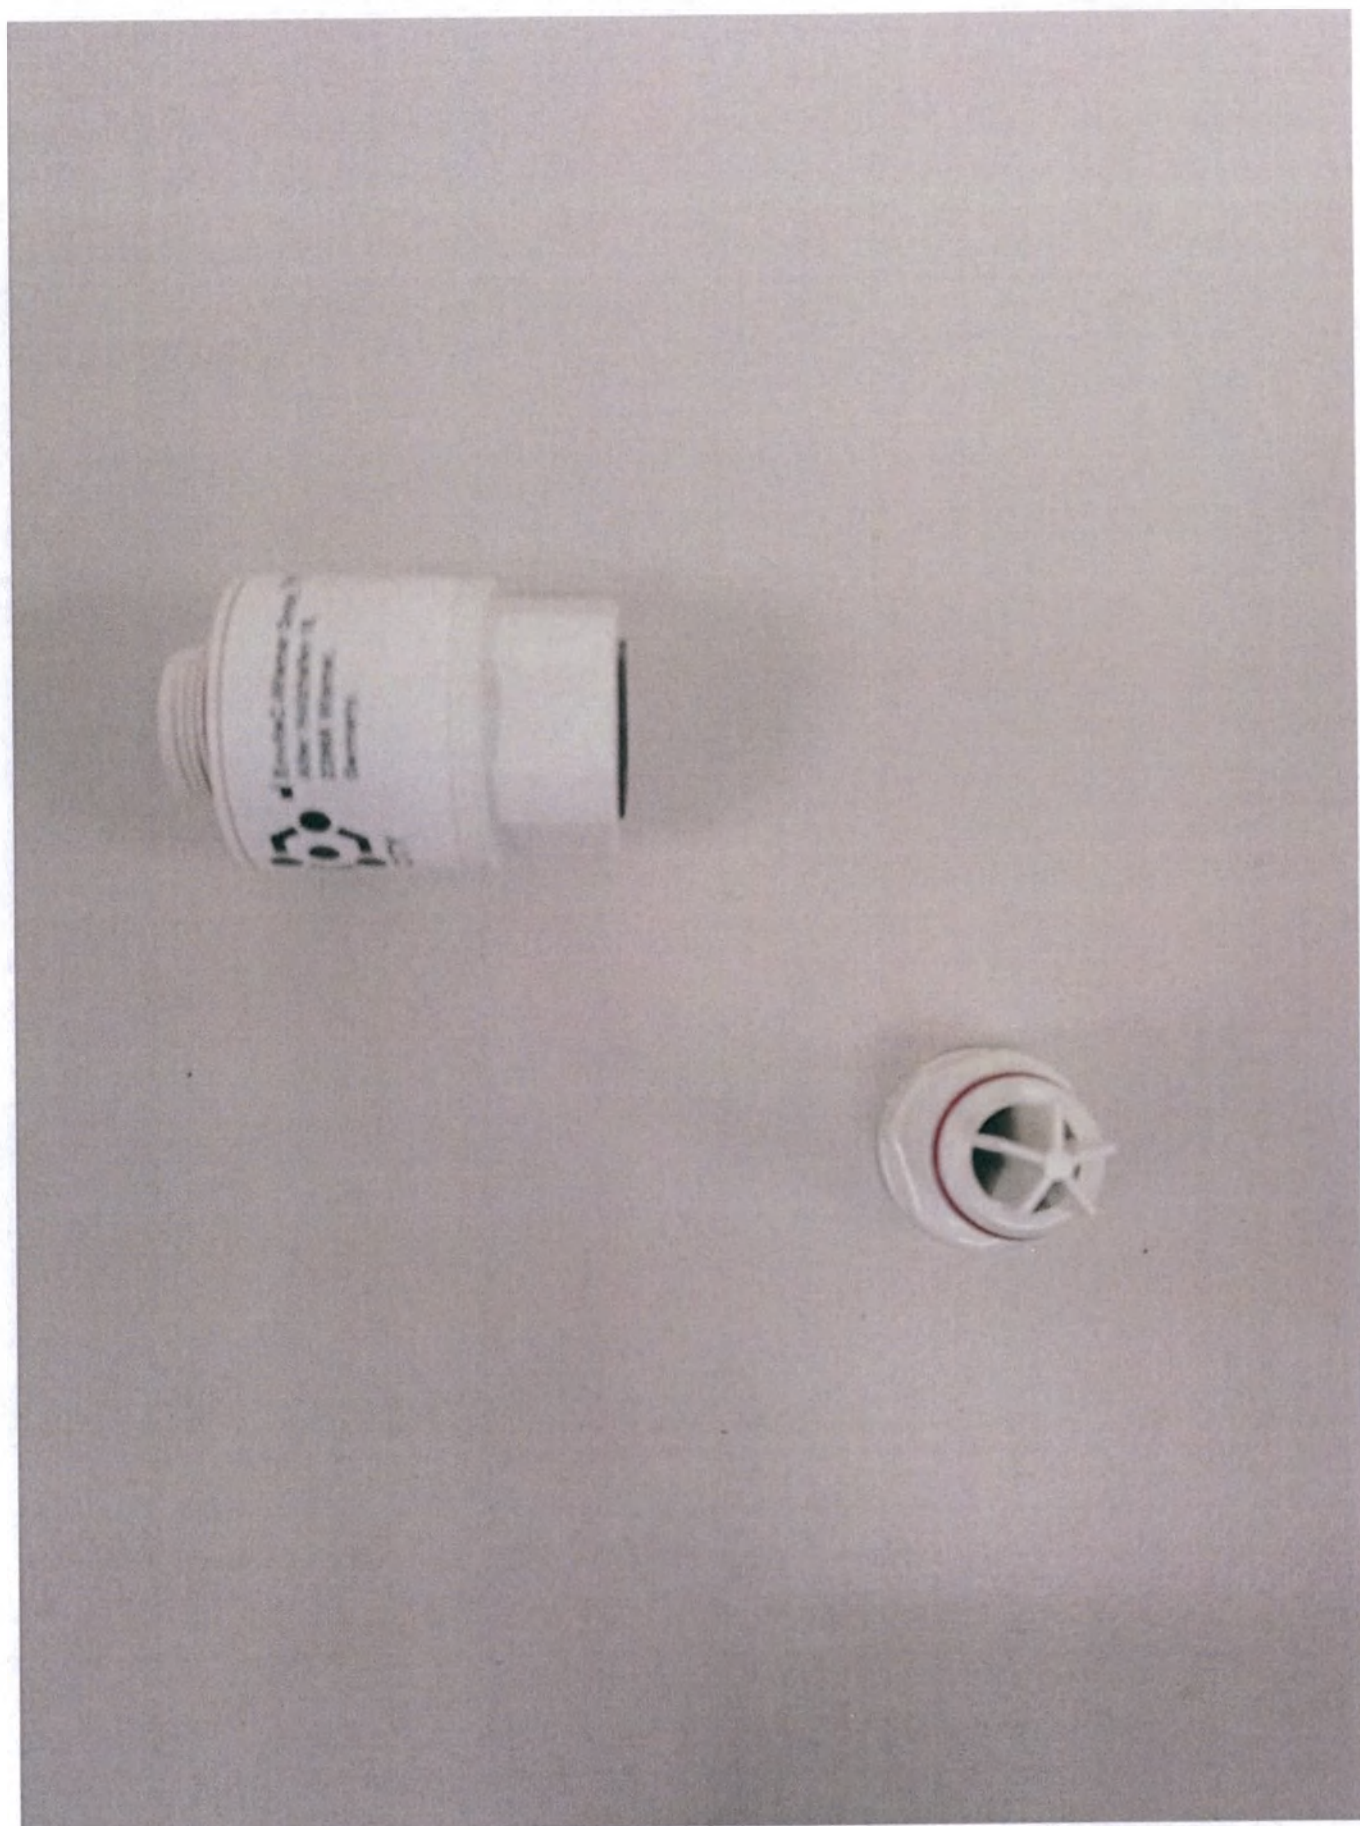


Датчик кислорода

Датчик кислорода

 11.03.2021  11.03.2024 **REF** 040-000196-00

LOT 22022500042




CE 0123




City Technology Limited

Фото маркировки упаковки: Датчик кислорода

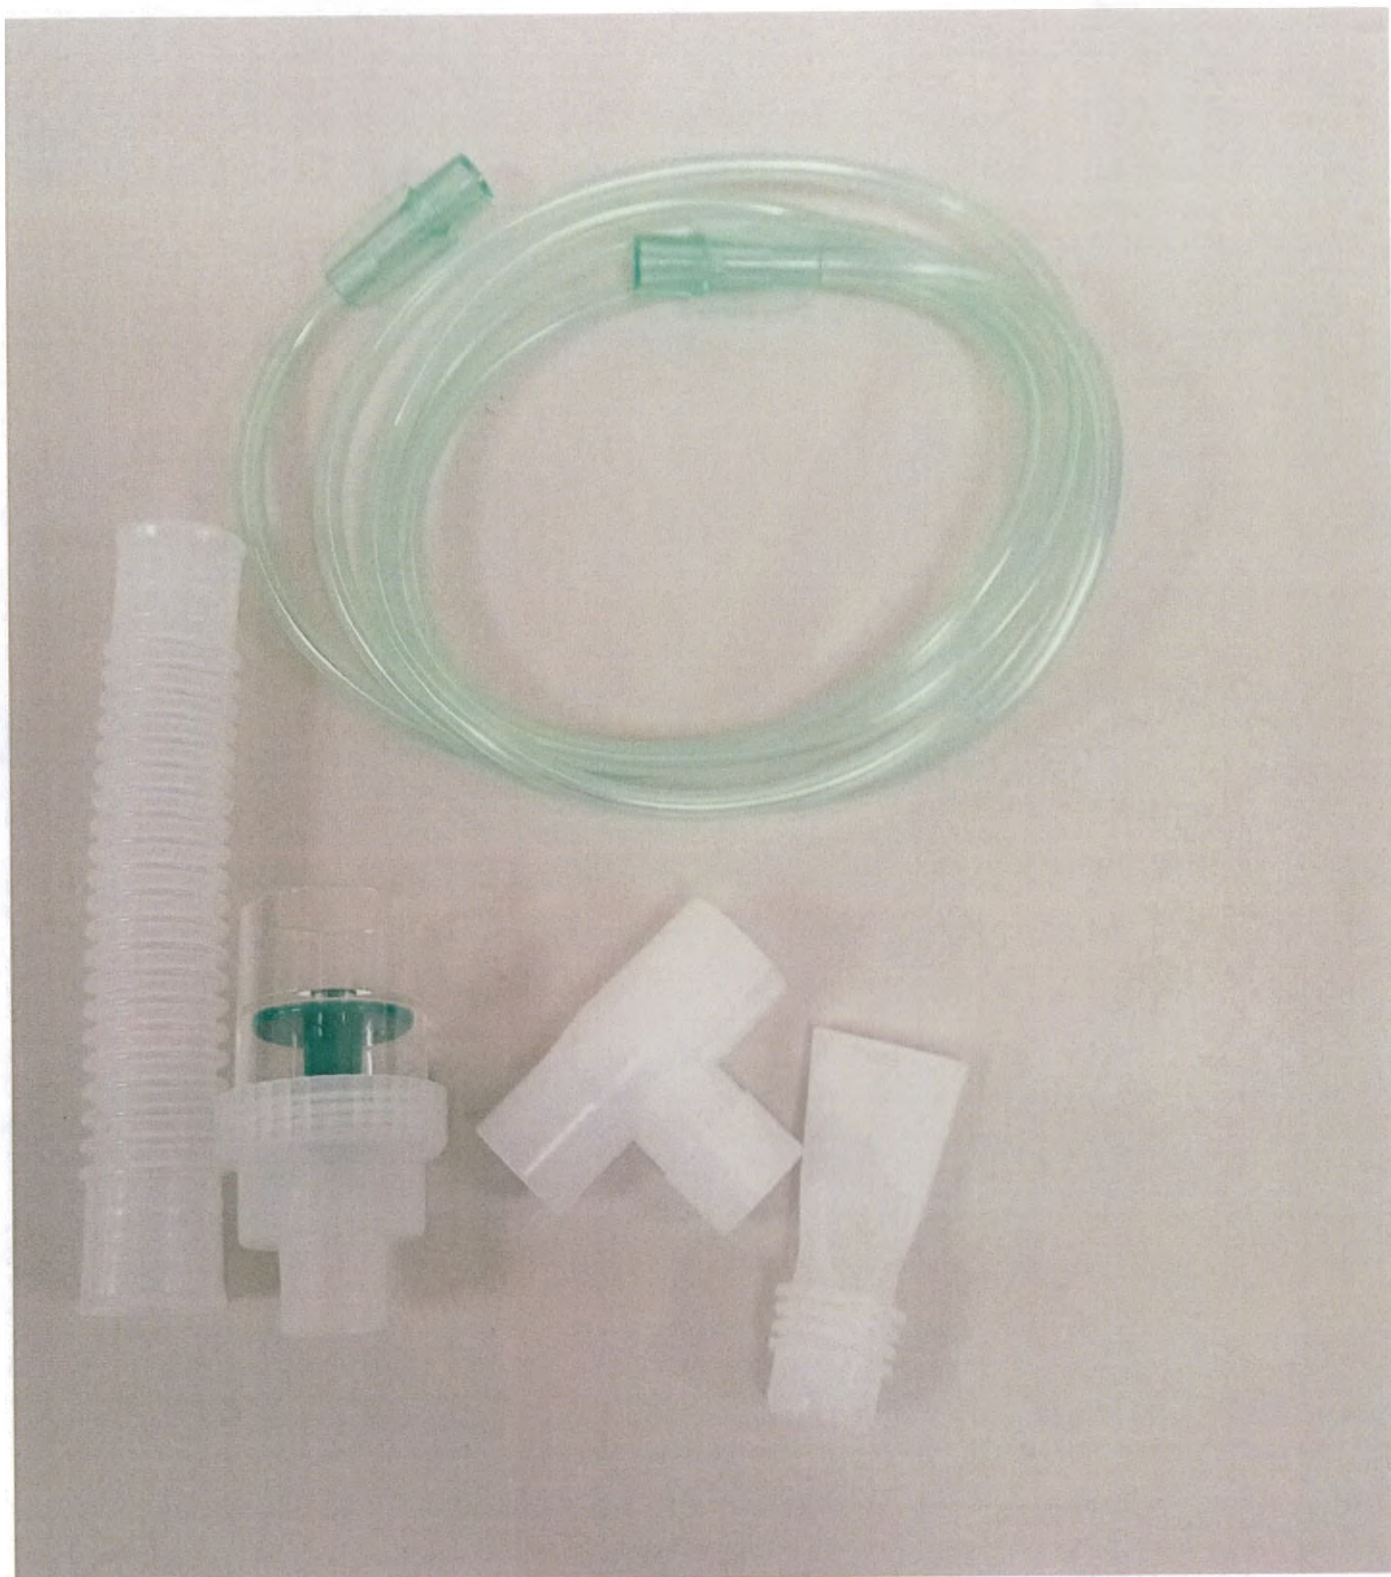

Небулайзер

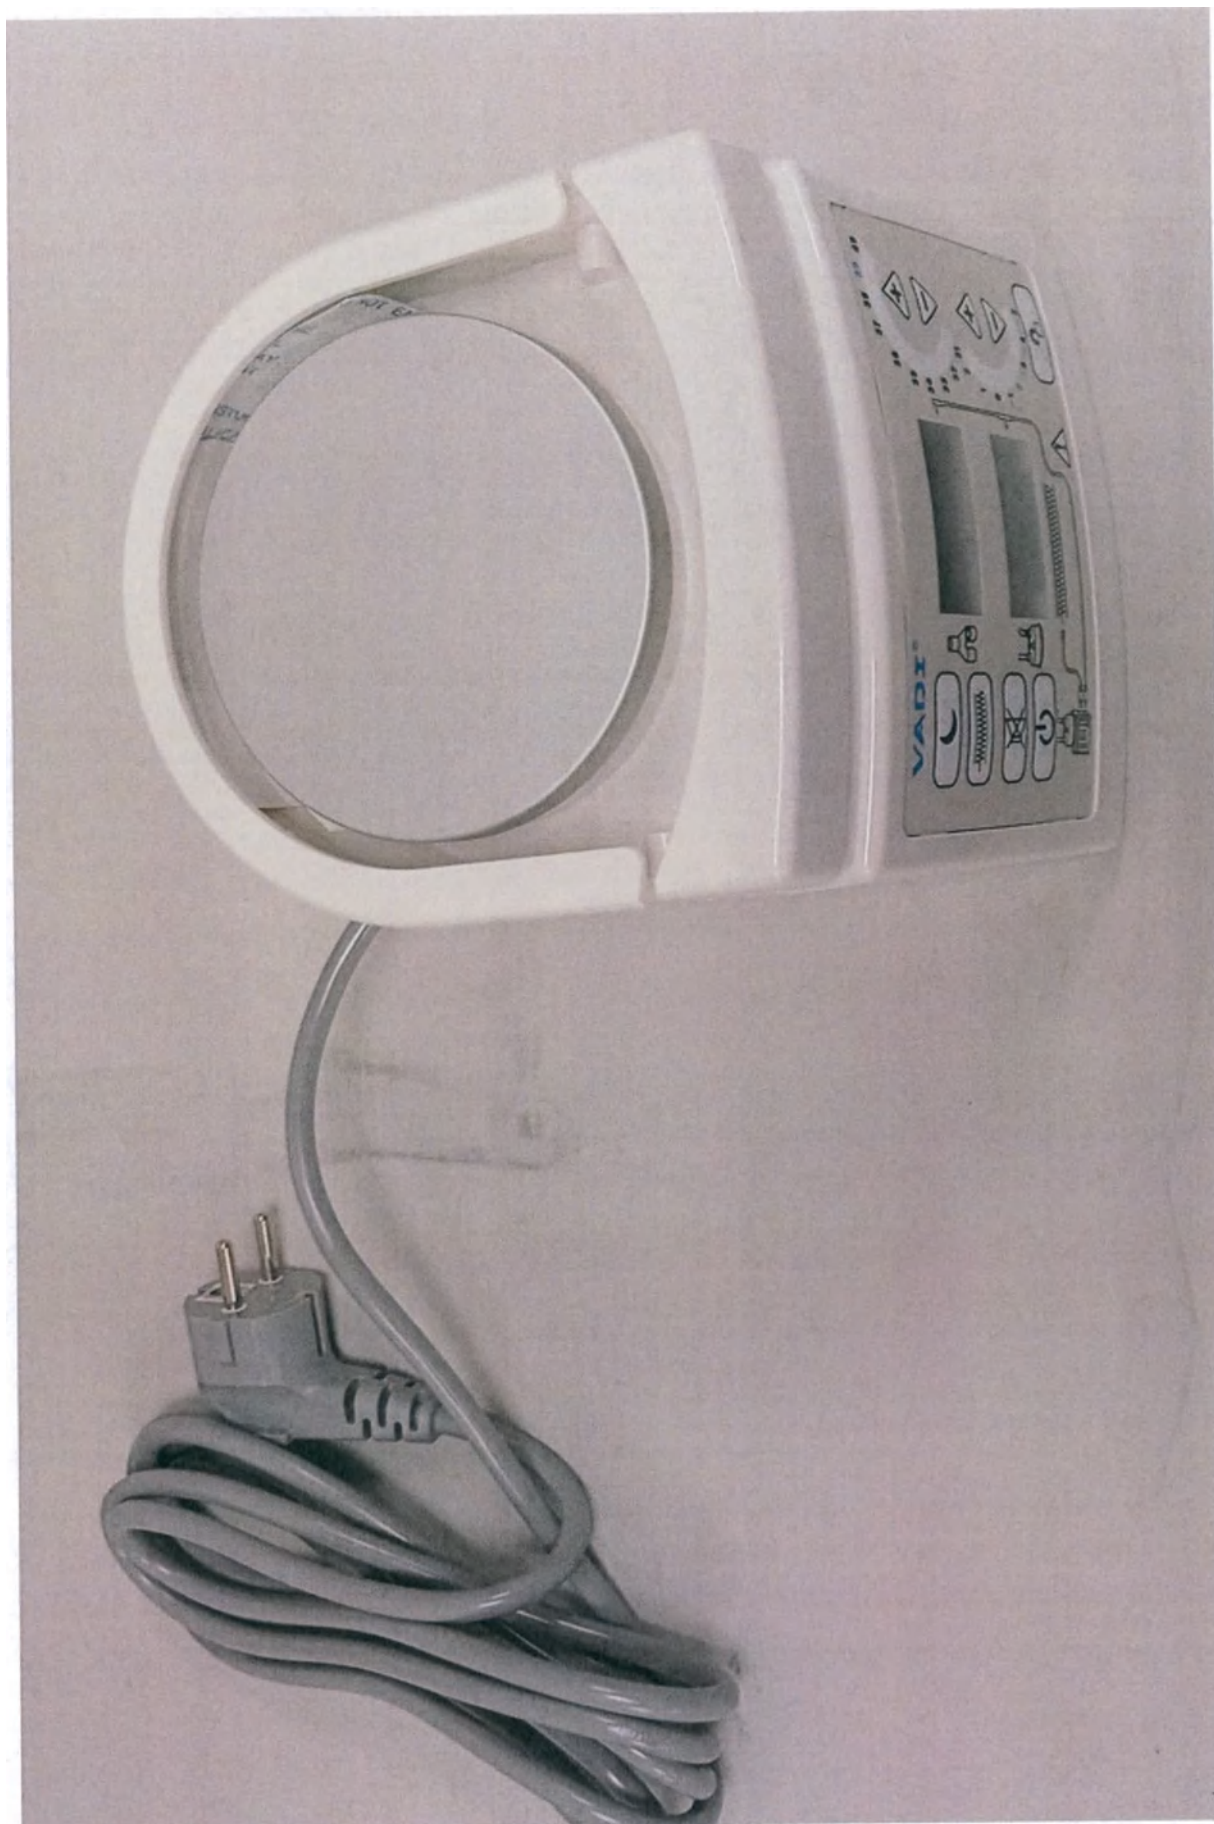

Увлажнитель



Фото маркировки: Увлажнитель



Фото маркировки: Увлажнитель

1710VAC

VADI

Увлажнитель



03.08.2021

03.08.2024

REF

040-00855-00

LOT

21082700216



VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei
No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan
E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911
E-mail: sales@vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922

Website: www.vadimedical.com.tw

EC REP Obelis S.A.

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.
Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@obelis.net

Фото маркировки упаковки: Увлажнитель



Датчик температуры

VADI

Датчик температуры

 16.09.2021  16.09.2024 **REF** 040-000801-00 **LOT** 22021900027  2460 



VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei

No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan


E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911

Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922

EC REP Obelis S.A.

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.


Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail.@obelis.net



Кабель с функцией нагрева

VADI

Кабель с функцией нагрева

 30.06.2021  30.06.2024  REF 040-000800-00  LOT 21051413  CE 2460 

 VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei
No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan
E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911
Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922


  Obelis S.A.
Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.
Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@obelis.net

ОК ГОДНОСТИ. 5 года

代理人信息:
公司名称: 北京迈达利东方医疗器械有限公司
地址: 北京市朝阳区五里桥二街1号院1号楼0423
电话: 010-67884510

生产日期: 请见封口处
有效日期: 请见封口处
制造批号: 请见封口处

Made In Taiwan
VA-0-VH30100.VD_02

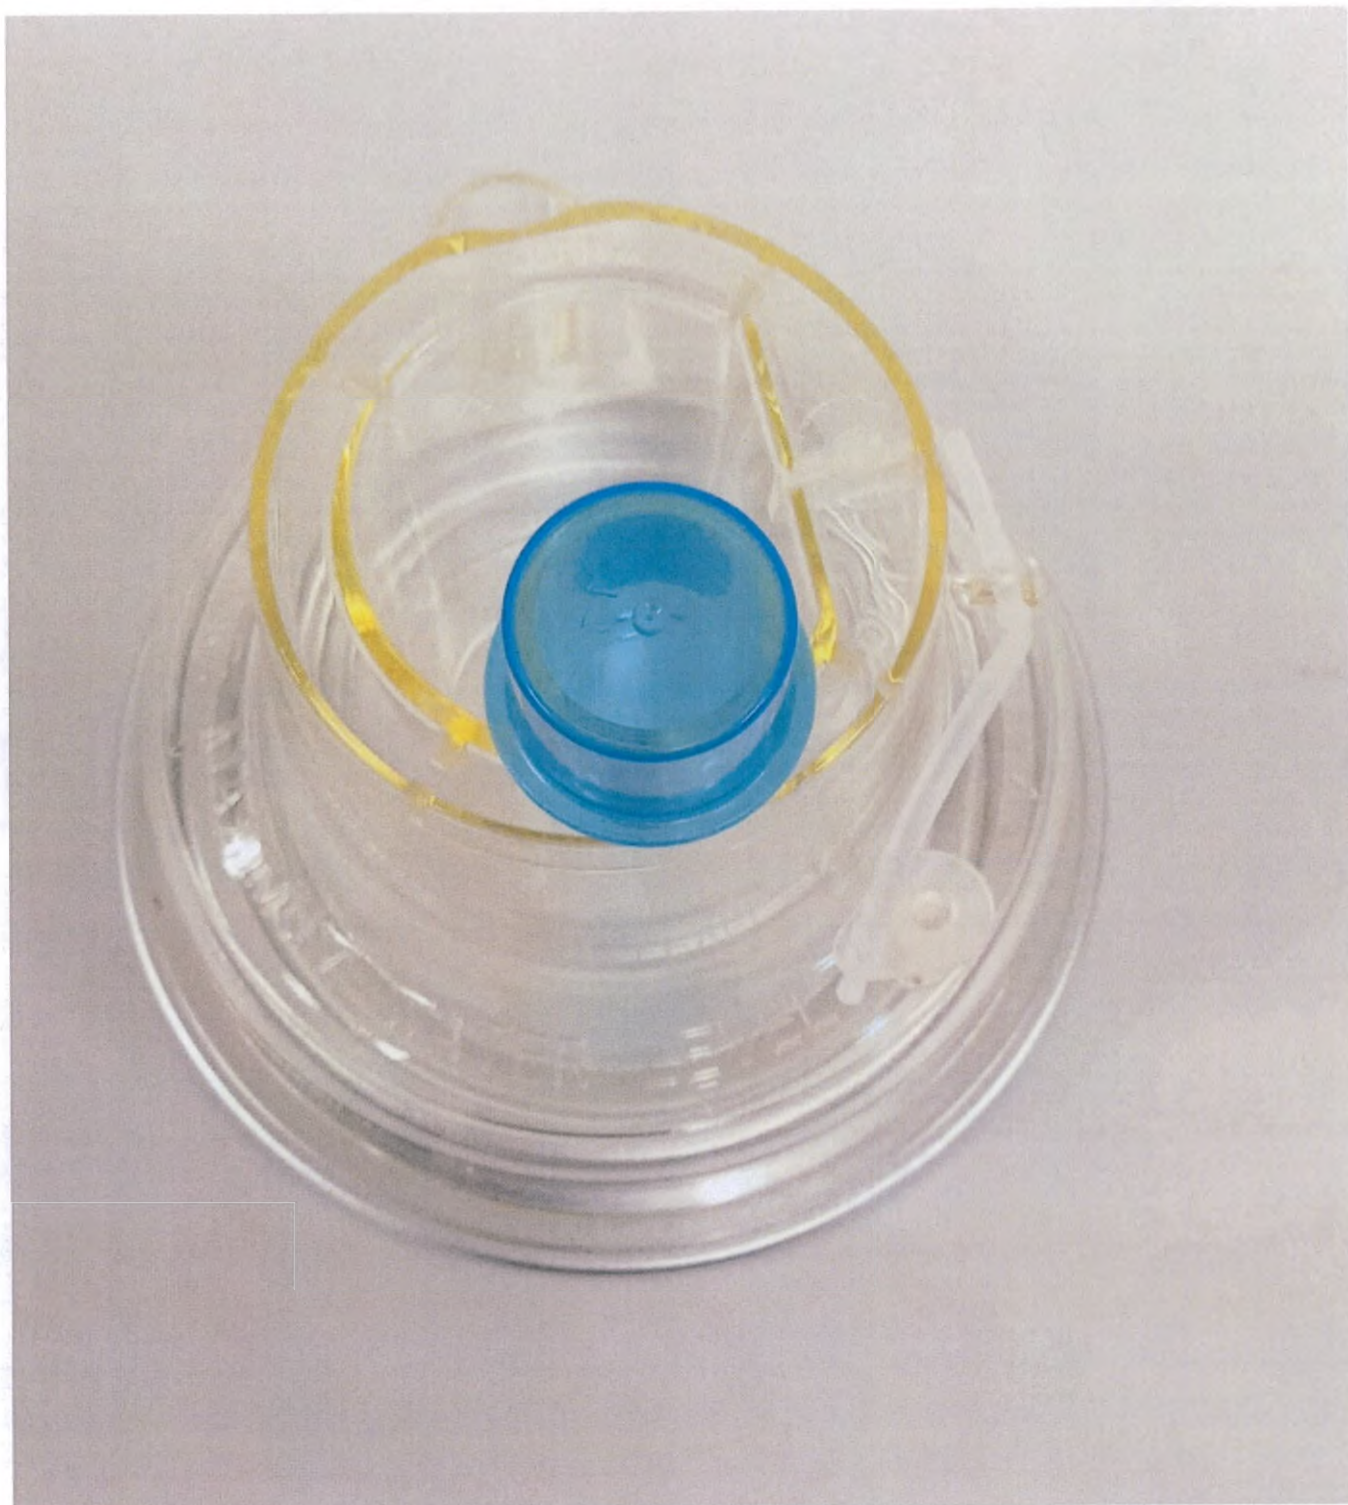

Камера водяная


VADI

Камера водяная

 04.02.2021  04.02.2024 **REF** 040-000797-00 **LOT** 21121300008 



VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei
No. 198, Ln. 298, Huandong Rd., Zhongshan Village, Yangmei Dist., Taoyuan City, Taiwan
E-mail: sales@vadimedical.com.tw Tel: +886-3-475-9911
Website: www.vadimedical.com.tw Fax: +886-3-475-9922




Obelis S.A.
Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium.
Tel: +32-2-732-5954 Fax: +32-2-732-6003 E-mail: mail@obelis.net

Срок годности 1:3



Модуль CO2 основного потока



COMEN

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., LTD.
Add: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12
of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2,
FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen,
Guangdong, 518106, P.R. China
Tel. +86-755-26408879 Fax. +86-755-26431232



IP44

Фото маркировки: Модуль CO2 основного потока

Модуль CO2 основного потока



04.08.2021



04.08.2024

REF

115-006486-00

LOT

CM01-2202230012

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China Тел.: +86-0755-
26431236 E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, в/тер.г. муниципальный округ №21, ул. Кропоткинская, дом 2 литера А, часть земель
6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, факс +7-(812) 600-82-79

Фото маркировки упаковки: Модуль CO2 основного потока



Адаптер для взрослых / детей, одноразовый

6063-00


adaptador para
mislede
pour voies
ott léger
ora per
occepre
august
a dnm
torosty

4213

etrix, LLC
192 USA
hland
Germany
3108-02 Ver C

Адаптер для взрослых / детей, одноразовый

21.10.2021 21.10.2024 REF 040-000021-00 LOT 460006799



 Respironics Novamatrix, LLC
5 Technology Drive Wallingford, CT 06492 USA


EC REP Respiration Deutschland GmbH & Co. KG

TEAR TO OPEN

RESPIRONICS
Pediatric/Adult

[illegible]

[107]

2021-04-02

Made in China



Адаптер для новорожденных/младенцев, одноразовый





Фото маркировки упаковки: Адаптер для новорожденных/младенцев, одноразовый

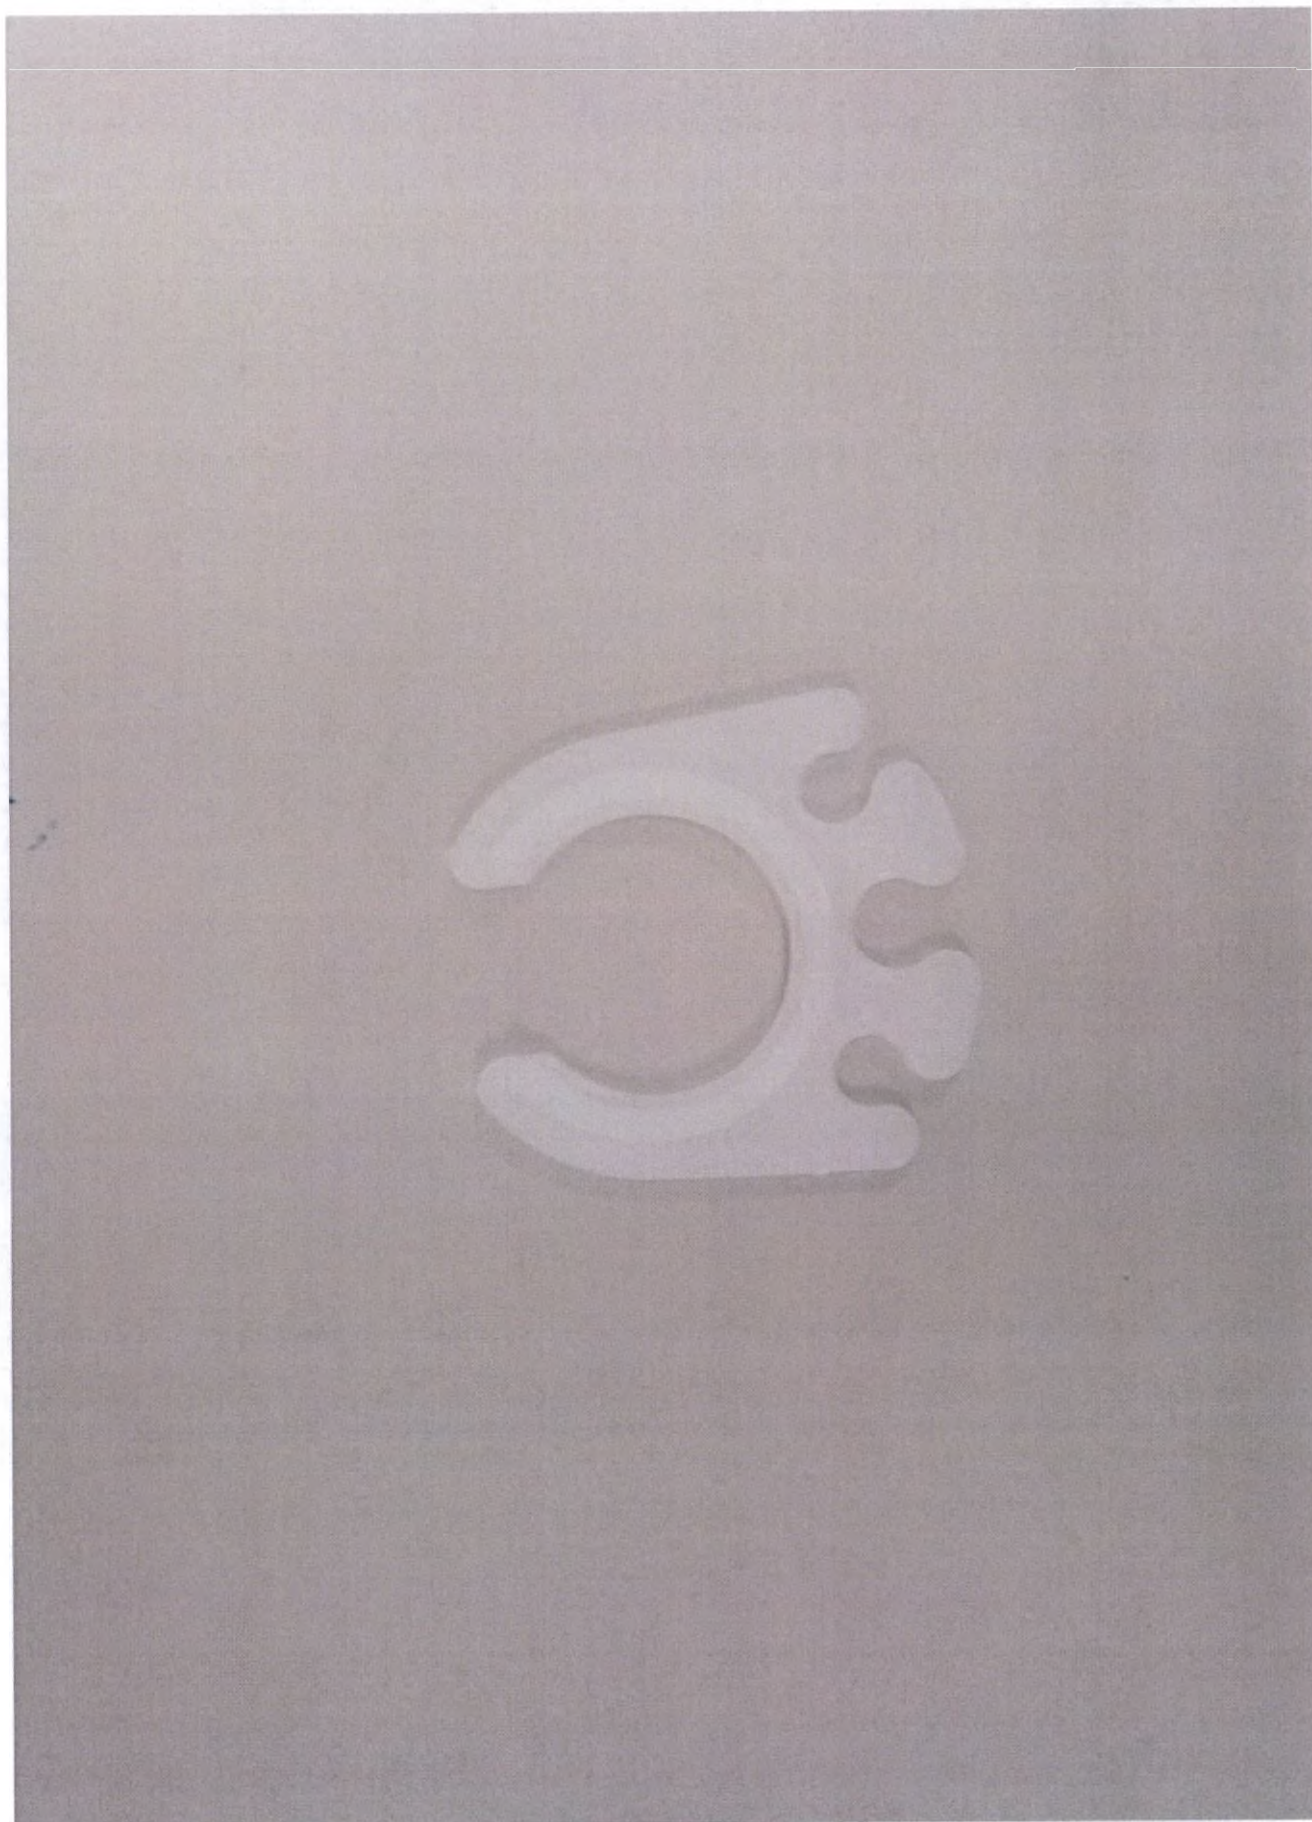

Держатель модуля

Фото маркировки упаковки: Держатель модуля

Держатель модуля



16.06.2021



16.06.2024

REF


040-000023-00

LOT

20220303-141


Производитель: Respironics California Inc

2271 Cosmos Ct, Carlsbad CA 92011

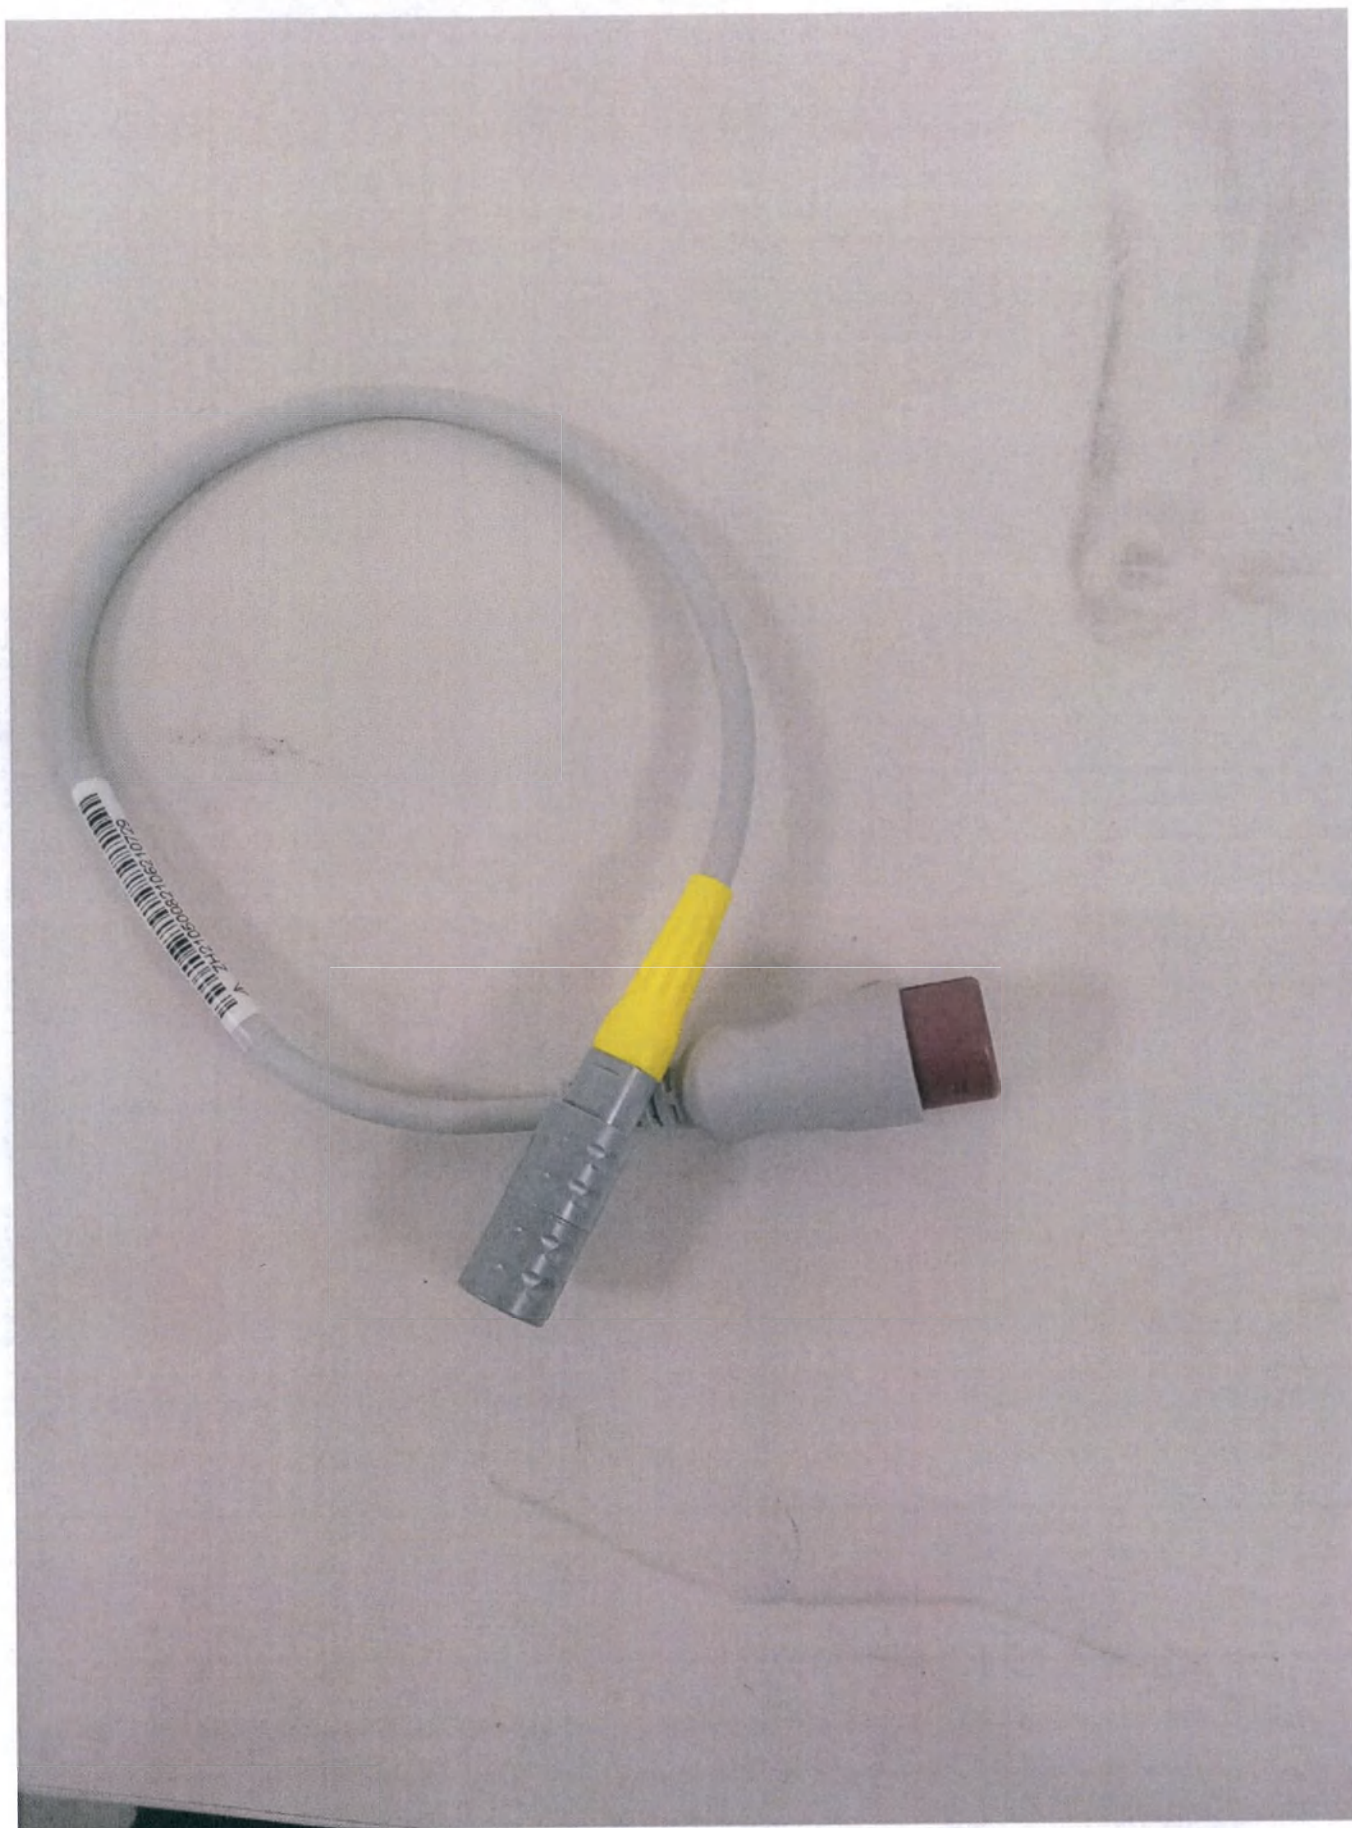

Удлинитель CO2

Удлинитель CO2



16.06.2021

16.06.2024 REF 040-0000242-01

LOT ZH21080112109010046

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медицин Инструменте Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FUYU Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Тел.: +86-0755-26431236 E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медицин Инструменте Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FUYU Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195398, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литер А, часть помещ.

ИН с нов. 500000, e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79

Фото маркировки упаковки: Удлинитель CO2



Модуль CO2 бокового потока



Влагосборник

Влагосборник

21.12.2021 21.12.2026 REF 040-001054-00 LOT 20220309-004

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шэньчжэнь Комен Медицинские Инструменты Ко., Лтд»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhai Avenue, Maian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Tel.: +86-0755-26431236 E-mail: info@comenmedical.ru


Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шэньчжэнь Комен Медицинские Инструменты Ко., Лтд»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhai Avenue, Maian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИ»
Адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, вв.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Кирпичная, дом 2 литера А, часть помещ.
631 с пом. 39/05 email: medstrateg@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79

Фото маркировки упаковки: Влагосборник



Трубка для сушки

Трубка для сушки

 07.12.2021  07.12.2026  REF 040-001055-00  LOT 20220303143

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236 E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ.
6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79




Адаптер, большой размер




Адаптер, маленький размер

Conjunto adaptador das vias aéreas
 Luftvägsadapterset
 Set adattatore per via respiratoria
 Luftveisadaptersett
 Légúti adapterkészlet
 Hengitystiesovitinsarja
 Luftvejsadaptersæt
 Komplet nastavkov za dihalo
 Zestaw łącznika układu oddechowego
 Souprava adaptéru dýchacích cest
 Комплект на въздуховодещ адаптер
 Komplet nastavkov za dihalo
 Set adaptor pentru căi respiratorii
 Gaisa plūsmas adaptera komplekts
 Ūhuteede adapteri komplekt
 Kvėpavimo takų adapterių rinkinys
 Adapteri Seti




Адаптер, маленький размер

26.12.2021 26.12.2024 REF 040-001063-00 LOT 20200430002



Respironics Novamatrix, LLC
 5 Technology Drive Wallingford, CT 06492 USA
 EC REP Respironics Deutschland GmbH & Co. KG



Датчик SpO2 с кабелем для взрослых





Фото маркировки упаковки: Датчик SpO2 с кабелем для взрослых



Датчик SpO2 для взрослых

Датчик SpO2 для взрослых

 09.11.2021

 09.11.2024

REF 040-000726-00

LOT ZH21110952201140236

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru


Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, район г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, этаж 3
ИН с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



Удлинитель кабеля SpO2

Удлинитель кабеля SpO2



07.09.2021



07.09.2024



REF

040-000769-00



LOT

ZH21090702201131240

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:


Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Кирилловская, д. 1, литера А, часть помещ.
81 с вост. 59.49, e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-700-15-79

Фото маркировки упаковки: Удлинитель кабеля SpO2



Датчик SpO2 для взрослых, детей и новорождённых

Датчик SpO₂ для взрослых, детей и новорождённых

 08.11.2021



08.11.2024

REF

040-000730-00

LOT

ZH2011086201205

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ.
6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79

Фото маркировки упаковки: Датчик SpO₂ для взрослых, детей и новорождённых






Фото: Разъем клеммный источника кислорода

 08.06.2021 08.06.2024 040-001815-00 20220303-147

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вв.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть по
Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



 ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

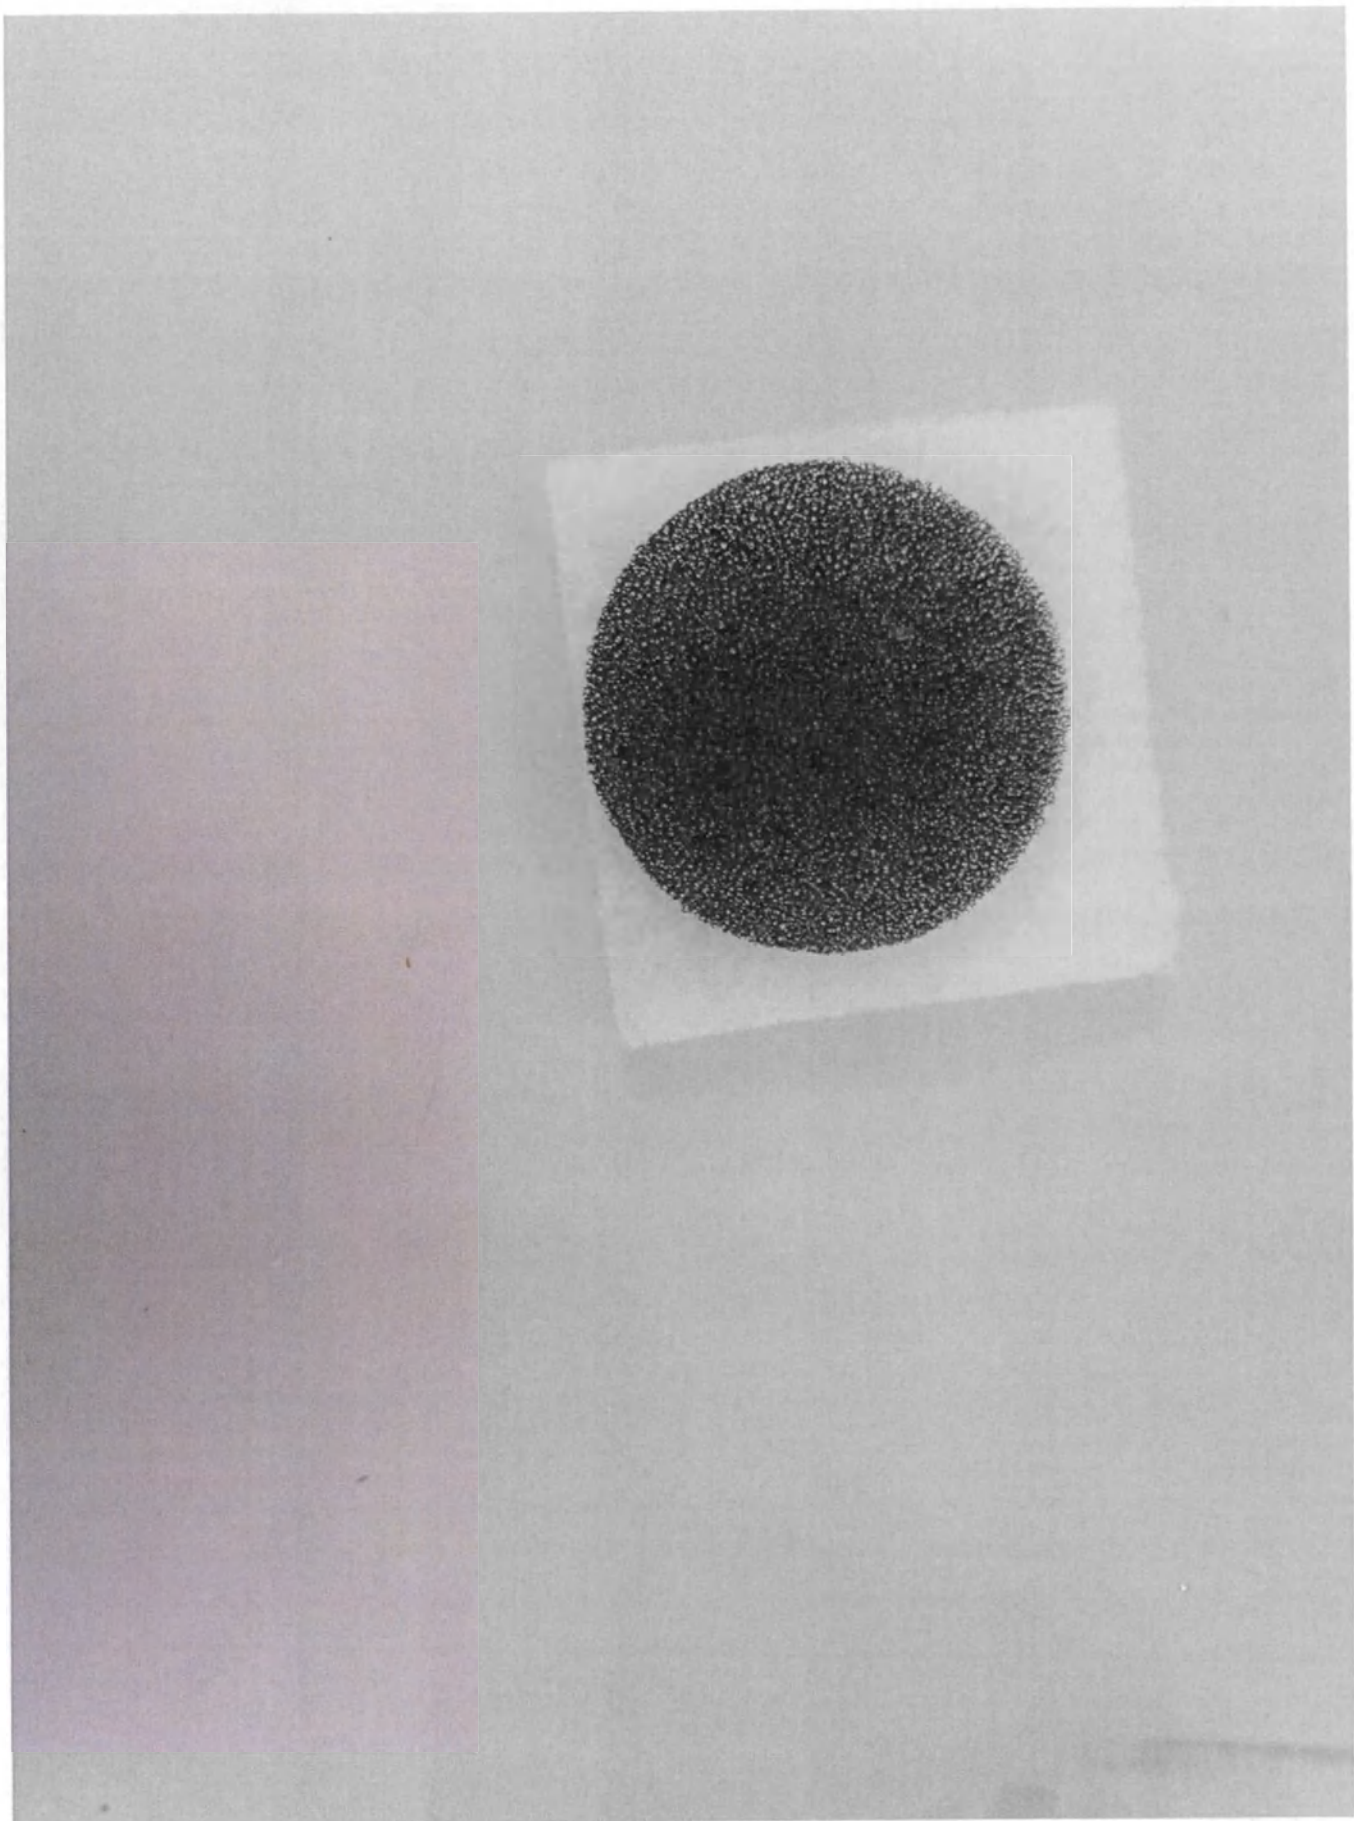

Сетка пылезащитная

Сетка пылезащитная



03.10.2021



03.10.2024



REF 041-00000041-00



LOT 20220303-039

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236

E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195799, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ.
6Н с ном. 39/49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



Узел быстроразъемный всасывающего клапана

Узел быстроразъемный всасывающего клапана



13.11.2021



13.11.2024



115-0001112-00



220100354

Производитель:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China
Тел.: +86-0755-26431236
E-mail: info@comenmedical.ru

Место производства:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building,
Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

Адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, вк. т.о.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ.
6Н с ном. 39.49 e-mail: medstrategy@yandex.ru Телефон +7-(812) 600-42-80, 8-800-300-82-79



Узел быстроразъемный клапана выдоха



М.П.

