

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ТЭК Техоснастка»


Антонов И.М.
«13» декабря 2023 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ПЛАНШЕТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ
96 X 0,2 МЛ РАЗРЕЗАЕМЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ
ПО ТУ 32.50.50-003-75319334-2022**

«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 x 0,2 мл разрезаемый, прозрачный»:

- планшет 119.70 x 79.70 x 21.1

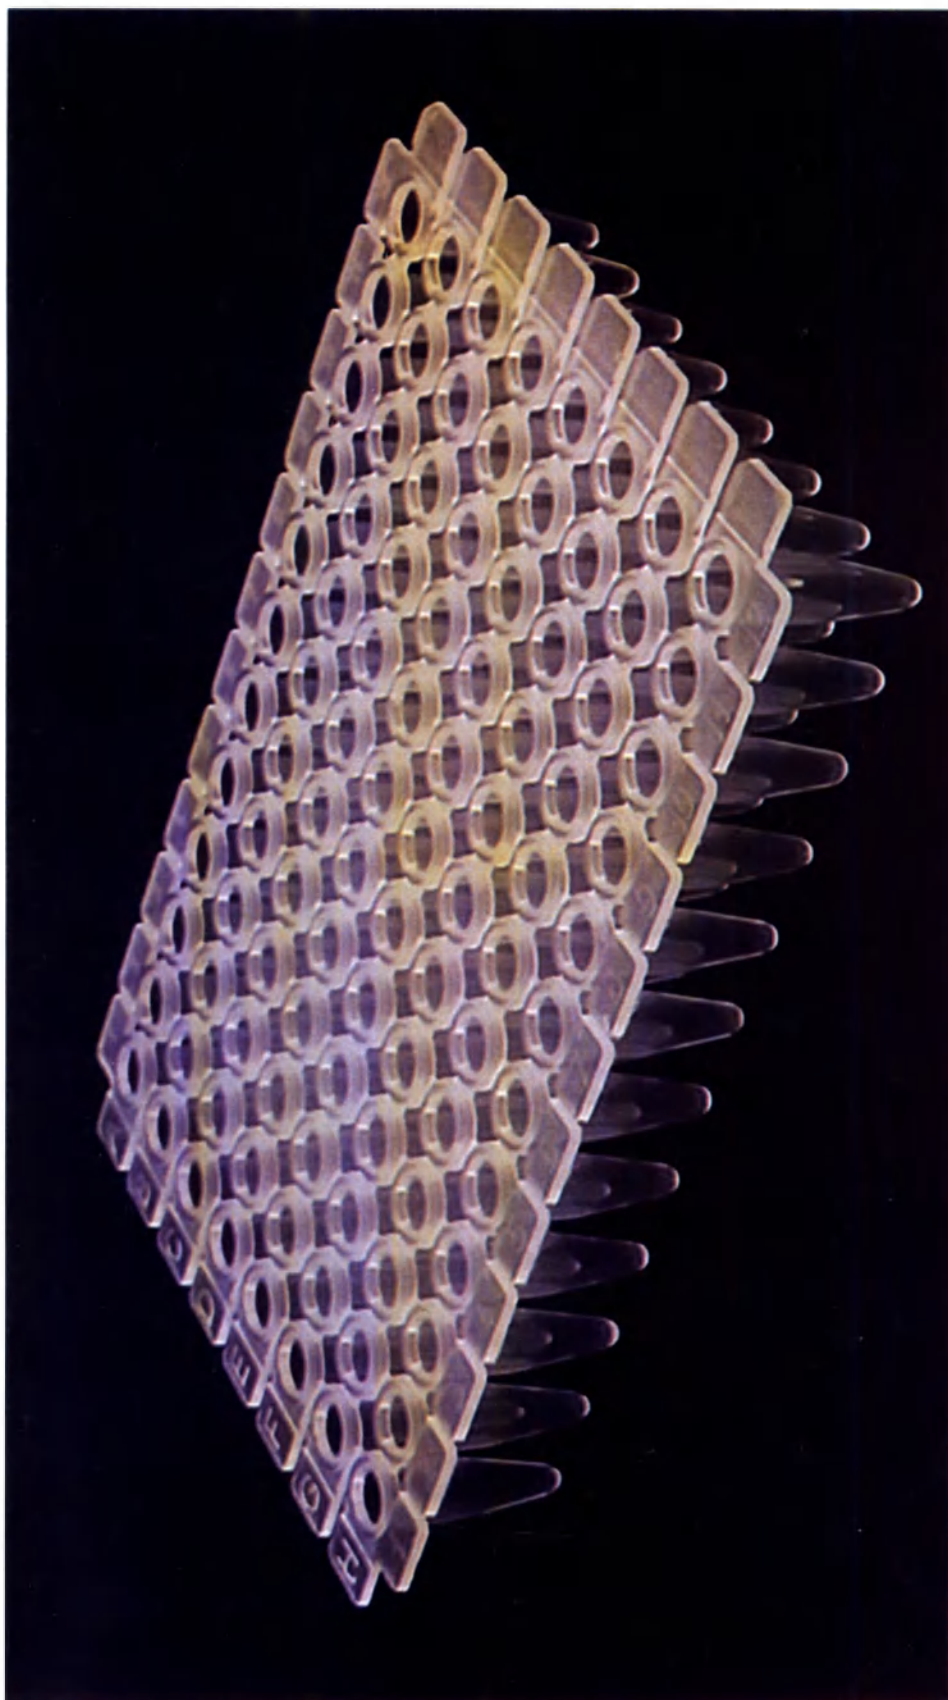

«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 х 0,2 мл разрезаемый, прозрачный»:

- инструкция по применению

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ТЭК Техоснастка»



Антонов И.М.

13.11.2023 г.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПЛАНШЕТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ
96 X 0,2 МЛ РАЗРЕЗАЕМЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ
ПО ТУ 32.50.50-003-75319334-2022**

с изменениями на 13.11.2023 г


«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 х 0,2 мл разрезаемый, прозрачный с крышками»:

- планшет 119.70 х 79.70 х 21.1

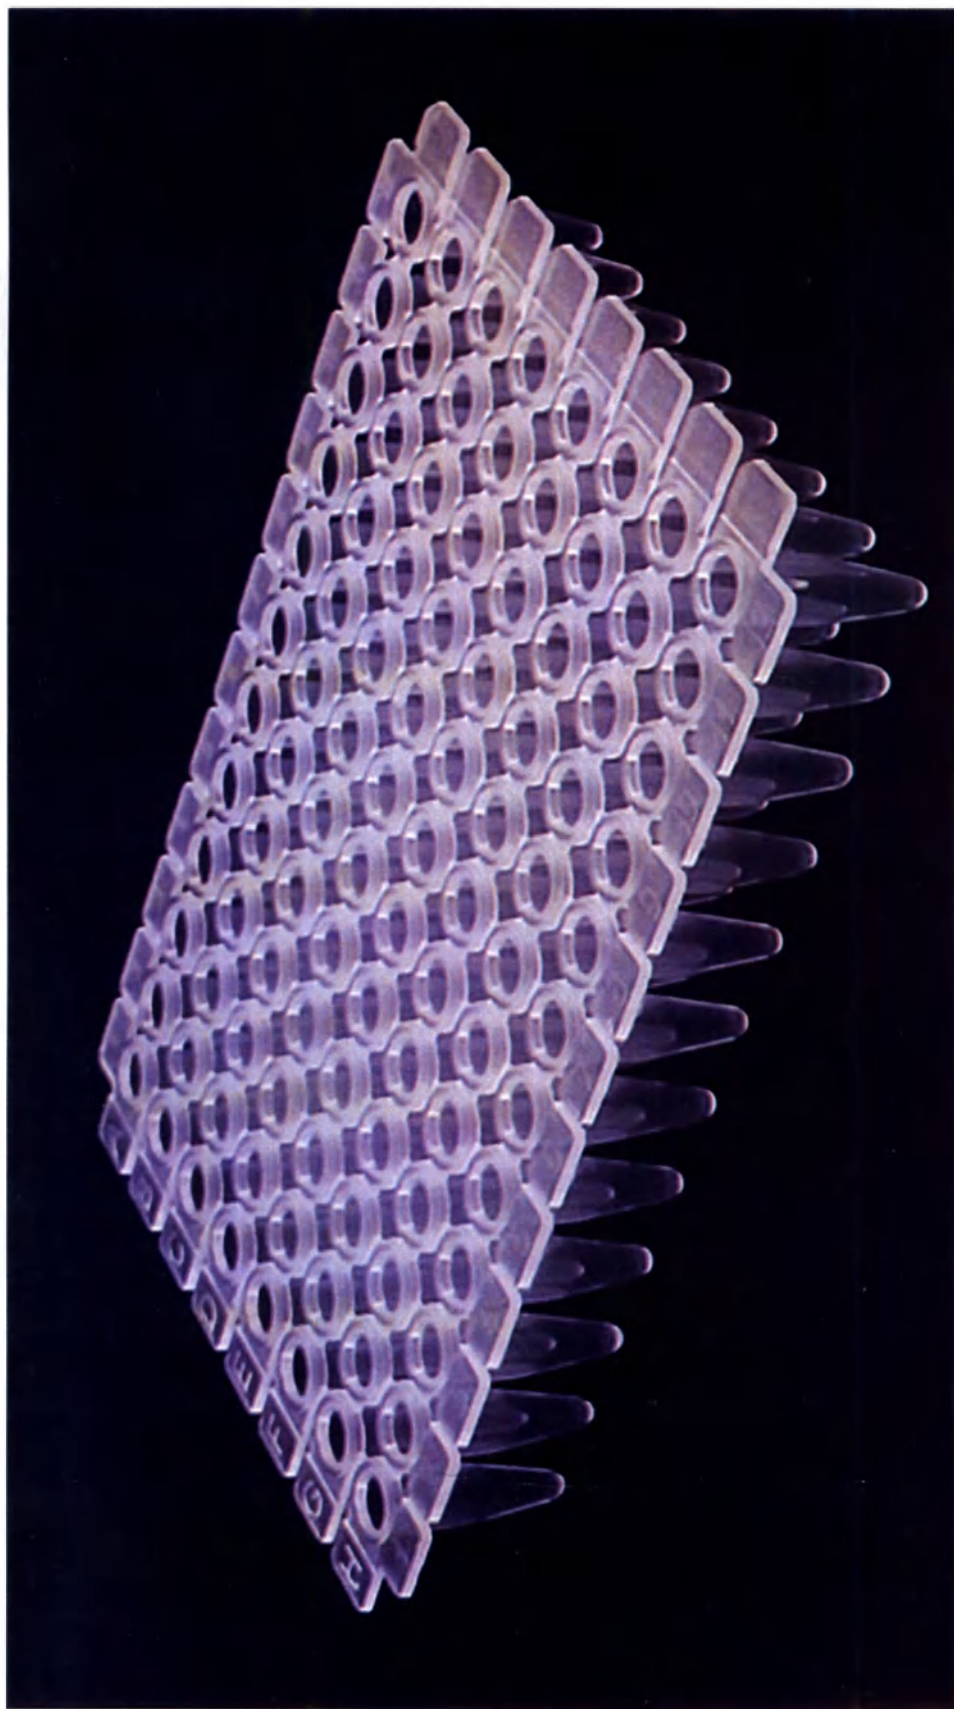


«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 х 0,2 мл разрезаемый, прозрачный с крышками»:

- крышки стрипованные 78.38 х 6.85 х 3.1

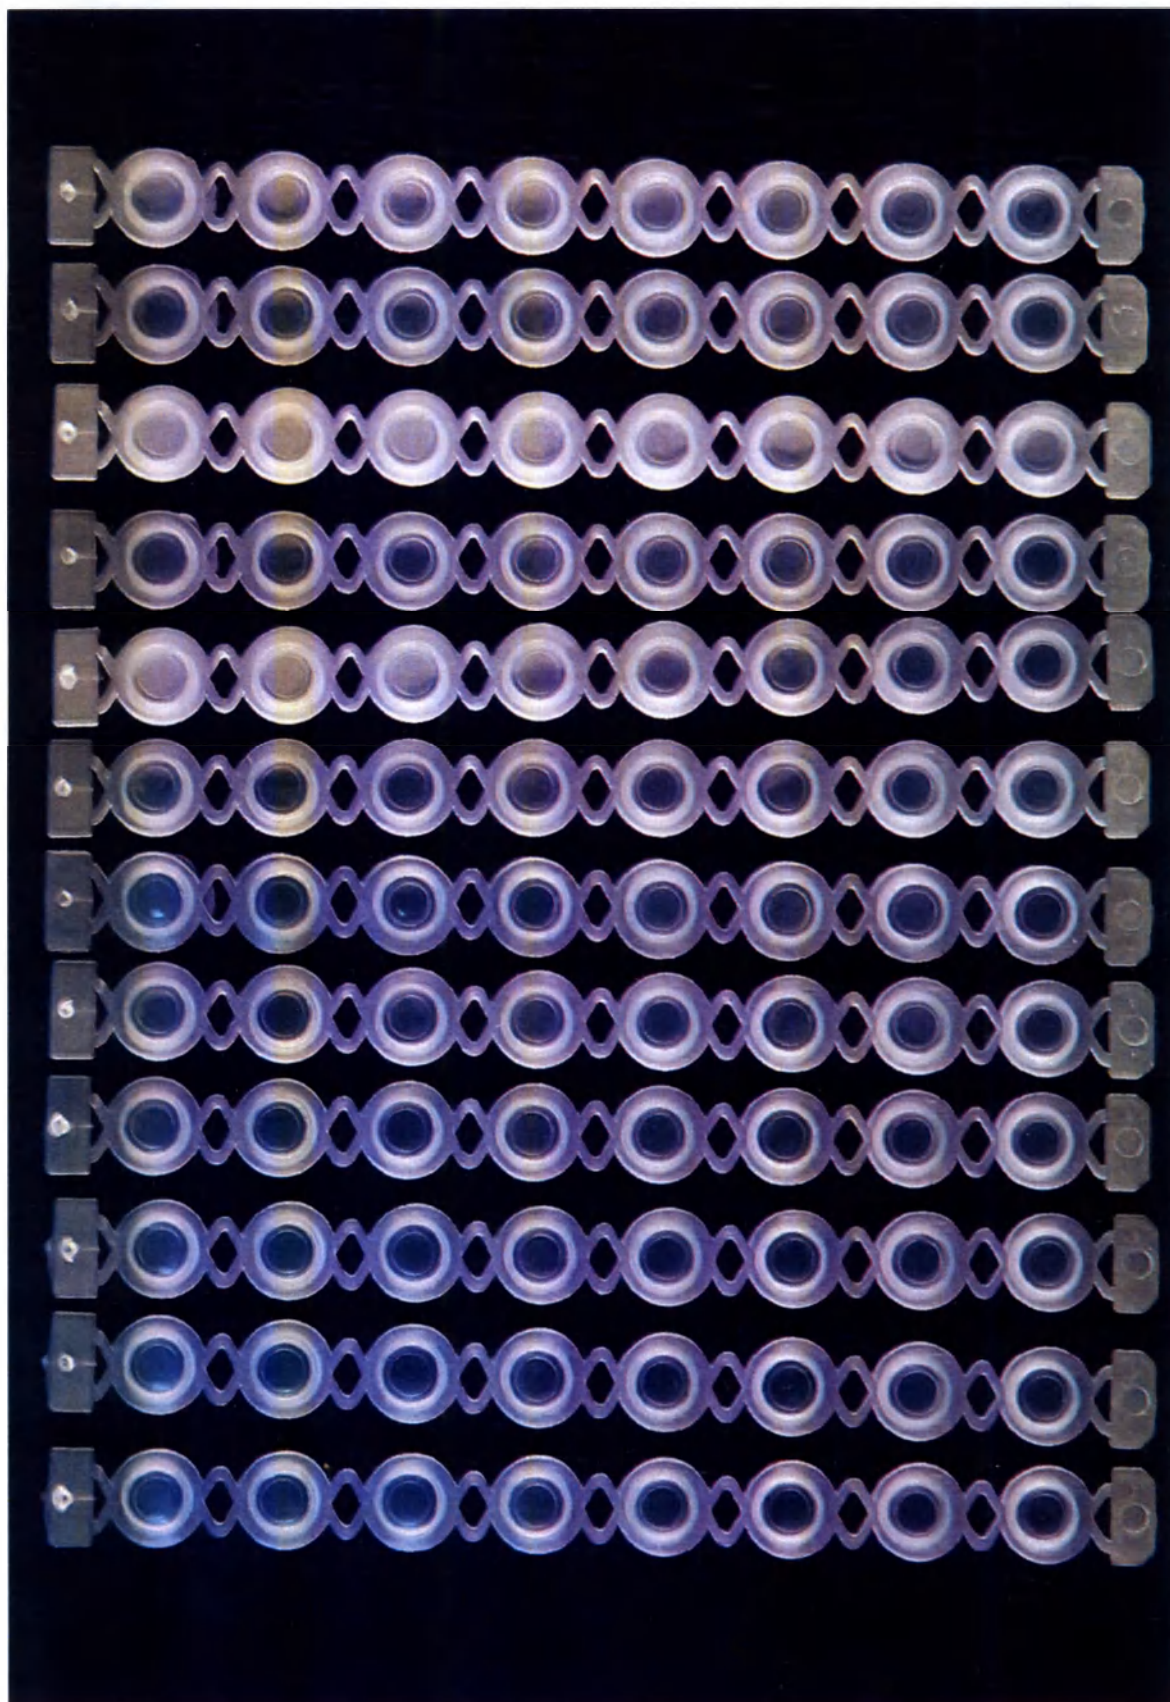

«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 x 0,2 мл разрезаемый, прозрачный с крышками»:

- инструкция по применению

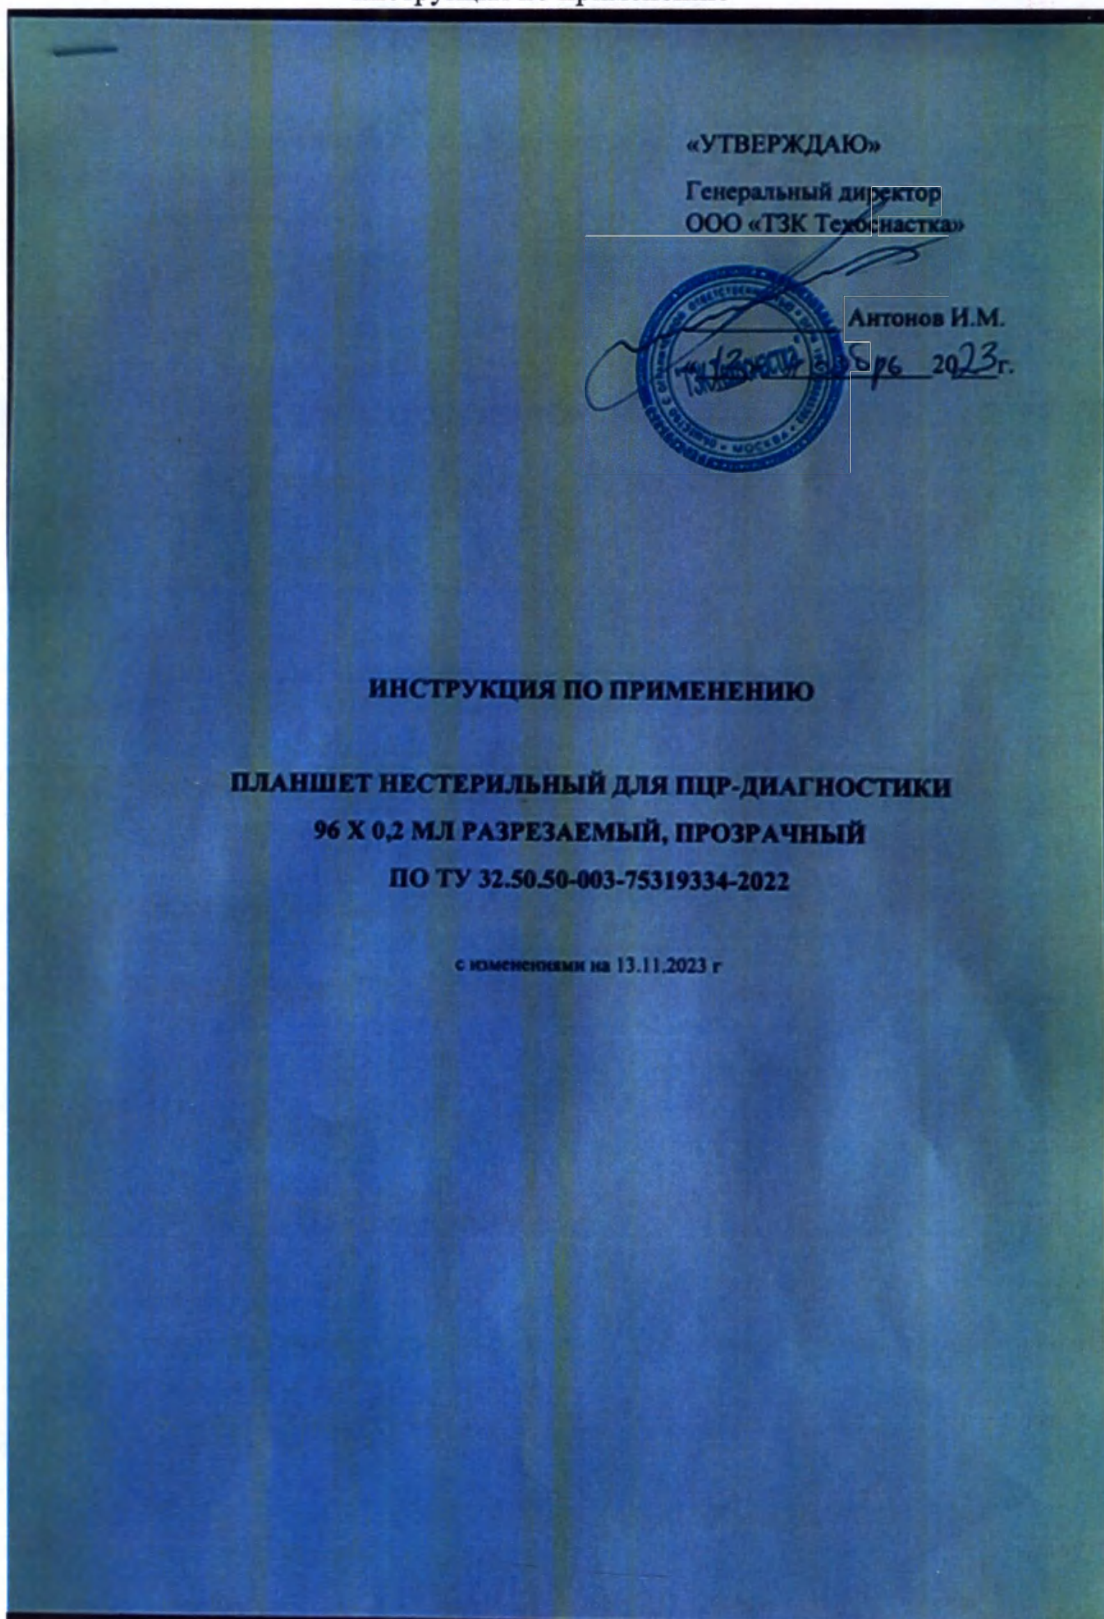

Пример первичной упаковки и маркировки:

«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 x 0,2 мл разрезаемый, прозрачный»



Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 x 0,2 мл
разрезаемый, прозрачный по ТУ 32.50.50-003-75319334-2022

Вариант исполнения: «Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 x 0,2 мл
разрезаемый, прозрачный»

ТУ № _____

Планшет предназначен для отбора, сохранения биологических
жидкостей образцов, либо биологического материала человека (образцы
клеток, тканей биологических жидкостей человека, секрета, продукты
жизнедеятельности человека, фекально-оральные и респираторные выделения),
реактивов, буферов для полимеразной цепной реакции.



Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Техноста»
155809, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 60



2-120

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C

и относительной влажности 80%

Условия транспортировки и хранения: при температуре от -50 до +50°C

и относительной влажности до 98%



01.2023

Дата упаковки: 01.2023




60 месяцев



Пример первичной упаковки и маркировки:

«Планшет нестерильный для ПЦР-диагностики 96 х 0,2 мл разрезаемый, прозрачный с крышками»

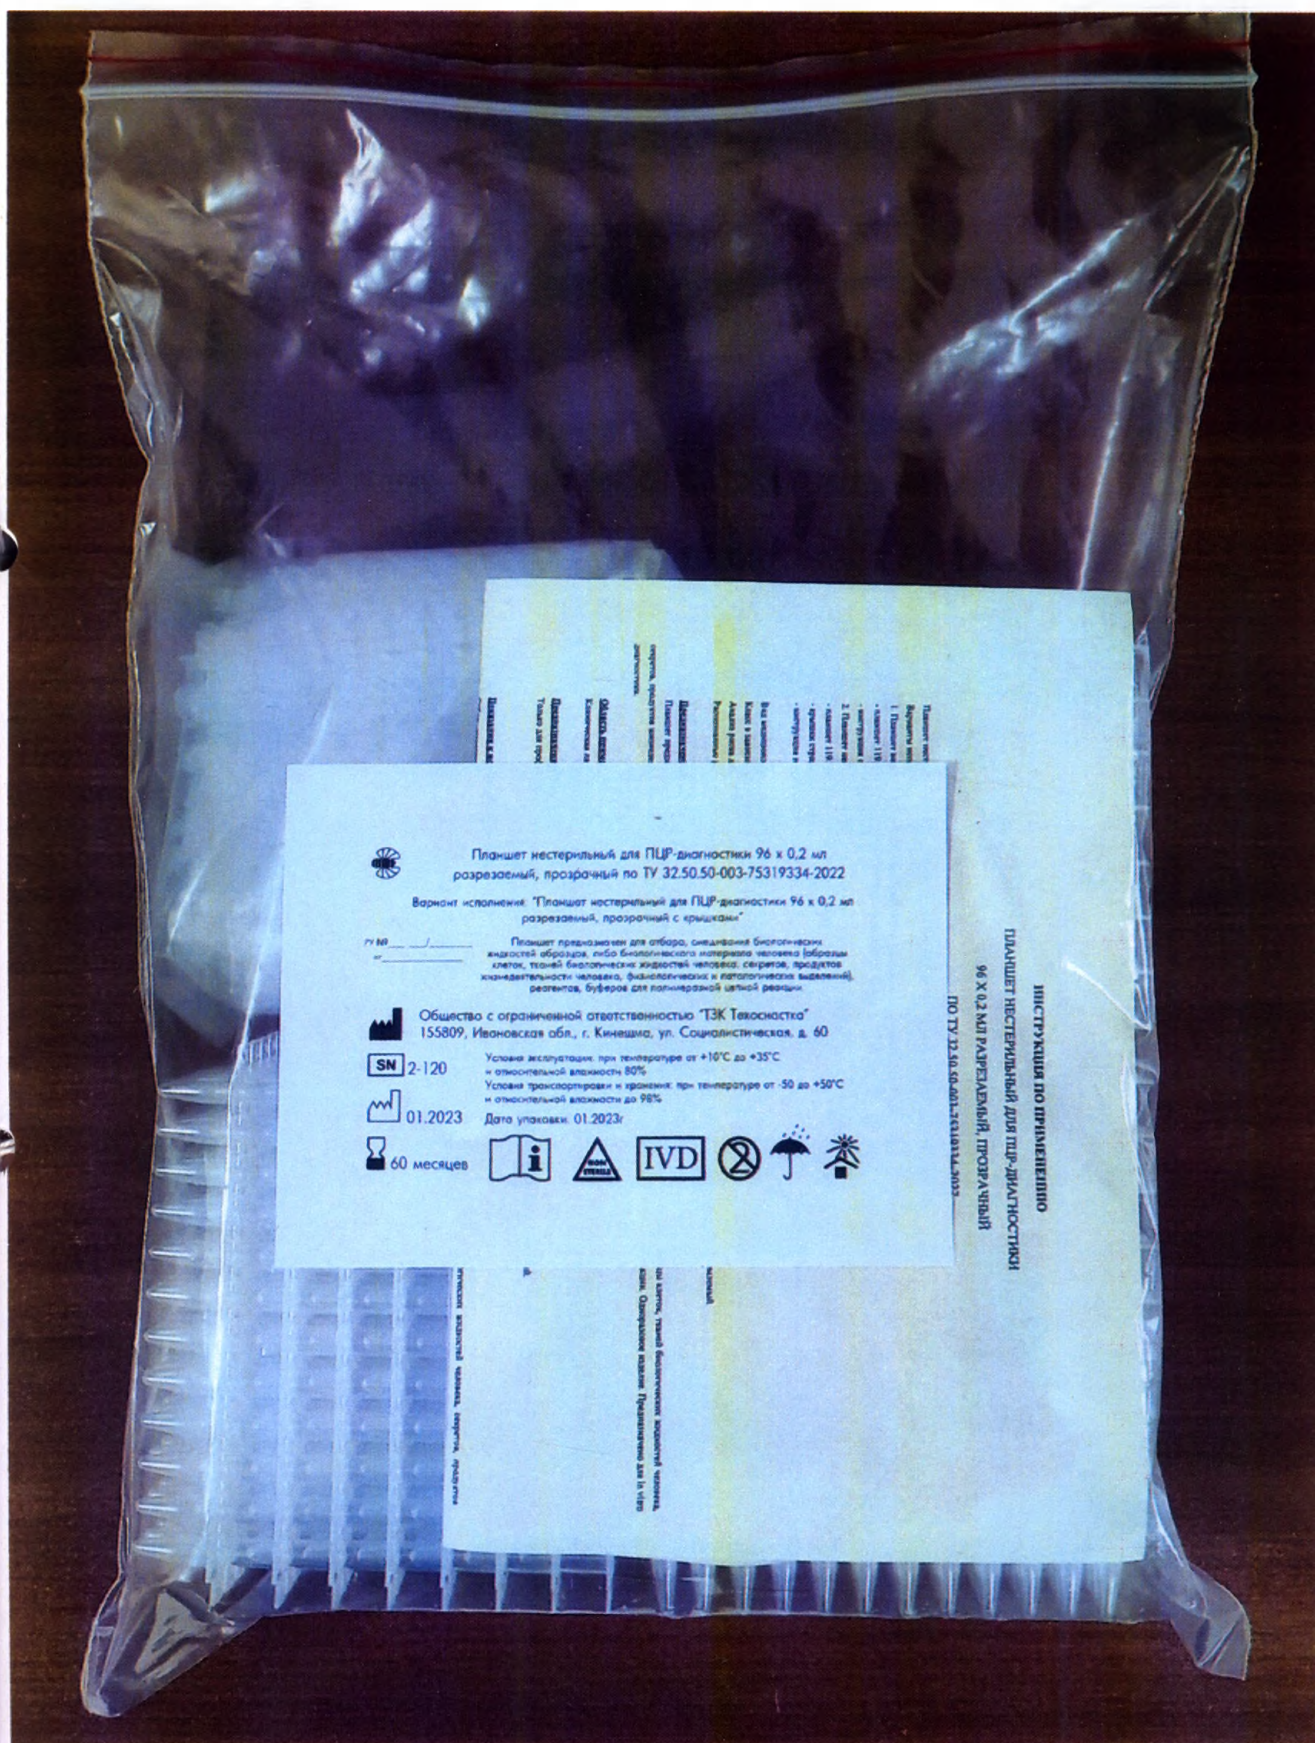



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ТЭК Техоснастка»

Антонов И.М.
«12» декабря 2010 г.

