




ООО "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регуляторным вопросам

ООО «Эбботт Лэбораториз»

 Киселева А.А.

« 16 » августа 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Окклюдер для закрытия открытого артериального протока
Amplatzer Piccolo

Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Картонная коробка для хранения.





Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Картонная коробка для хранения. Маркировка.



Amplatzer Piccolo™ Occluder

Duct Occluder

tr: Kanal oküderi
pt: Dispositivo de oclusão do canal
es: Ocluser de conducto

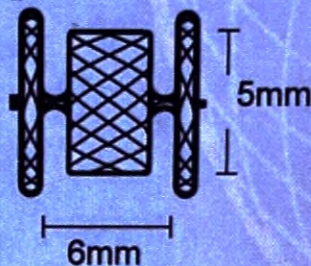

UDI	 (01)05415067031051(17)250930(10)7697474
	2025-09-30
REF	9-PDAP-05-06-L 
LOT	7697474



Made in USA



2020-10-12




Abbott Medical
5050 Nathan Lane North
Plymouth, MN
55442 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833



Abbott Medical
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem
Belgium
+32 2 774 68 11

600054755

Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Содержимое картонной коробки для хранения.






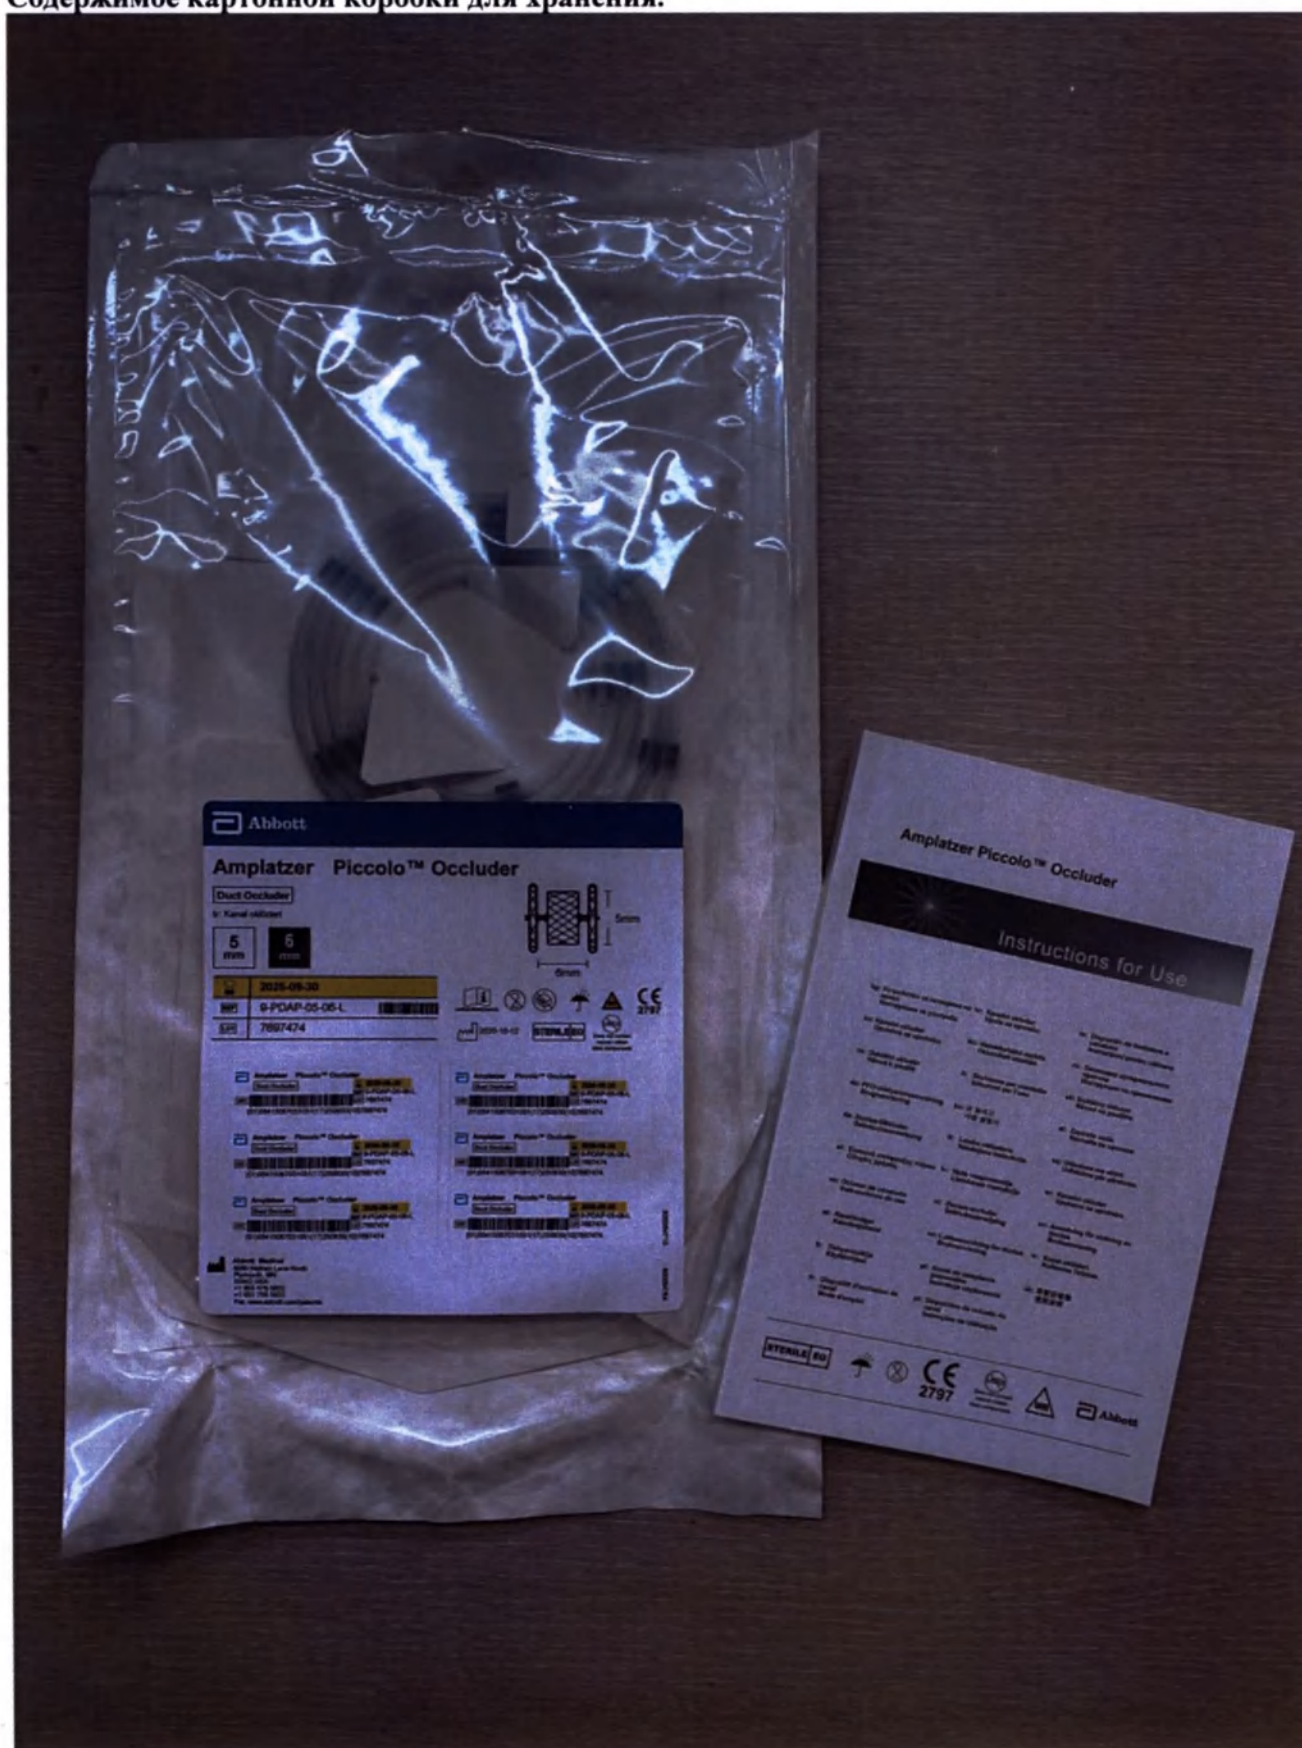


Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Наружный пакет. Вид спереди.



| tr: | Kanal oklüderi |

6 mm

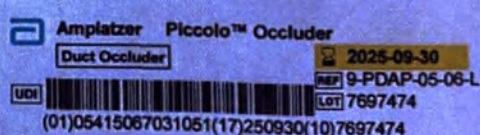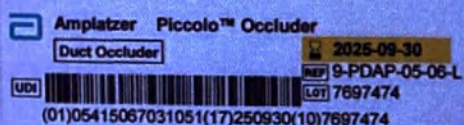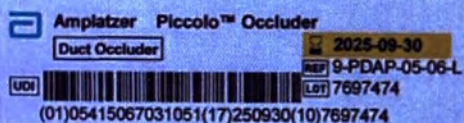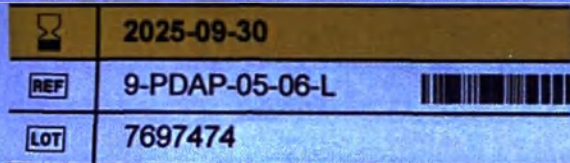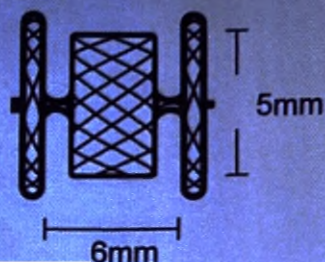

 **Abbott Medical**
5050 Nathan Lane North
Plymouth, MN
55442 USA
+1 855 478 5833
+1 651 756 5833
Pat. www.abbott.com/patents

600054715 600054764

**Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Наружный пакет. Вид сзади.**




**Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Внутренний пакет. Вид спереди.**



**Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Внутренний пакет. Вид сзади.**




**Ожклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo.
Картонная подложка.**

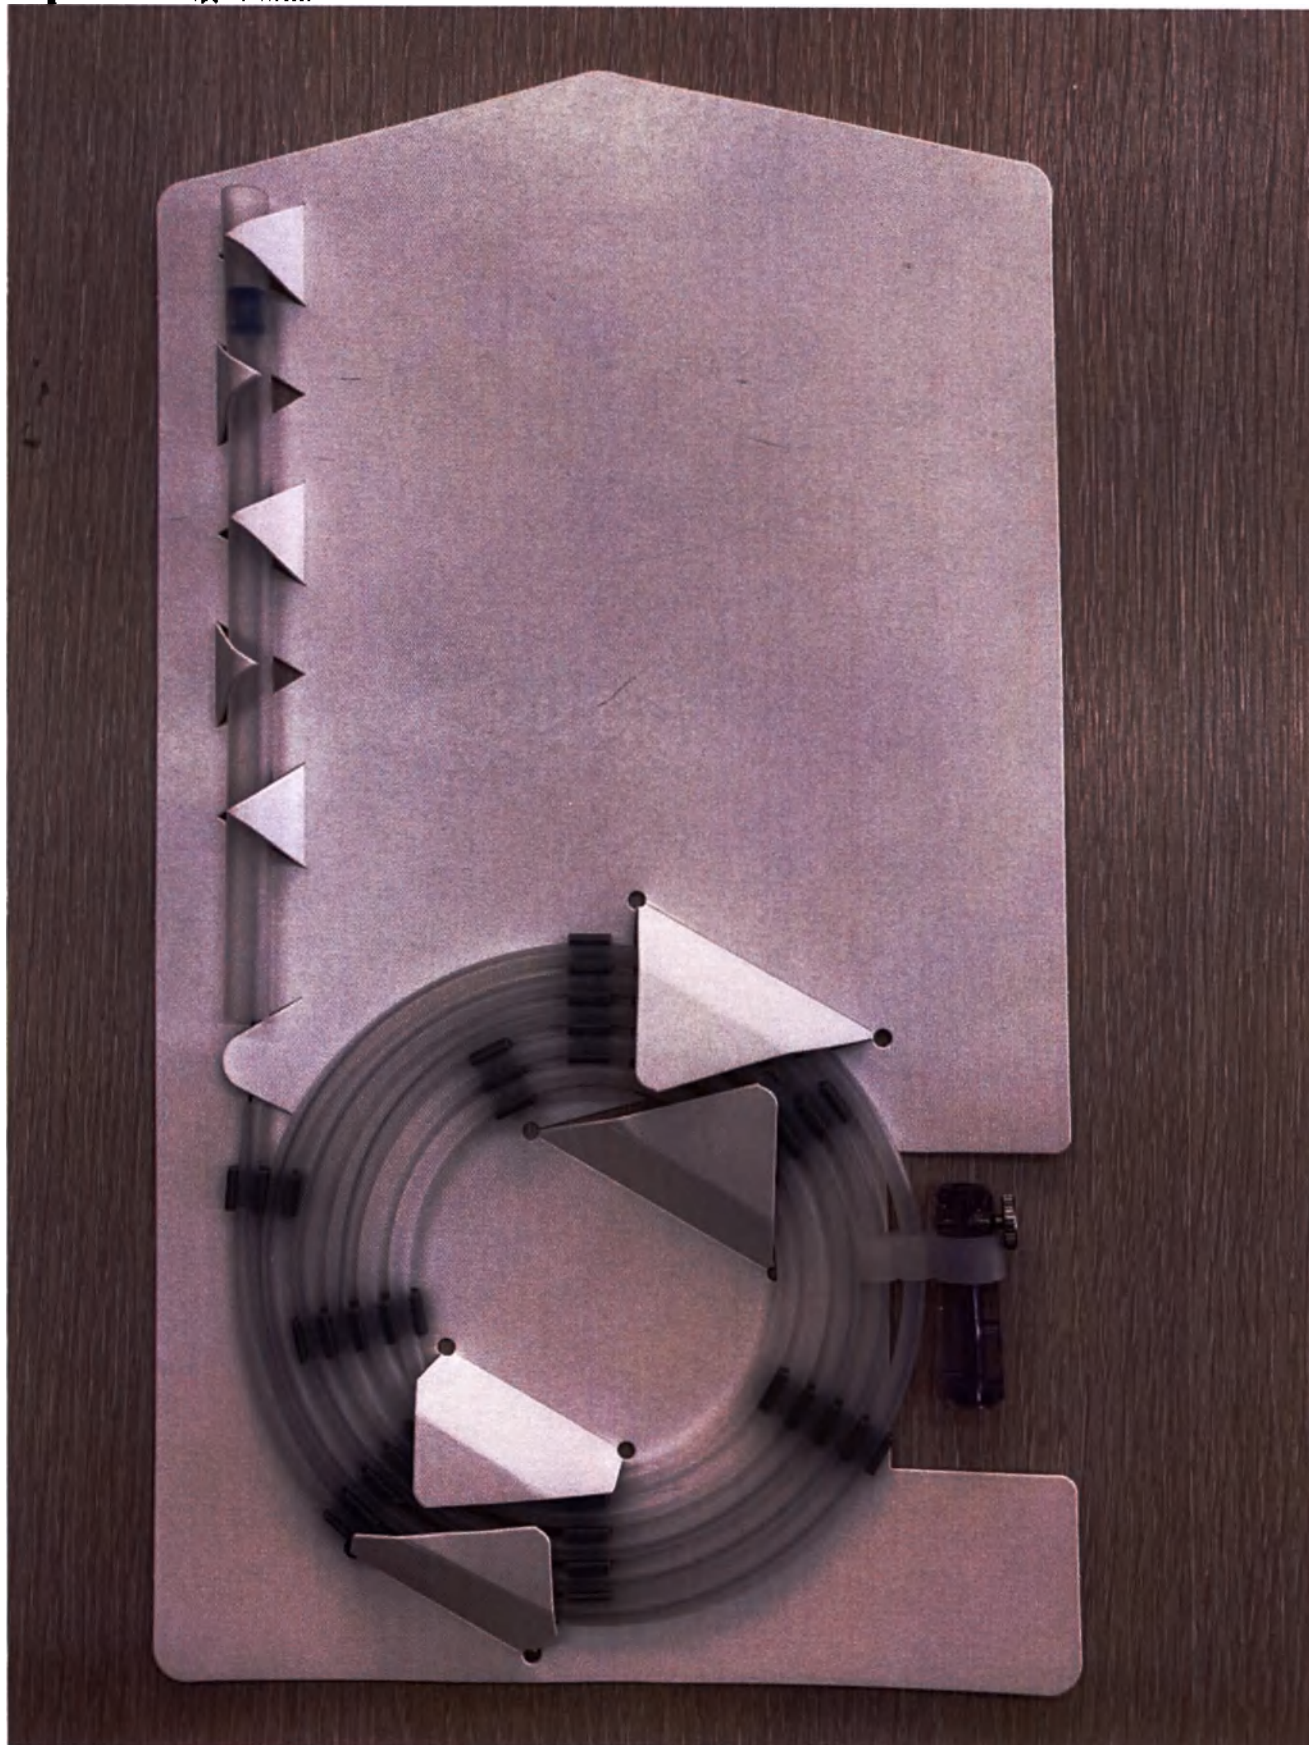

Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo, с диаметром перешейка (мм) / расстоянием между ограничительными дисками (мм): 5 мм / 6 мм.



Доставочный проводник.

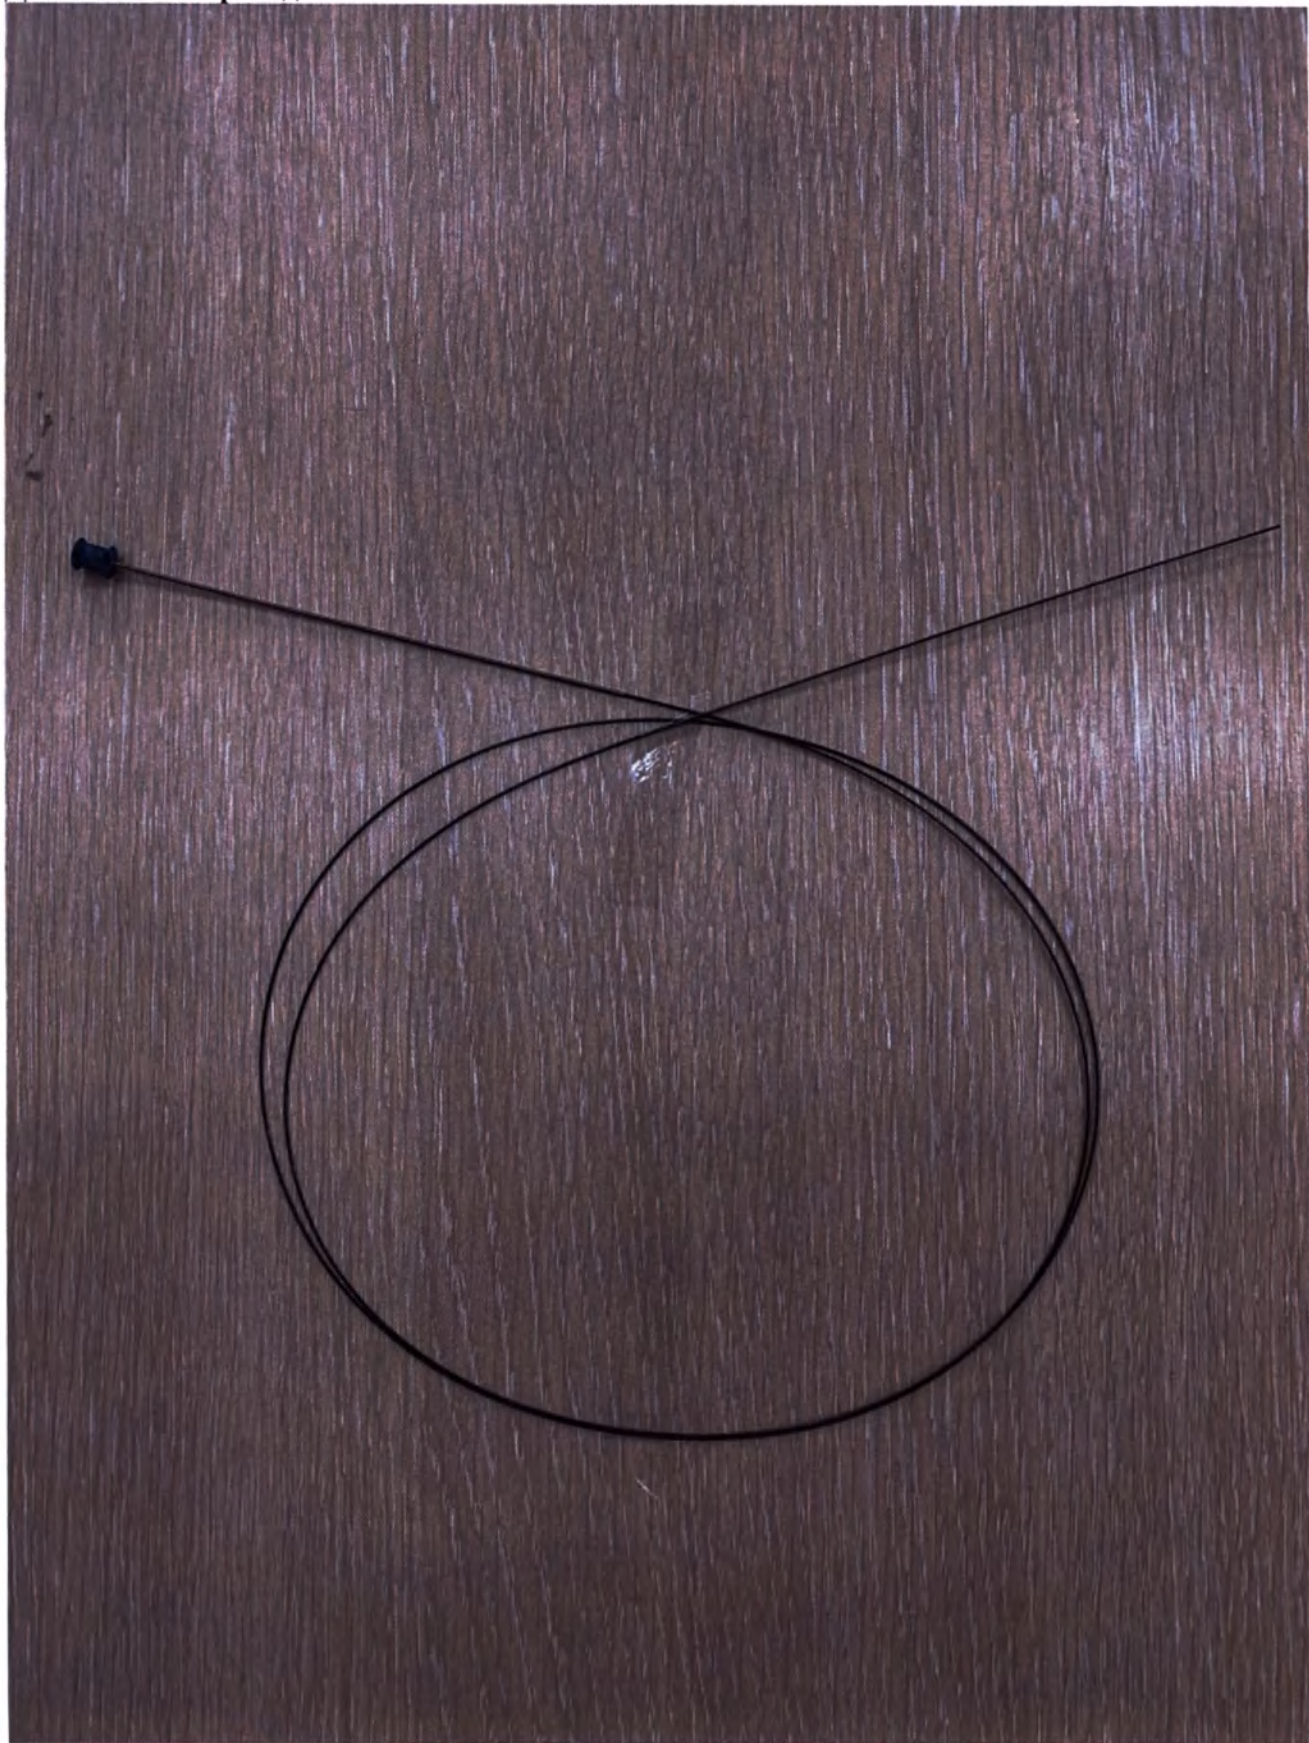

Кольцо диспенсера.



Держатель проводника.



Защитная оболочка окклюдера.



Amplatzer Piccolo™ Occluder

Instructions for Use

bg: Устройство за затваряне на канал Инструкции за употреба	hr: Kanalni okluder Upute za uporabu	ro: Dispozitiv de închidere a canalului Instrucțiuni pentru utilizare
bs: Kanalni okluder Uputstvo za upotrebu	hu: Vezetékelzáró eszköz Használati utasítás	ru: Окклюдер артериального протока Инструкции по применению
ca: Duktální okluder Návod k použití	it: Occlusore per condotto Istruzioni per l'uso	sk: Duktálny okluzor Návod na použitie
da: PFO-okklusjonsanordning Brugsanvisning	ko: 관 폐쇄기 사용 설명서	sl: Zapiralo voda Navodila za uporabo
de: Ductus-Okluder Gebrauchsanweisung	lt: Latakio okluderis Naudojimo instrukcija	sq: Okludues me shirit Udhëzime për përdorim
el: Συσκευή απόφραξης πόρου Οδηγίες χρήσης	lv: Vada nosprostotājs Lietošanas instrukcija	sr: Kanalni okluder Uputstvo za upotrebu
es: Ocluser de conducto Instrucciones de uso	nl: Ductus-occluder Gebruiksaanwijzing	sv: Anordning för slutning av ductus Bruksanvisning
et: Kanalisulgur Kasutusjuhend	no: Lukkeanordning for ductus Bruksanvisning	tr: Kanal oklüderi Kullanma Talimatı
fi: Tiehyensulkija Käyttöohjeet	pl: Korek do zamykania przewodów Instrukcja użytkowania	zh: 导管封堵器 使用说明
fr: Dispositif d'occlusion de canal Mode d'emploi	pt: Dispositivo de oclusão do canal Instruções de Utilização	

STERILE EO



CE
2797



Does not contain
natural rubber
latex components



Abbott

Макет дополнительной маркировки для РФ.

Окклюдер для закрытия открытого артериального протока Amplatzer Piccolo

Размер: см. на упаковке

Производитель: Abbott Medical (Эбботт Медикал),

5050 Nathan Lane North Plymouth, MN 55442

Страна происхождения: см. на упаковке

Код партии (Lot): см. на упаковке

Срок годности (): см. на упаковке

Условия хранения: см. на упаковке

Информация о стерильности: см. на упаковке

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровка графических символов: см. инструкцию по применению


Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Эбботт Лэбораториз»

125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Тел./факс: +7(495)-258-42-80/81

РУ № XXX от xx.xx.xxxx



XXXXXXXXXX (xxxx-xx-xx)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

* 17 (ссылка на документ)

листов

Общество с ограниченной ответственностью
«Эбботт Лабораториз»

Менеджер по регуляторным вопросам
Киселева А.А.