

Фотографические изображения медицинского изделия
Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента регистрации ООО «ИЛС»

Стариковская И.А.

«



2023 г.

Product: Real-Time PCR System


Model: Lepgen-96

Rated input: AC230v~, 50 Hz, 1200VA

SN : 22JY18690189F



Nov.29.2022




Beijing Lepu Medical Technology Co.,Ltd.

Building 7-1, No.37, Chaoqian Road, Changping District,

Beijing, 102200, P.R. China.

Lepu Medical (Europe)Cooperatief U.A.



Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands.

Tel: +31-515-573399

Fax: +31-515-760020

catalogue number: BJ12ZZ10.001

Макет маркировки для обращения в РФ на Систему Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени (нанесение маркировки на русском языке осуществляется на территории РФ уполномоченным представителем в РФ)

Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени



Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.
Building 7-1, No. 37, Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200,
P.R. China



Телефон: 010-80123111

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Тел.: +7 (495) 664 2884, Факс: +7 (495) 664 2889
info@interlabservice.ru

Напряжение – 230 В
переменного тока
Мощность – 1200 ВА
Частота – 50 Гц

РУ № XXX XXXX/XXXXX от _____.

*Расшифровку графических символов см. в руководстве по эксплуатации
Дата производства, серийный номер прибора и каталожный номер
указаны на оригинальной маркировке*





Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени (Кабель питания – 1 шт.)



Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени (Адаптер-переходник для кабеля питания – 1 шт.)




Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени (Кабель последовательного порта – 1 шт.)




Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в реальном времени (Кабель преобразователь – 1 шт.)



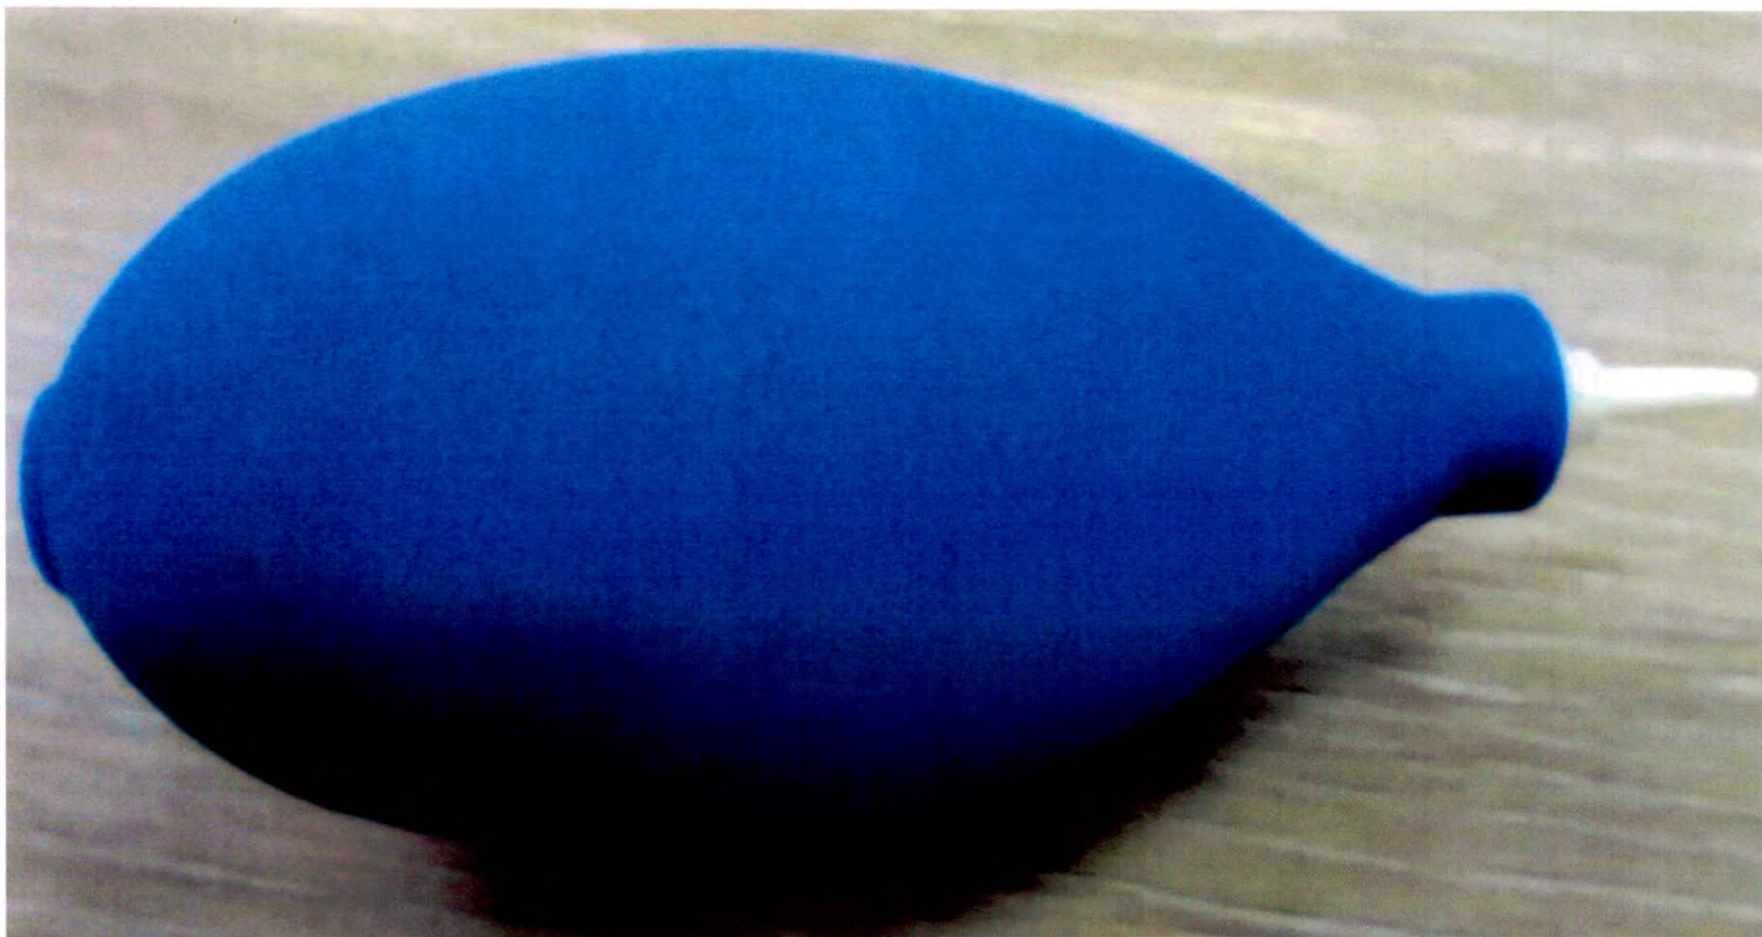




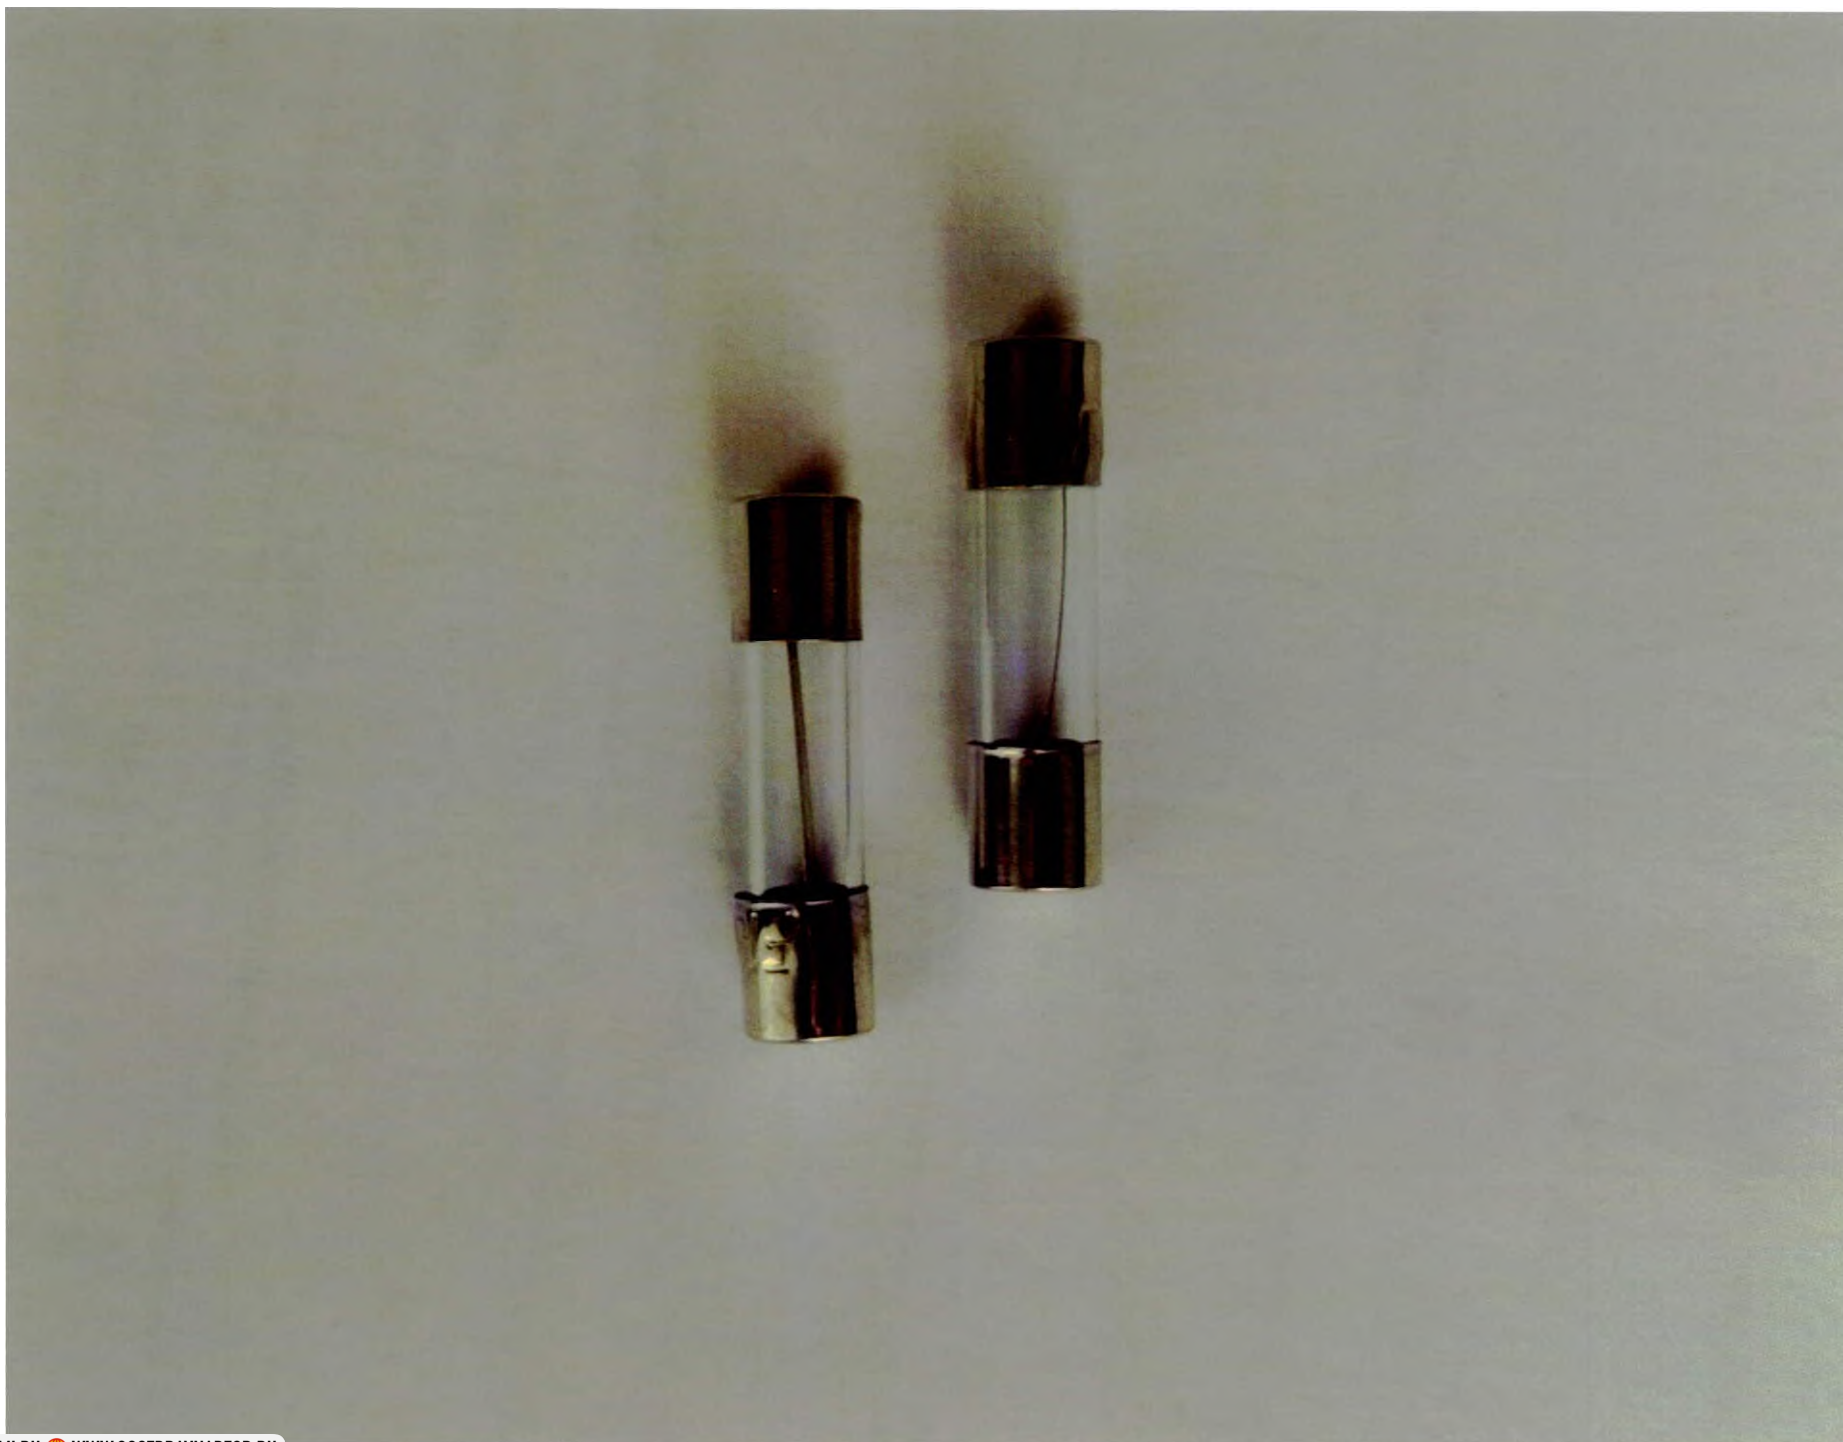



**Система Lergen-96 для ПЦР-диагностики в
реальном времени**

Руководство по эксплуатации

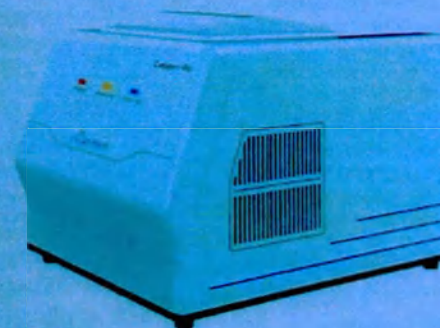

Компания «БЕИДЖИНГ ЛЕПУ МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.» (BEIJING LERU
MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.)

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 13 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»

И.А. Стариковская

