

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019
Макеты упаковки

Январь 2024

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 18±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 - 83-20.

Сделано в России.


Годен до:

LOT Партия №

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ
1 шт., ø18 мм

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ, ø18 мм

1 шт.

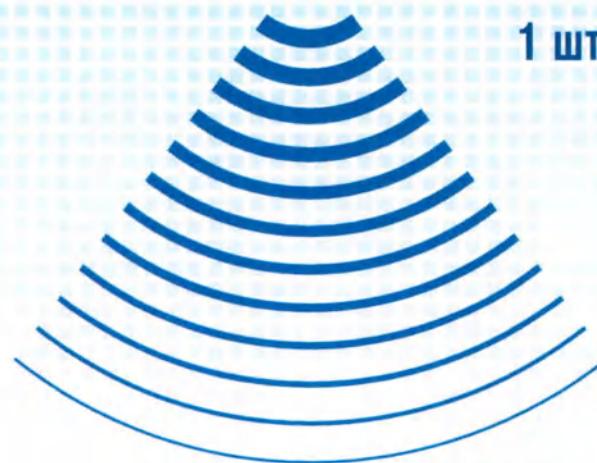

ALPINA PLAST



VER 2 АП

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 20±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.

 Годен до:

 Партия №

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ

1 шт., ø20 мм

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ, ø20 мм

1 шт.



ALPINA PLAST



VER 2 АП

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.

 Годен до:

 Партия №

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ

1 шт., ø28 мм

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ, ø28 мм

1 шт.



ALPINA PLAST



VER 2 АП

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 33±2 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.

⌚ Годен до:

LOT Партия №

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ

1 шт., ø33 мм

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ, ø33 мм

1 шт.



ALPINA PLAST



VER 2 АП

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 34±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Годен до:

LOT Партия №

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ

1 шт., ø34 мм

ПРЕЗЕРВАТИВ ДЛЯ УЗИ, ø34 мм

1 шт.



ALPINA PLAST



VER 2 АП

VIVA ПРЕЗЕРВАТИВ | 1 шт.
для УЗИ | Ø 18 мм

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ,
Ø 18 мм
1 шт.**

VIVA



VER 2 АП

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 18±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Годен до:



Партия №

VIVA ПРЕЗЕРВАТИВ | 1 шт.
для УЗИ | $\varnothing$ 20 мм

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ,
 $\varnothing$ 20 мм
1 шт.**

VIVA



VER 2 АП

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 20±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.



🕒 Годен до:

📦 ЛОТ Партия №

VIVA ПРЕЗЕРВАТИВ 1 шт.
для УЗИ Ø 28 мм

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ,
Ø 28 мм
1 шт.**

VIVA



VER 2 АП

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.



Годен до:

LOT Партия №

VIVA ПРЕЗЕРВАТИВ 1 шт.
для УЗИ Ø 33 мм

ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ,
Ø 33 мм
1 шт.

VIVA



VER 2 АП

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 33±2 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.



Годен до:

LOT Партия №

VIVA ПРЕЗЕРВАТИВ 1 шт.
для УЗИ Ø 34 мм

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ,
Ø 34 мм
1 шт.**

VIVA



VER 2 АП

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 34±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.



Годен до:



Партия №

Клапан без лака

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 18±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Годен до:

LOT Партия №

ViZiT®

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø18 мм**



**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø18 мм**



VER 3 AP



Окно без лака

Клапан без лака

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 20±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

■ **Изготовлено по заказу:** ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

■ **Импортер в Республике Беларусь:** ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.



ViZiT®

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø20 мм**



**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø20 мм**



VER 3 AP

Годен до:

LOT Партия №

Окно без лака

Клапан без лака

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.

Годен до:

LOT Партия №

vizit®

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø28 мм**



**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø28 мм**



4 607046 746273

VER 3 AP

Окно без лака

Клапан без лака

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 33±2 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Годен до:

Партия №

vizit®

**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø33 мм**



**ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø33 мм**



VER 3 AP



Окно без лака

Клапан без лака



ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø34 мм

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) для ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 34±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



ПРЕЗЕРВАТИВ
для УЗИ, Ø34 мм



VER 3 AP

Годен до:

LOT Партия №



Окно без лака

Презерватив для УЗИ, ø 18мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Не использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 18 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки - $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10634 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 20 мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 20 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 28мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +26 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 28 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки - 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.


Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



Партия № 00000

Годен до: 0000-00

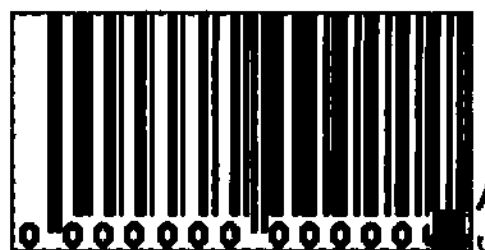

Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 33 мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 33 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 34мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Не использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 34 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 18мм

Количество 100 шт.

ALPINA PLAST

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Не использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 18 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки - 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (Т.З. «ALPINA PLAST», 100 шт.)

加

Инструкция по применению

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019



**Получите инструкцию,
отсканировав QR-код.**

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 20 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки - $0,08 \pm 0,01$ мм

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.


тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



Партия № 00000

Годен до: 0000-00

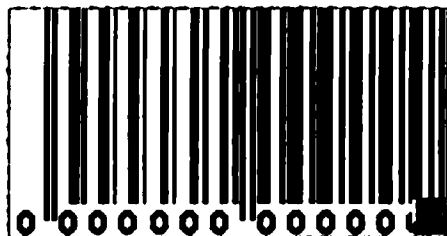

**Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (Т.З. «ALPINA PLAST», 100 шт.)**

Презерватив для УЗИ, ø 28 мм

ALPINA PLAST

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 28 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Получите инструкцию,
отсканировав QR-код.



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицины – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (Т.З. «ALPINA PLAST», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 33 мм

ALPINA PLAST

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с мазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Не использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПИН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 33 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (Т.З. «ALPINA PLAST», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 34мм

ALPINA PLAST

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с мажи и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 34 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки - $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (Т.З. «ALPINA PLAST», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 18мм

Количество 100 шт.

VIVA

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.



Получите инструкцию,
отсканировав QR-код.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +26 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 18 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки - $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицелия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (Т.З. «VIVA», 100 шт.)

VIVA



Сделано в России.



000



Годен до: 0000-00



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Презерватив для УЗИ, ø 28мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 28 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (Т.З. «VIVA», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 33 мм

Количество 100 шт.

VIVA

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 33 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
меди изделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (Т.З. «VIVA», 100 шт.)

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

**Чехол защитный (пресерватив) для датчика УЗМ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с мешки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Экспериментальные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 34 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.


Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru. **Сделано в России.**

Сделано в России.



Партия № 00000

Годен до: 0000-00

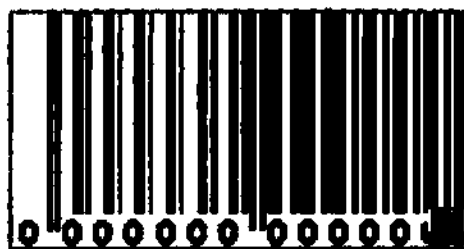

**Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицеления – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (Т.З. «VIVA», 100 шт.)**

Презерватив для УЗИ, ø 18мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с маской и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 18 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
меди изделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (Т.З. «VIZIT», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 20 мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректотрансвального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 20 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.




0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00

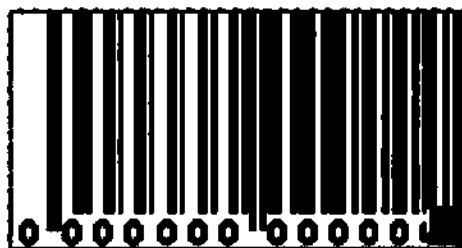

Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (Т.З. «VIZIT», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 28мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ

по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 28 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.



0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00



Получите инструкцию,
отсканировав QR-код.

Сделано в России.



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медиц изделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (Т.З. «VIZIT», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 33 мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 33 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/0694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.



Партия № 00000

Годен до: 0000-00



Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
меди изделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (Т.З. «VIZIT», 100 шт.)

Презерватив для УЗИ, ø 34мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, с смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 34 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru.

Сделано в России.




0000



Партия № 00000



Годен до: 0000-00

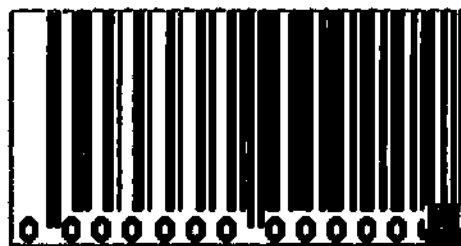

Макет маркировки этикетки для упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (Т.З. «VIZIT», 100 шт.)

ALPINA PLAST

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 18 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.


Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

 Годен до:

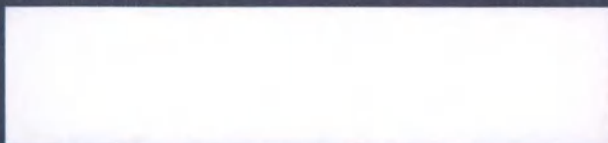

 Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

ALPINA PLAST


50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 20 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

 Годен до:

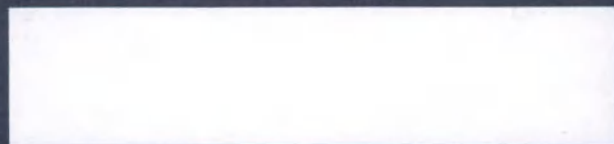

 Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 20 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.


Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

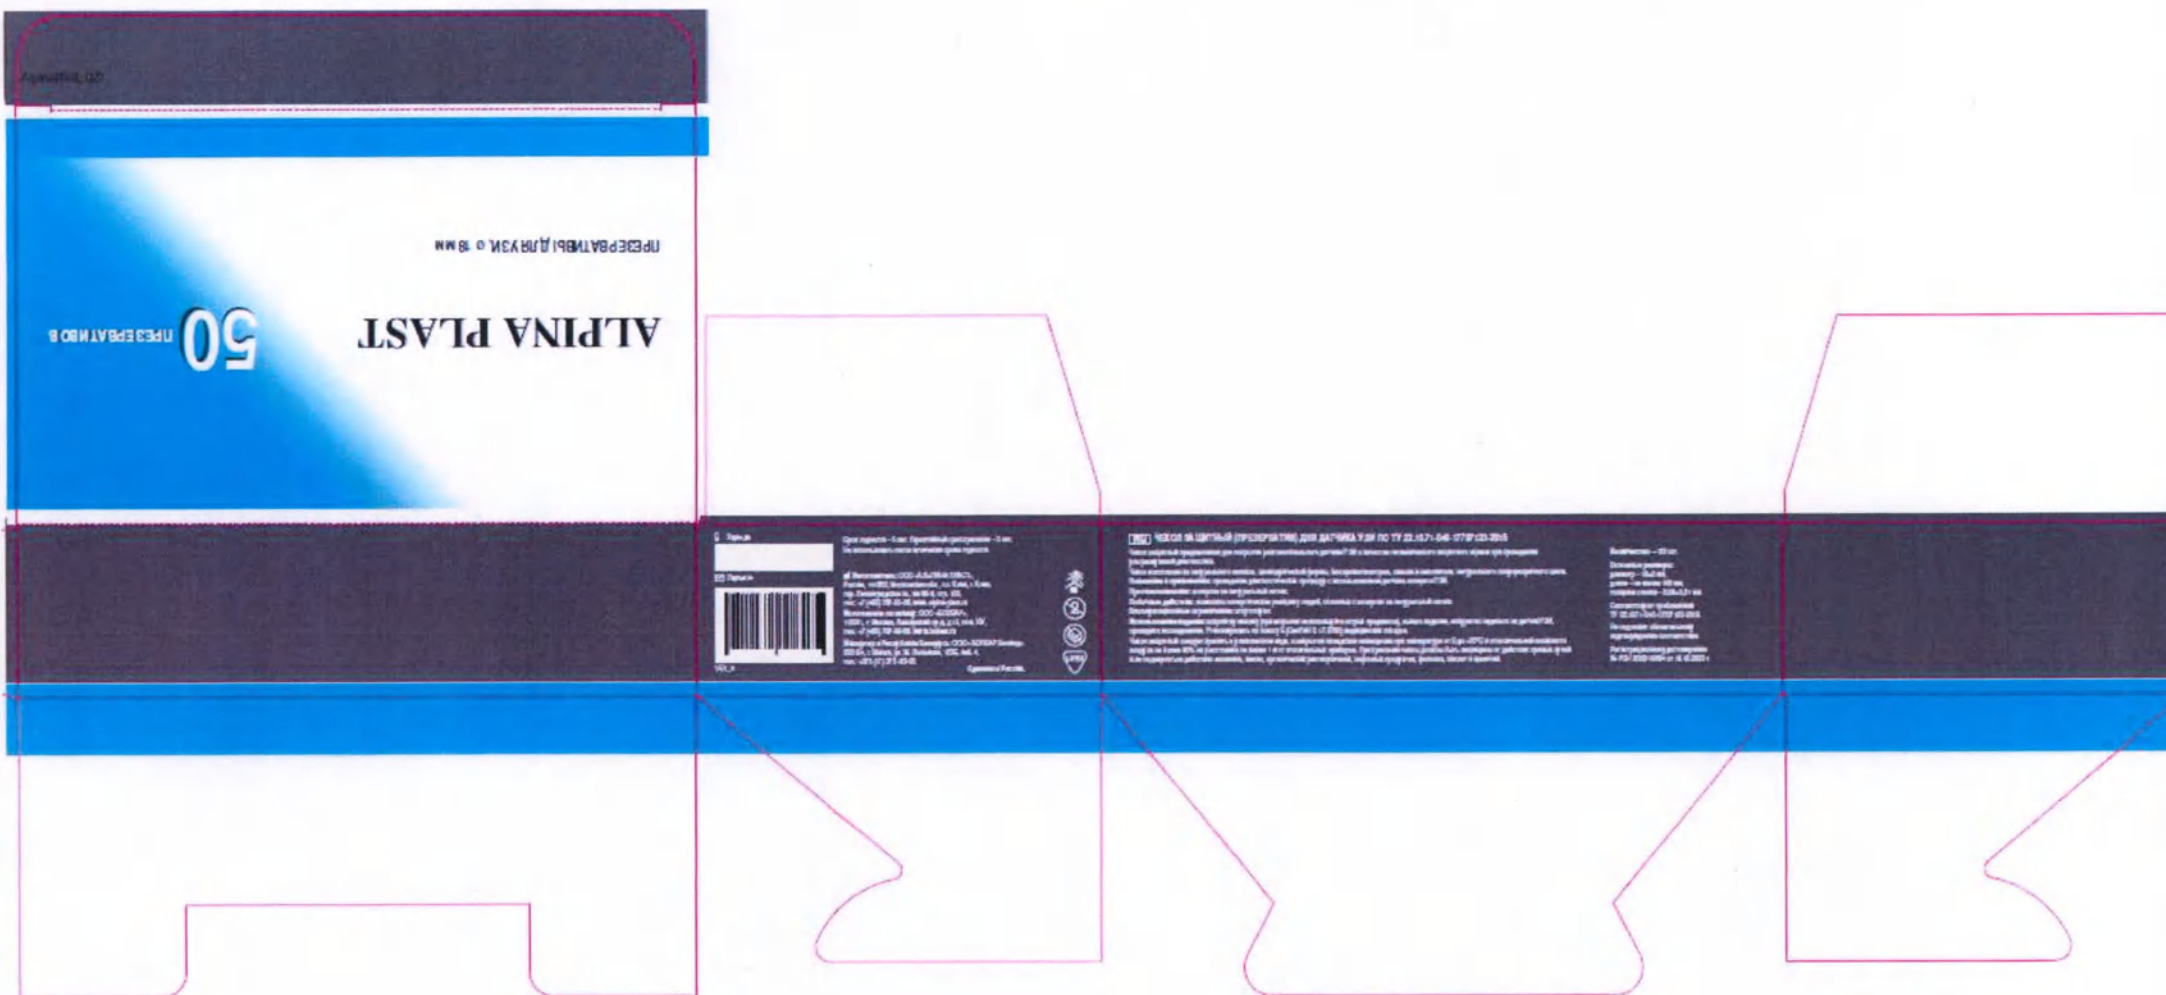

Общий вид макеты упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 28 мм (50шт.)

ALPINA PLAST

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 28 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (50 шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.


Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (50 шт.)



Годен до:

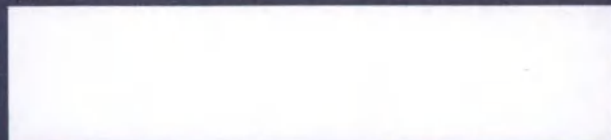

Партия №



VER_n


Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (50 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.


Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (50 шт.)

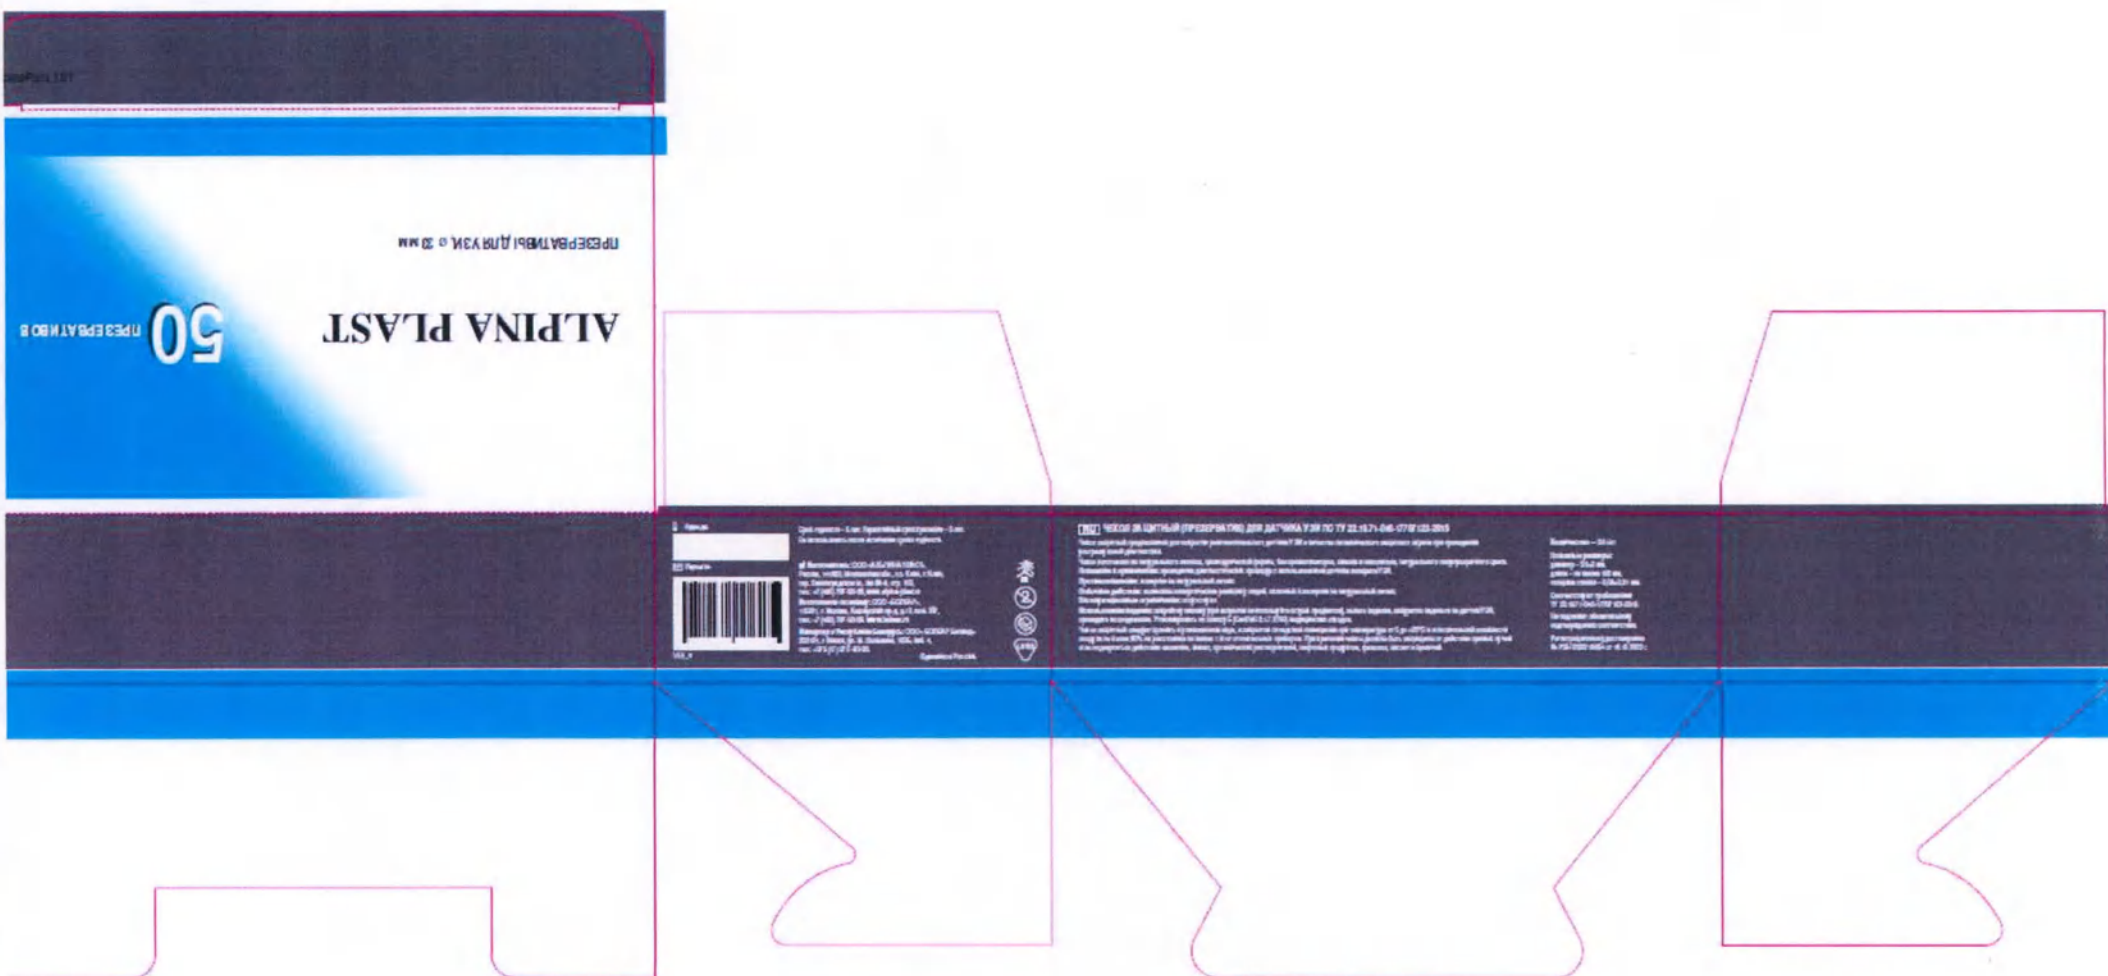

Общий вид макеты упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 33 мм. (50шт.)

ALPINA PLAST

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 33 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (50 шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 33 ± 2 мм,

длина – не менее 185 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.


Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (50 шт.)



Годен до:



Партия №

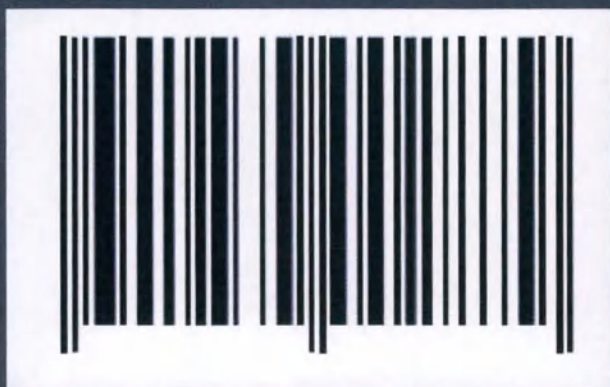

VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (50 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.


Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (50 шт.)

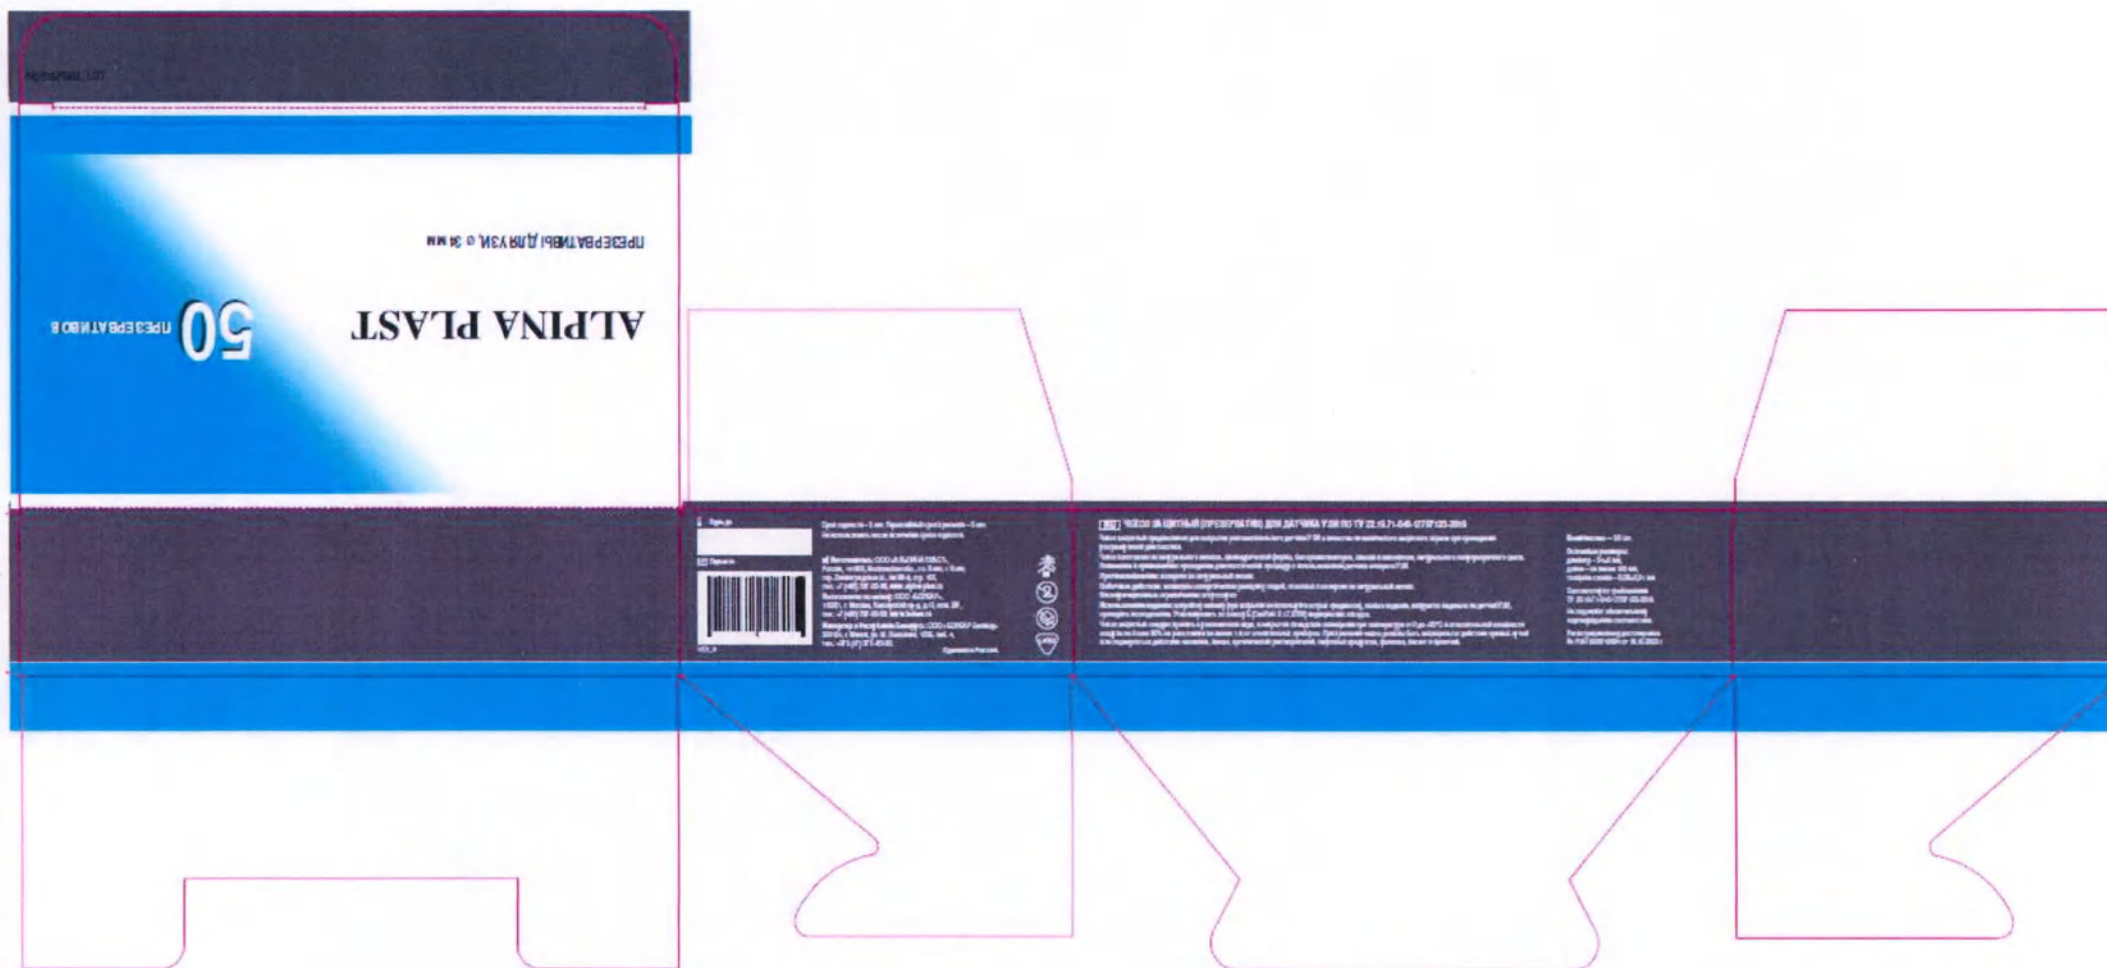

Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 34 мм. (50шт.)

ALPINA PLAST

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 34 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (50 шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 34 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (50 шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (50 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.


Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (50 шт.)

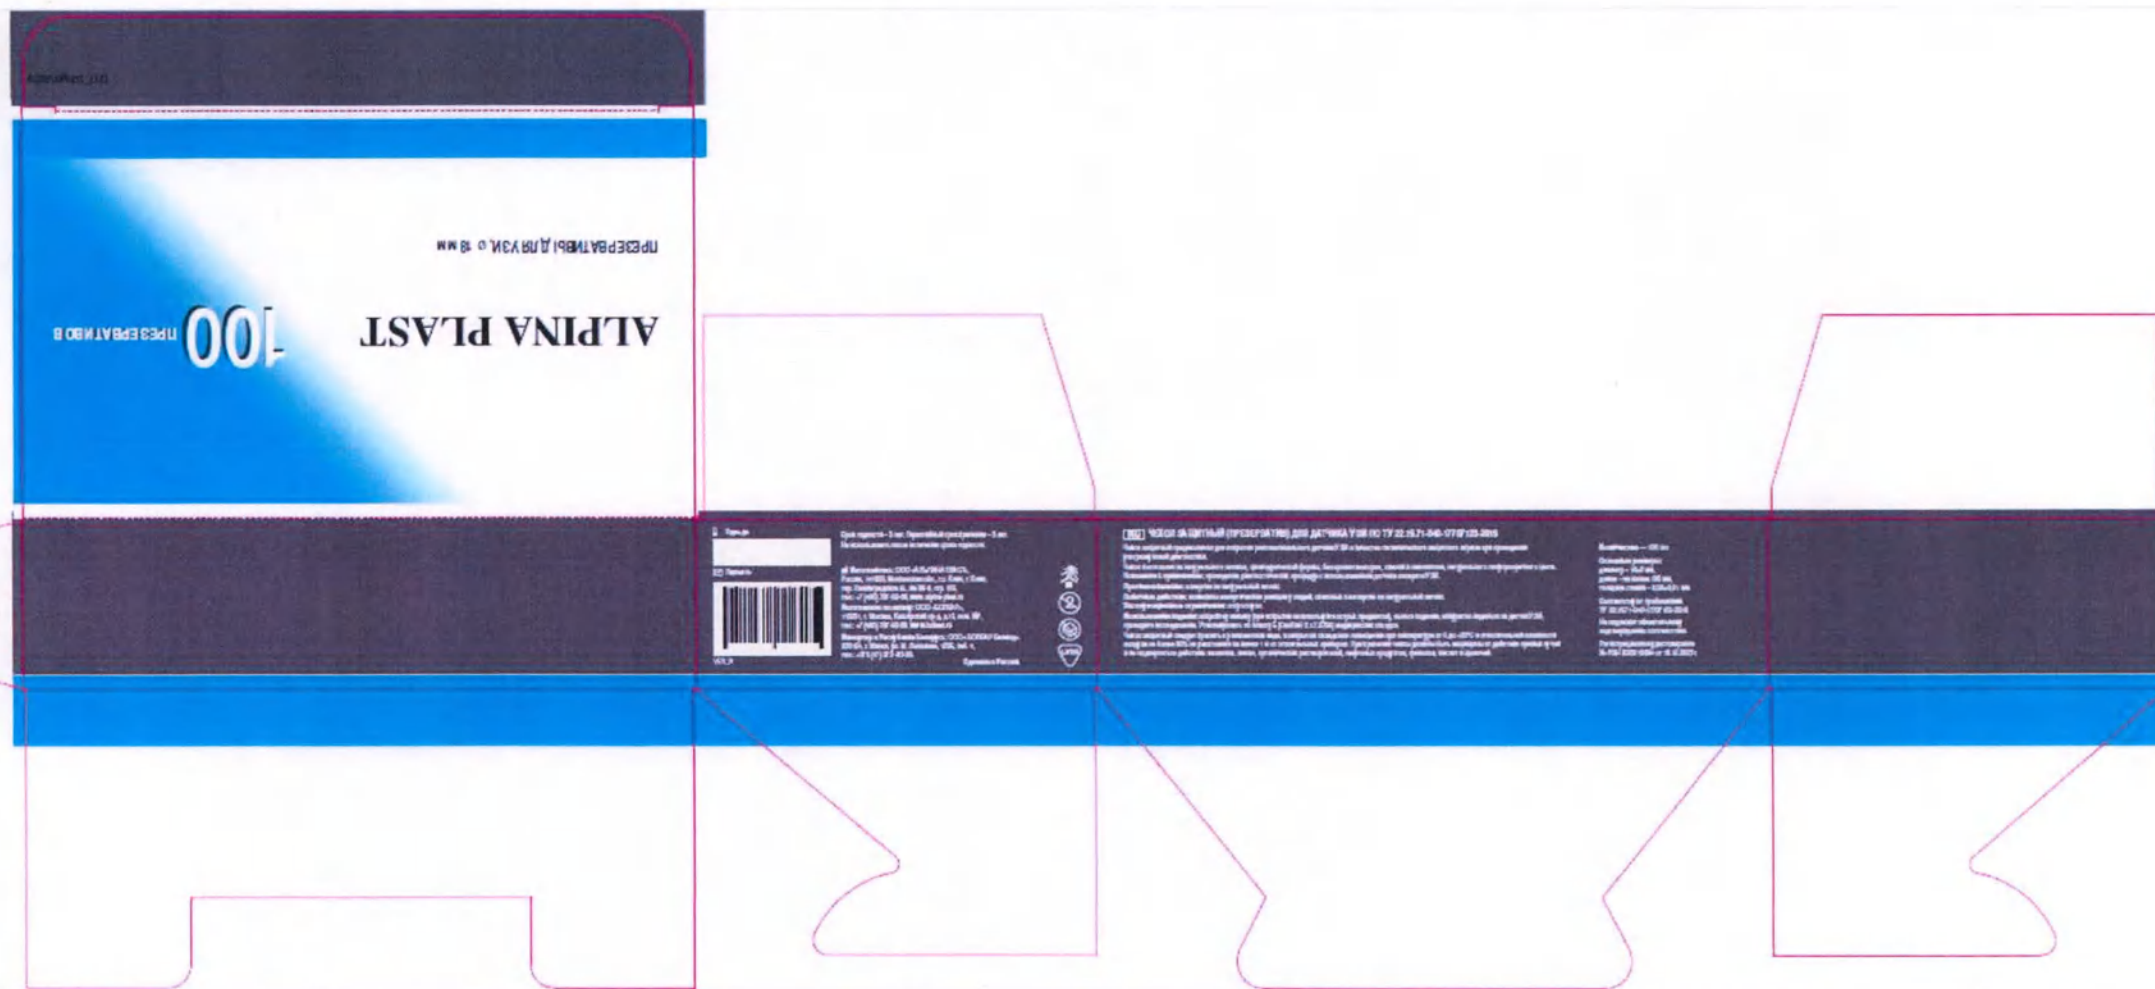

Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 18 мм. (100шт.)

ALPINA PLAST

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 18 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (100шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (100шт.)

ALPINA PLAST

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 20 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 20 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.


Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)



Годен до:

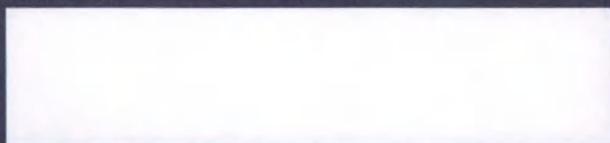

Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru


Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

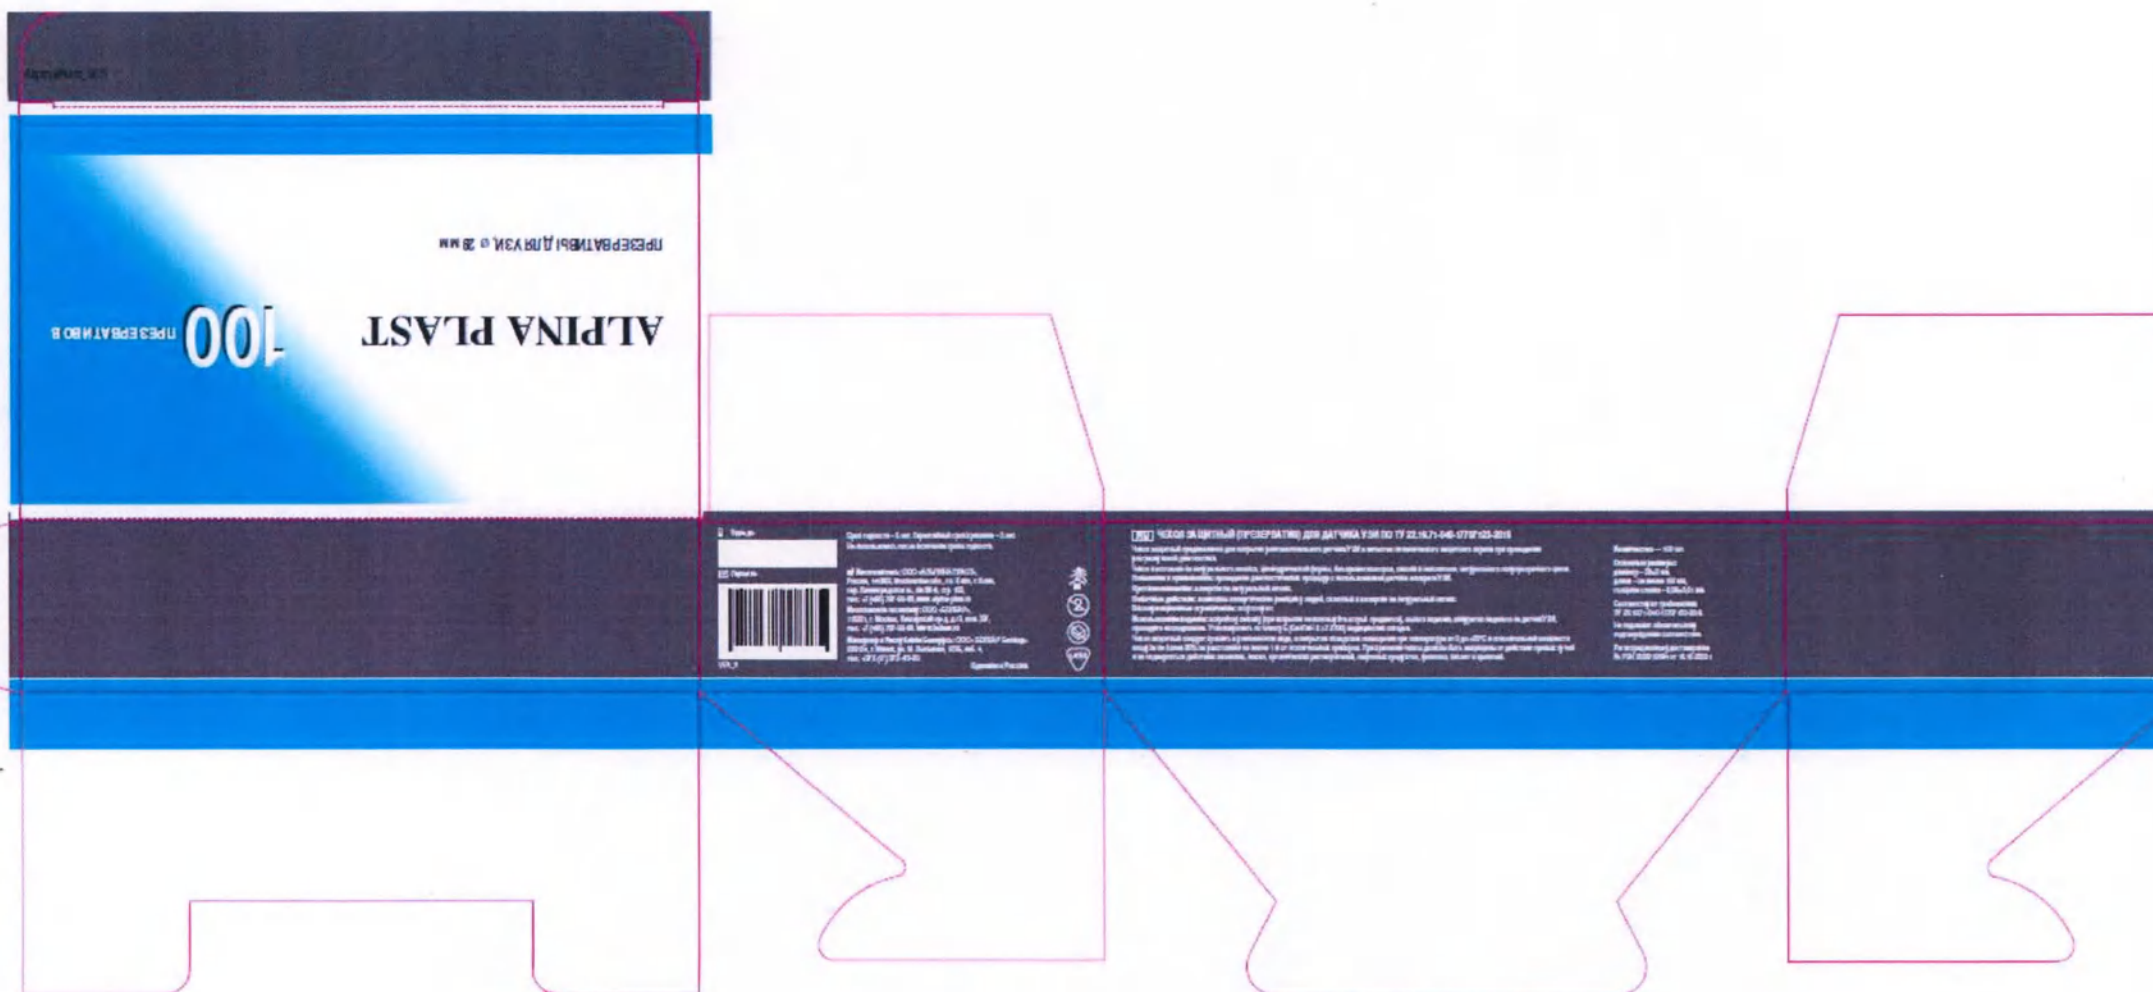

Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 28 мм. (100шт.)

ALPINA PLAST

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, $\varnothing$ 28 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 28, (100 шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (100 шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (100 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28, (100 шт.)

ALPINA PLAST

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 33 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (100 шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 33 ± 2 мм,

длина – не менее 185 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (100 шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (100 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.


Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33, (100 шт.)

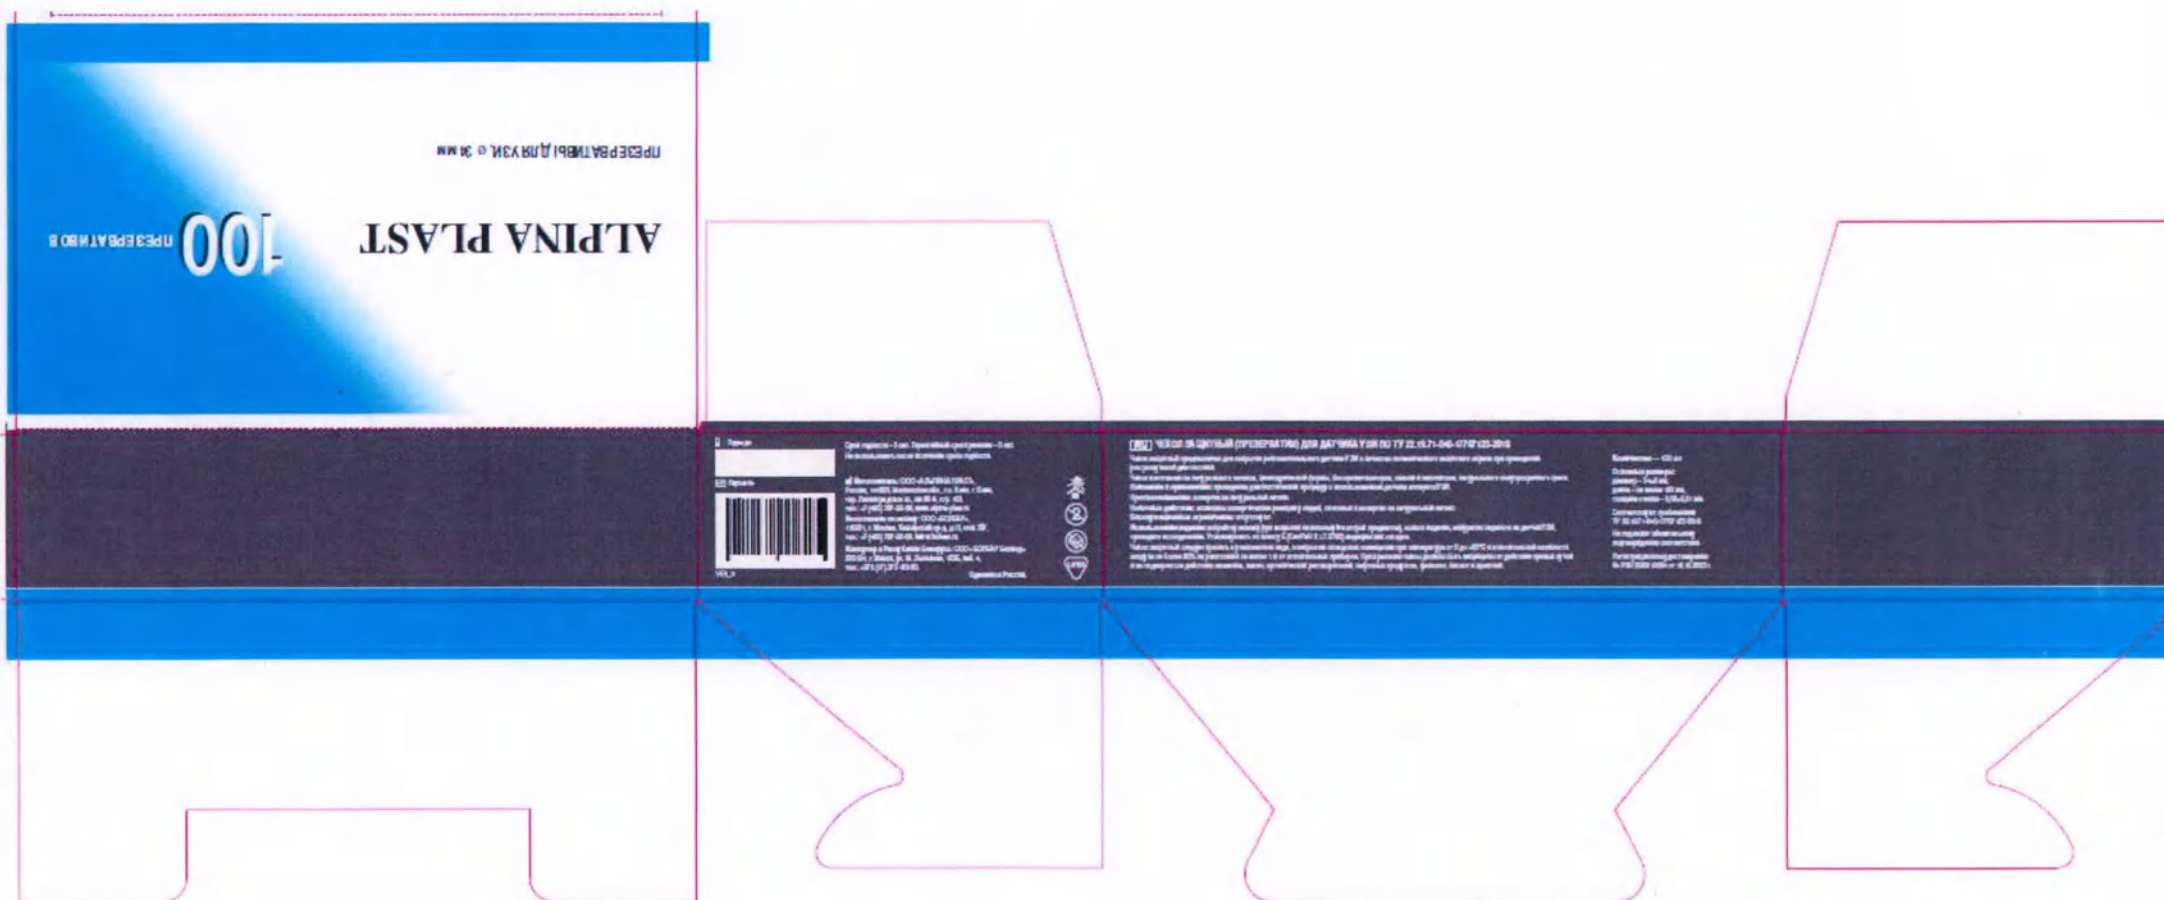

Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 34 мм (100 шт.)

ALPINA PLAST

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 34 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (100 шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 34 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (100 шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (100 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34, (100 шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 18 мм (50 шт.)

VIVA

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 18 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 20 мм. (50 шт.)

VIVA

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 20 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 20 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

VIVA

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, Ø 28 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, Ø 28мм (50шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)



Общий вид макета упаковки медицинского изделия – Презерватив для УЗИ, 33 мм (50 шт.)

VIVA


50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 33 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)

 Годен до:

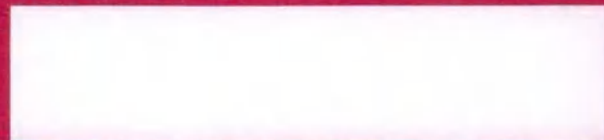

 Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 33 ± 2 мм,

длина – не менее 185 мм,

толщина стенки – $0,08\pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)

VIVA

50

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, Ø 34 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, Ø 34мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 34 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.


Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)



Годен до:

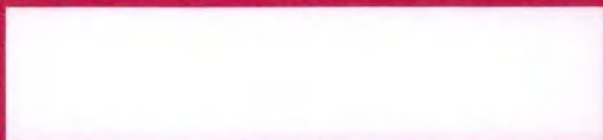

Партия №



VER_п

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)

VIVA

100 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 18 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 20 мм (100 шт.)

VIVA

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 20 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 20 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)



Годен до:



Партия №



VER_п

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 28 мм (100 шт.)

VIVA

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 28 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)

VIVA

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 33 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 33 ± 2 мм,

длина – не менее 185 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортёр в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)

VIVA

100

ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, Ø 34 мм

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, Ø 34мм (100 шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 34 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100 шт.)



Годен до:



Партия №



VER_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100 шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенные фрагменты упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100 шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 18 мм (50 шт.)



50 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 18 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (50шт.)



50 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 20 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 20 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (50шт.)



50 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 28 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (50шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 33 мм (50 шт.)



50 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 33 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 33 ± 2 мм,

длина – не менее 185 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)



Годен до:



Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (50шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 34 мм (50 шт.)



50 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 34 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 34 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (50шт.)



100 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 18 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 18мм (100шт.)



100 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, Ø 20 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, Ø 20мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 20 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)

 Годен до:



 Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 20мм (100шт.)



Общий вид макета упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, 28 мм (100 шт.)



100 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 28 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)



Годен до:



Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 28мм (100шт.)



100 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 33 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 33 ± 2 мм,

длина – не менее 185 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)



Годен до:



Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 33мм (100шт.)



100 ПРЕЗЕРВАТИВОВ

ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДЛЯ УЗИ, ø 34 мм

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100шт.)



Годен до:



LOT Партия №



VER10_n

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,
тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,
тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.



Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100шт.)

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 34 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100шт.)

RU ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Увеличенный фрагмент упаковки медицинского изделия - Презерватив для УЗИ, ø 34мм (100шт.)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

185/сго воемь листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов



Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019
фото изделий, упаковки

Январь 2024



Презерватив для УЗИ, ø 18мм



Презерватив для УЗИ, ø 20мм



Презерватив для УЗИ, ø 28мм



Презерватив для УЗИ, ø 33мм



Презерватив для УЗИ, ø 34мм



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медицделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIVA», 100 шт.)



Презервативы для УЗИ, ø 20мм

Количество 100 шт.

Инструкция по применению

Чехол защитный (презерватив) для датчика УЗИ
№ ТУ 22.18.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для защиты рефлексиметрического датчика УЗИ от загрязнения и повреждения. Чехол выполнен из ультратонкой эластичной пленки из полиуретана, имеет форму, соответствующую форме датчика. Без ароматизаторов, смазки и наполнителей, натурального матово-прозрачного цвета.



Получить инструкцию
отправив SMS-сообщение

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: аллергия, аллергические реакции у людей, склонных к аллергиям на натуральные латексы.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: извлеките упаковку. При вскрытии не используйте пальцы и ногти. Чехол извлечь аккуратно, не повреждая датчик. Проверить целостность чехла.

Утилизация: после использования изделие подлежит утилизации по классу Б (См. Письмо 2.1.1.2700) медицинских отходов.

Хранение: чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом состоянии, вдали от прямых солнечных лучей, в диапазоне температур от 0 до +20°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускать контакта с острыми предметами. При вскрытии чехла, допускать быть воздействию на датчик УЗИ и не подвергать его воздействию влаги, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Срок годности: 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

— использовать после истечения срока годности.

Основные размеры: номинальный диаметр – 20 мм, длина – не менее 100 мм, толщина стенки – 0,06-0,07 мм.

Согласовано в соответствии с ТУ 22.18.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационный удостоверение № РО-Н-2020/12854 от 18.10.2020г.

И изготовитель: ООО «АЛПИНА ПЛАСТ», Россия, 141003, Московская обл., г. Клин, т. Клин, пер. Ленинградское ш., км 9В-2, стр. 103
тел. +7 (495) 767-93-85, www.alpina-plast.ru

Сделано в России.



Партия № 00000

ГОТ Годен до: 0000-00



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIVA», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «VIVA», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «VIVA», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIVA», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIZIT», 100 шт.)

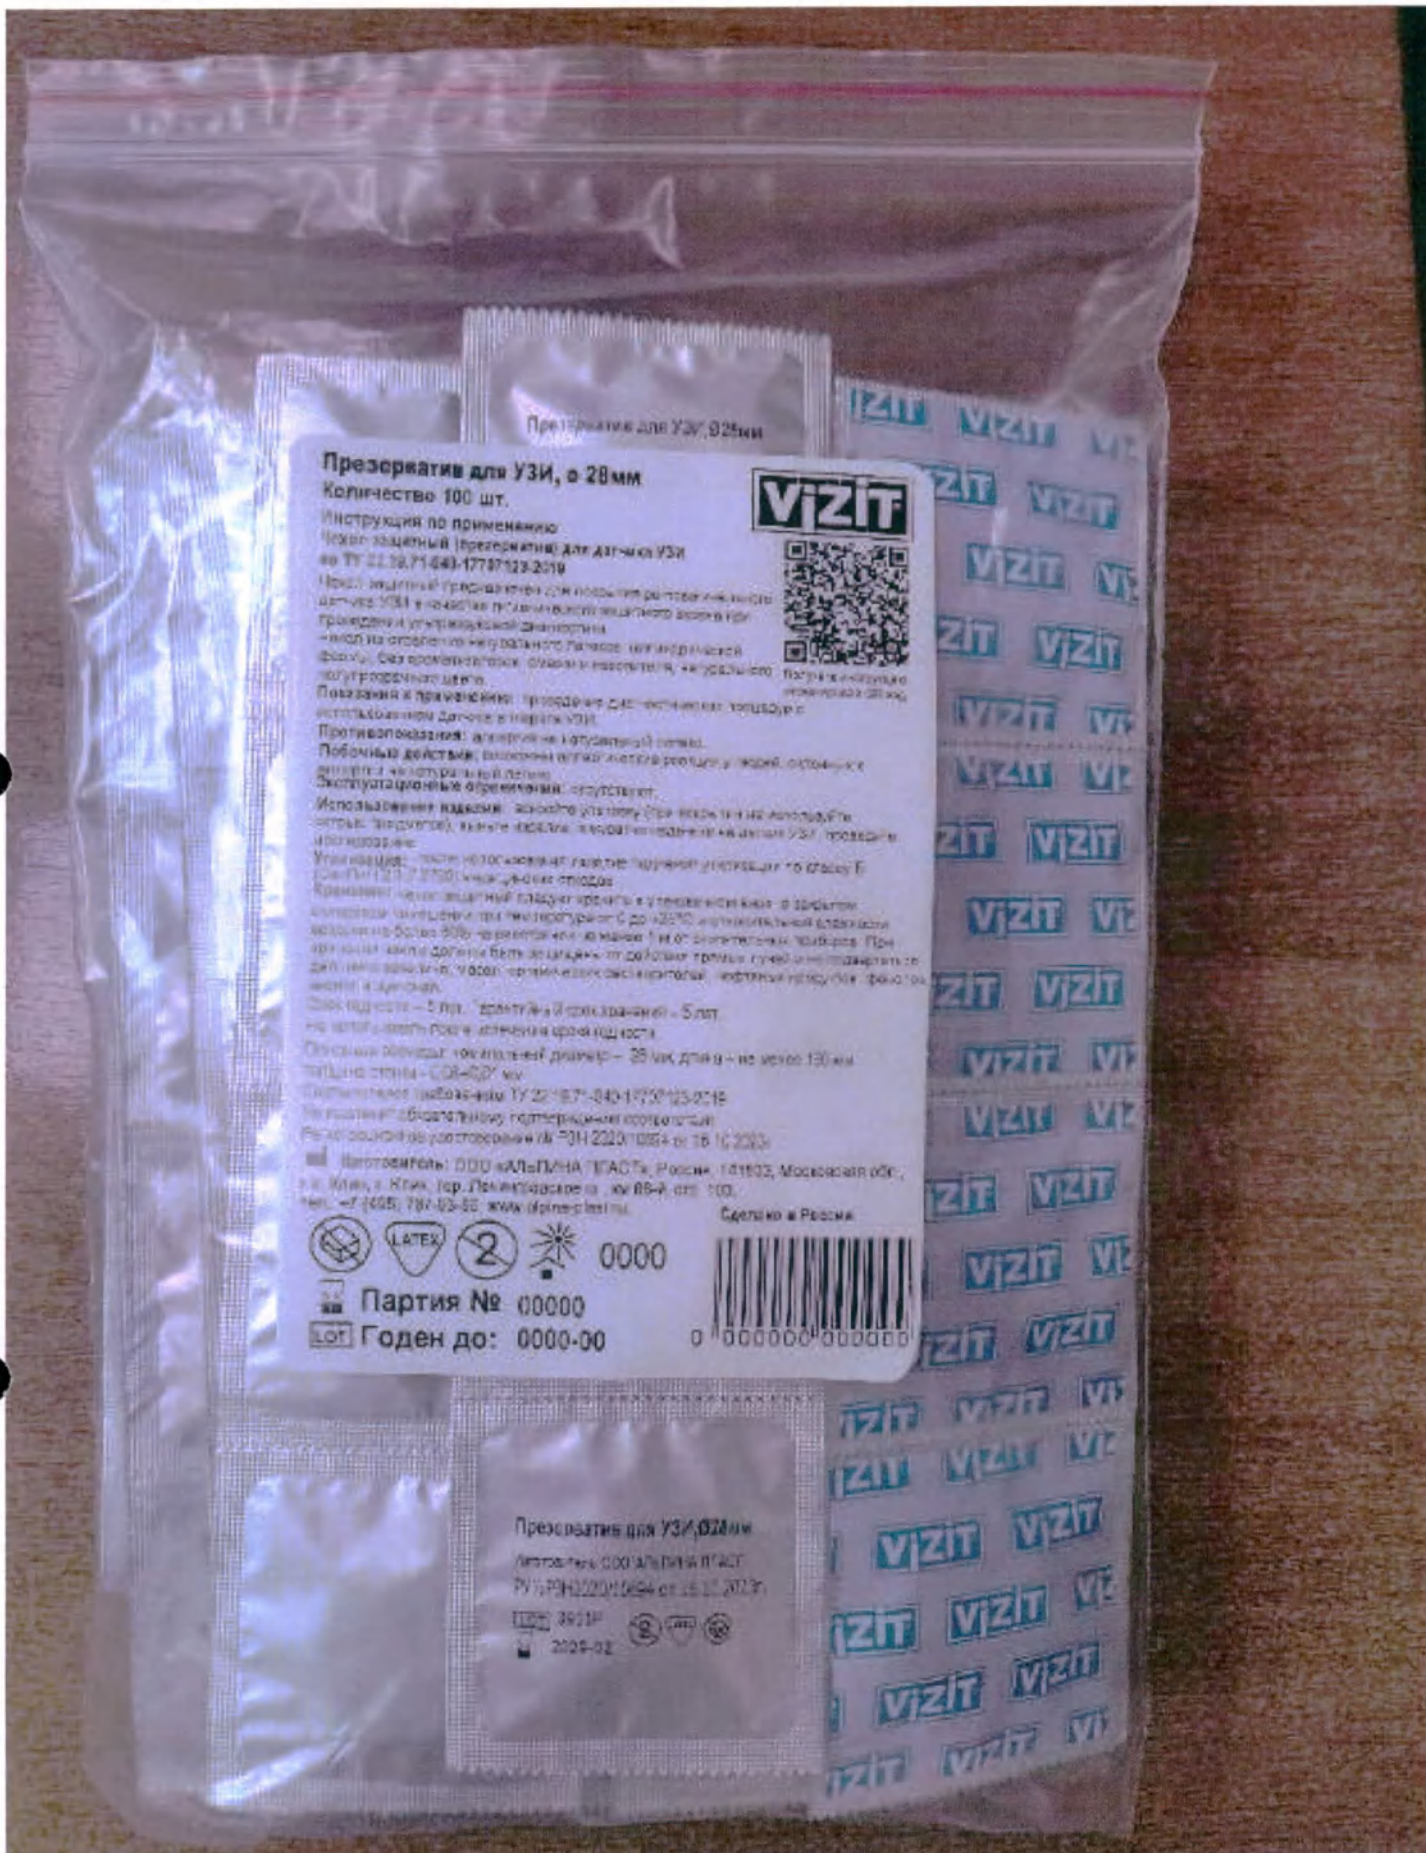


Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена)
медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «VIZIT», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «VIZIT», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIZIT», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, Ø 28 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 100 шт.)



Фото упаковки (пакет с замком ZipLock из полиэтилена) медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 100 шт.)



Фото (лицевая сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм, ø 20 мм, ø 28 мм, ø 33 мм, ø 34 мм (товарный знак «VIVA», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 18 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 18 мм
(товарный знак «VIVA», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 20 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88 й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед» 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 20 мм, (товарный знак «VIVA», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 28 мм (товарный знак «VIVA», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию эфирных масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 33 ± 2 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел. +7 (495) 787 92-68, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787 92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел. +375 (17) 373 83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 33 мм, (товарный знак «VIVA», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 34 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел. +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел. +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 34 мм (товарный знак «VIVA», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию взвешивания, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 18 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б каб. 4 тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 18 мм (товарный знак «VIZIT», 1 шт.)

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 20 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,06 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел. +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201 г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмэд», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 1235, каб. 4, тел. +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 20 мм (товарный знак «VIZIT», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмэд», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 1235, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, 28 мм (товарный знак «VIZIT», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведения диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов) выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию азелаина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 33 ± 2 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – $0,06 \pm 0,01$ мм

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел. +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201 г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124 г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел. +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «VIZIT», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведения диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов) выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 90% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию эфирных масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 34±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел. +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел. +375 (17) 373-83-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIZIT», 1 шт.)



Фото (лицевая сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 18 мм, $\varnothing$ 20 мм, $\varnothing$ 28 мм, $\varnothing$ 33 мм, $\varnothing$ 34 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 1 шт.)

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ с качеством гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов) выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 18 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ» Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР», 115201 г. Москва, Каширский пр-д д.13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124 г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-33-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 18 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия реактивного датчика УЗИ с целью предотвращения защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без присадок, масел и химических веществ, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральные латексы.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыть упаковку (при вскрытии не использовать острых предметов), вынуть изделие, аккуратно надеть на датчик УЗИ, проводить исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию загаров, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 20 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ» Россия 141603, Московская обл., г.о. Клин, с. Клин, тер. Ленинградское ш. км 88-й стр. 103, тел. +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201 г. Москва, Каширский пр-д, д. 19, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР-Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лыньковс, 123Б каб. 4, тел. +375 (17) 973-43-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 20 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и наполнителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведения диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 60% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию эфирных масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 28±2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – 0,08±0,01 мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, г. Клин-тер, Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103, тел.: +7 (495) 787-83-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 3, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лисенкова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-33-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 1 шт.)

**ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.**

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскройте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию эфирных масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 33 ± 2 мм, длина – не менее 185 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет. **Гарантийный срок хранения** – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 18.10.2023 г.

И изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ» Россия 141603 Московская обл. г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш. км 88-й стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66 www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»

115201 г. Москва, Каширский пр-д д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортёр в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмад»

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-33-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 33 мм, (товарный знак «ALPINA PLAST», 1 шт.)

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ
ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Чехол защитный предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики. Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрыйте упаковку (при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ, проведите исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию эфирных масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Основные размеры: диаметр – 34 ± 2 мм, длина – не менее 190 мм, толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Количество: 1 шт.

Срок годности – 5 лет, Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

Соответствуют требованиям ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

И изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 68-и стр. 103, тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР».

115201 г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124 г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел.: +375 (17) 373-43-20.

Сделано в России.

Фото (оборотная сторона) упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», 1 шт.)



Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр – 18 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

 **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,

Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,

тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103,

тел.: +7 (495) 787-93-66, www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу: ООО «БОЛЕАР»,

115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,

тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


Импортер в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4,

тел.: +375 (17) 373 -83-20.

Сделано в России.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) –
Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 18 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

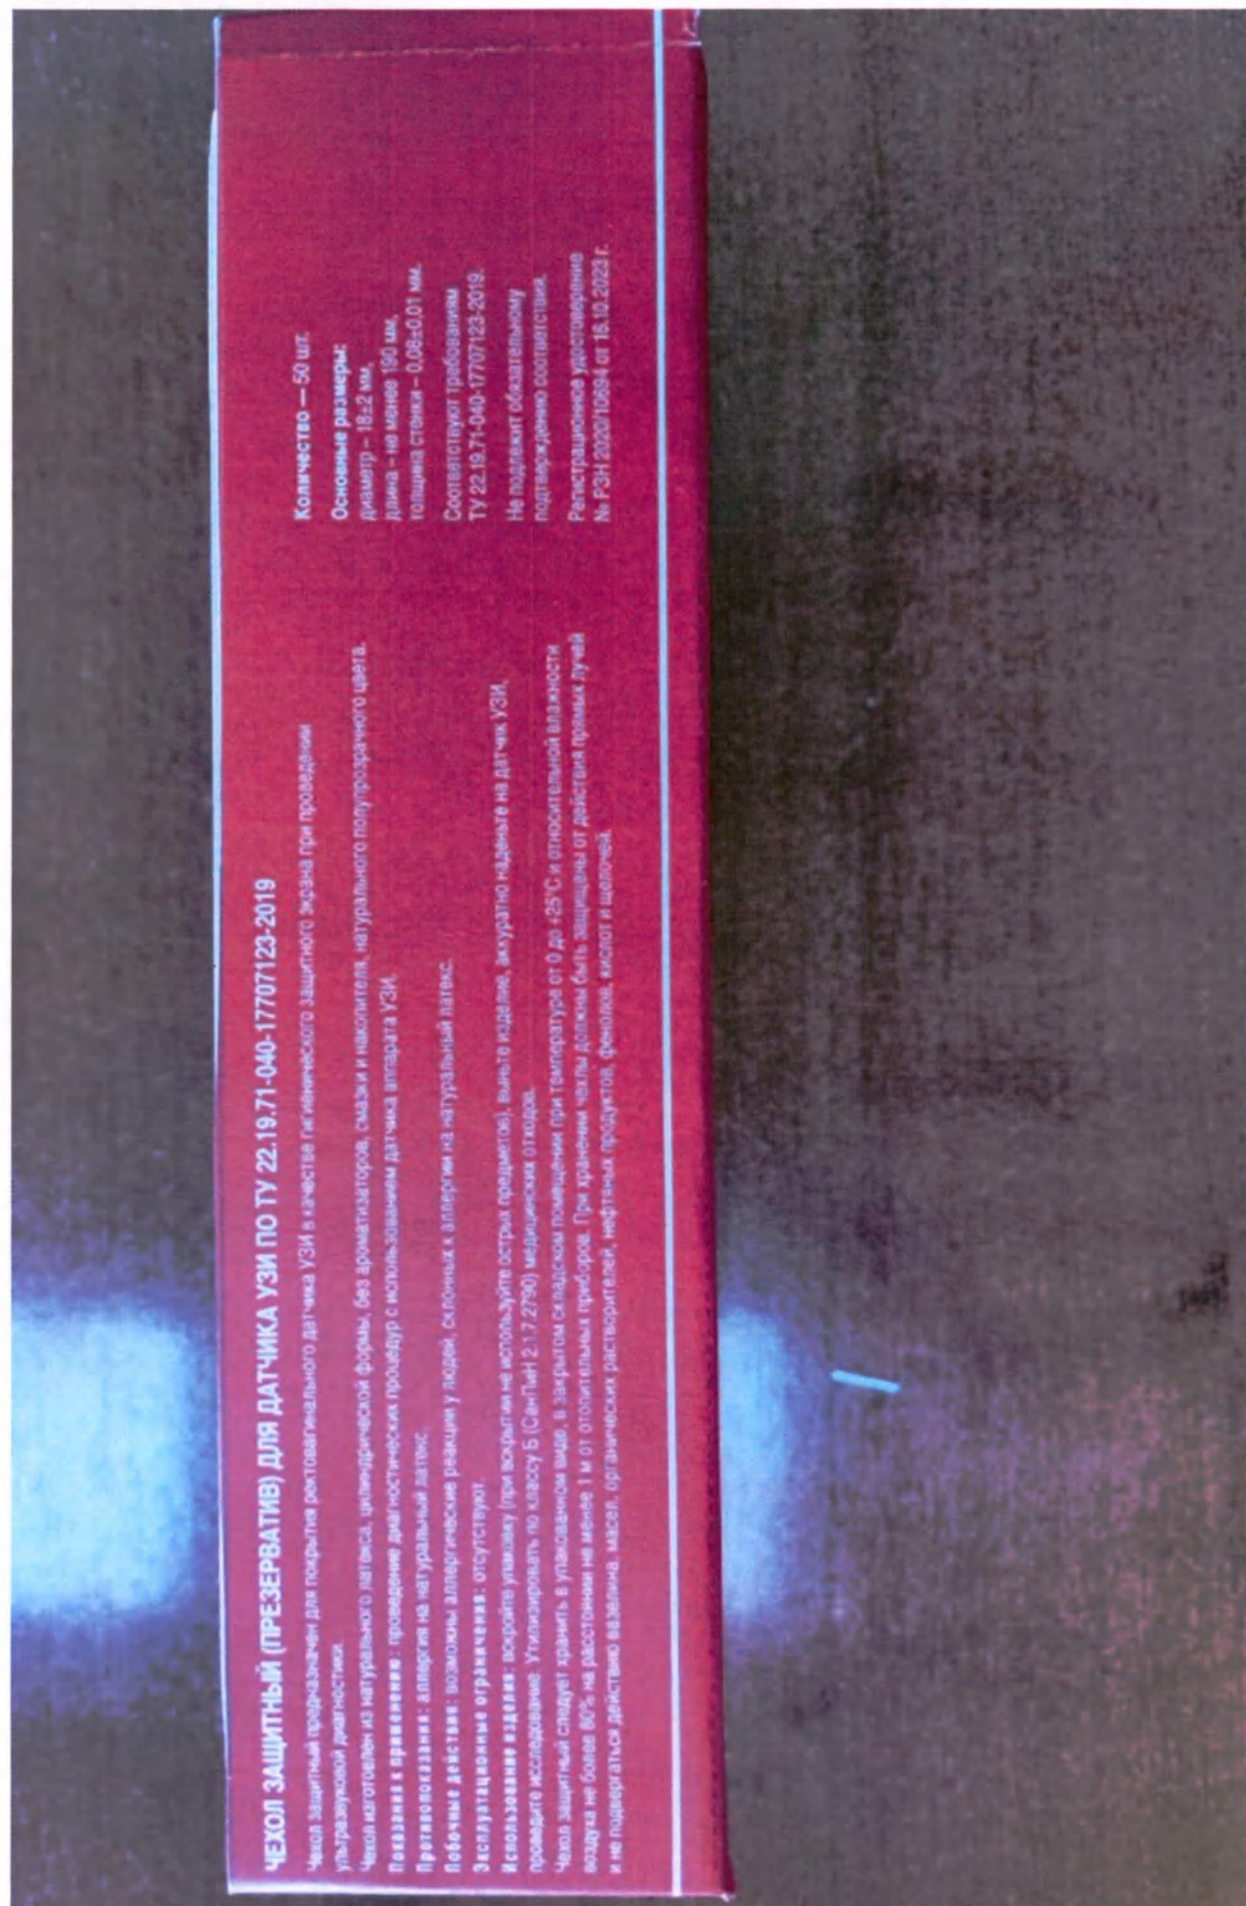

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректотерапевтического датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и наполнителя, натурального полупрозрачного цвета. Показан к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Заслуживающие ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрытие упаковки (при вскрытии не использовать острых предметов), вынуть изделие, аккуратно надеть на датчик УЗИ, провести исследование. Утилизировать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию влаги, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр — 18±2 мм,

длина — не менее 150 мм,

толщина стенки — 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному


подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ ФСН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) —

Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

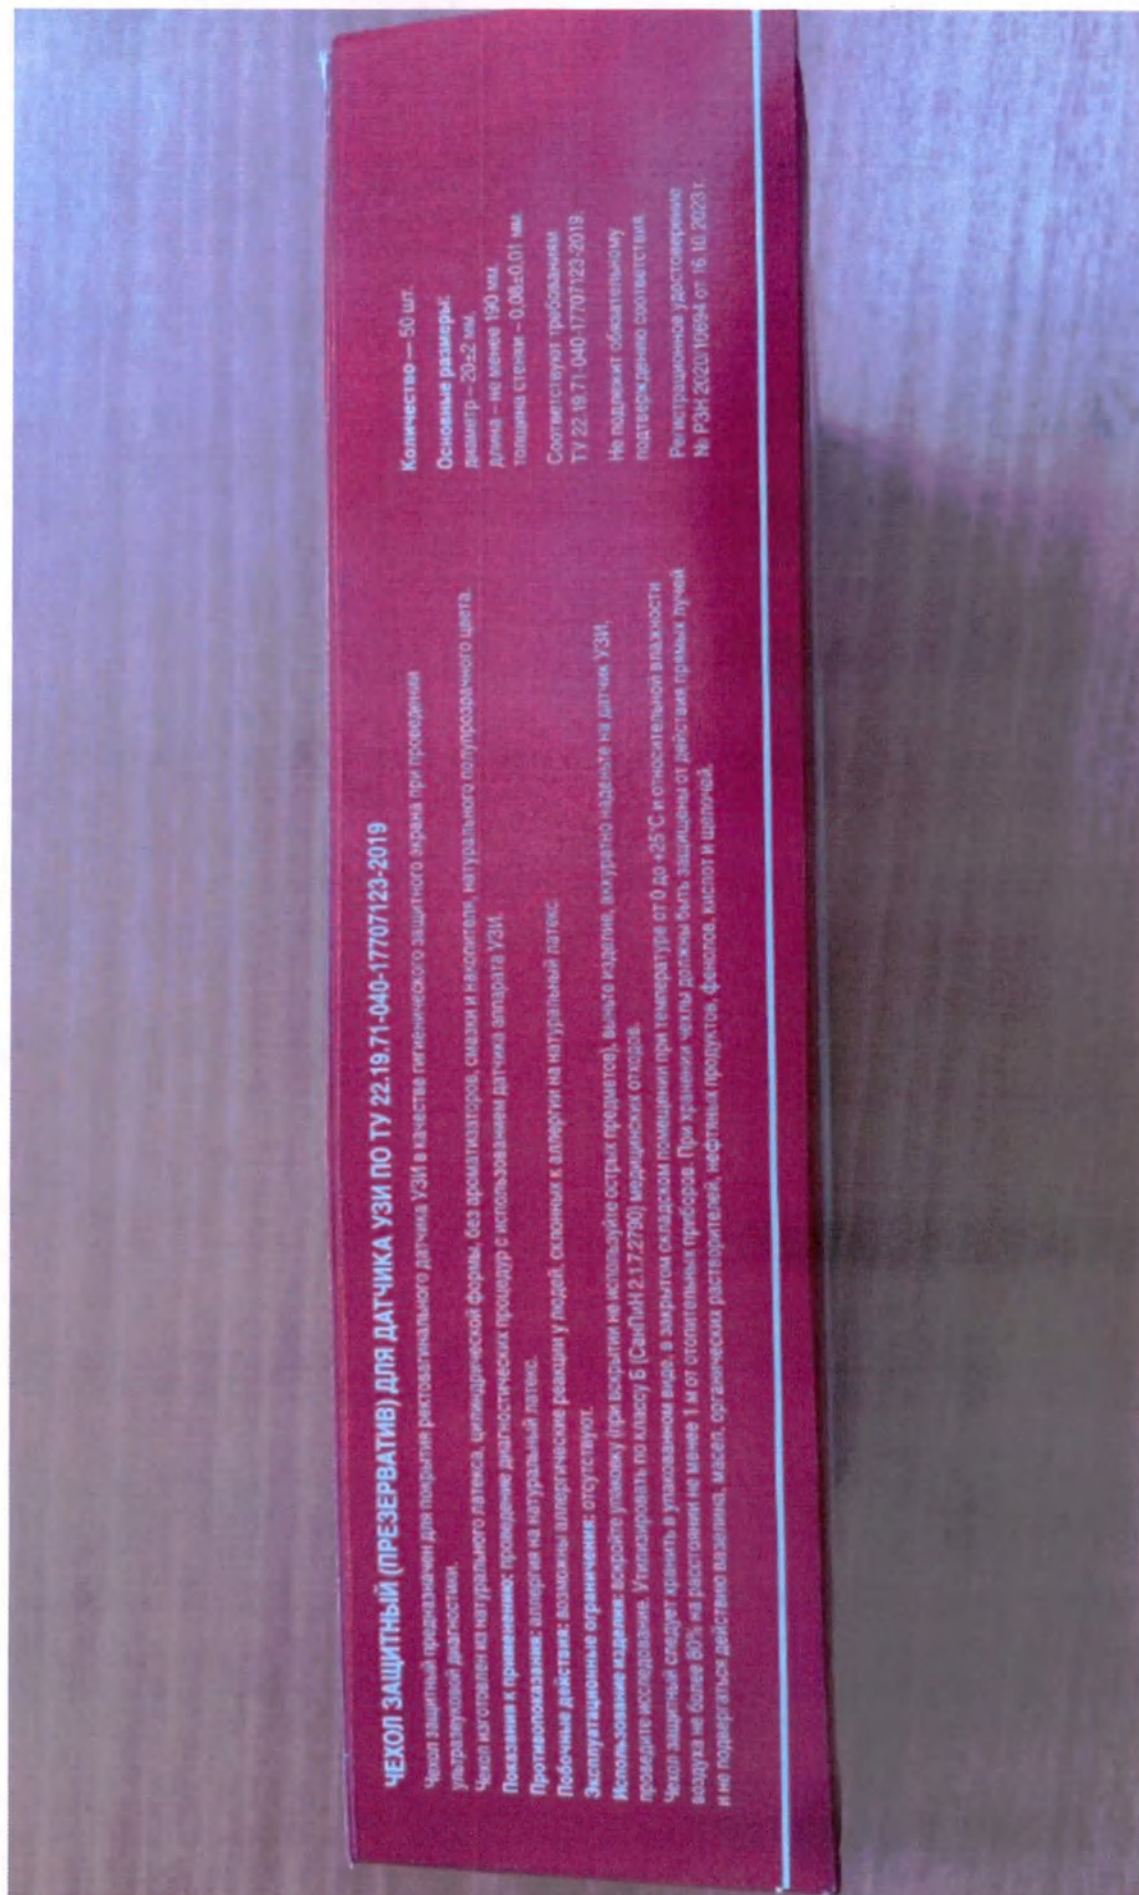

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия ректосигнального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении ультразвуковой диагностики.

Чехол изготовлен из натурального латекса, цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и красителей, натурального полупрозрачного цвета.

Показания к применению: проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания: аллергия на натуральный латекс.

Побочные действия: возможны аллергические реакции у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Использование изделия: вскрытое упаковку (при вскрытии не использовать острых предметов), вынуть изделие, аккуратно надеть на датчик УЗИ.

Примечание: изделие не использовать по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Чехол защитный следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться воздействию влаги, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр — 20±2 мм.

длина — не менее 150 мм.

толщина стенки — 0,06±0,01 мм.

Соответствует требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение:

№ РОИ 2020.10694 от 16.10.2023г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) — Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

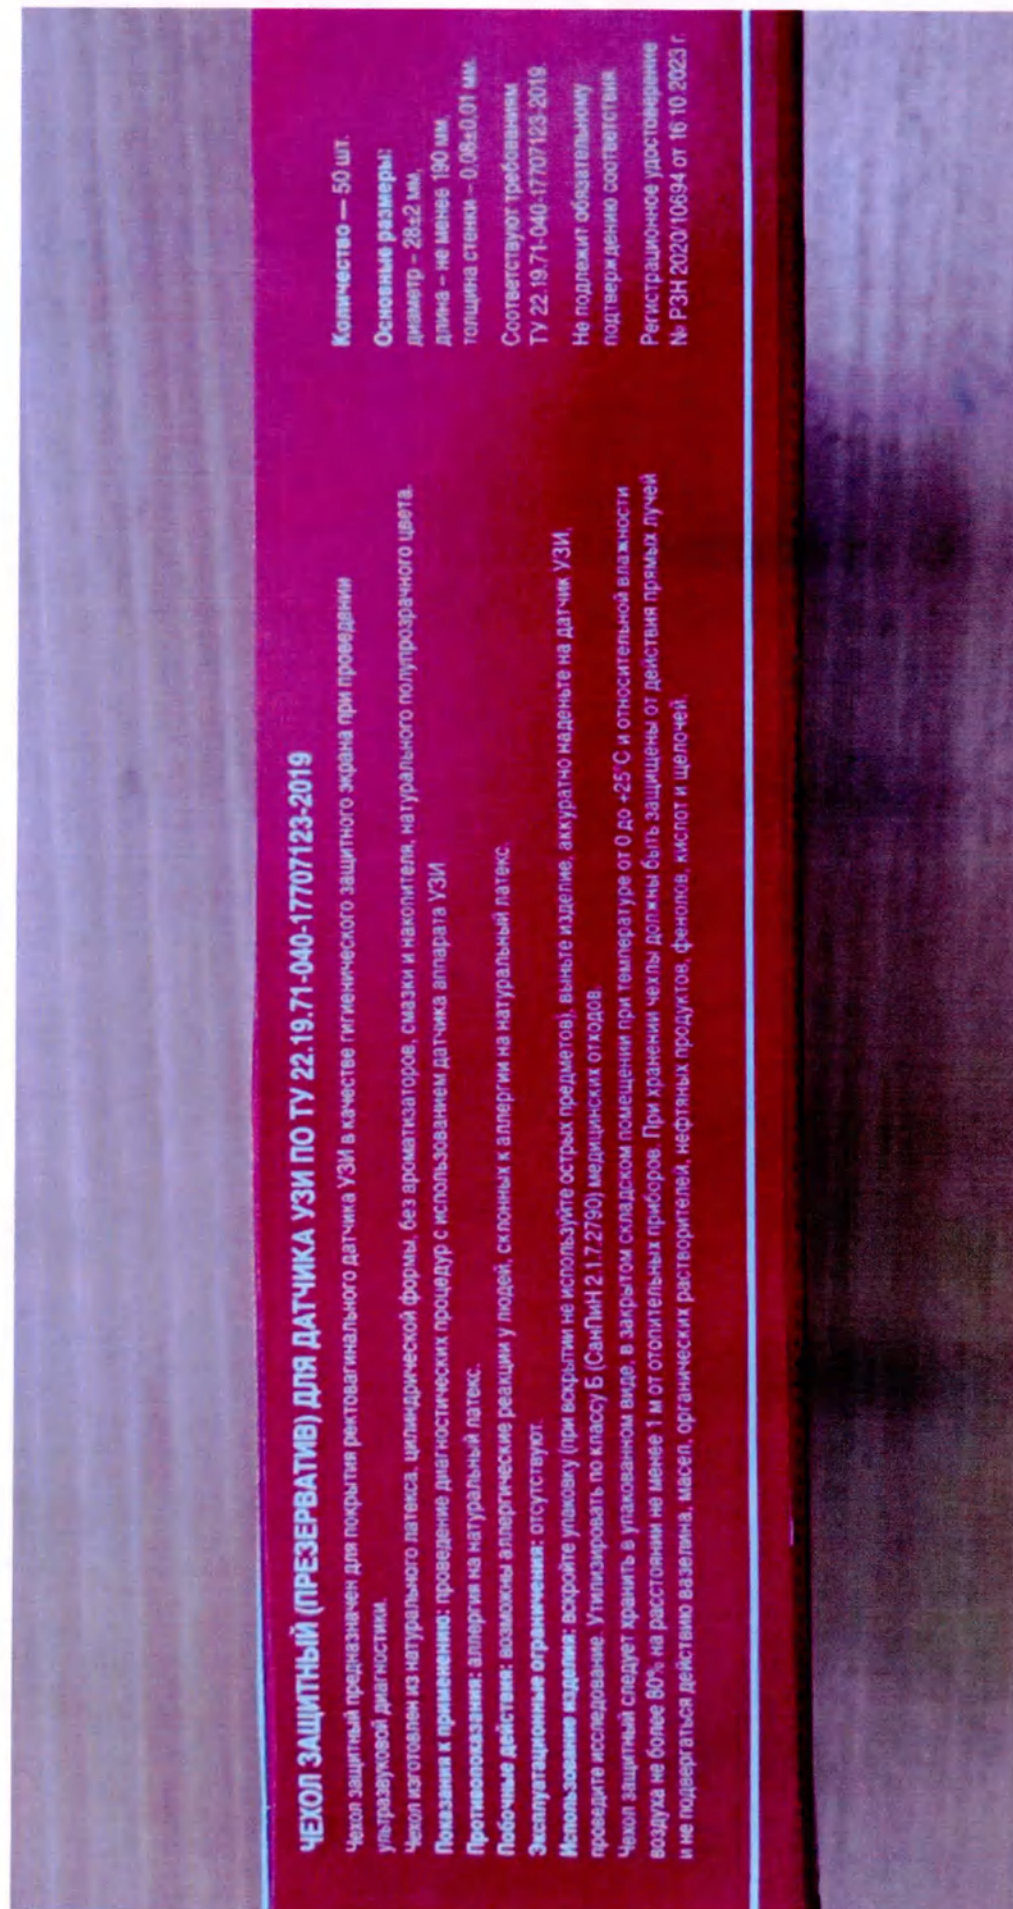


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

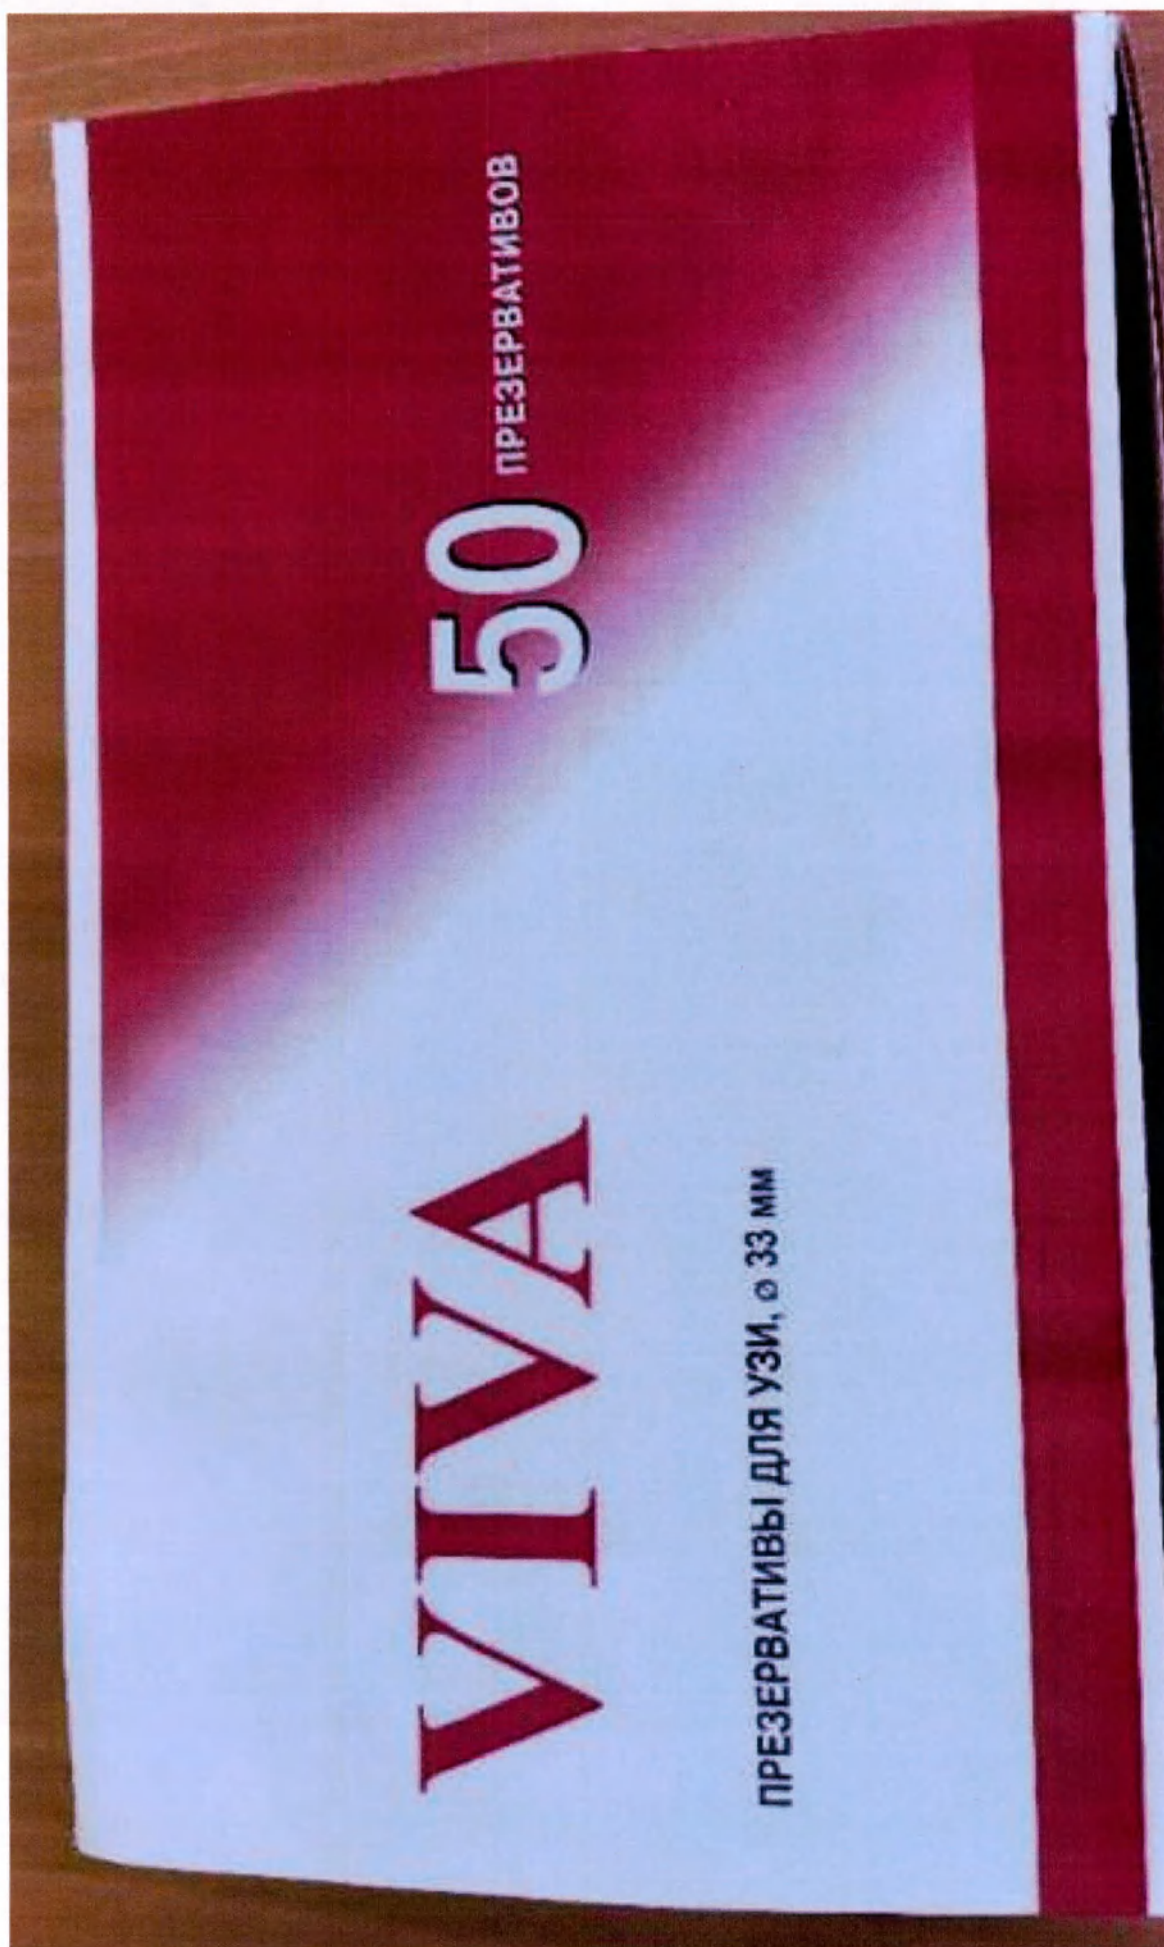


Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

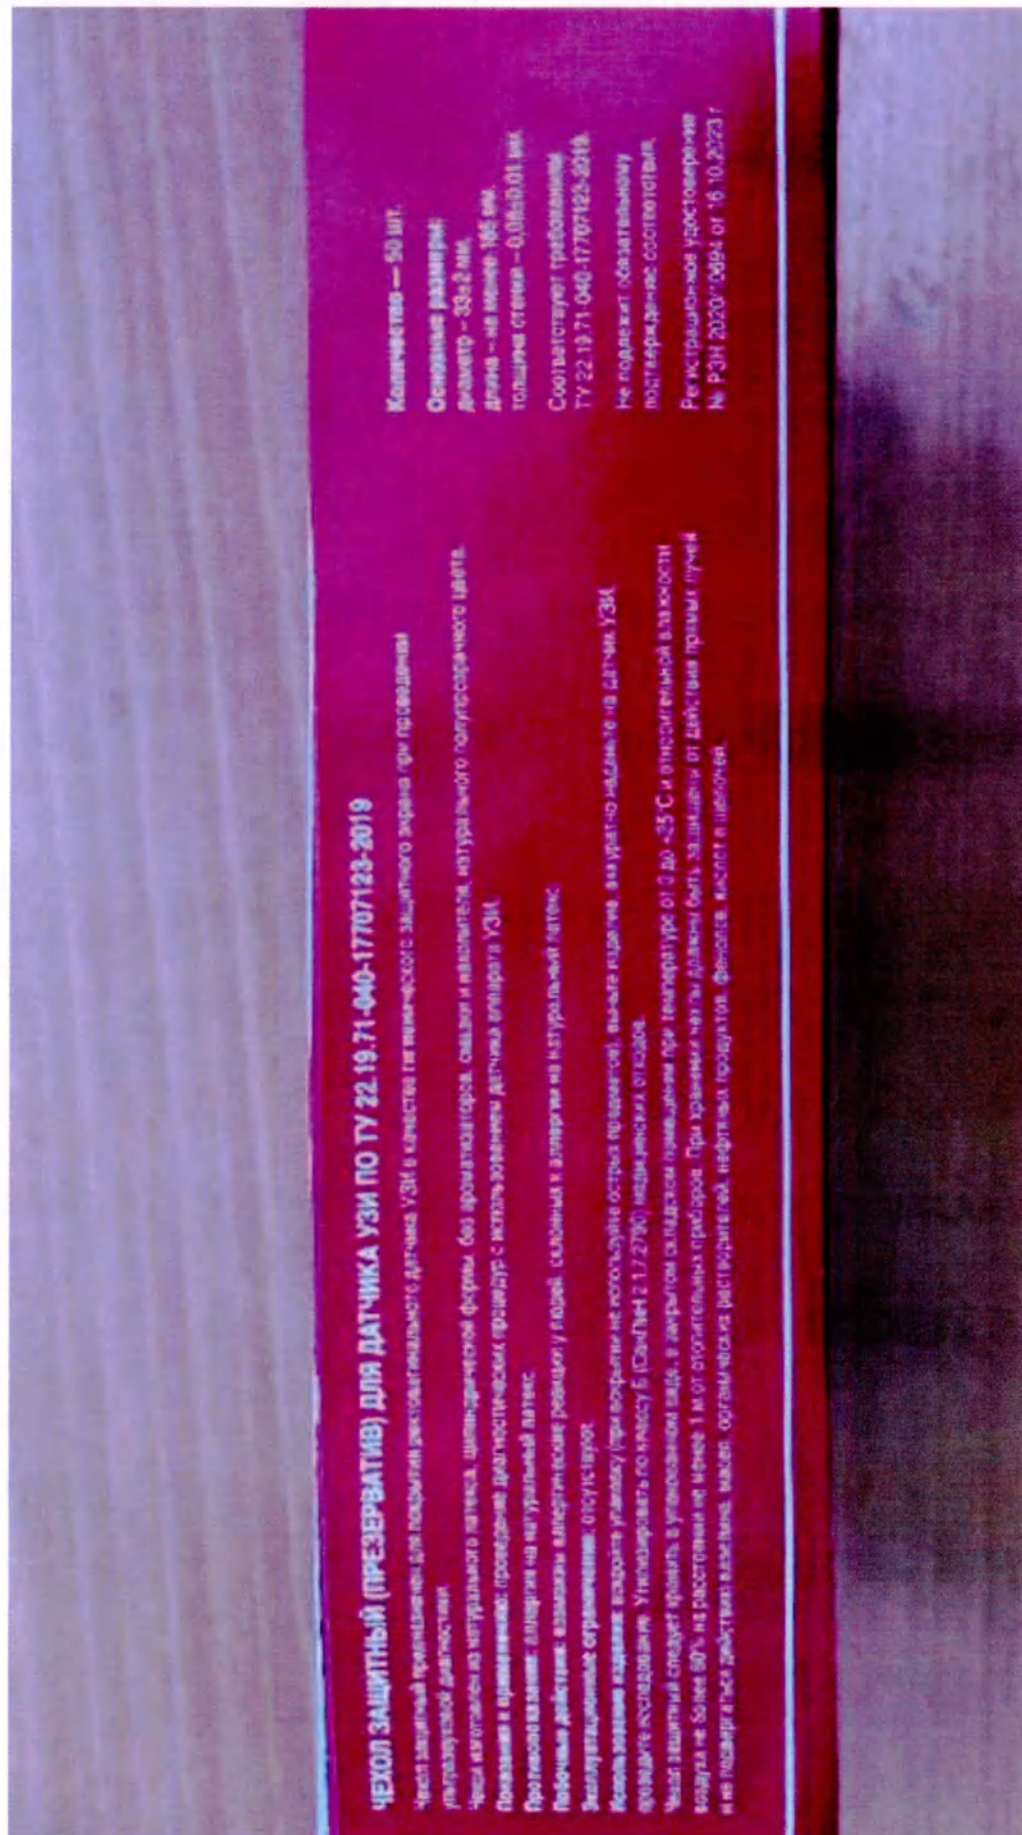


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) — Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

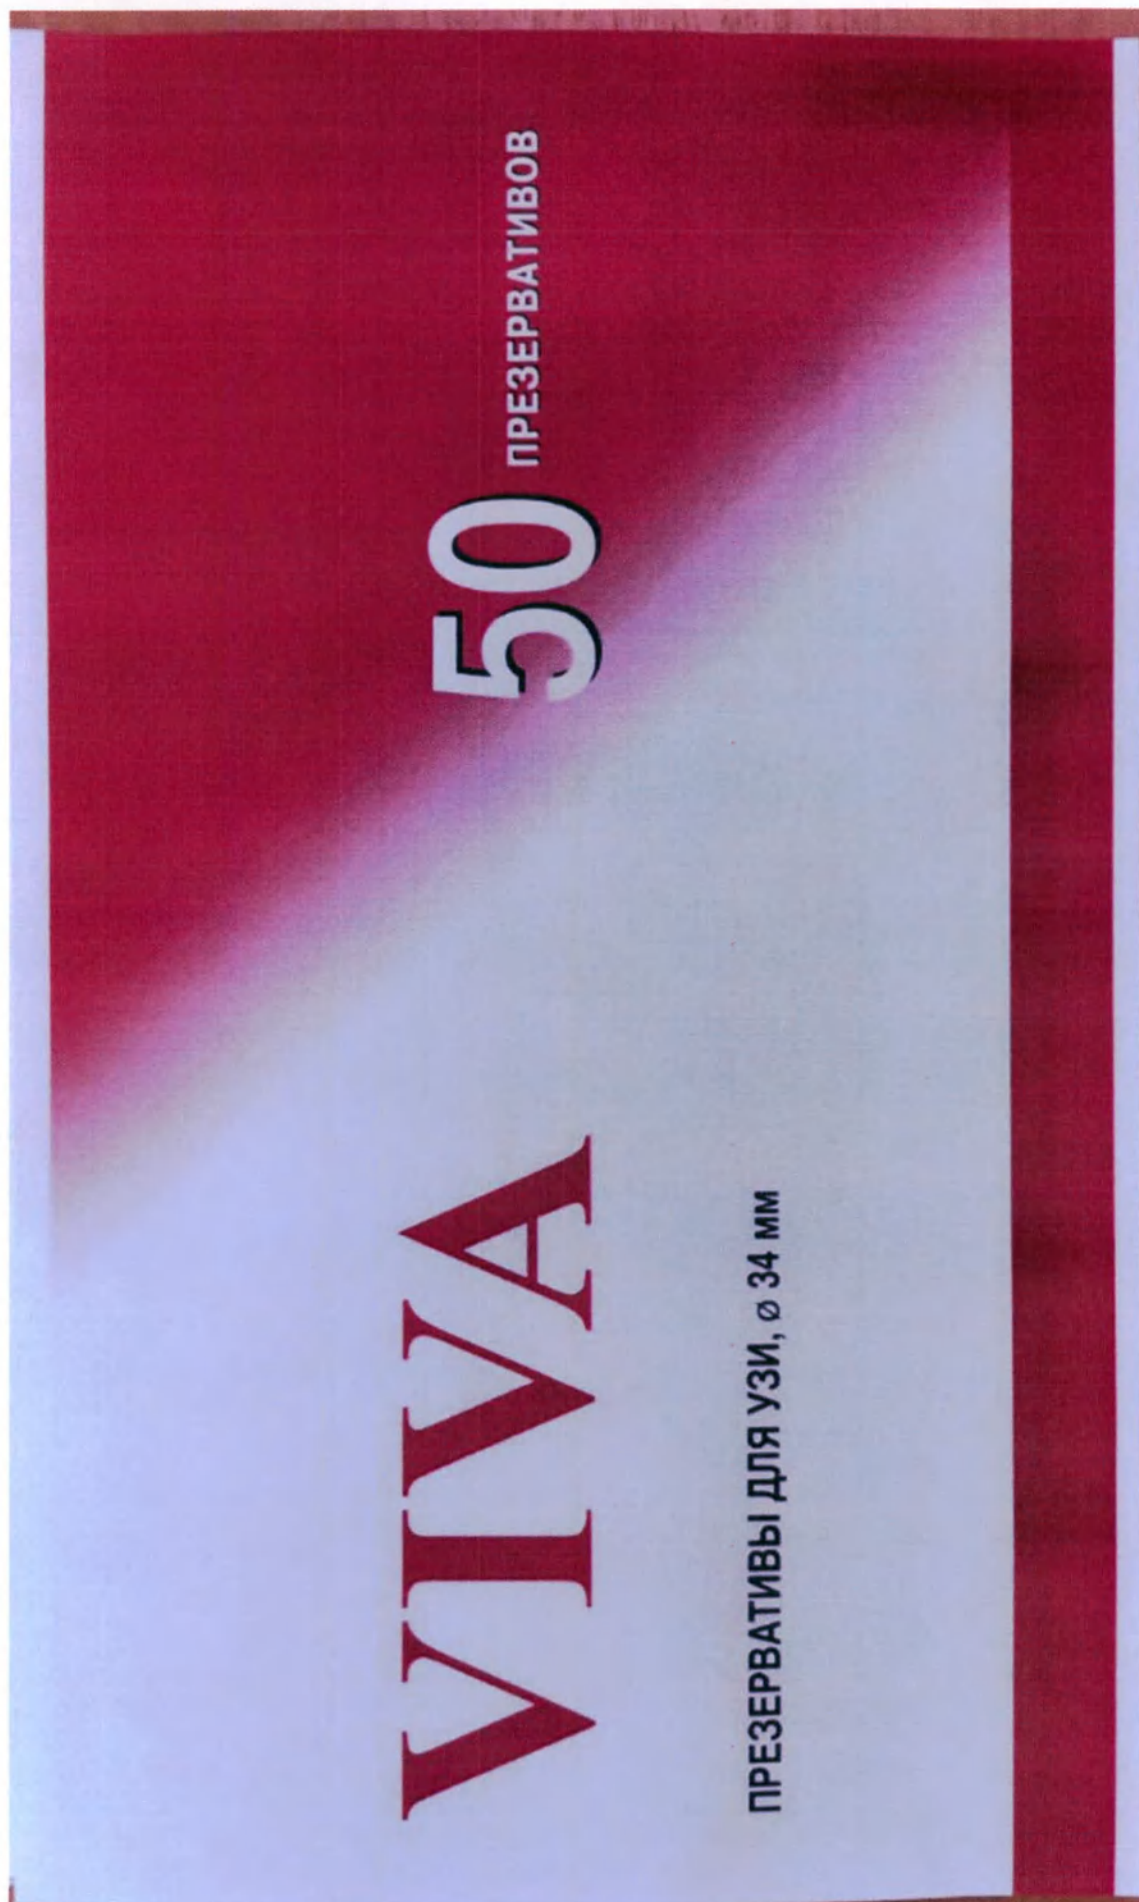


Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

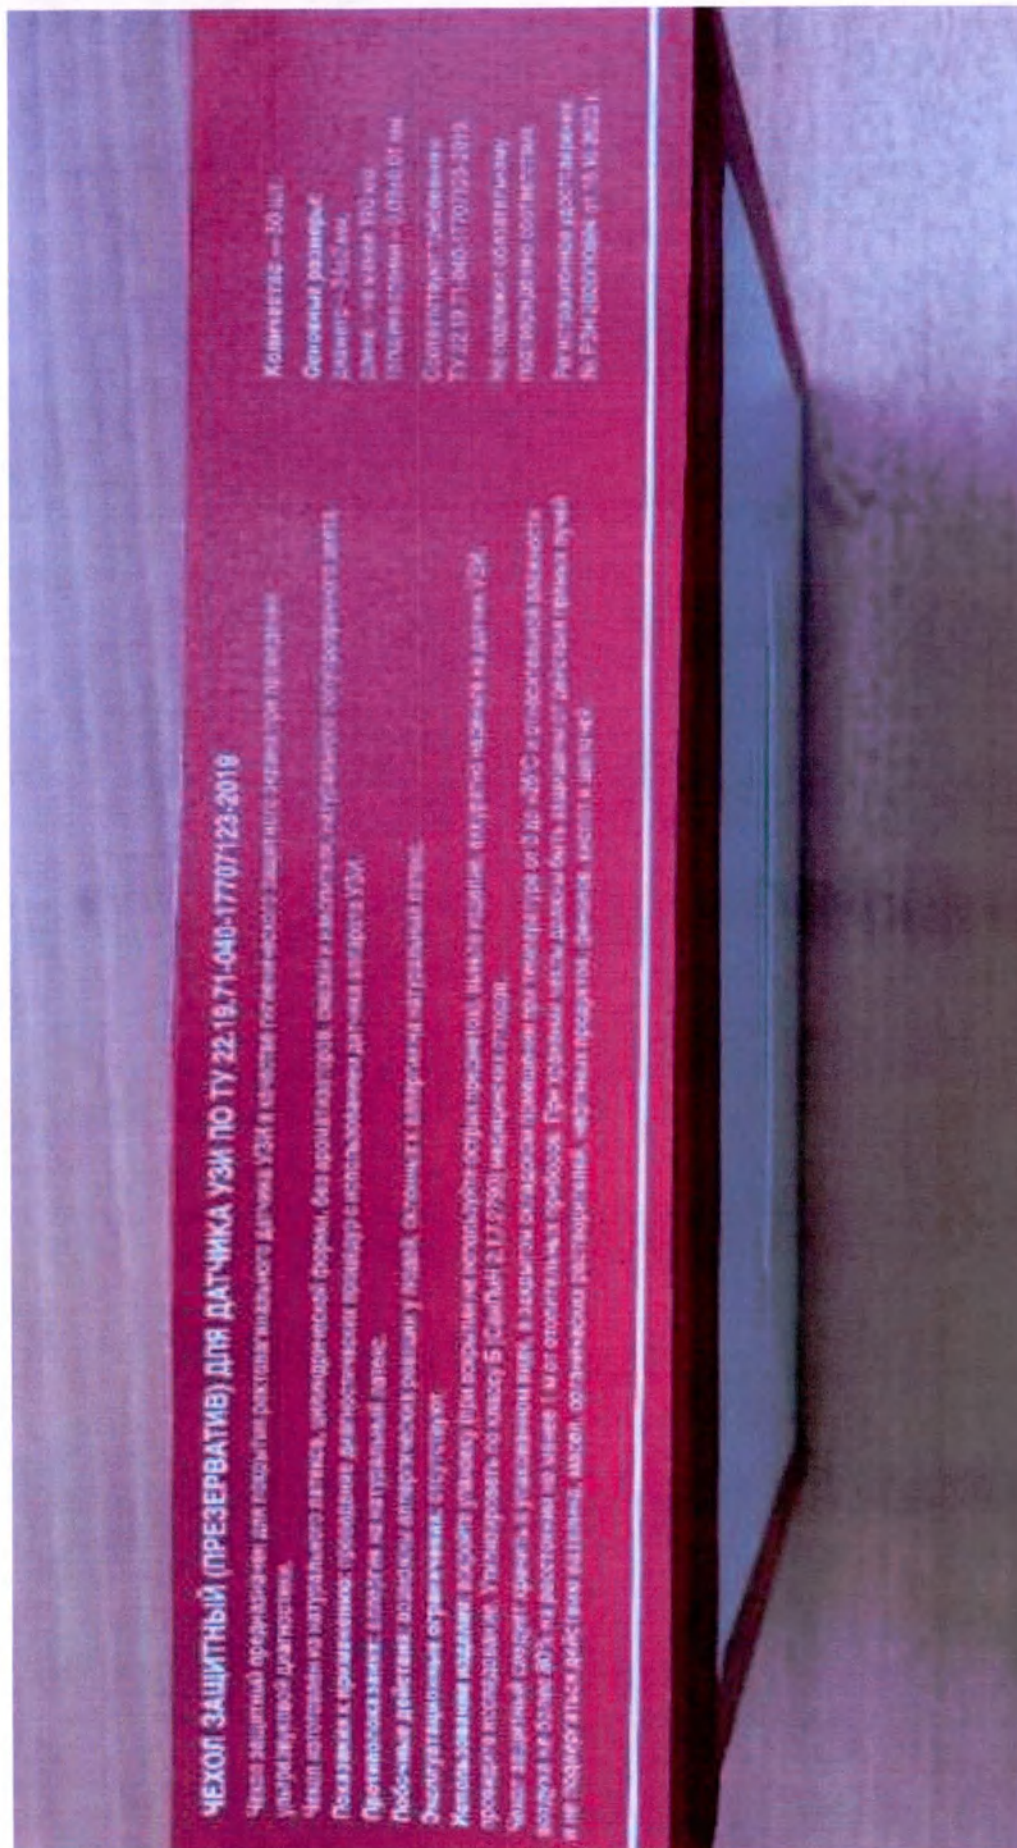


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) — Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 50 шт.)

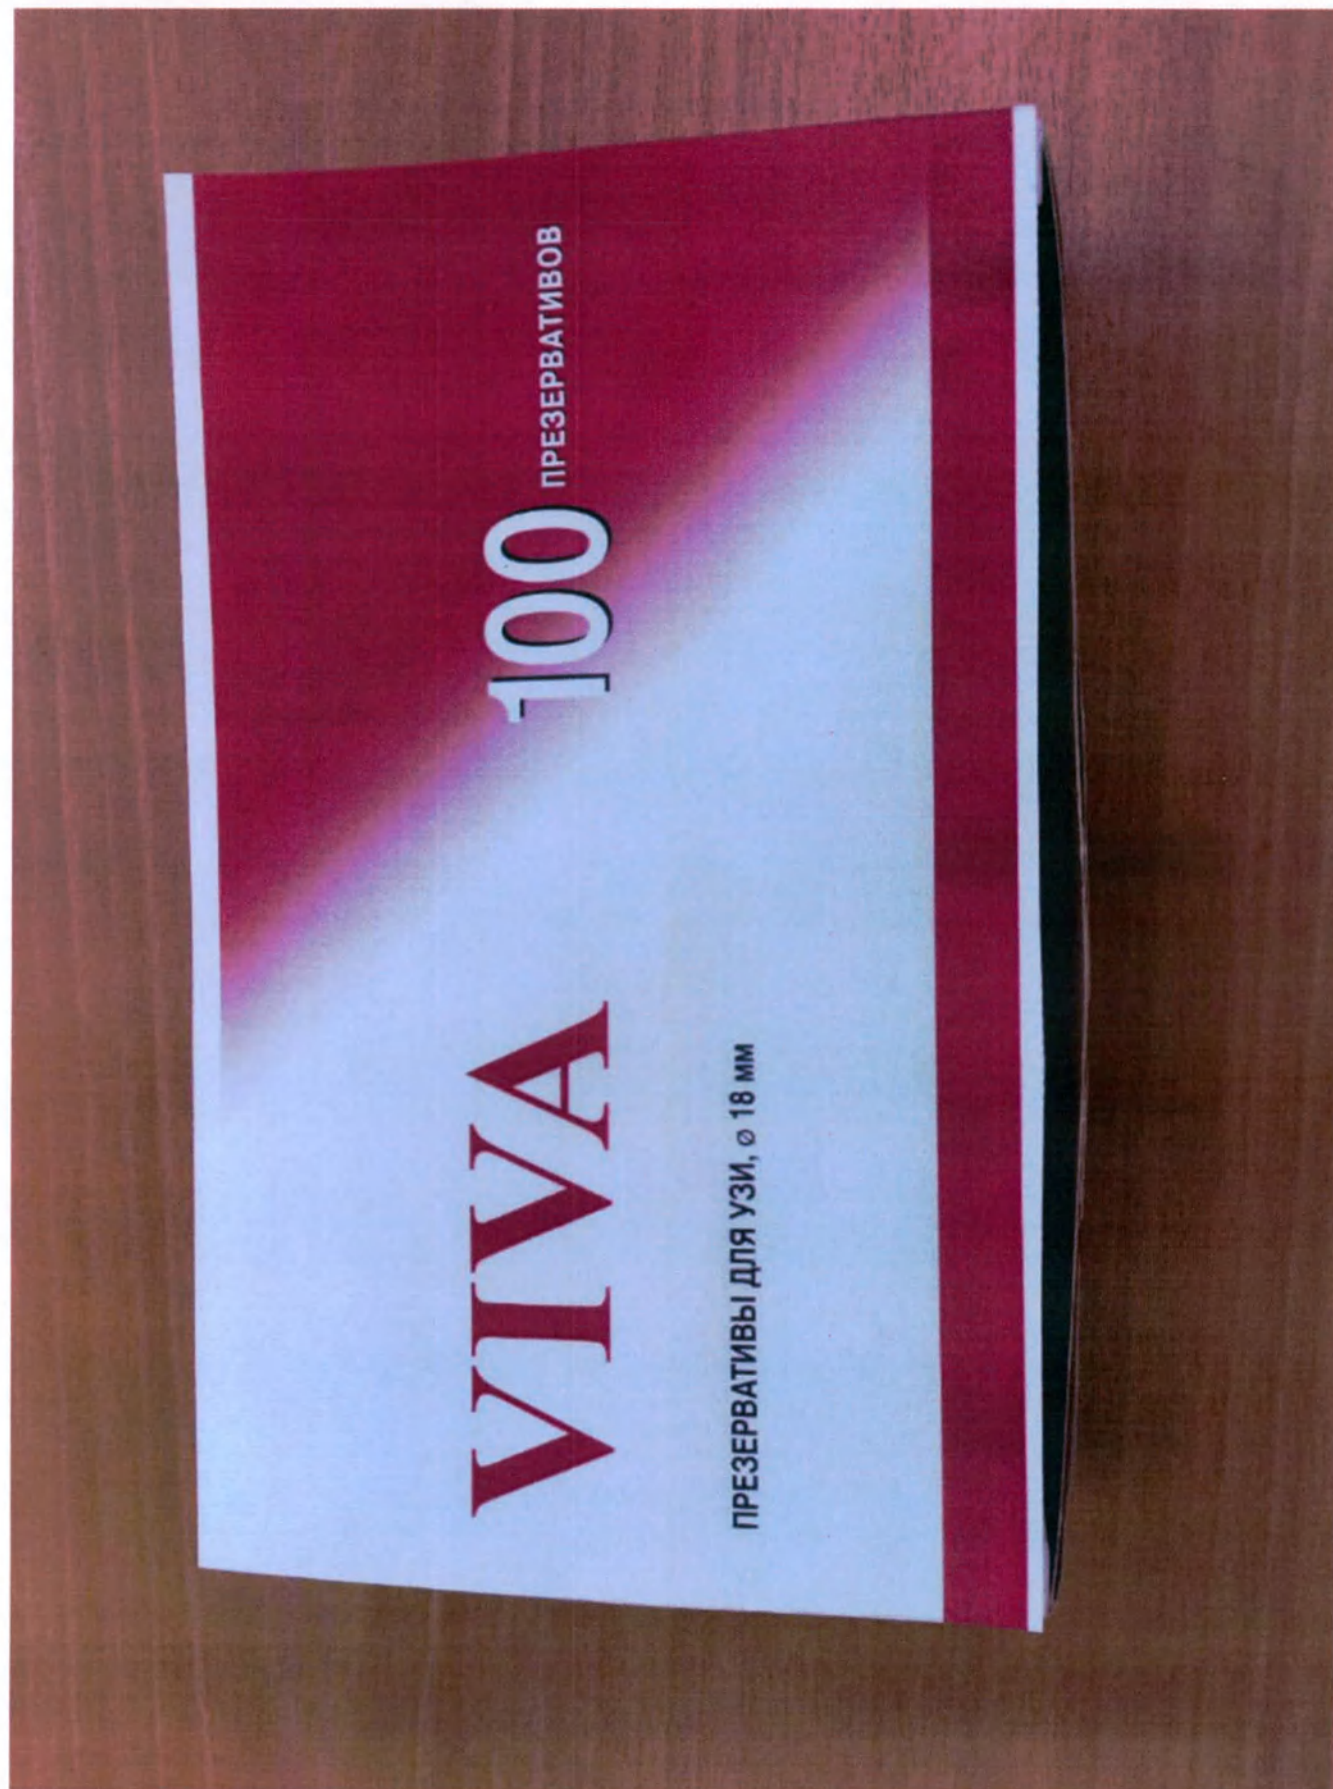


Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)

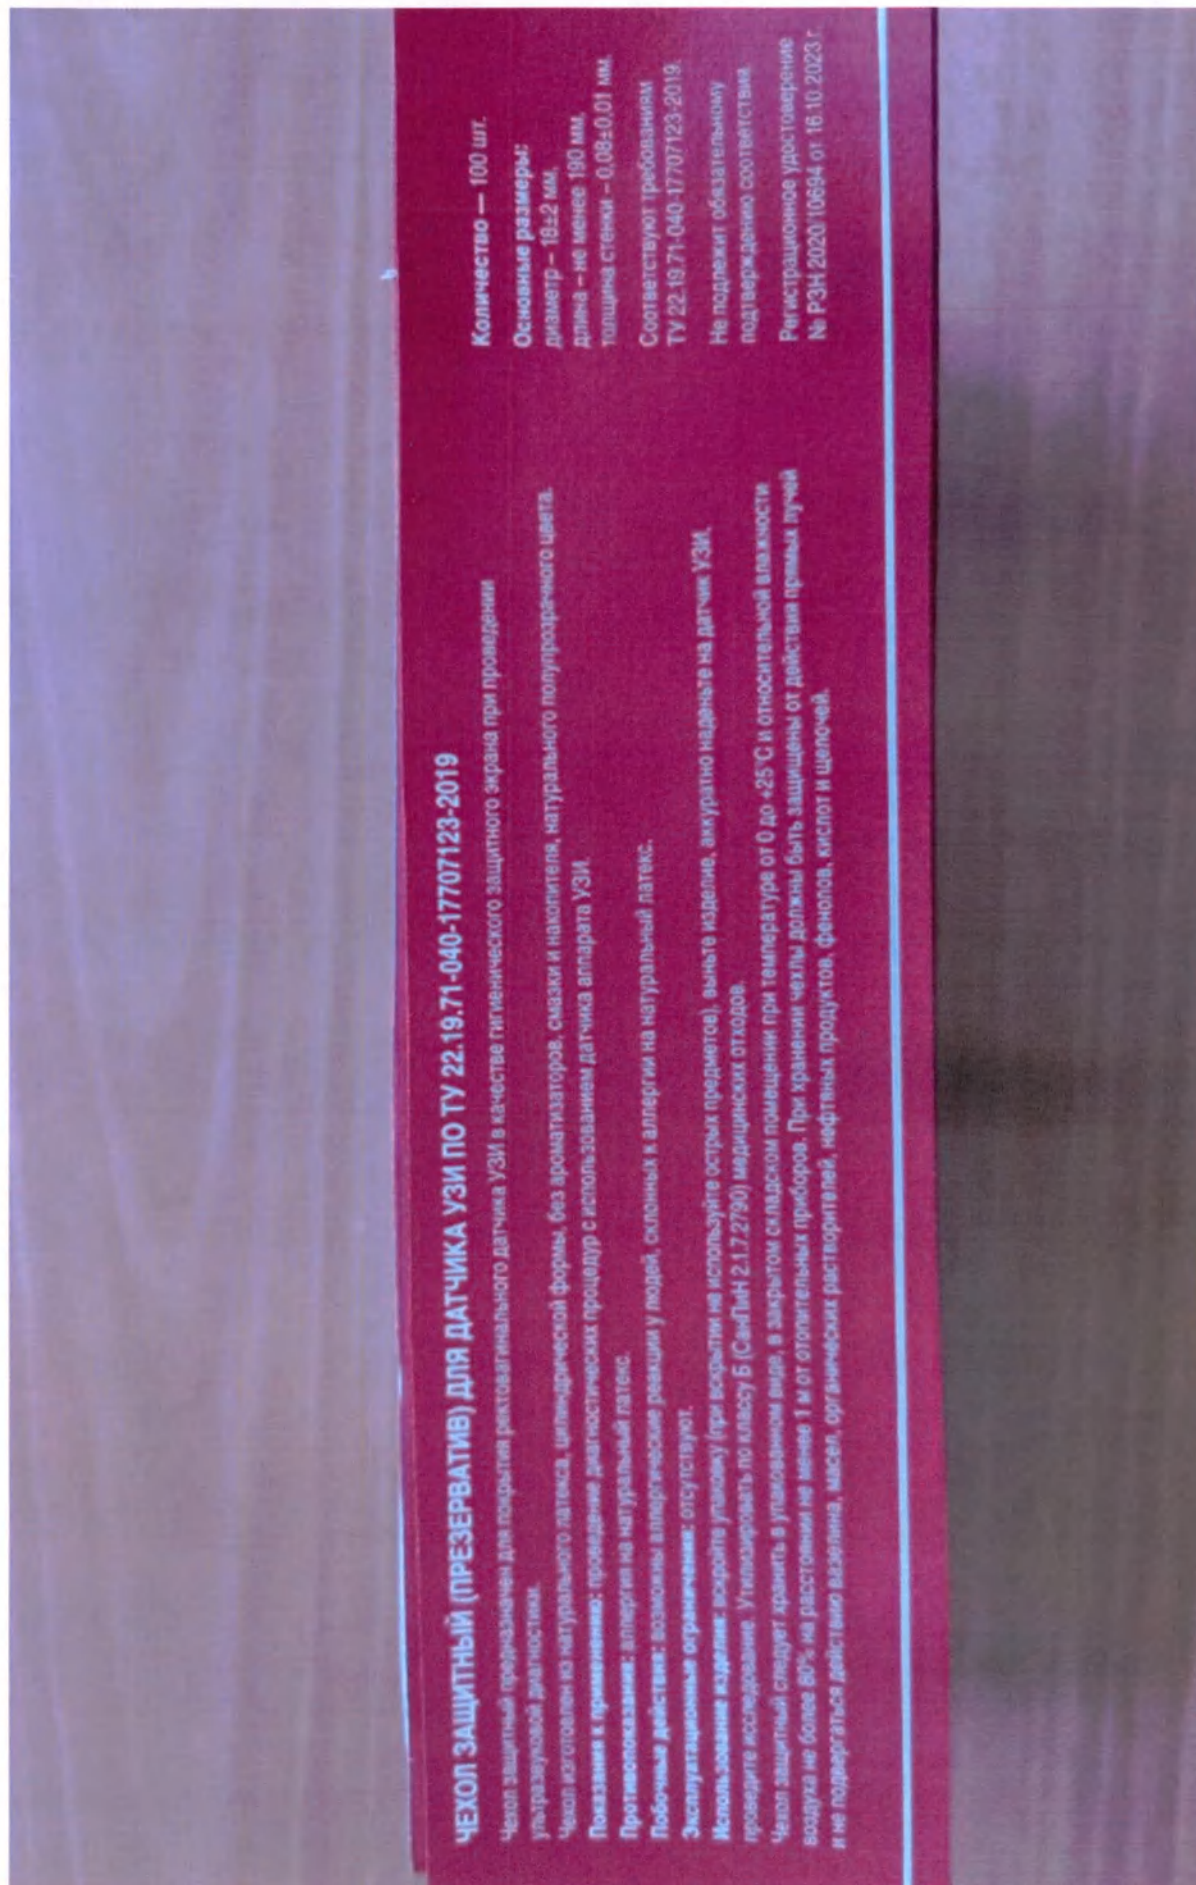


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) –
 Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)


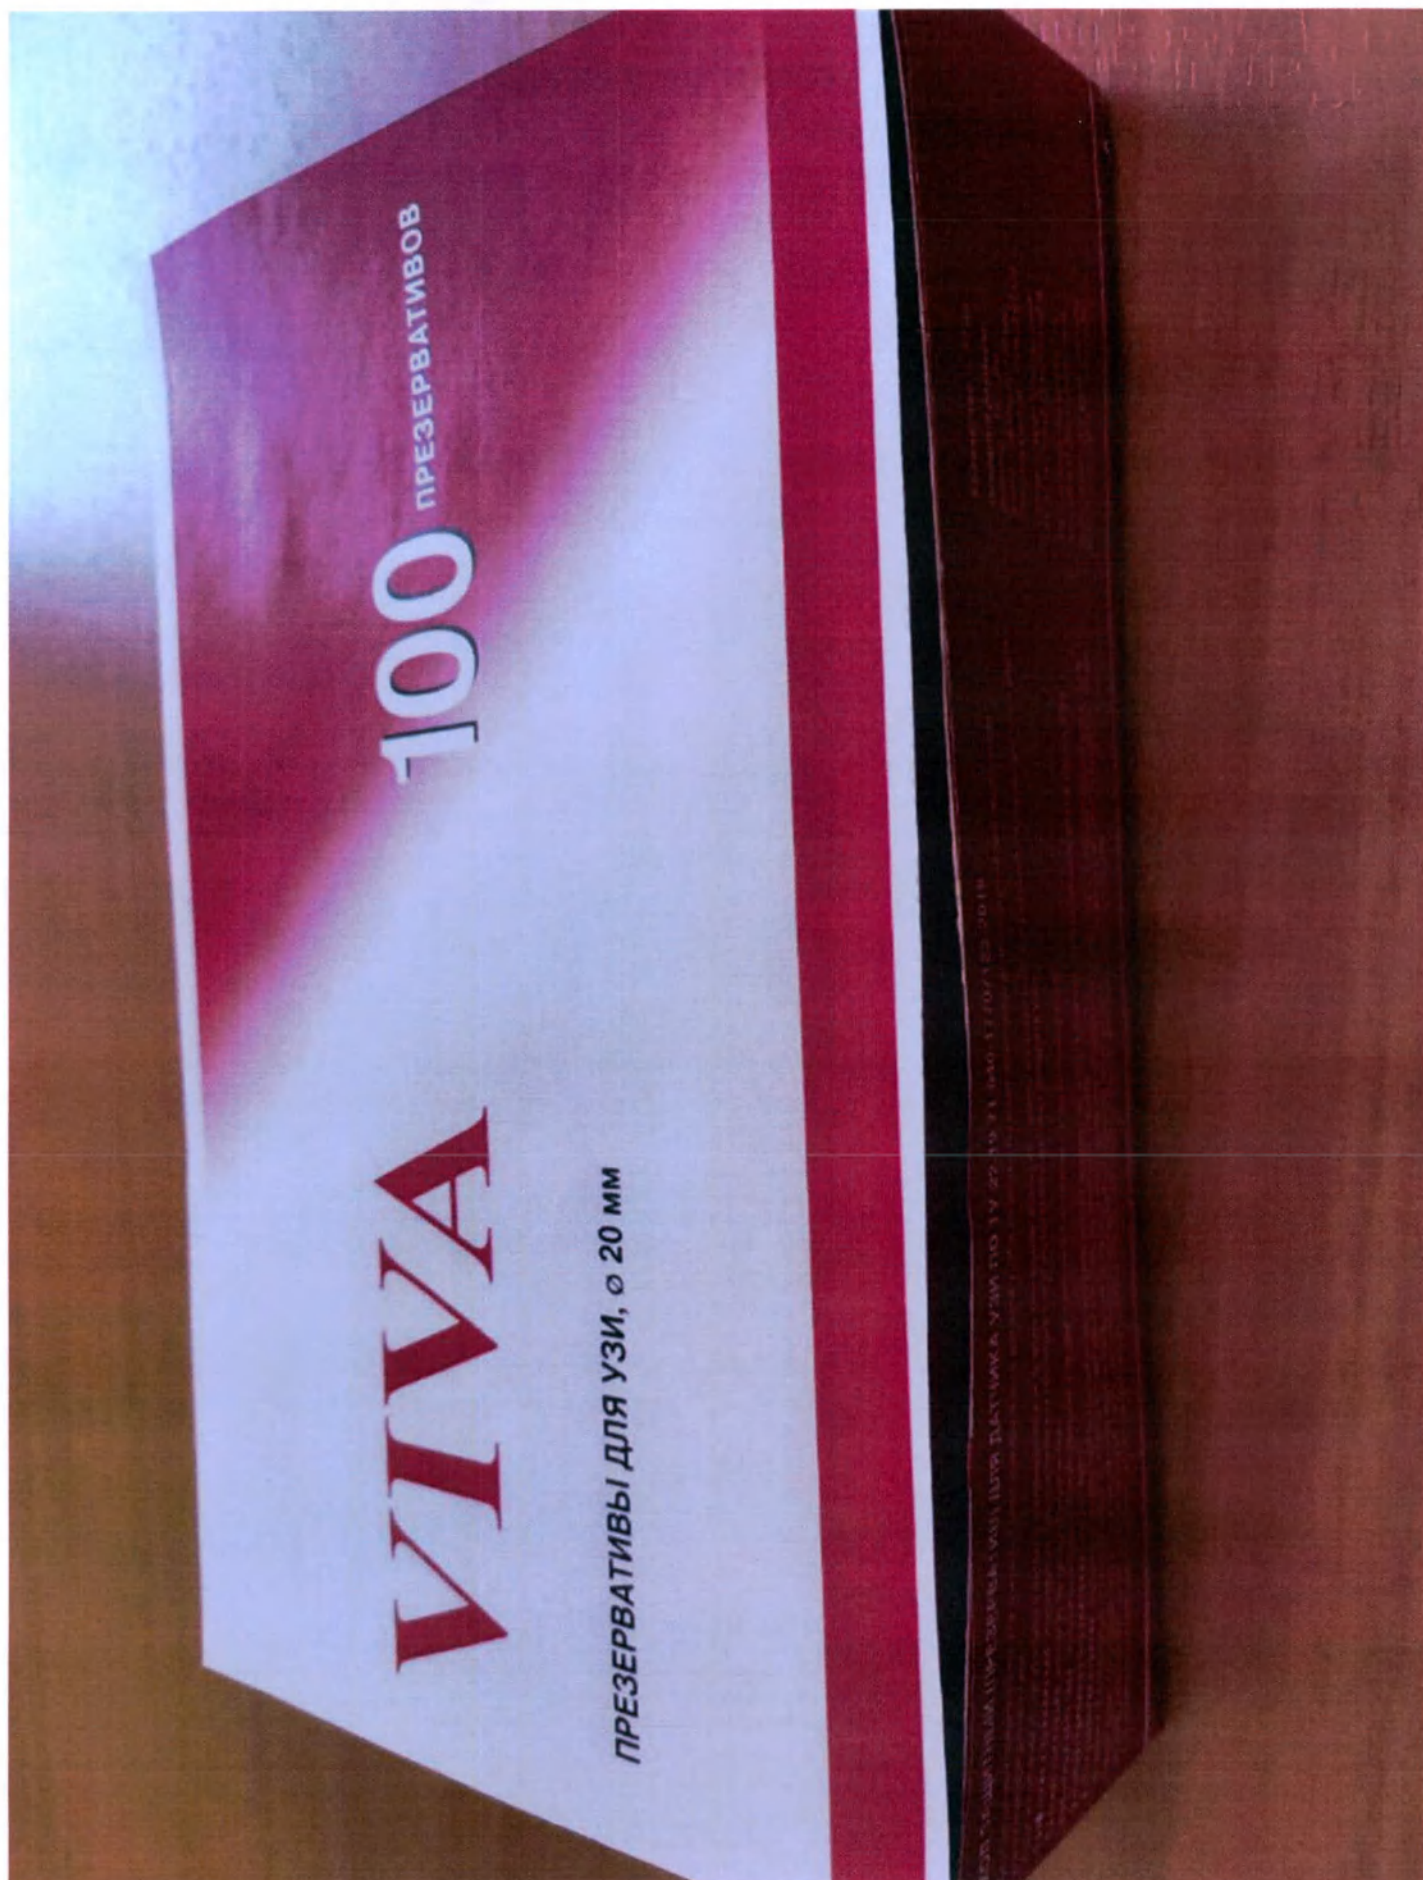


Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)

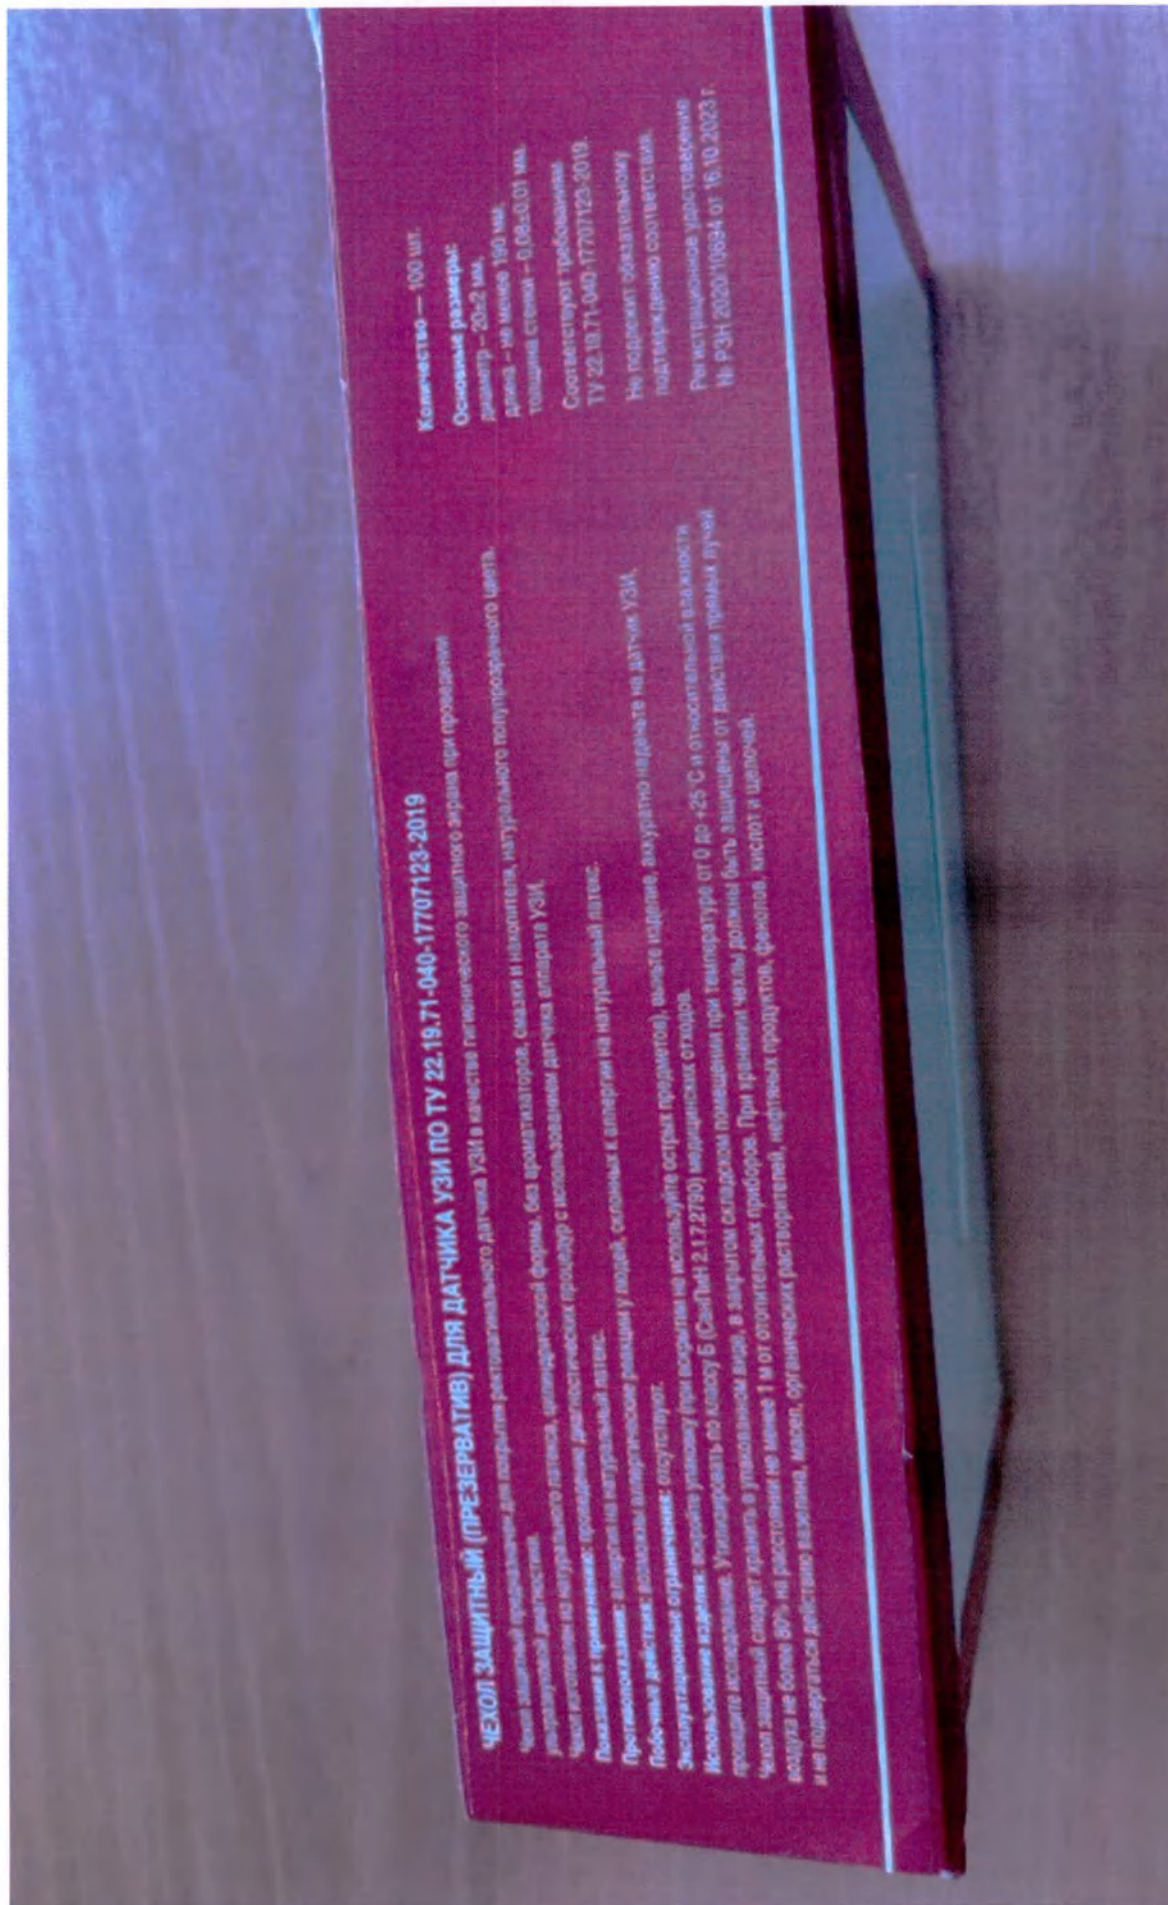

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ (ПРЕЗЕРВАТИВ) ДЛЯ ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

УЗИ. Чехол защитный предназначен для покрытия репродуктивного датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр — 20±2 мм,

длина — не менее 100 мм,

толщина стенки — 0,08±0,01 мм.

Соответствует требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10684 от 16.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) —

Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)

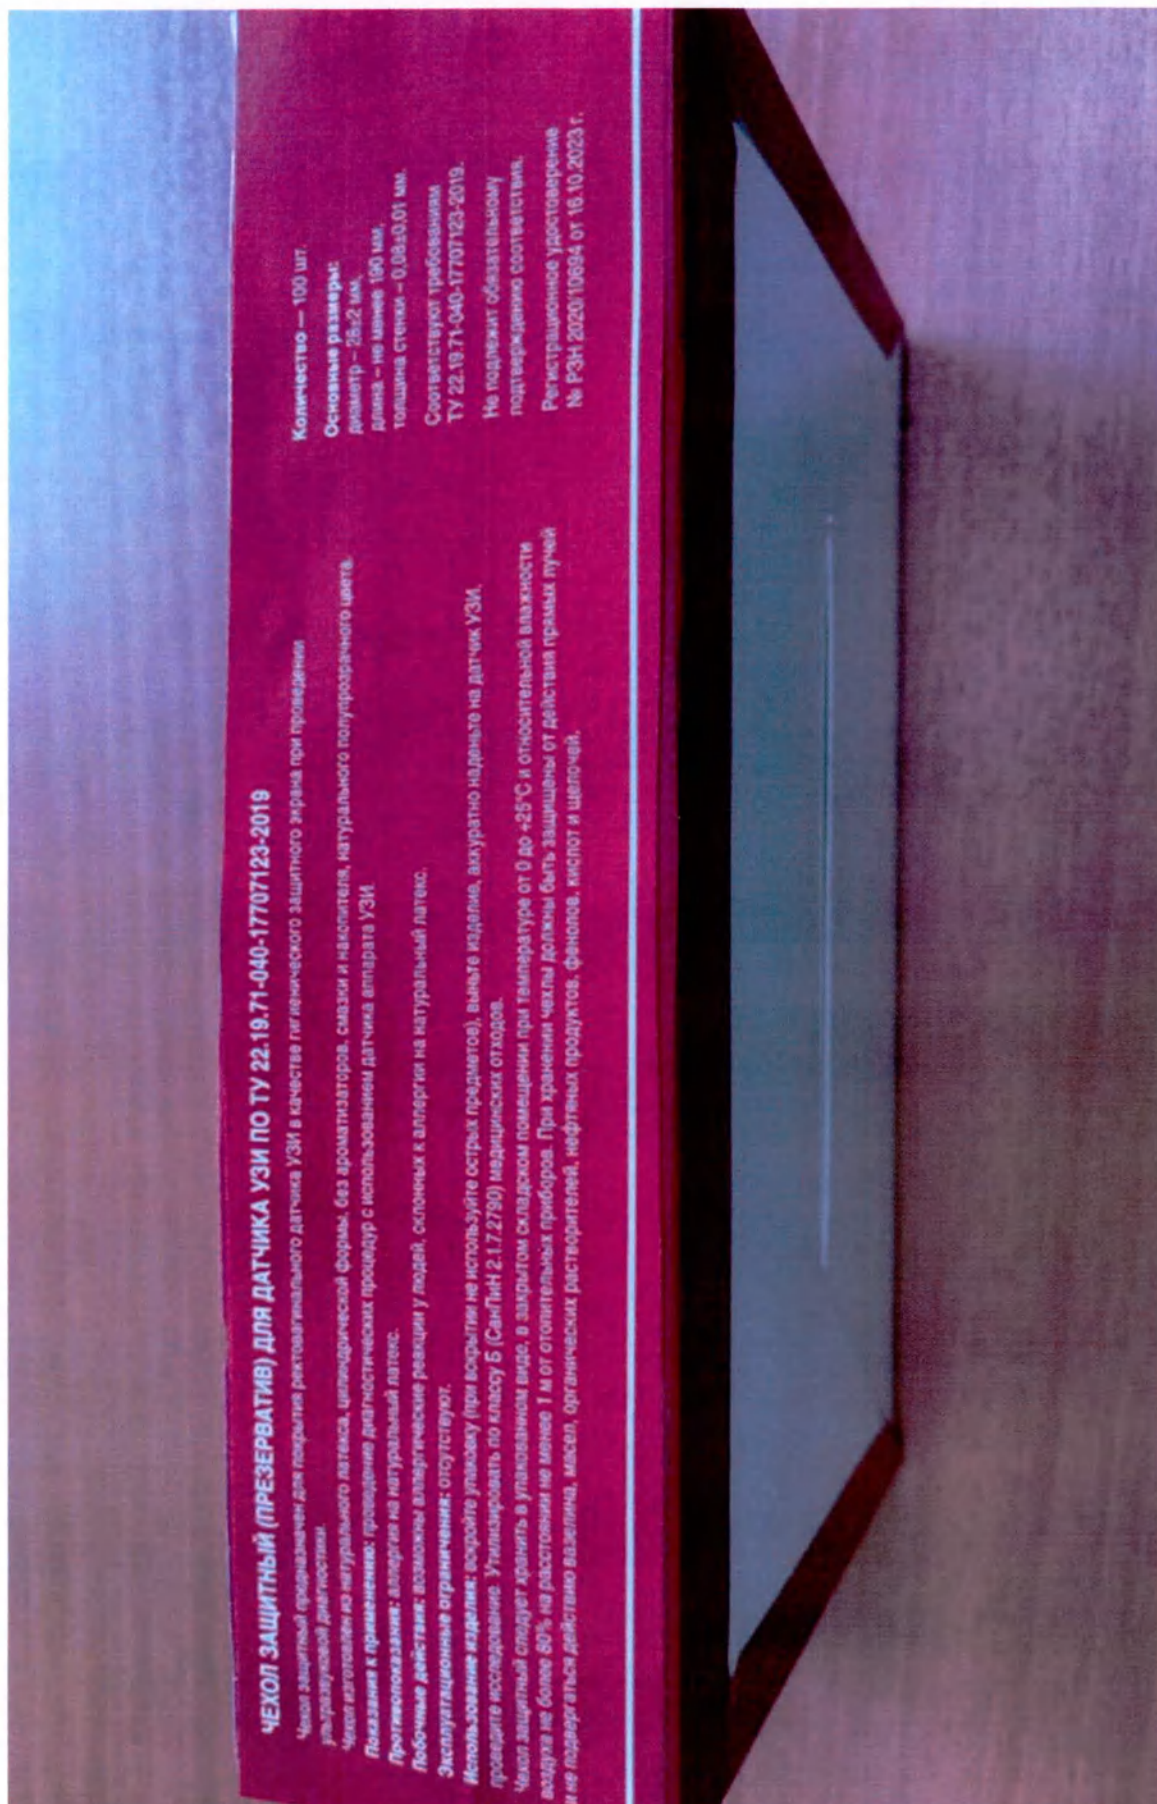


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) — Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)

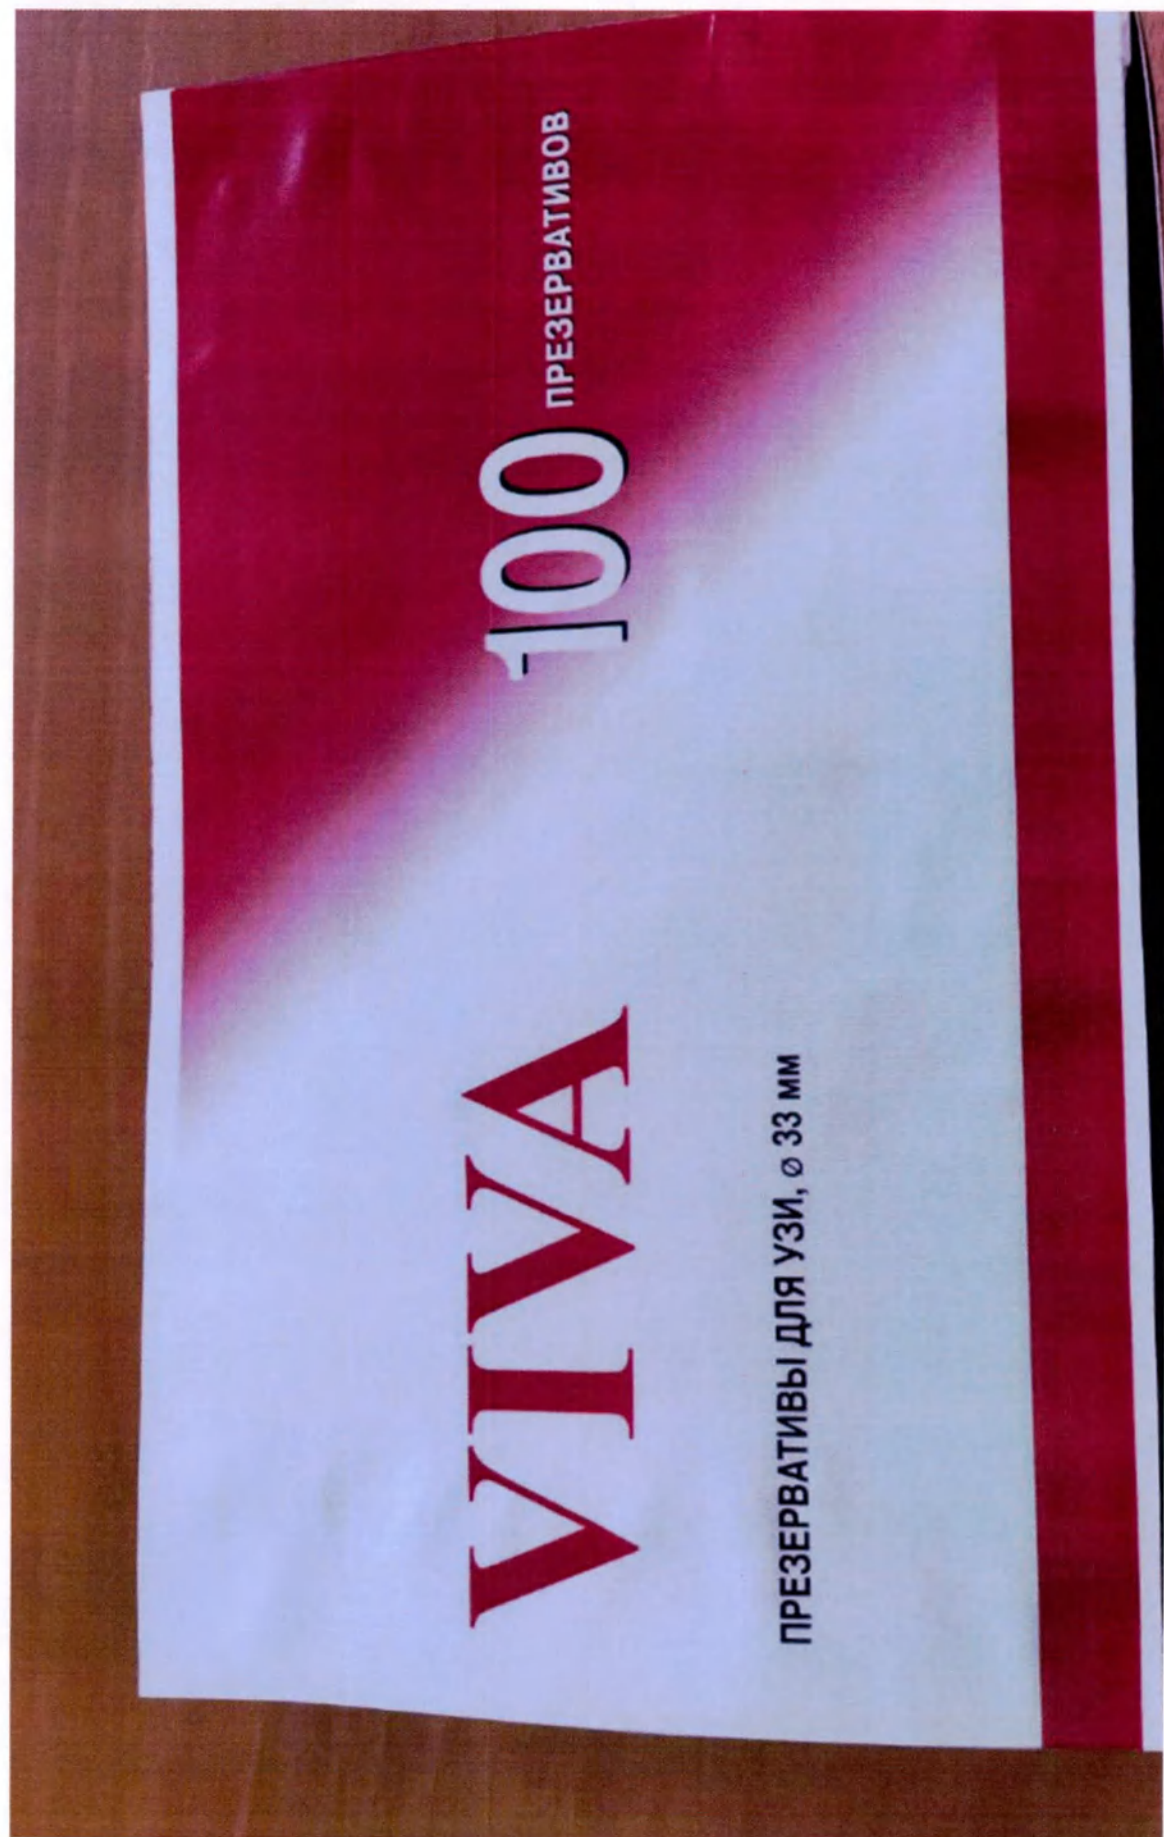
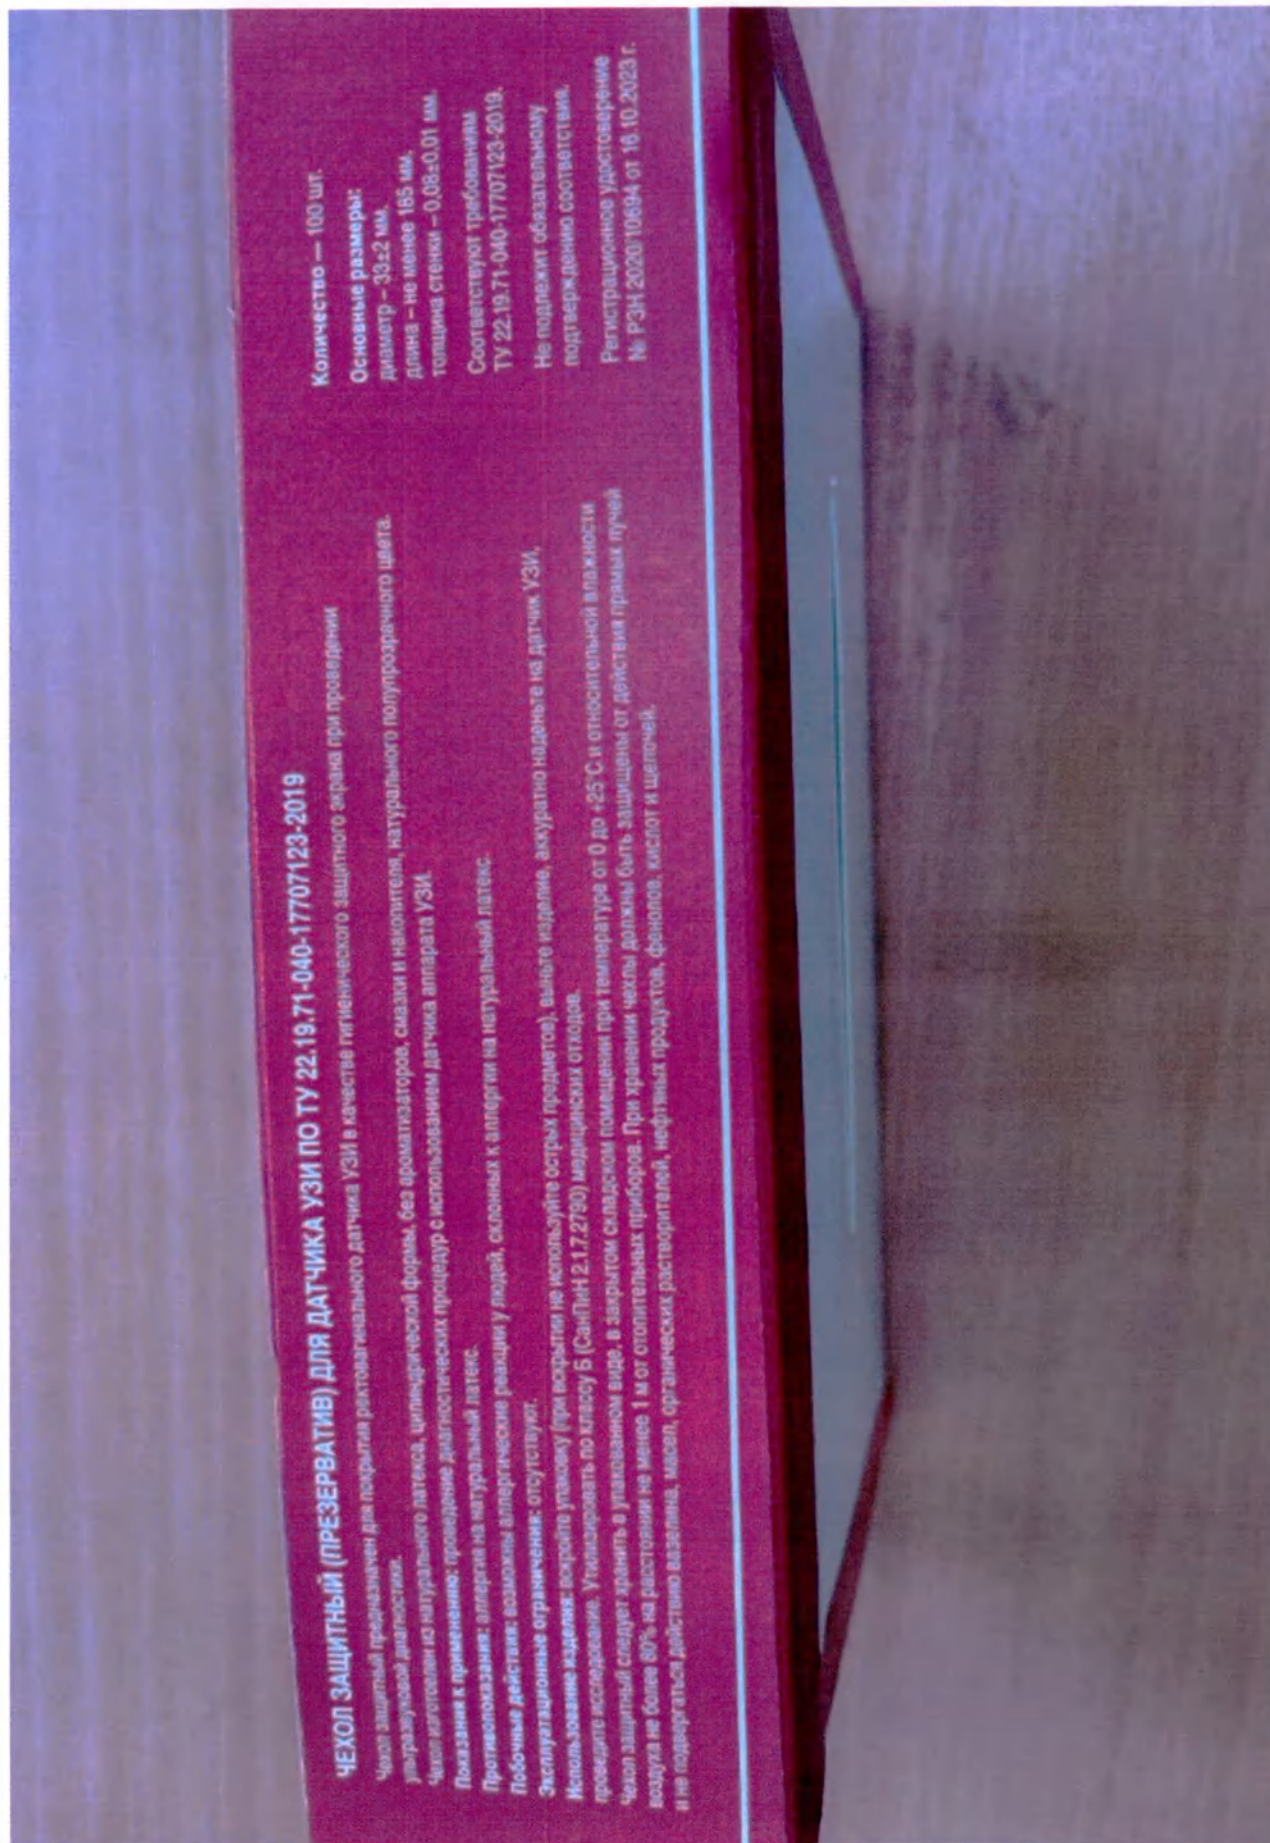


Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)



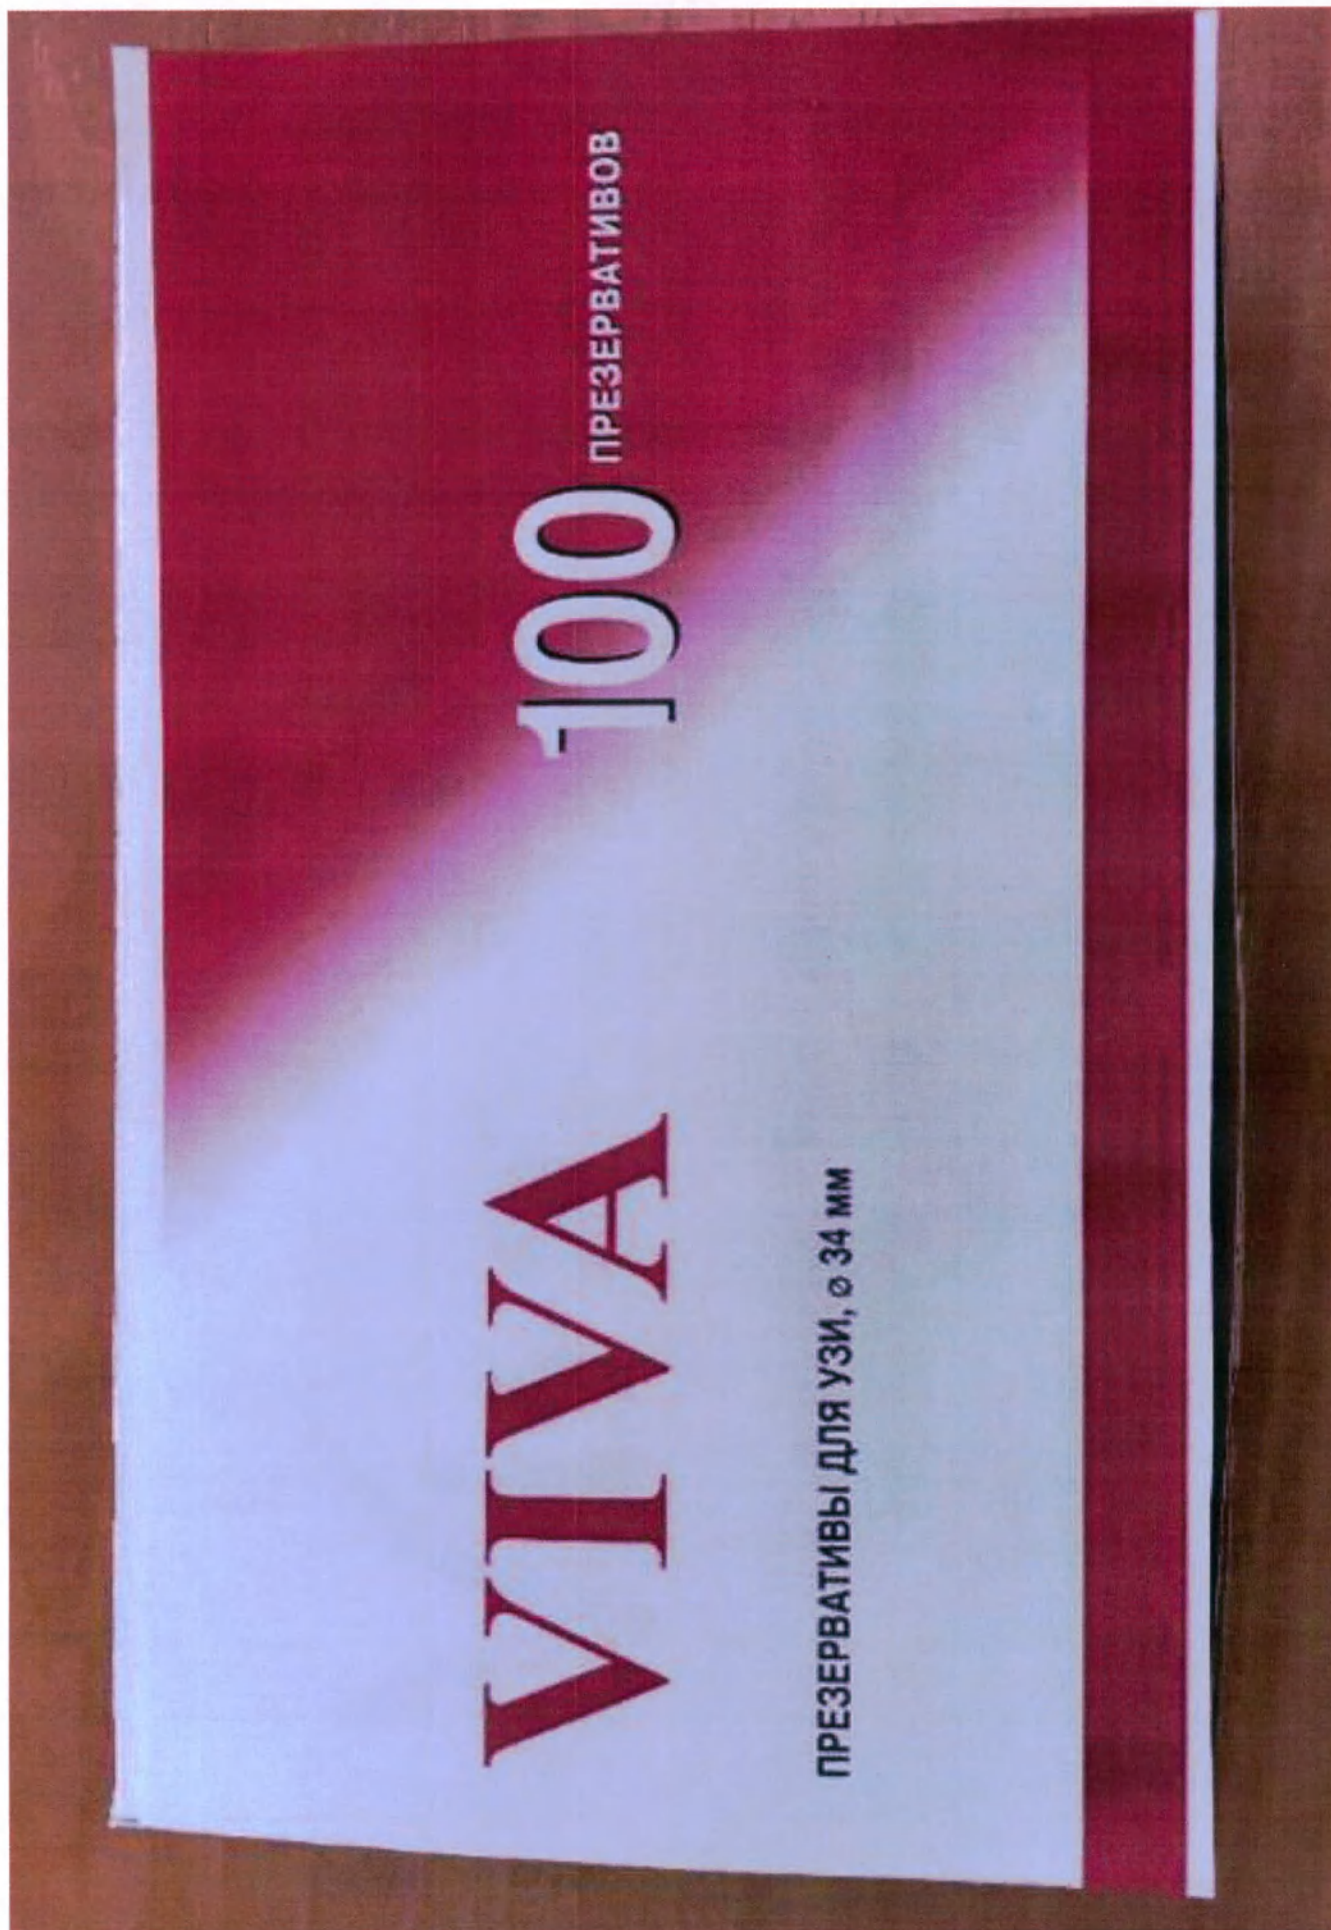


Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)

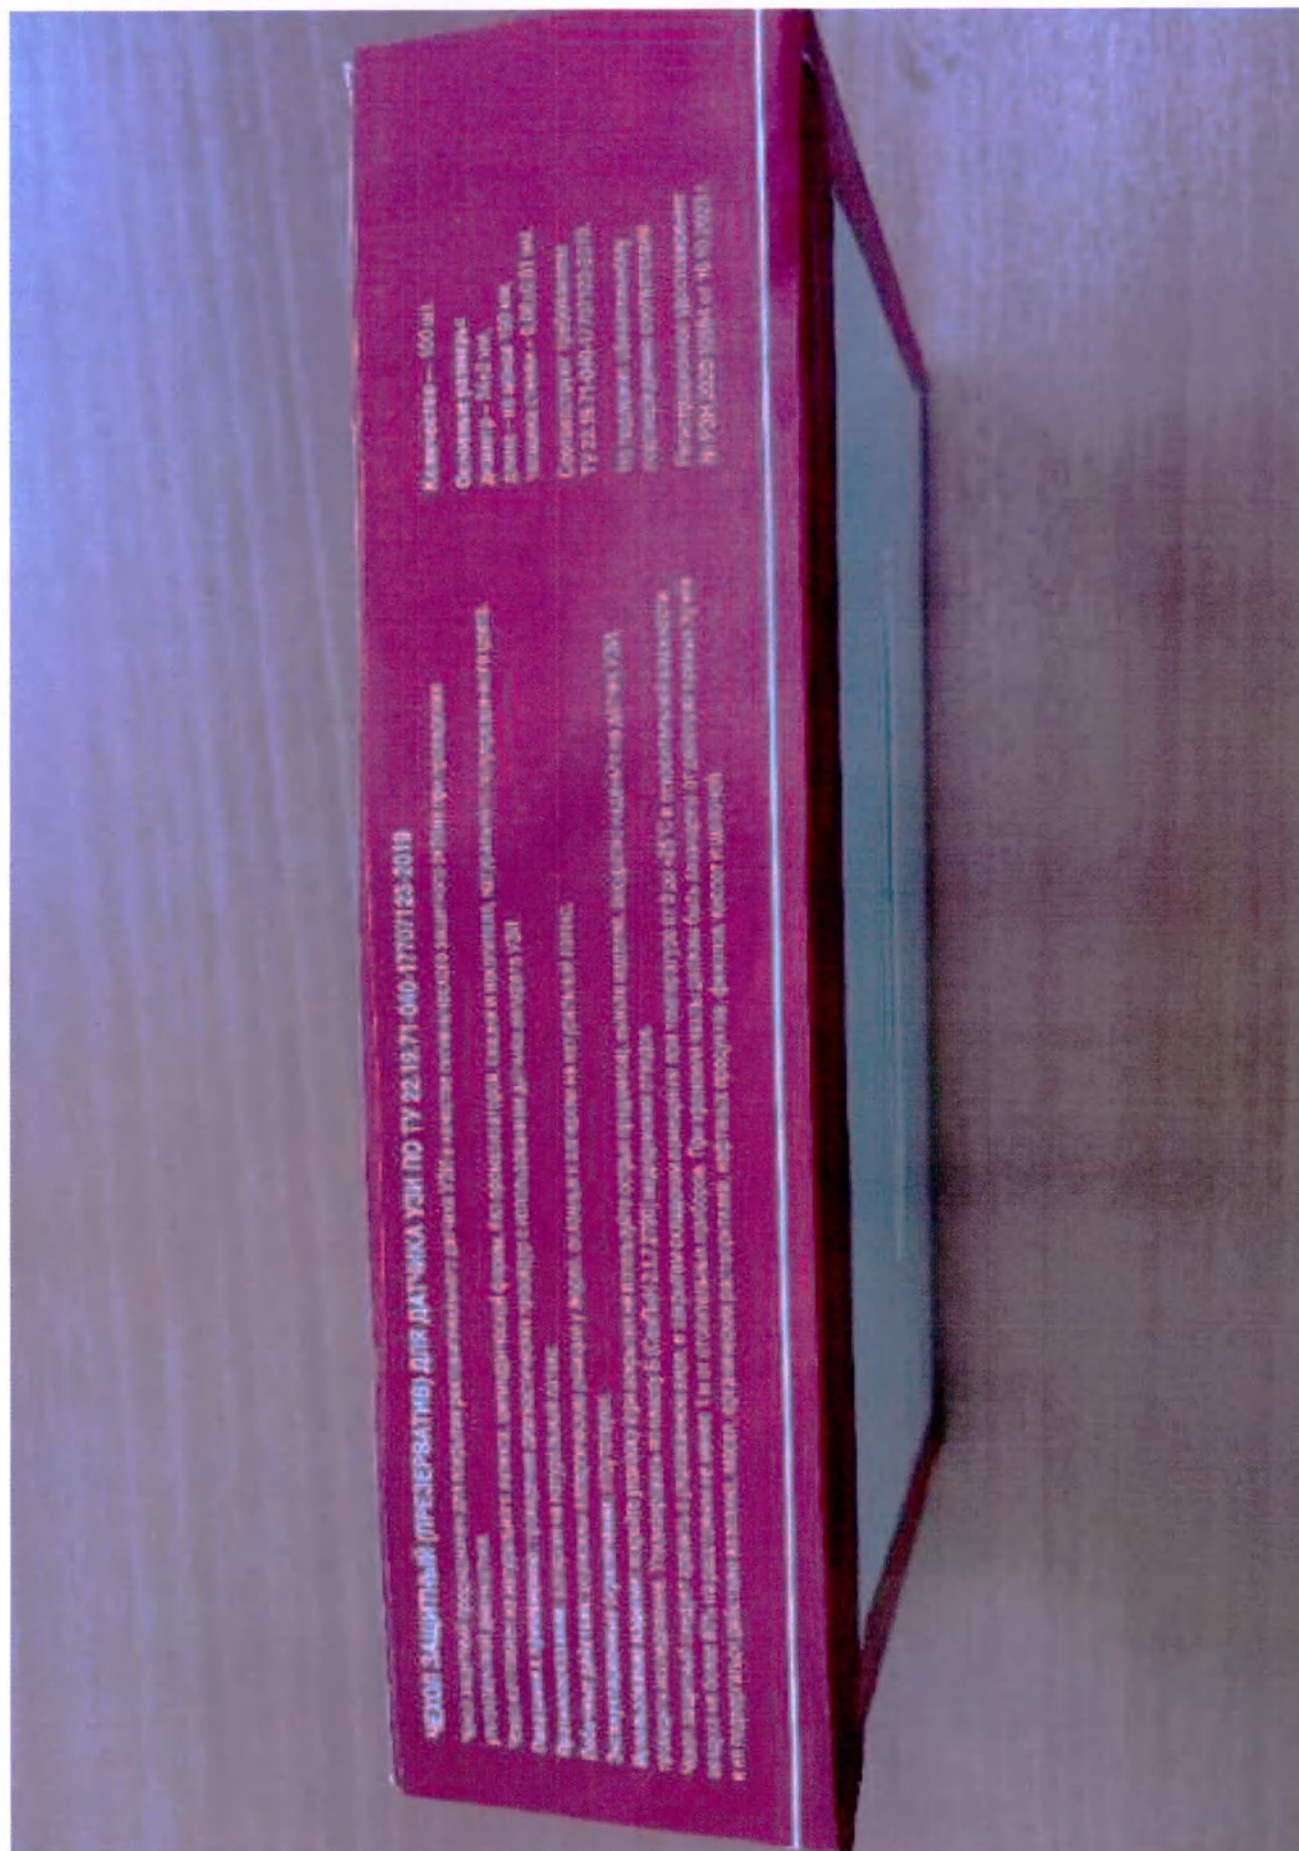


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) –
Презерватив для УЗИ, ø 34 мм (товарный знак «VIVA», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия –
Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)

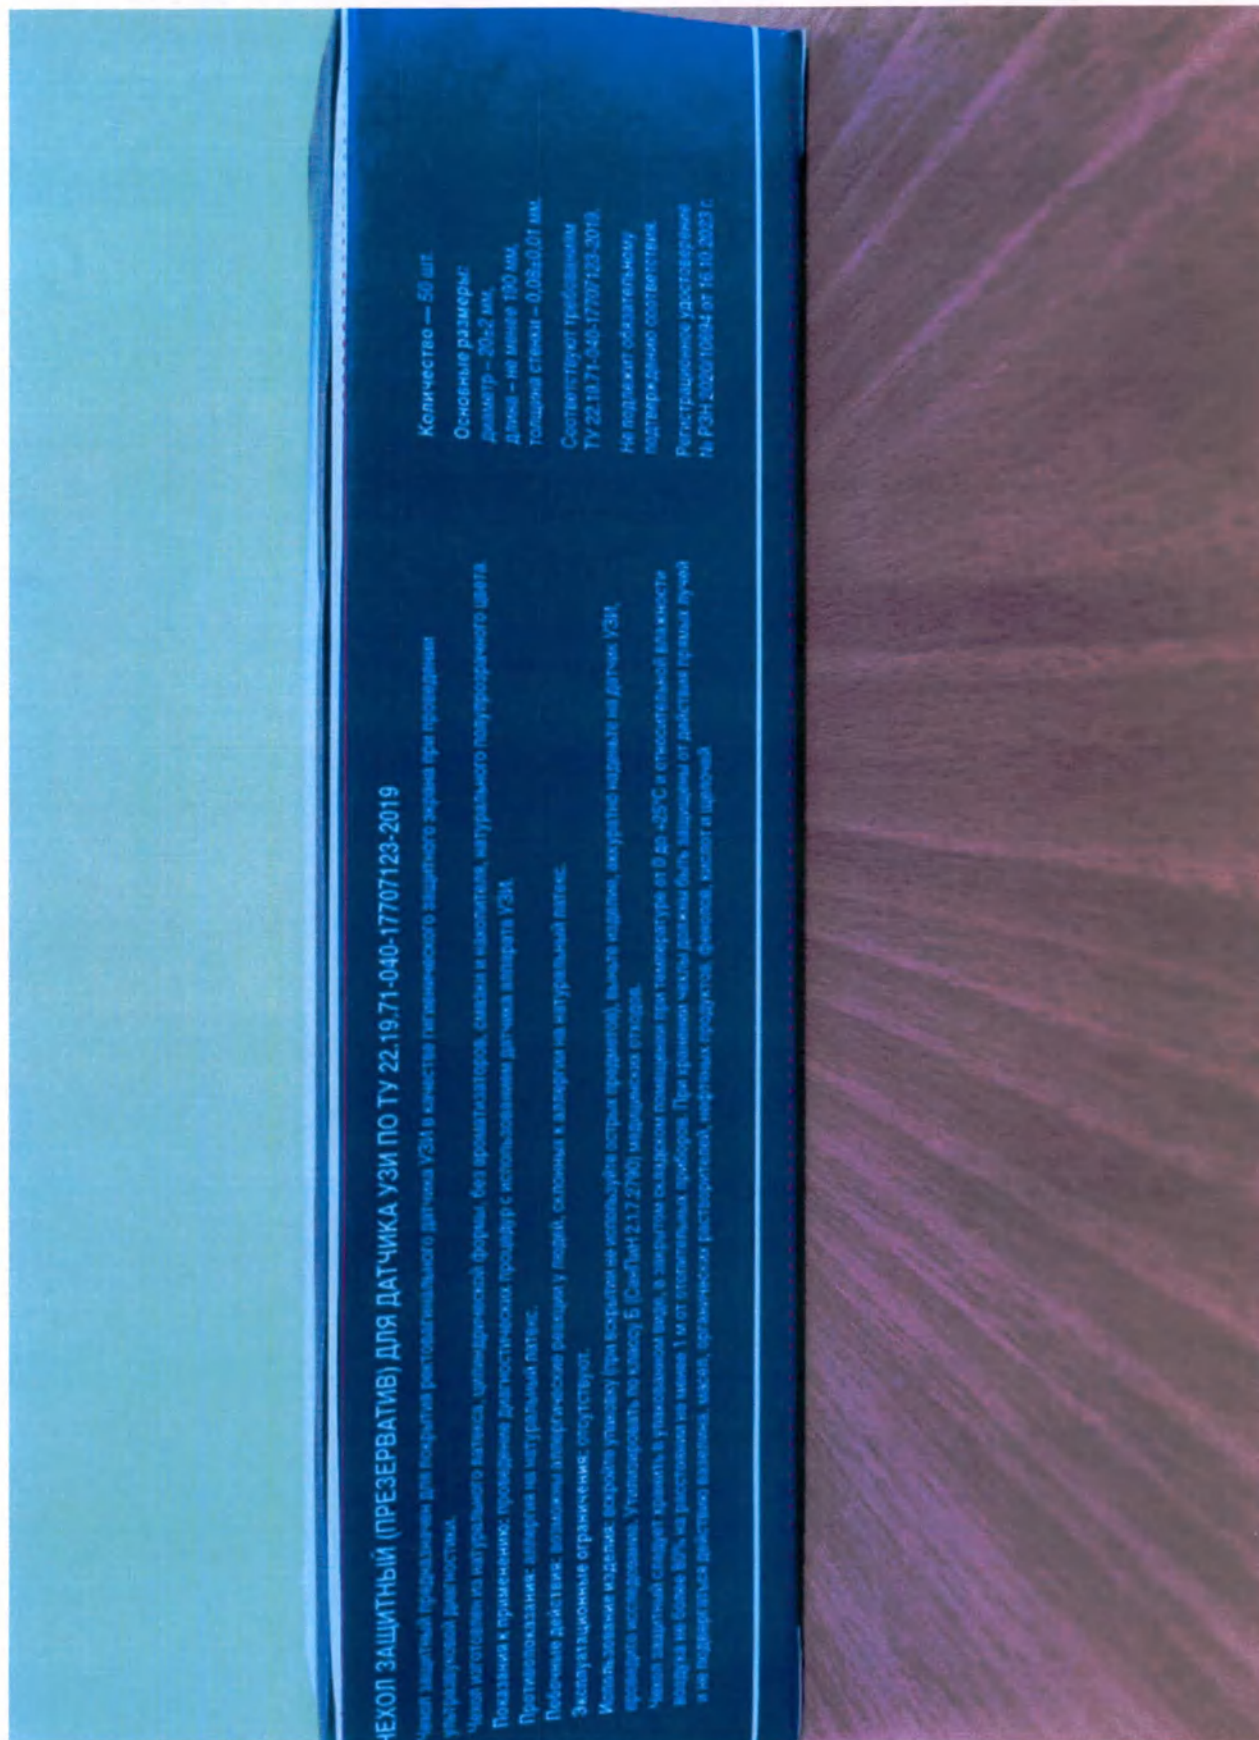


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент)—
Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)

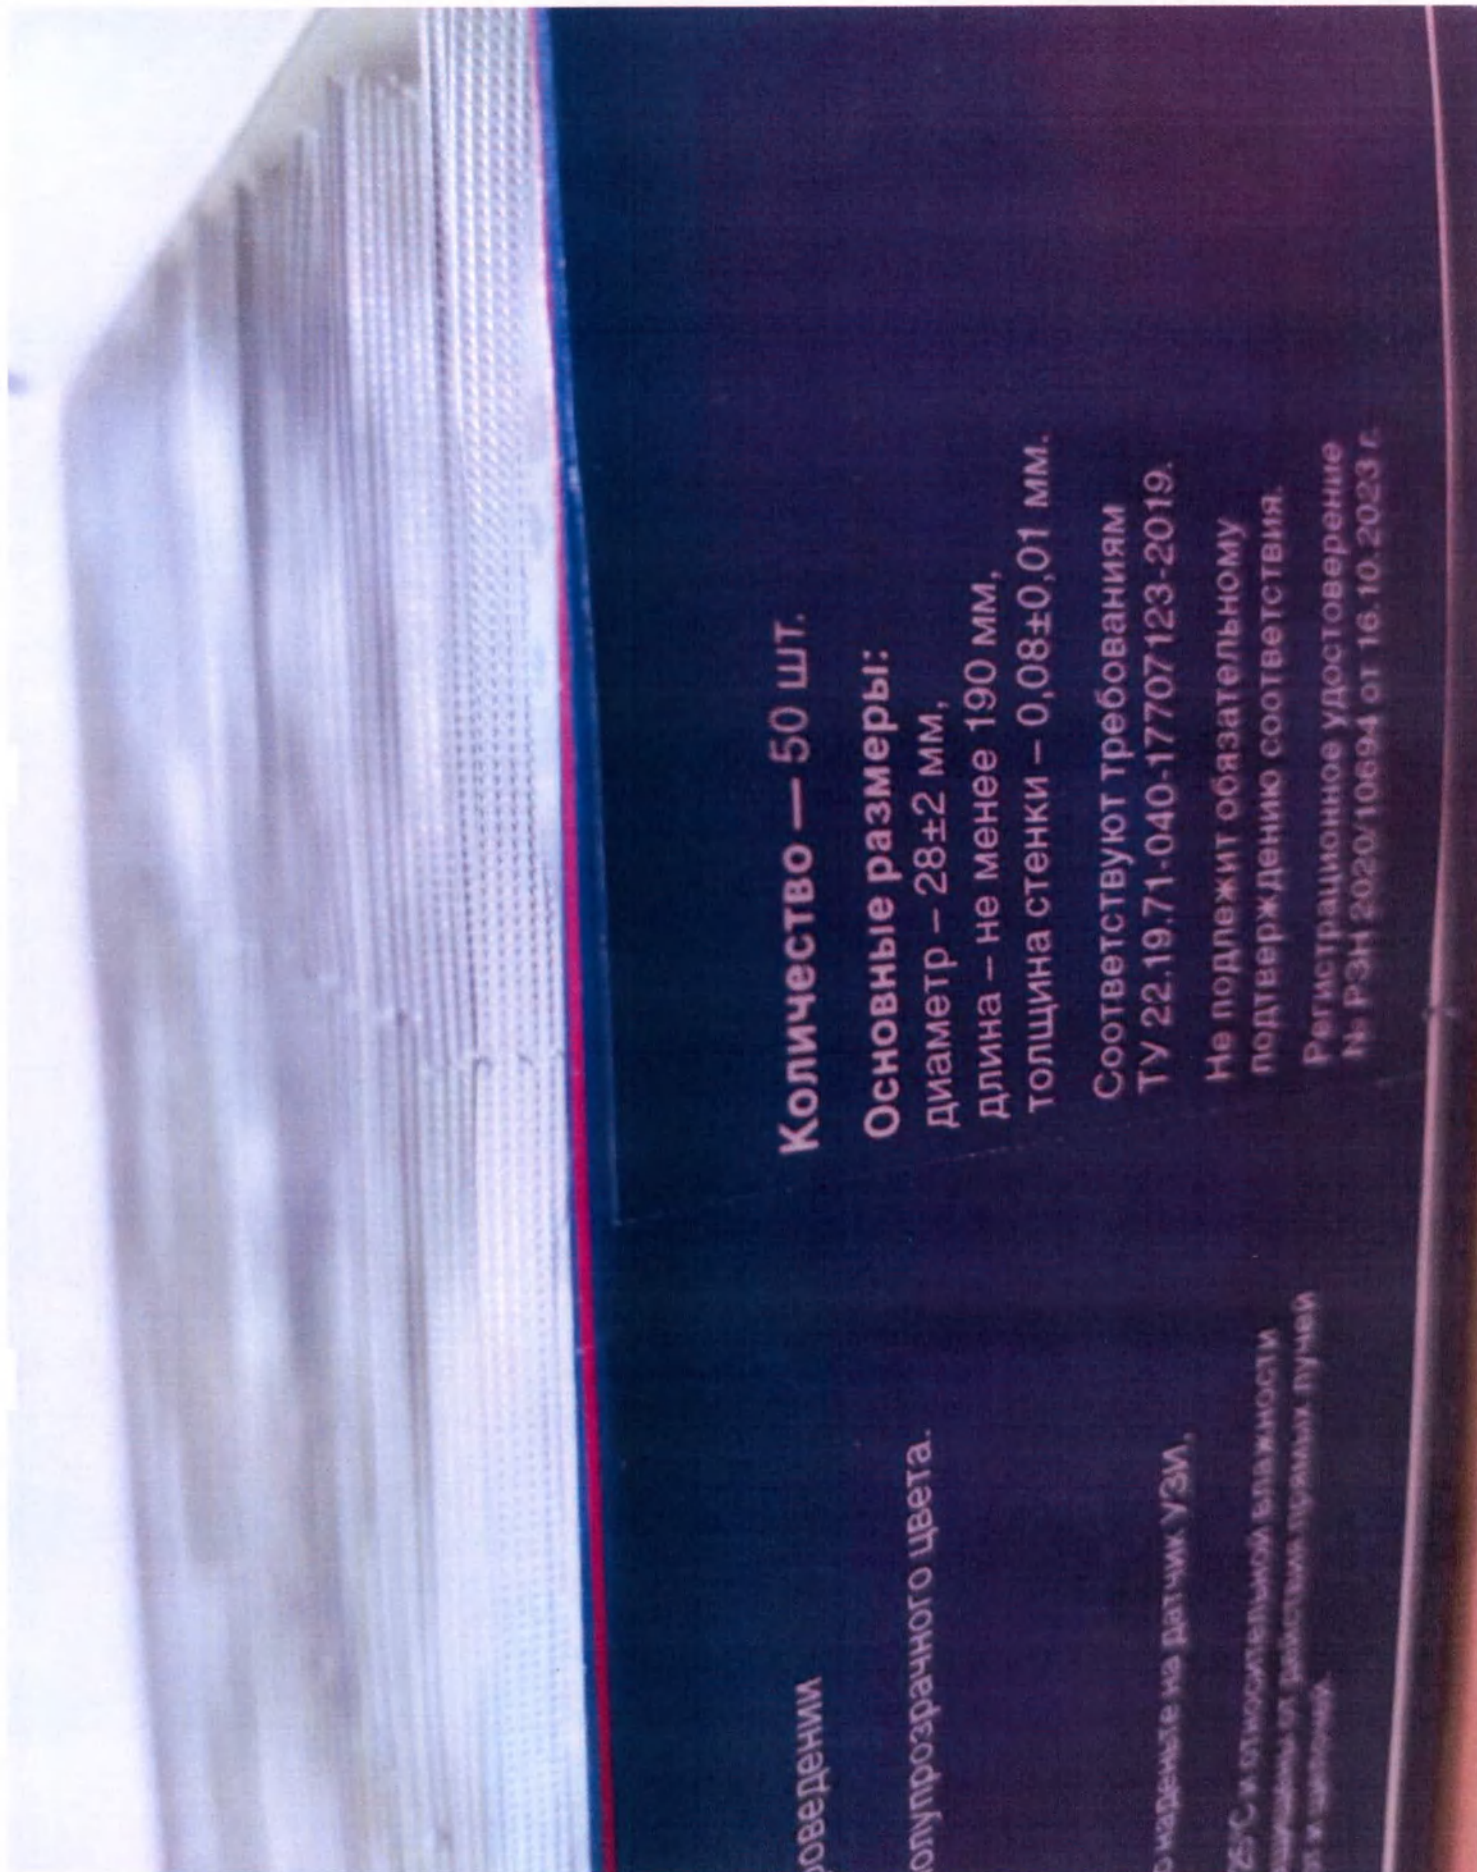


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 28 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)

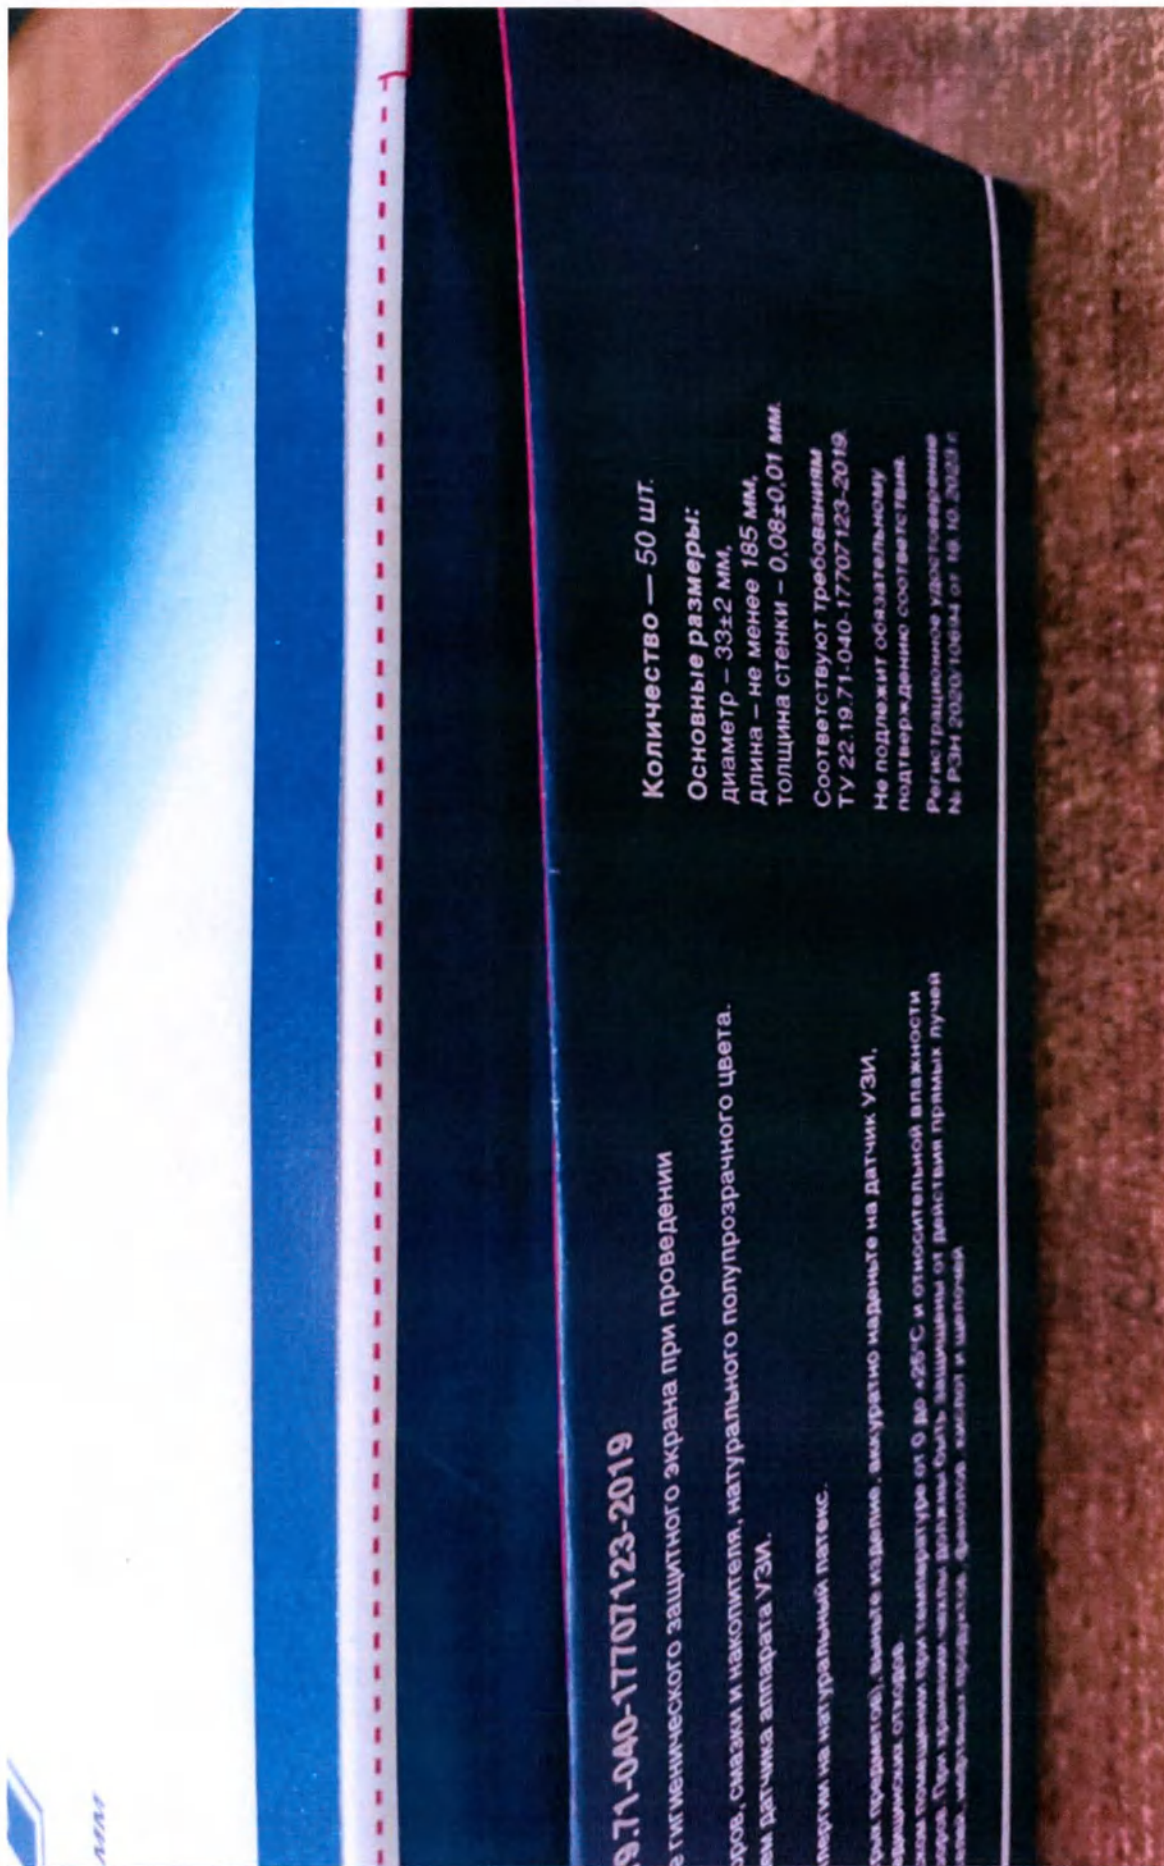


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 33 мм
 (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 50 шт.)

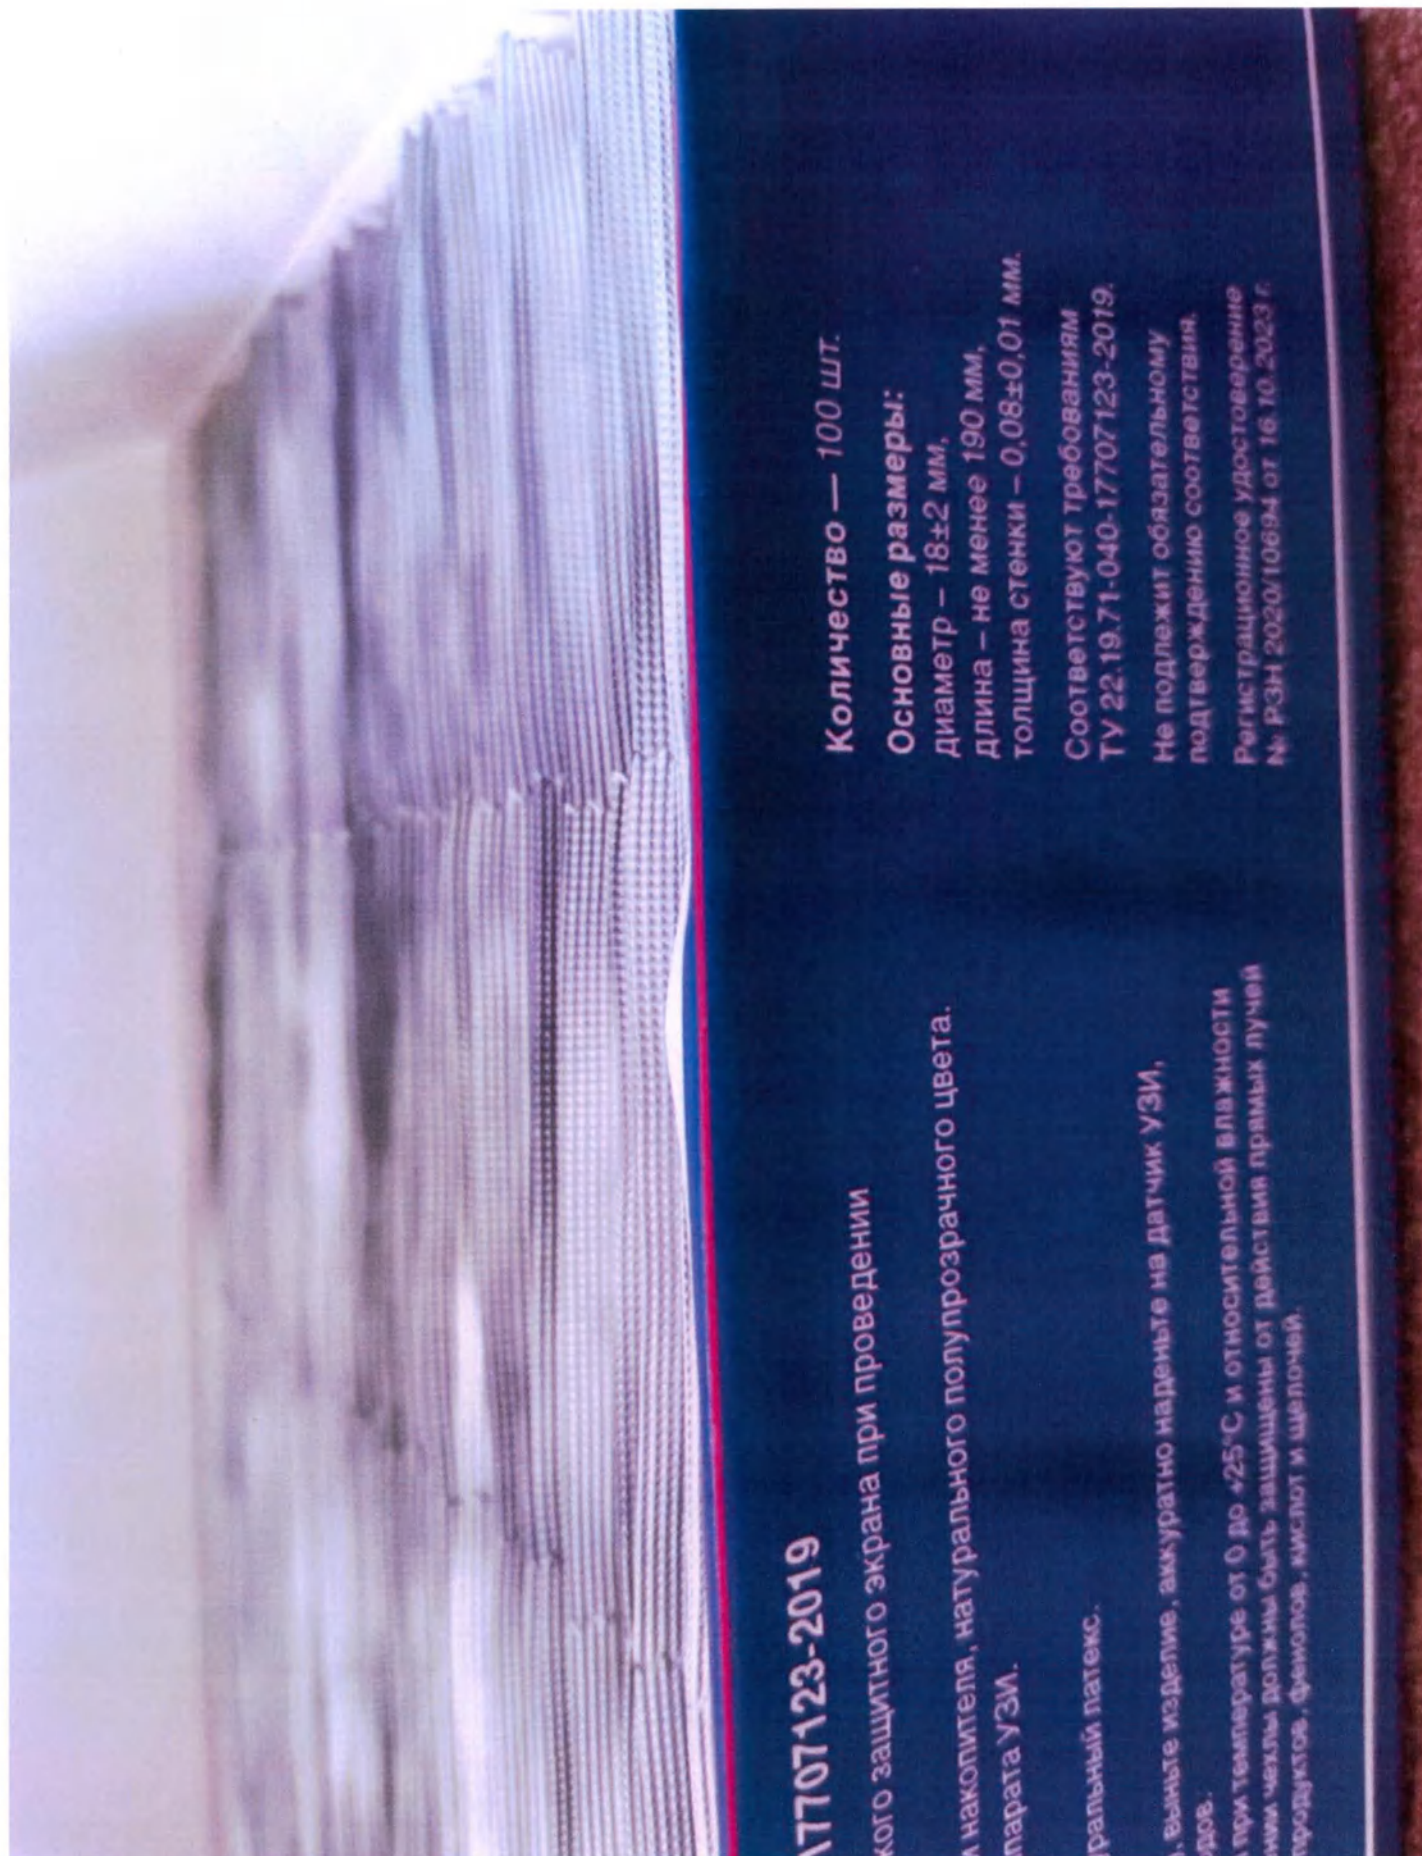


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)

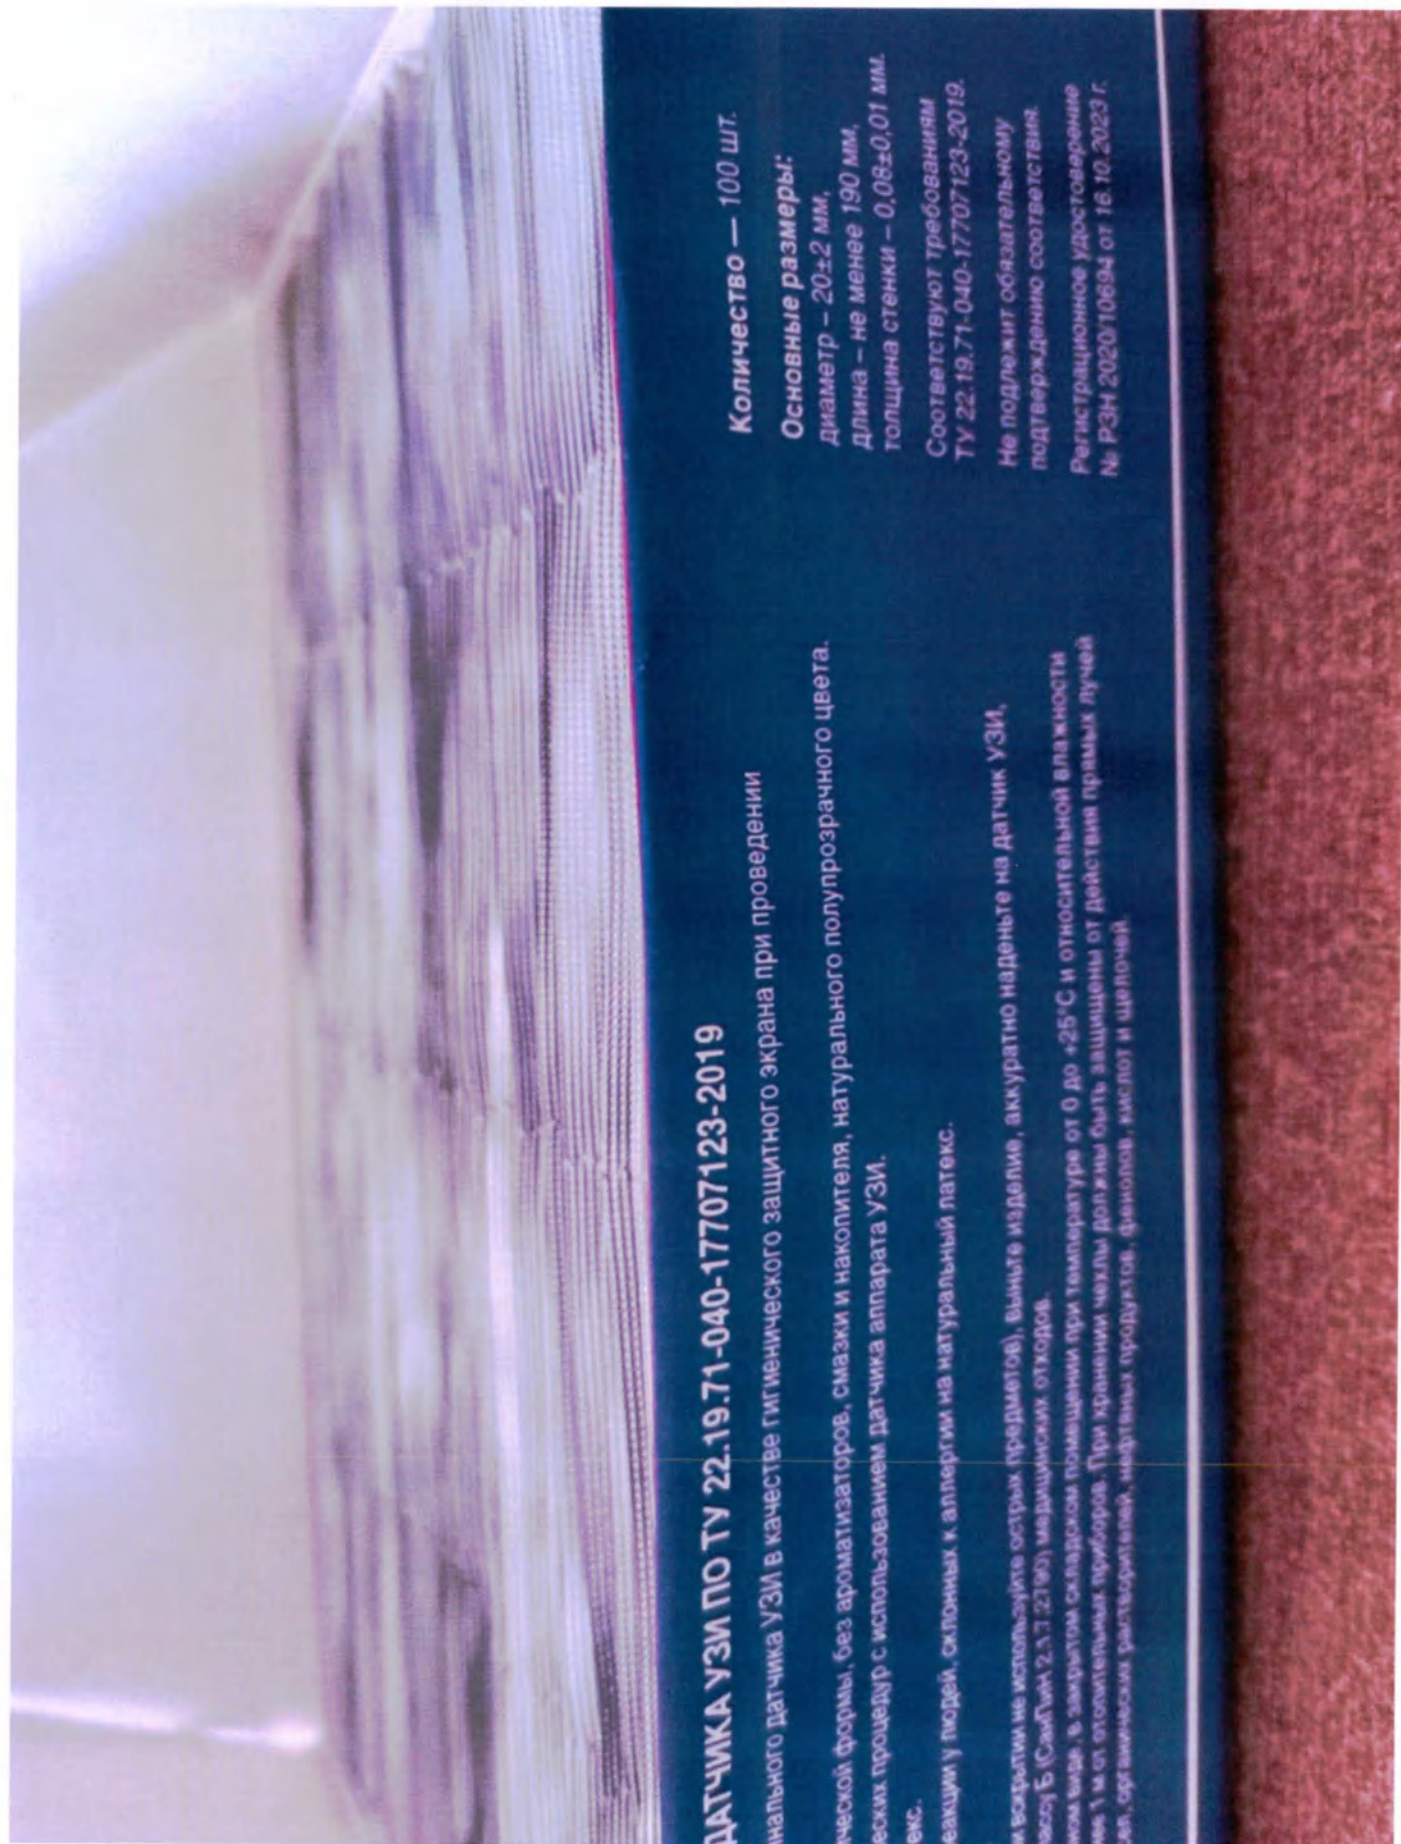


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)

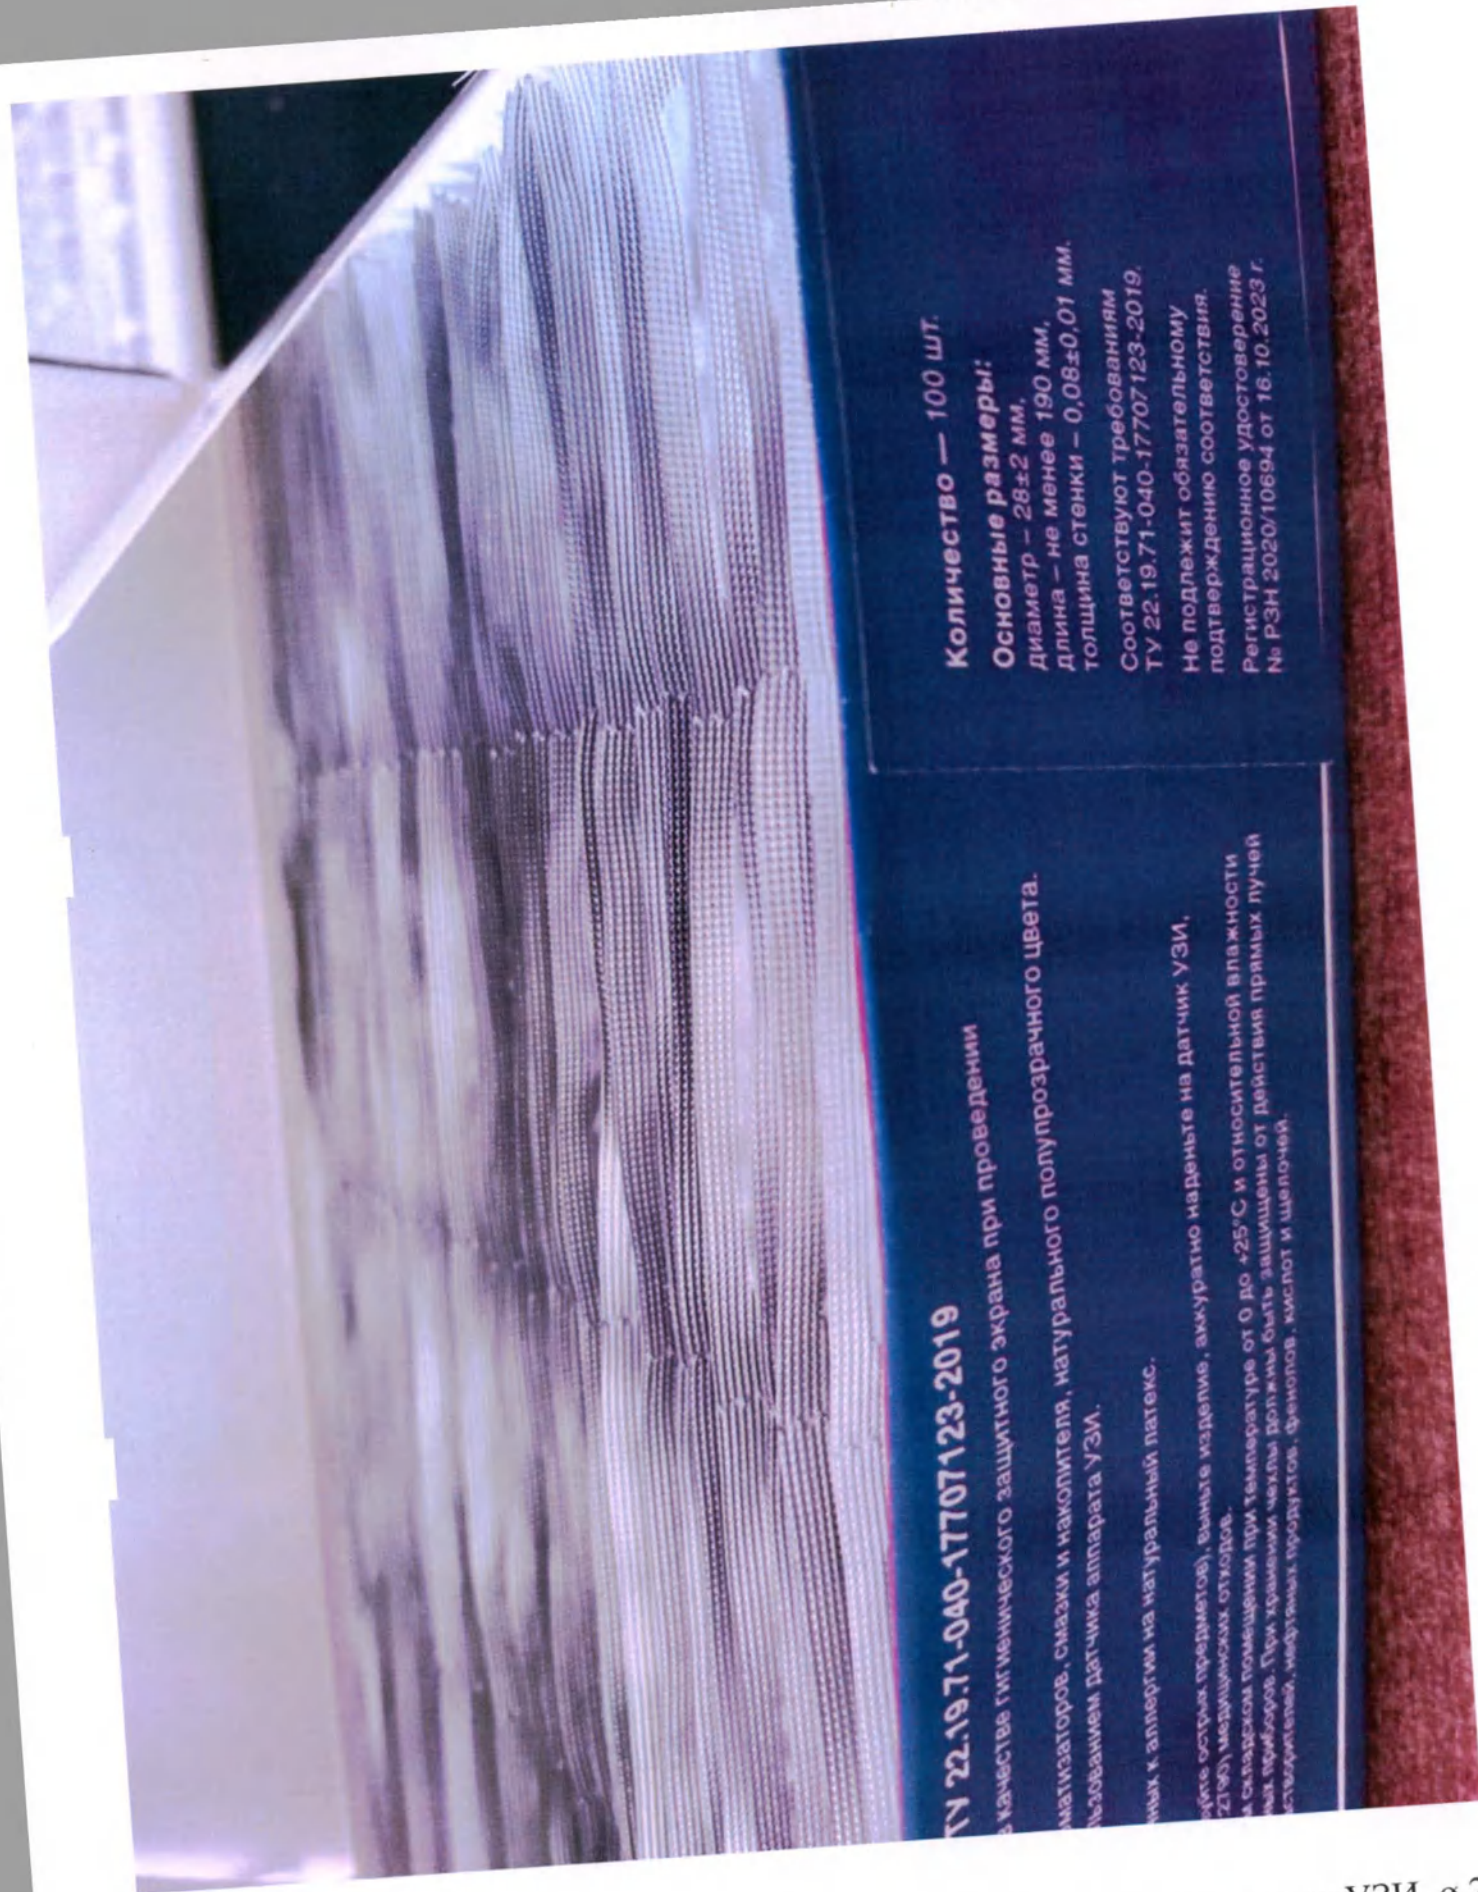


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм
 (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)

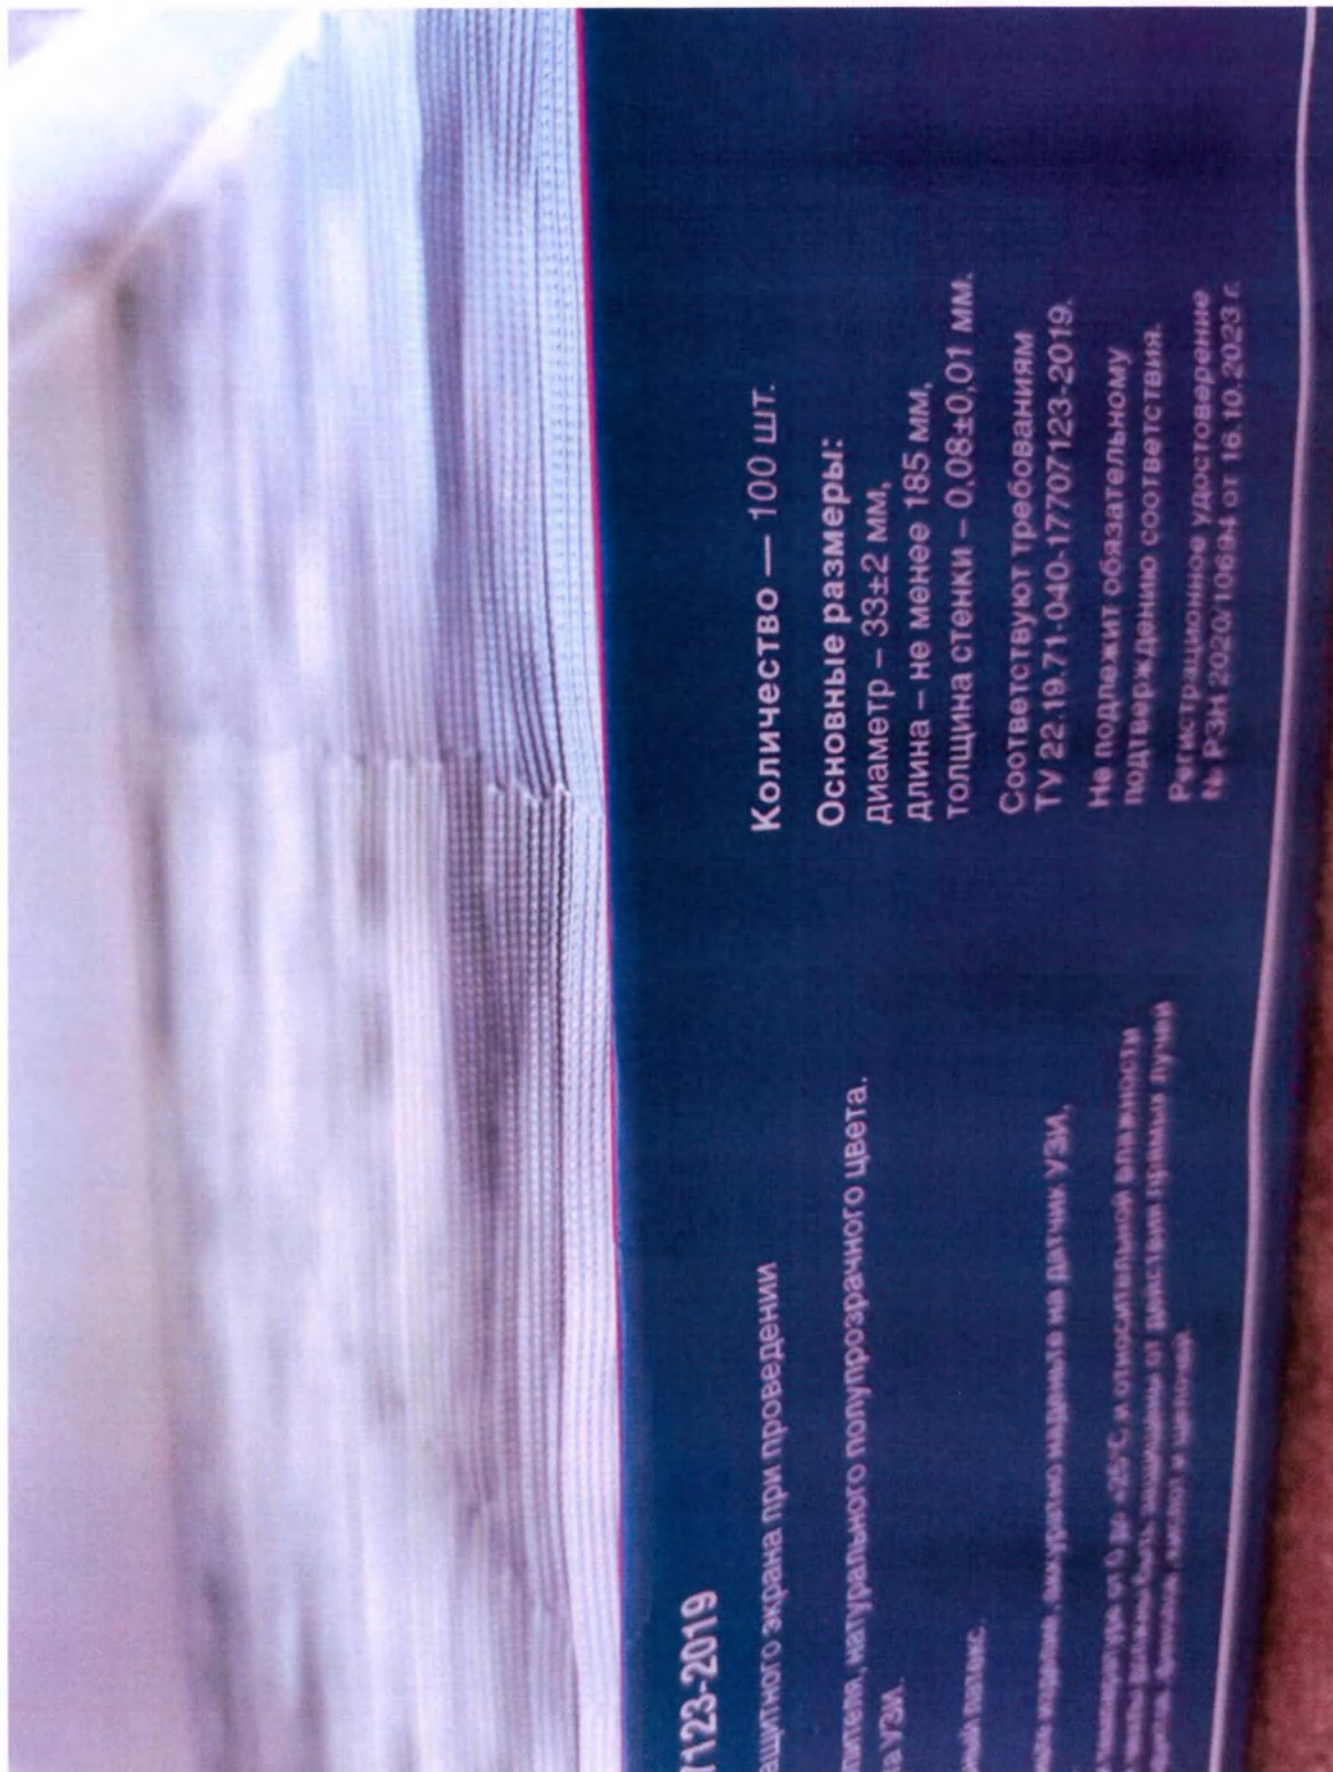


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 33 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)

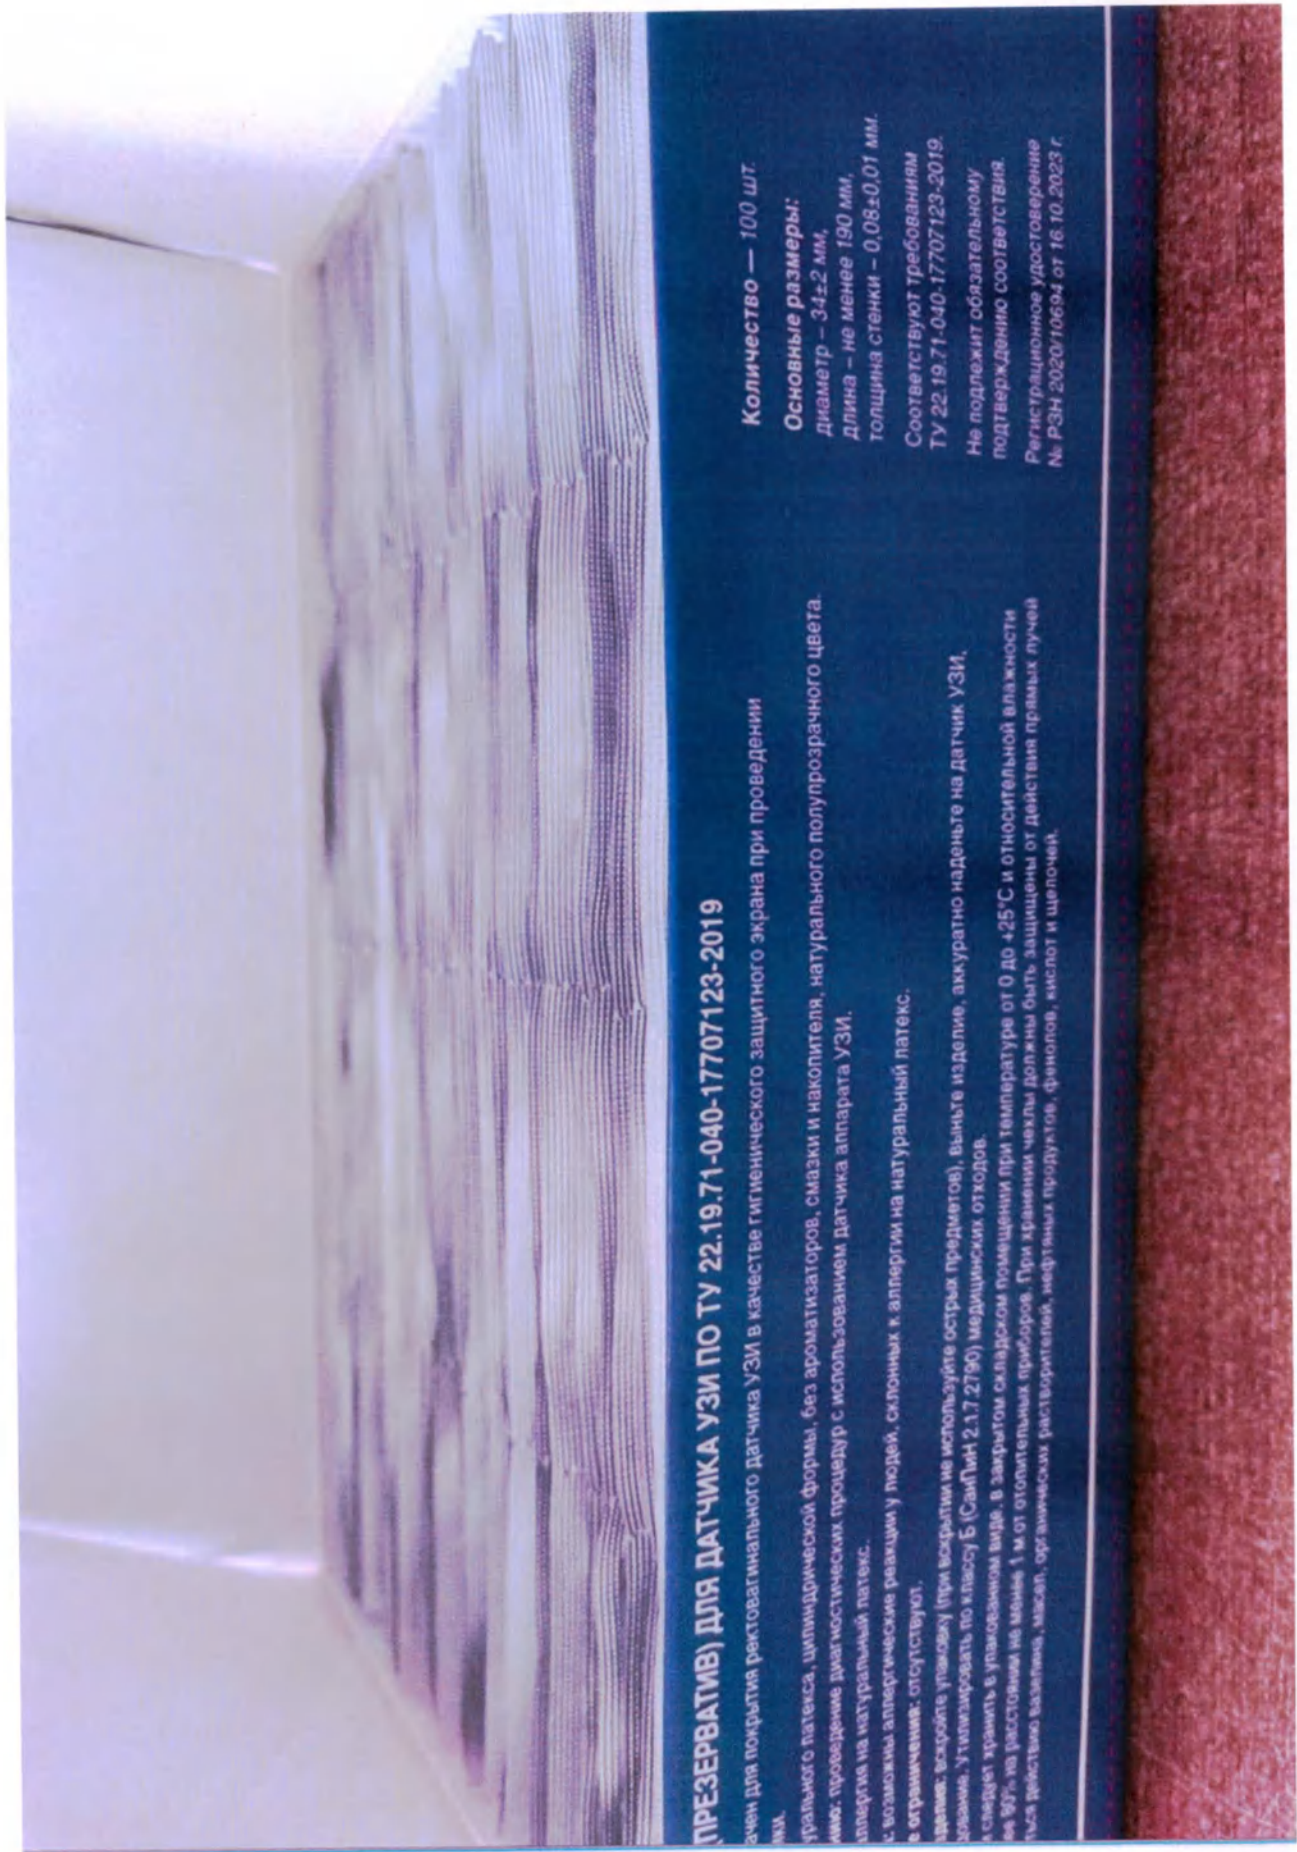


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 34 мм (товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)

Фото упаковки медицинского (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
(товарный знак «VIZIT», картонная коробка, 100 шт.)





Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)

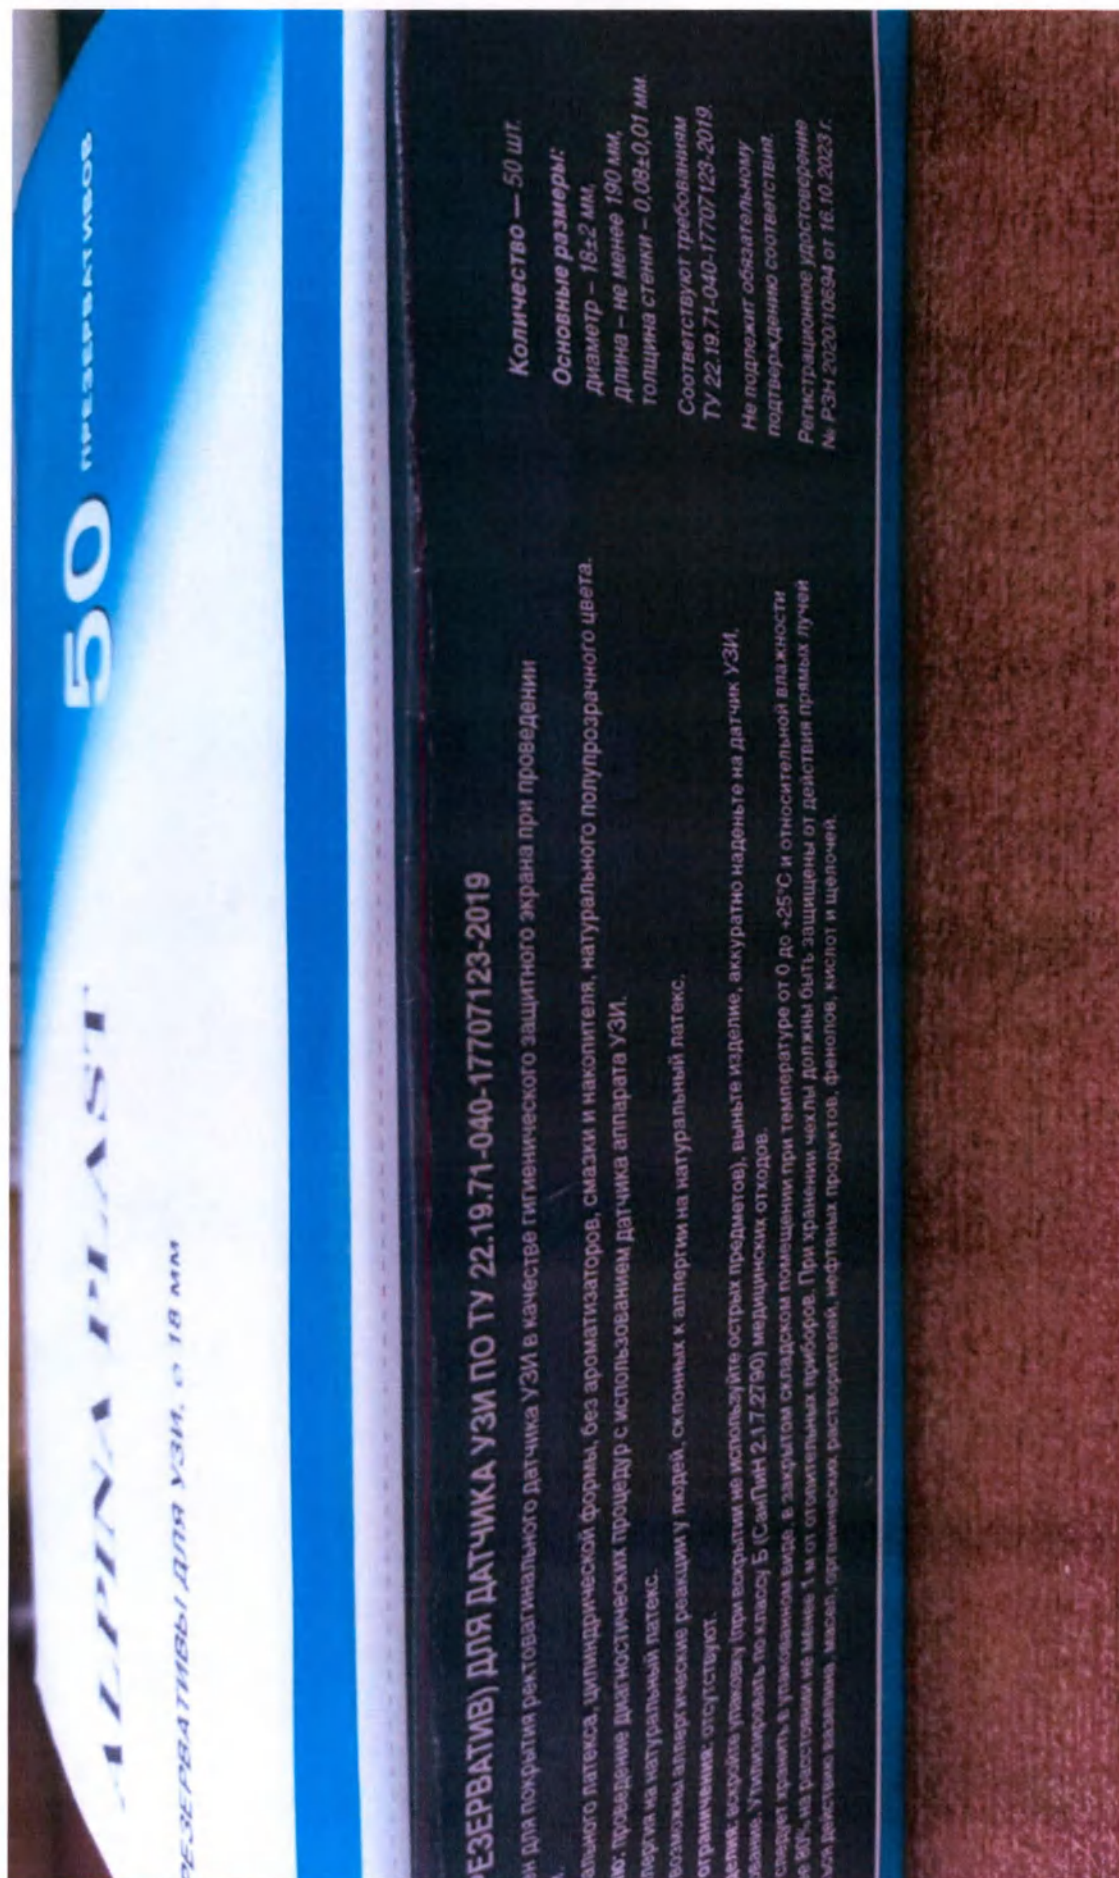


Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



КА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

исследований, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Используется для исследования датчика аппарата УЗИ.

Подойдет для использования на натуральном латексе.

Не используйте для исследования острых предметов, выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ.

Срок годности (с даты изготовления) — 24 месяца.

В закрытом состоянии при температуре от 0 до +25 °С и относительной влажности до 80% датчик может храниться в течение 12 месяцев. При хранении датчик должен быть защищен от действия прямых лучей солнечного света, влаги, нефтепродуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр — 20±2 мм,

длина — не менее 190 мм,

толщина стенки — 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Датчик УЗИ по ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Датчик УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

испытаний датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

испытаний датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

испытаний датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

испытаний датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

Количество — 50 шт.

Основные размеры:

диаметр — 33±2 мм.

длина — не менее 185 мм.

толщина стенки — 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 202010894 от 16.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)

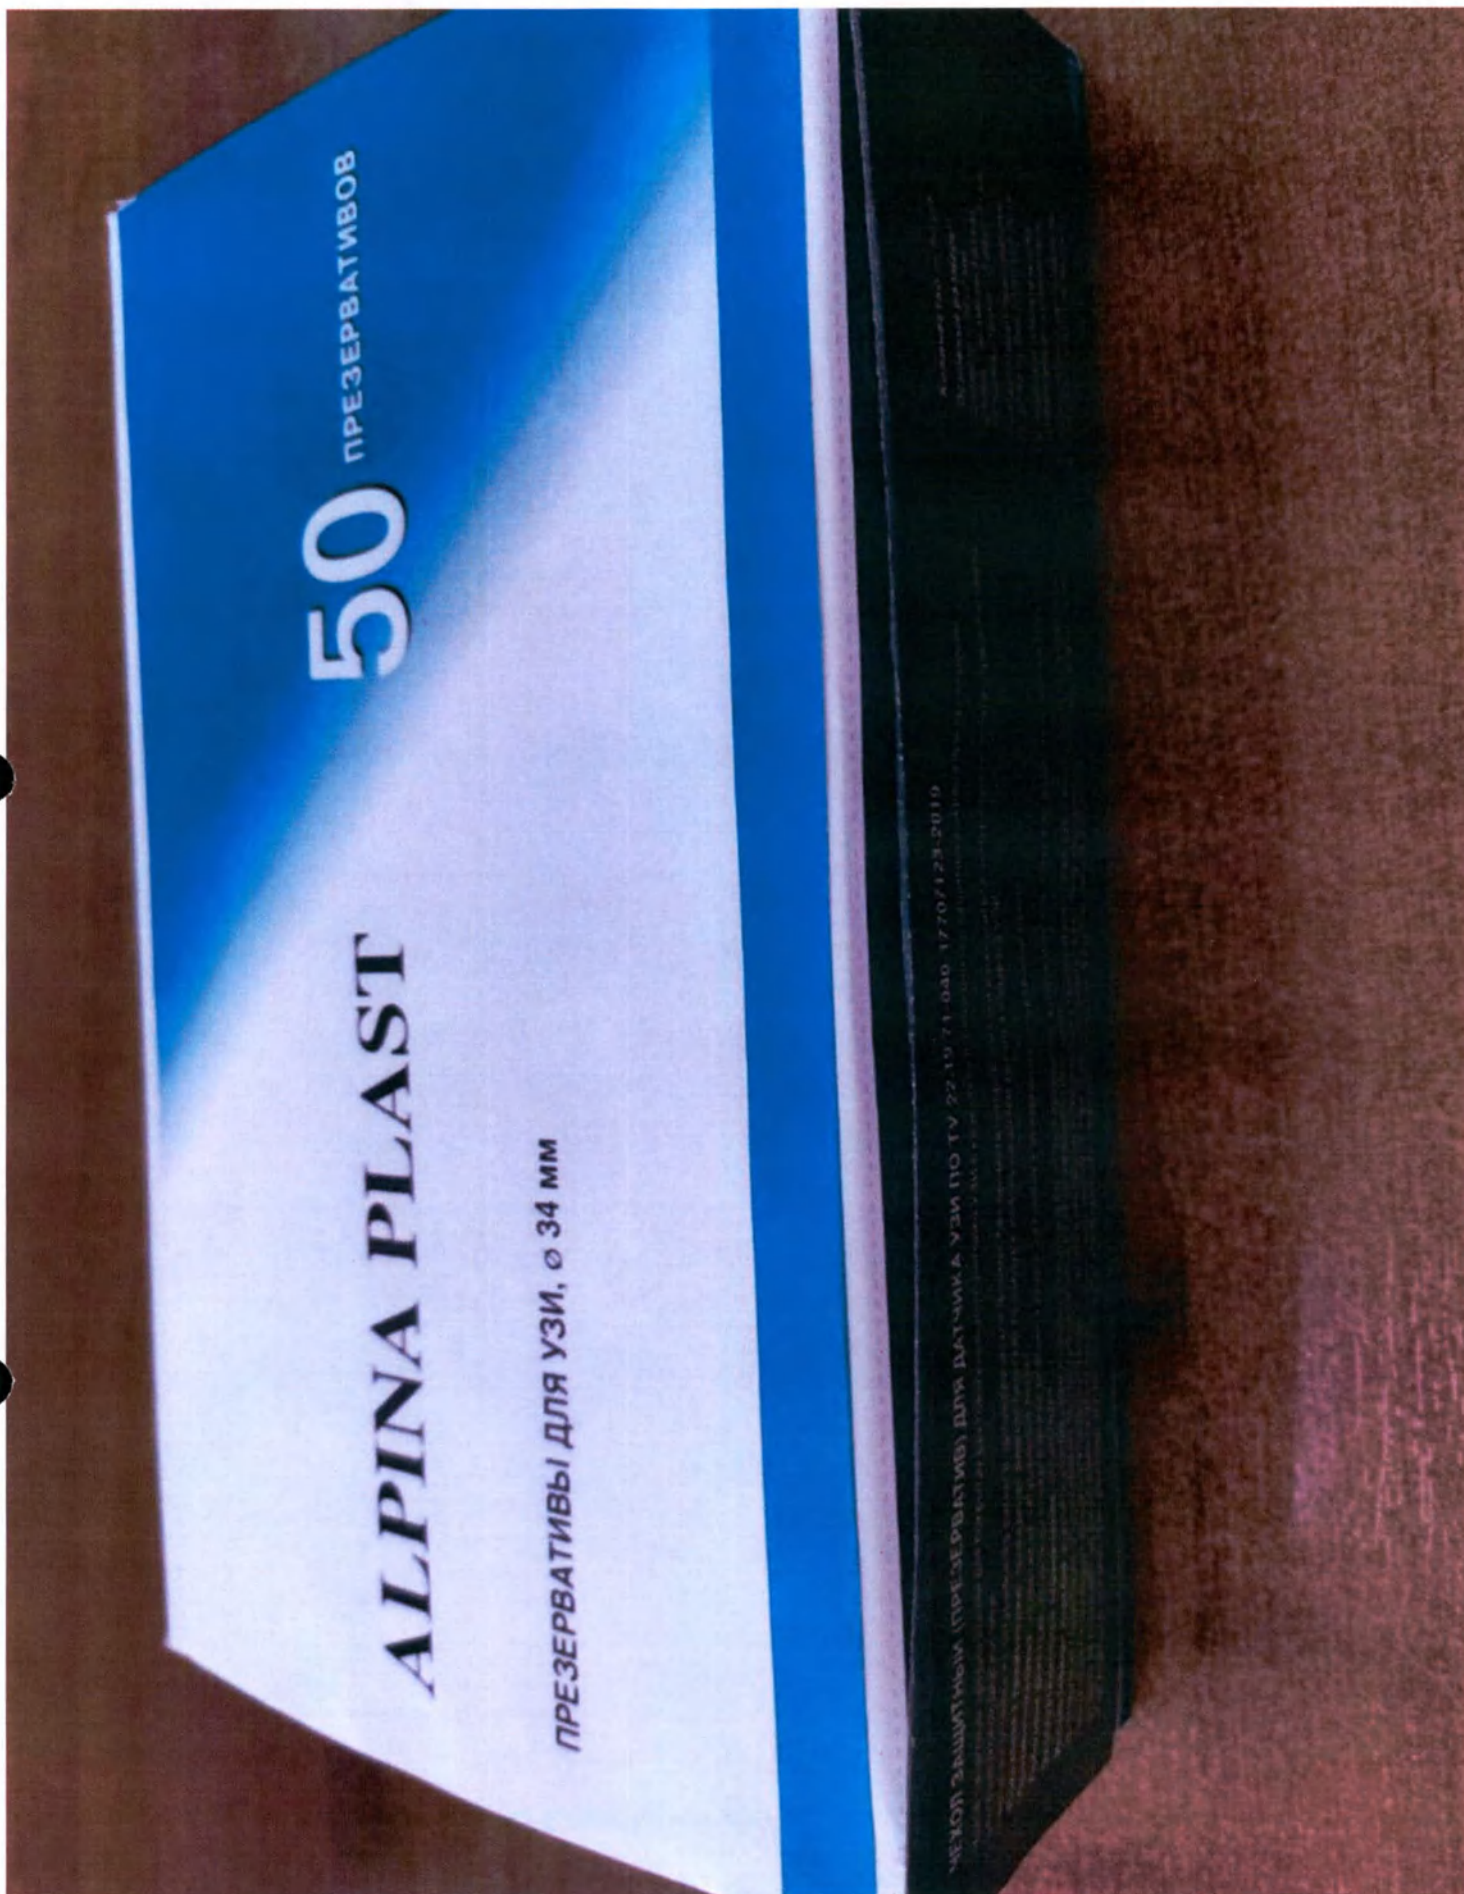



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 34 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 50 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)

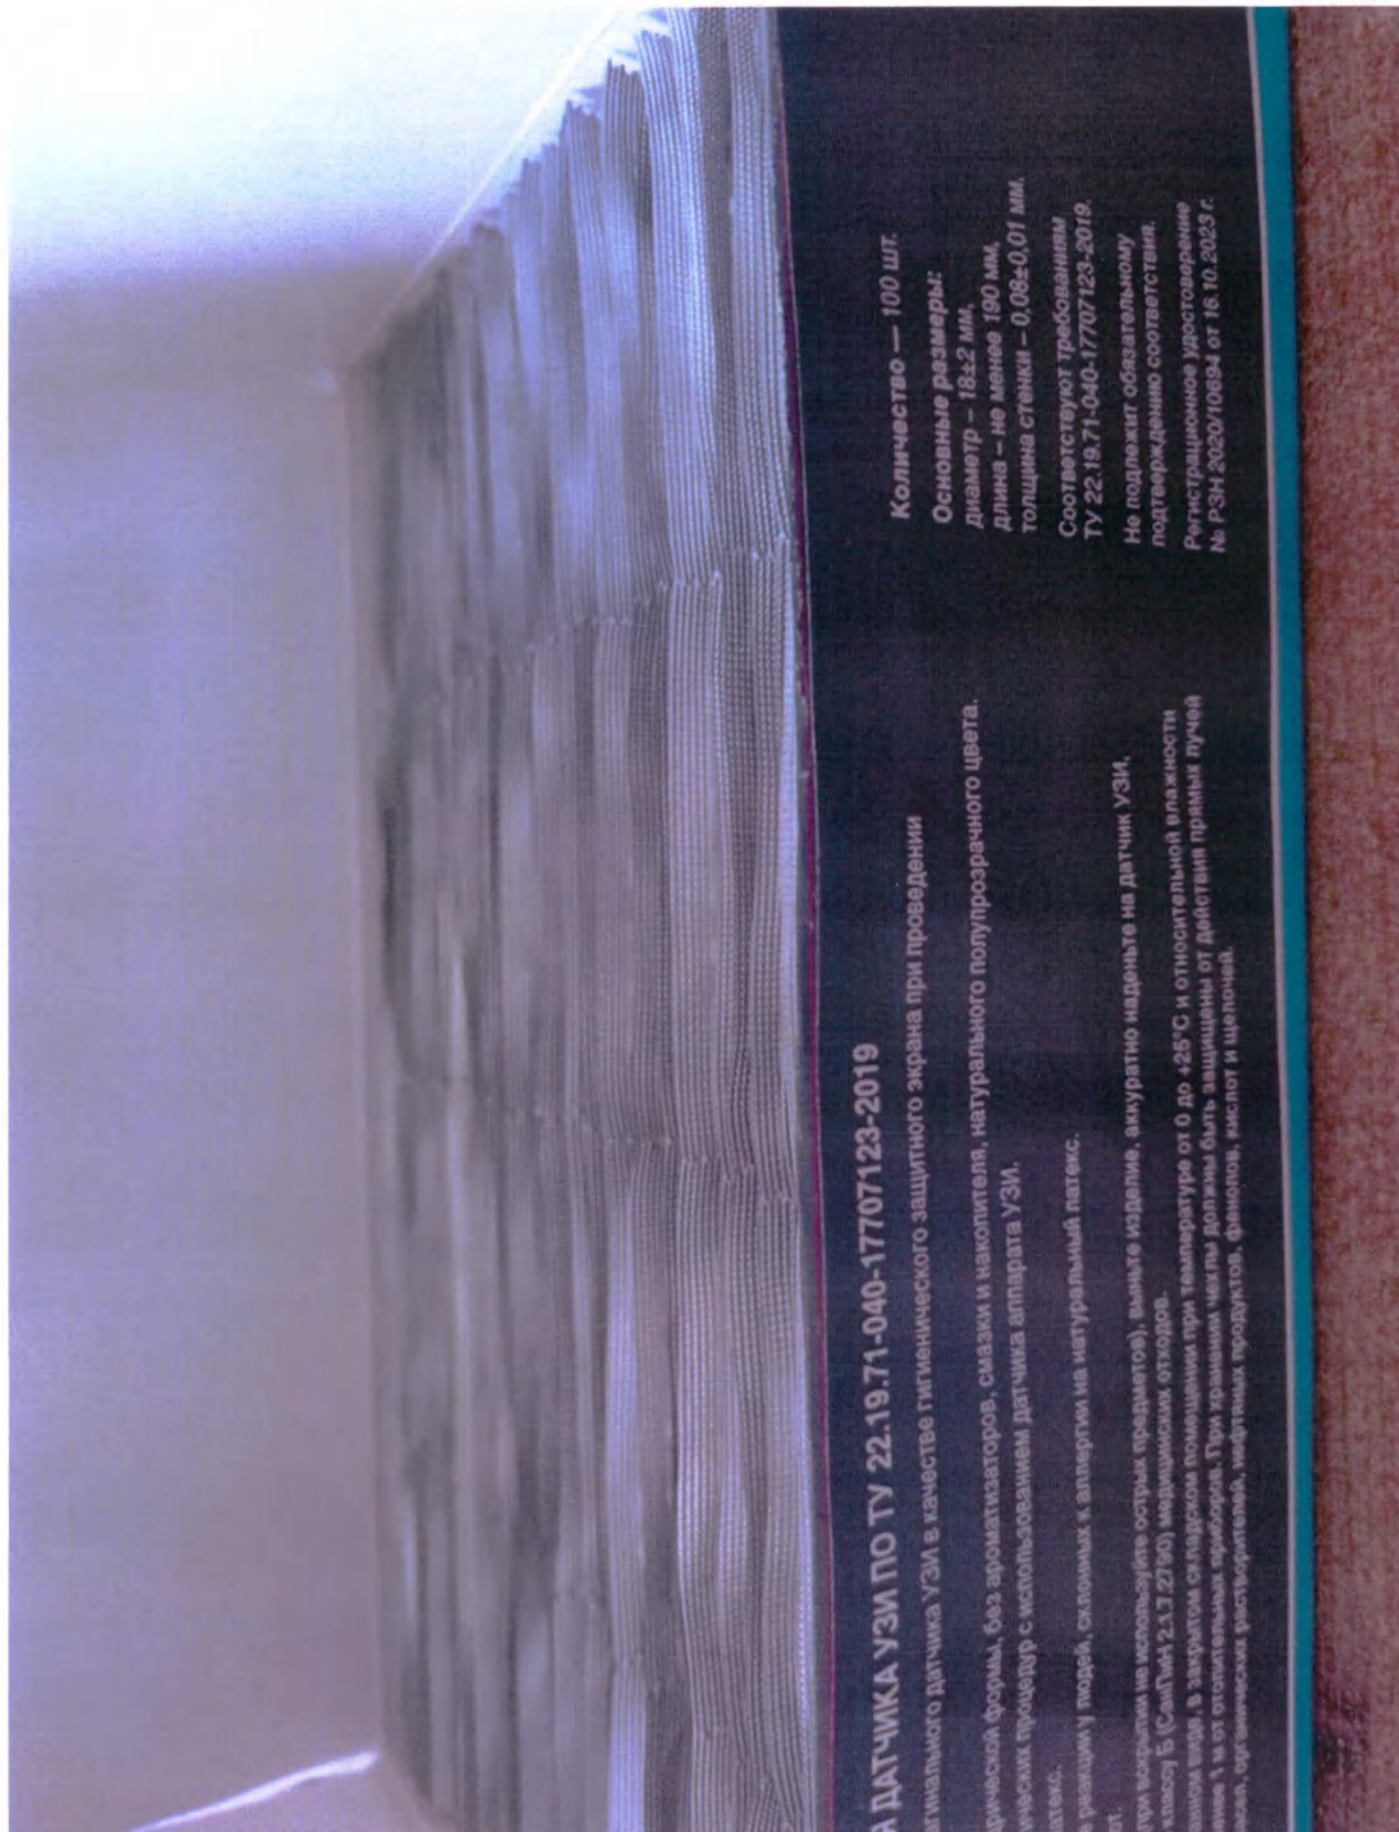

ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

агинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении
дрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.
ических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

датчик.
в реакцию у людей, склонных к аллергии на натуральный латекс.
от.

(при вскрытии не используйте острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ,
классу Б (СамГМН 2.1.7 2790) медицинским отходом.
анном виде, в закрытом с павском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности
аннее 1 м от отопительных приборов. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей
исла, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, мылов и щелочей.

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр — 18±2 мм,

длина — не менее 190 мм,

толщина стенки — 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.


Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 18 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 20 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)

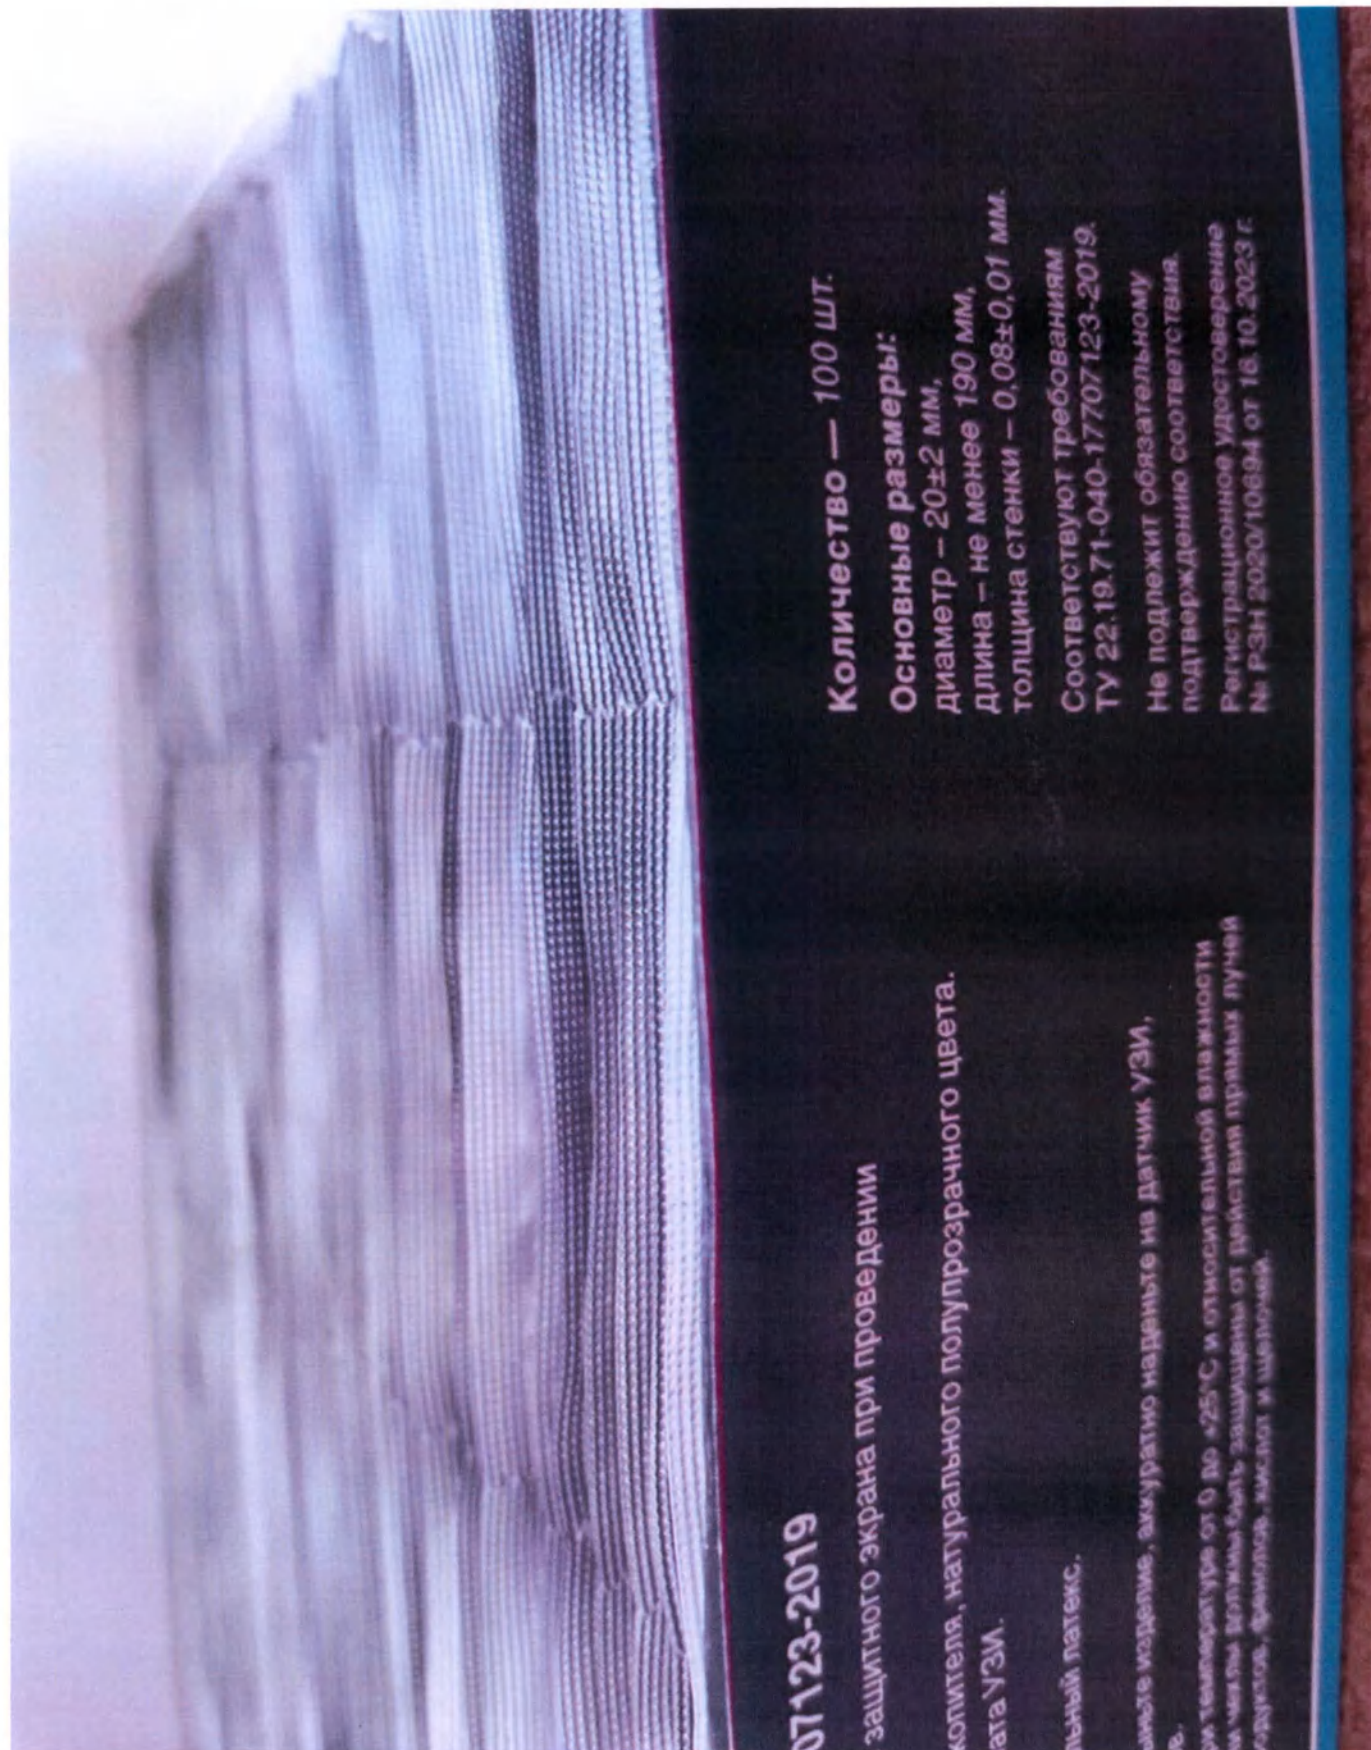

07123-2019

защитного экрана при проведении

копиптера, натурального полупрозрачного цвета.
ата УЗИ.

льный латекс.

амые изделие, аккуратно надените на датчик УЗИ,
в.

зи температуре от 0 до +25°C и относительной влажности
на чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей
солнца, фанглов, кислот и щелочей.

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр — 20 ± 2 мм,

длина — не менее 190 мм,

толщина стенки — $0,08 \pm 0,01$ мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2020/10694 от 18.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) — Презерватив для УЗИ, $\varnothing$ 20 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)

Фото упаковки медицинского (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 28 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

ультразвуковых исследований, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.
использованием датчика аппарата УЗИ.

аллергии на натуральный латекс.

от острых предметов), выньте изделие, аккуратно наденьте на датчик УЗИ,
используя его для медицинских отходов.

хранении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности
до 80%. При хранении чехлы должны быть защищены от действия прямых лучей
ультрафиолетового излучения, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр – 28 ± 2 мм,

длина – не менее 190 мм,

толщина стенки – $0,08 \pm 0,01$ мм.


Соответствуют требованиям
ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 33 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)

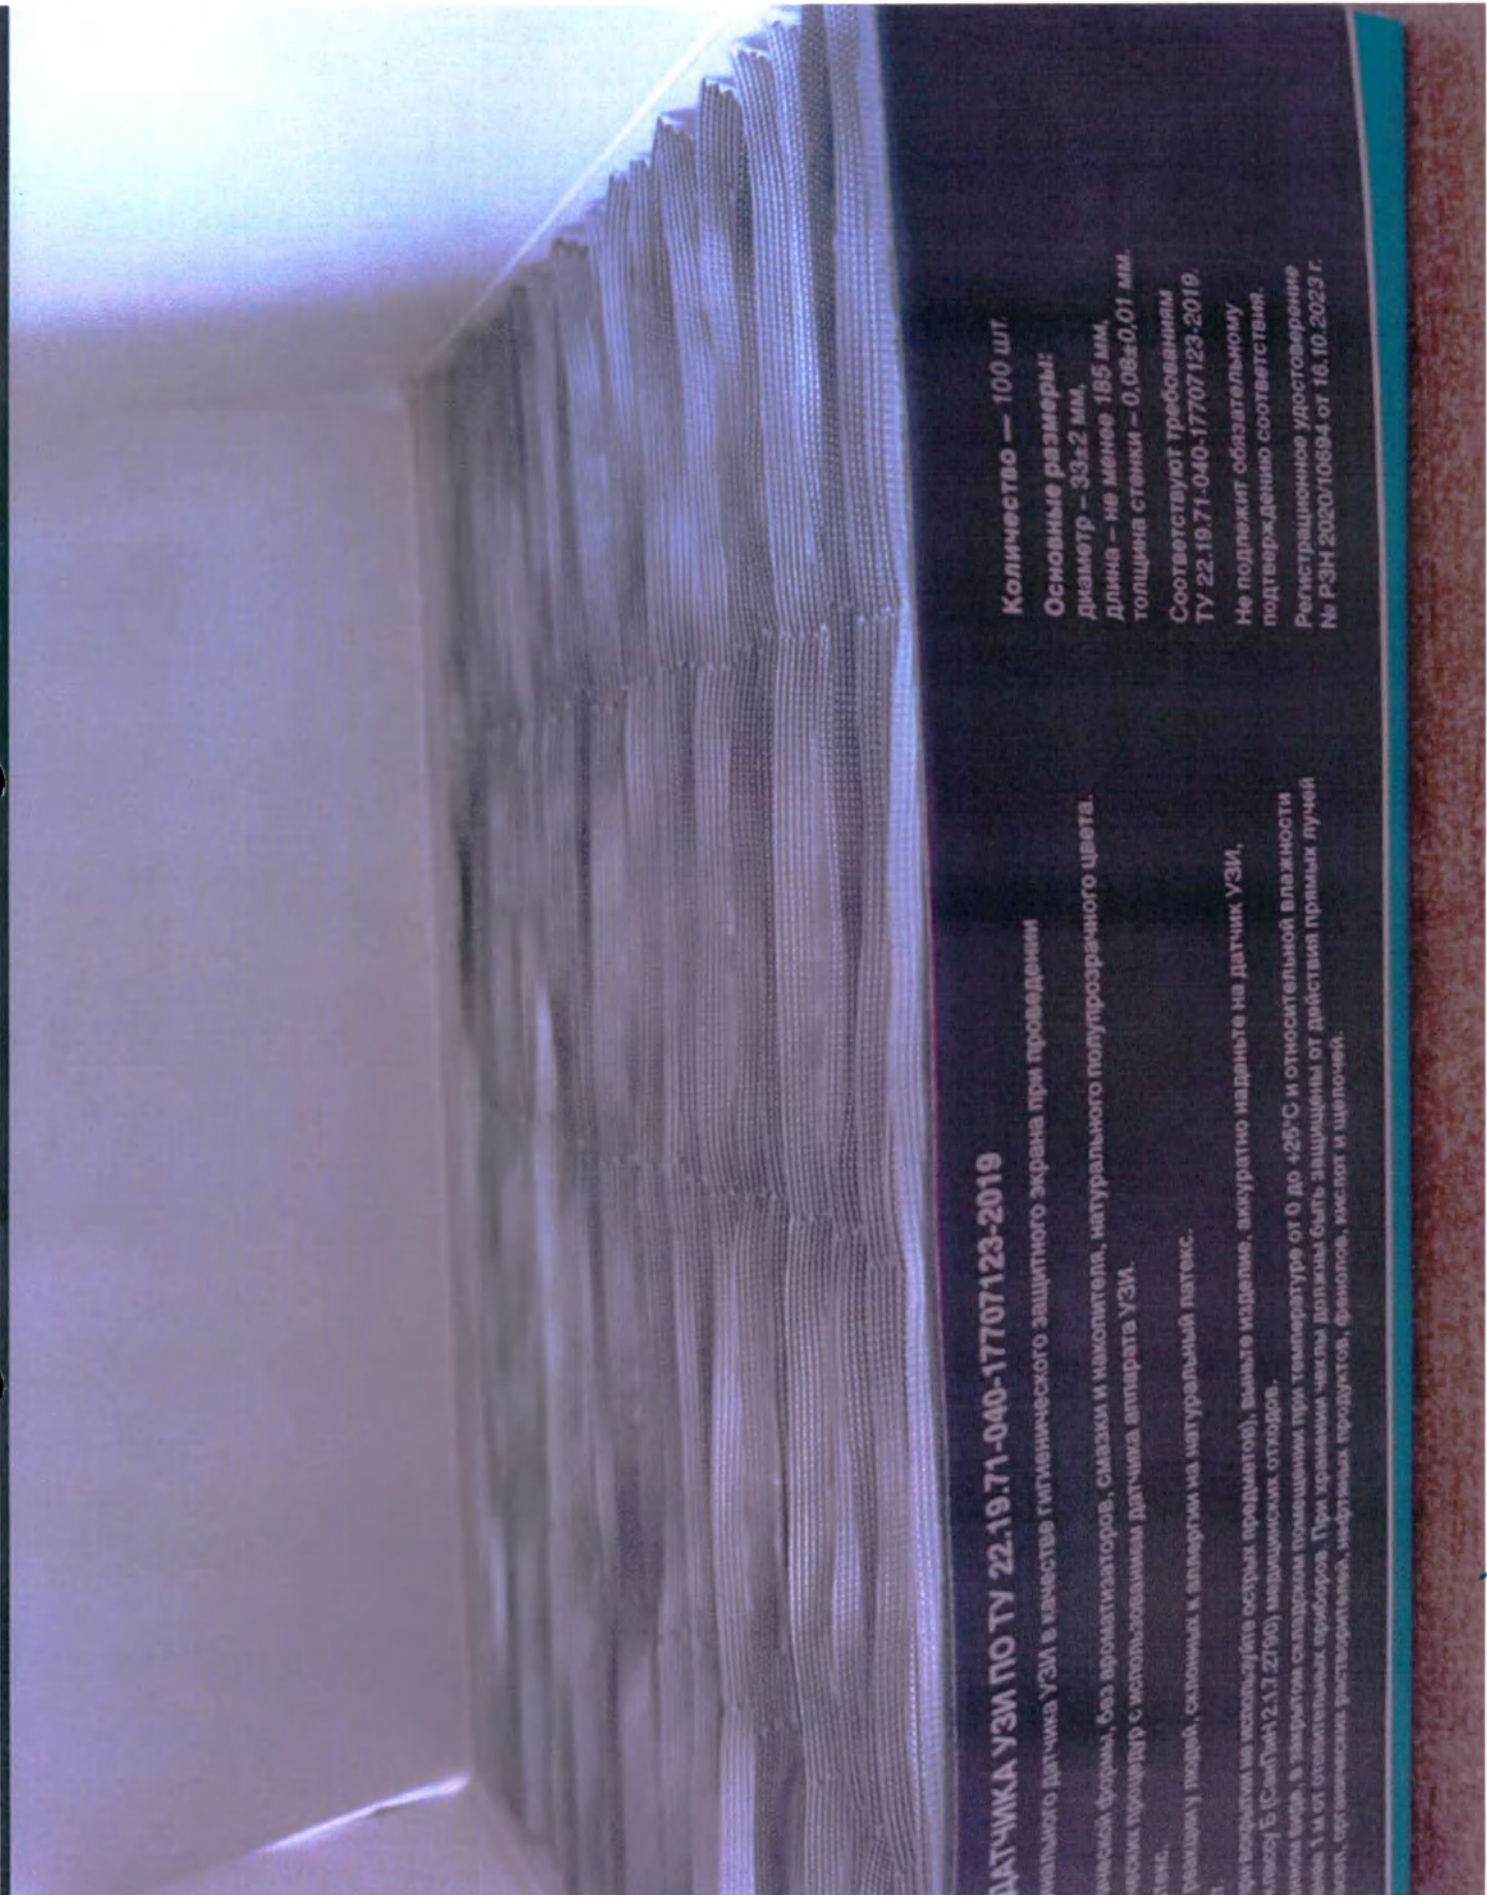

ДАТЧИКА УЗИ ПО ТУ 22.19.71-040-17707123-2019

Датчик УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении

исследований, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального полупрозрачного цвета.

Используется для использования датчика аппарата УЗИ.

Используется для использования на натуральной латекс.

Используется для использования (острых вредителей), вымываемые, аккуратно надежные на датчик УЗИ.

Используется для использования (острых вредителей), вымываемые, аккуратно надежные на датчик УЗИ.

Используется для использования (острых вредителей), вымываемые, аккуратно надежные на датчик УЗИ.

Используется для использования (острых вредителей), вымываемые, аккуратно надежные на датчик УЗИ.

Количество — 100 шт.

Основные размеры:

диаметр — 33±2 мм,

длина — не менее 185 мм,

толщина стенки — 0,08±0,01 мм.

Соответствуют требованиям

ТУ 22.19.71-040-17707123-2019.

Не подлежит обязательному

подтверждению соответствия.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/10694 от 16.10.2023 г.

Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент)— Презерватив для УЗИ, ø 33 мм (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
(товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)



Фото упаковки медизделия (увеличенный фрагмент) – Презерватив для УЗИ, ø 34 мм
 (товарный знак «ALPINA PLAST», картонная коробка, 100 шт.)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

106 / 0000000000 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игитов

