АЛЬПИНА ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

Макеты упаковки

Корректор формы соска по ТУ9398-025-17707123-2016

2023

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МалышОк!

Корректор формы соска по ТУ 9398-025-17707123-2016

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года с даты покупки

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления

Срок годности (службы): не ограничен

Изготовитель: ООО «Альпина ПЛАСТ»
Россия, 142402, Московская обл., г. Ногинск,
Ленинское шоссе, тел.: 8(496)51-55-44, 8(495)181-59-42
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info

АЛЬПИНА ПЛАСТ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибьютор в Республике Беларусь:
ООО «БОДЕАР Беларусь», 220034, г. Минск,
ул. Тимирязева, 131Б, каб. 6
тел.: +375(29) 374-83-28

Арт. 2052001022

4 607046 744682

МалышОк!

Корректор формы соска СТАНДАРТ

- коррекция плоских и втянутых сосков
- подготовка к грудному вскармливанию
- деликатно и бережно

МалышОк!

Руководство по эксплуатации

Корректор формы соска по ТУ 9398-025-17707123-2016

Показания:

Противопоказания:

Побочные действия отсутствуют.

Подготовка изделия к использованию:

Условия хранения:

Утилизация:

Использование корректора формы соска

Использование корректора до беременности

Использование корректора во время беременности

Использование корректора при грудном вскармливании

Время воздействия корректора должно быть согласовано с врачом.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МалышОк!

Корректор формы соска по ТУ 9398-025-17707123-2016
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5744 от 16.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы: не установлен.

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибьютор в Республике Беларусь:
ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск,
ул. М. Лынькова, 123Б, каб.4.
Тел.: +375 (17) 373-83-28

ИЗГОТОВЛЕНО

Арт. 2052001022

4 607046 744682

МалышОк!

Корректор формы соска СТАНДАРТ

- коррекция плоских и втянутых сосков
- подготовка к грудному вскармливанию
- деликатно и бережно

УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА

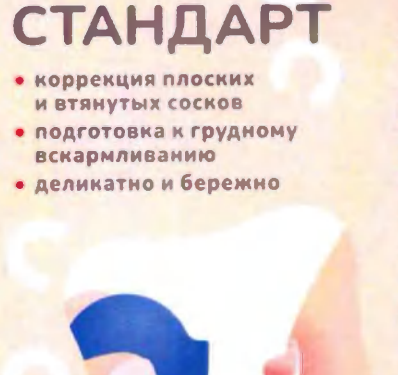

Ма

Ру

Корректор форм
предназначен дл
в терапевтическ
формирования со

Показания: подг
лению грудью, те
формы сосков.

Противопоказан
повышенная чув
беременности (ес
спровоцировать
рывания беремен
сультации врача)
При невроже
ходима консульт

Побочные дейст

Подготовка изде
корректор продез
ние балон и рез
методом погруже
с последующим
фекцию резерву
лированной воде
дезинфекции изд
в отверстие балл
разового примен
ощущений при и
вании формы сос
После каждого и
струей горячей в
и просушить.

Условия хранен
от -5°С до +40°С
80% при +25°С в
и загрязнений.

Утилизация: кор
товыми отходам

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

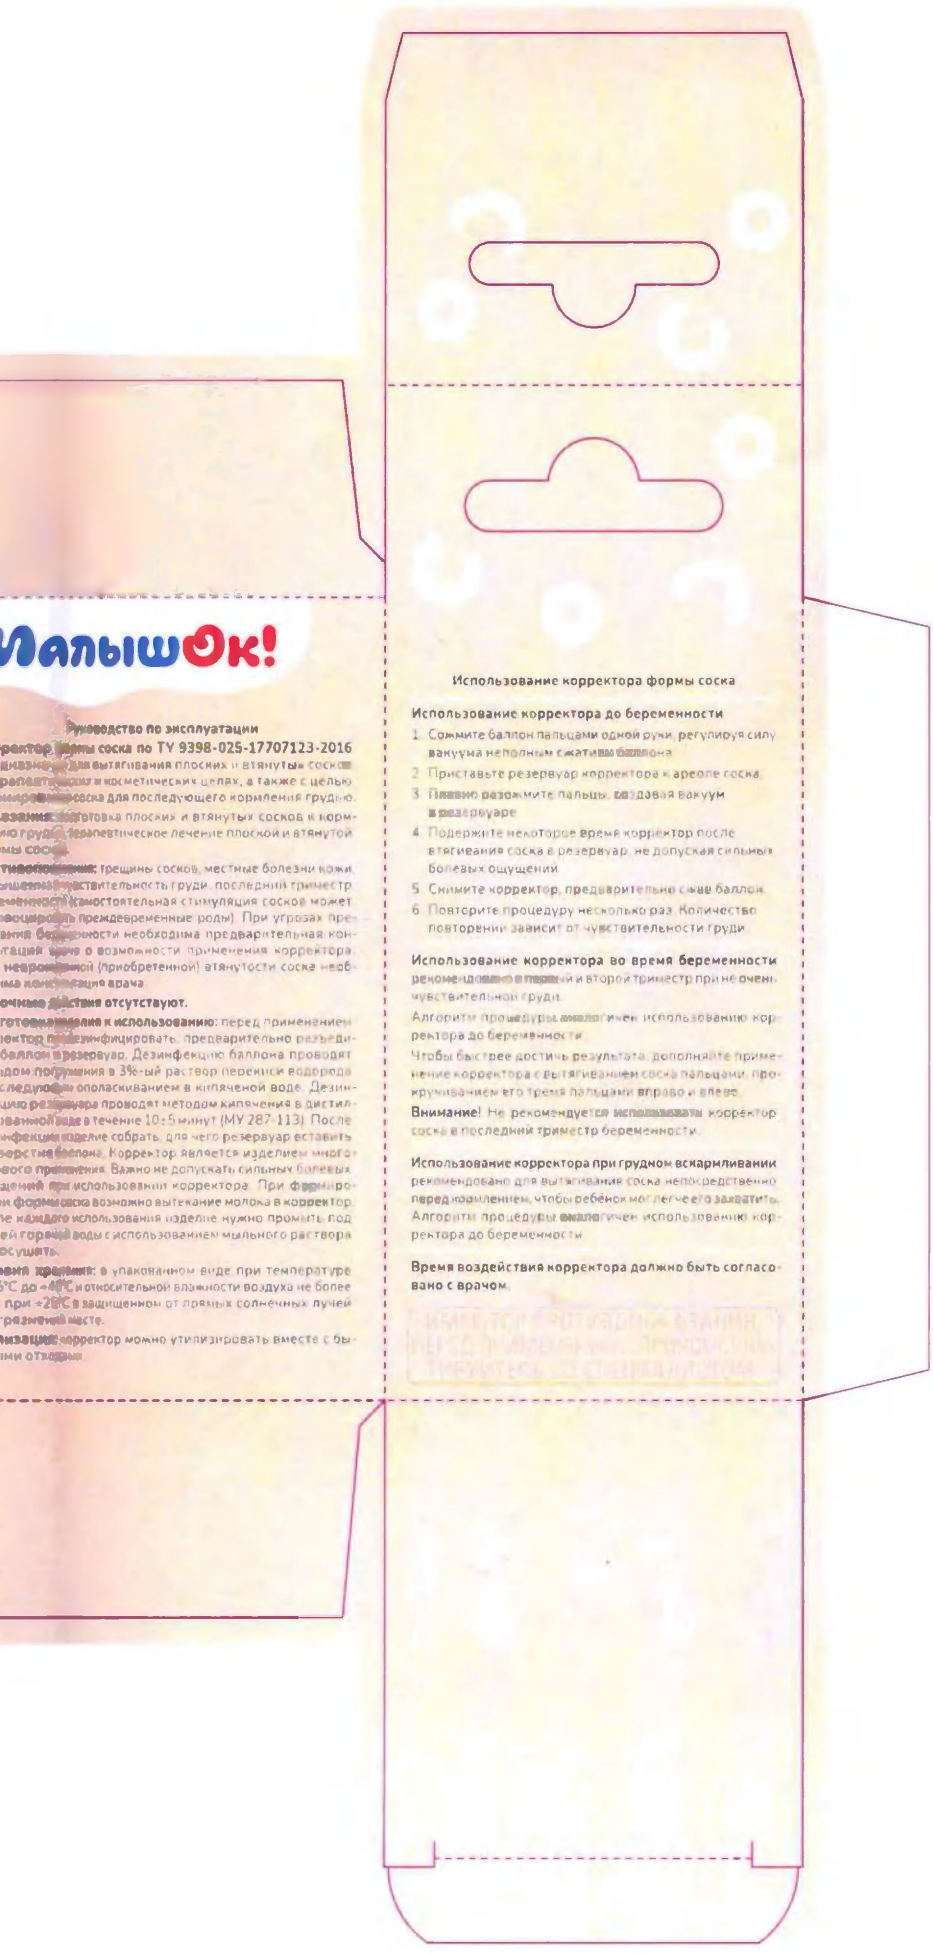

МалышОк!

Руководство по эксплуатации

ректор формы соска по ТУ 9398-025-17707123-2016

ивание для вытягивания плоских и втянутых сосков
репаративных и косметических целях, а также с целью
мирования соска для последующего кормления грудью.

зания: подготовка плоских и втянутых сосков к корм-
ию грудью, терапевтическое лечение плоской и втянутой
мы соска.

тивопоказания: трещины сосков, местные болезни кожи,
ышенная чувствительность груди, последний триместр
еменности (самостоятельная стимуляция сосков может
оцировать преждевременные роды). При угрозах пре-
ания беременности необходима предварительная кон-
тация врача о возможности применения корректора.
неправильной (приобретенной) втянутости соска необ-
ма консультация врача.

очные действия отсутствуют.

готовительные к использованию: перед применением
ректор дезинфицировать, предварительно разъеди-
баллон и резервуар. Дезинфекцию баллона проводят
ом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода
следующим ополаскиванием в кипяченой воде. Дезин-
ию резервуара проводят методом кипячения в дистил-
ованной воде в течение 10±5 минут (МУ 287-113). После
нфекции изделие собрать, для чего резервуар вставить
верстие баллона. Корректор является изделием много-
ового применения. Важно не допускать сильных болевых
щений при использовании корректора. При формиро-
и формы соска возможно вытекание молока в корректор.
ле каждого использования изделие нужно промыть под
ей горячей воды с использованием мыльного раствора
ос сушить.

ения хранения: в упакованном виде при температуре
°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более
при +25°С в защищенном от прямых солнечных лучей
грязненном месте.

изация: корректор можно утилизировать вместе с бы-
ими отходами.

Использование корректора формы соска

Использование корректора до беременности

1. Сомните баллон пальцами одной руки, регулируя силу вакуума неполным сжатием баллона.
2. Приставьте резервуар корректора к ареоле соска.
3. Плавно разомните пальцы, создавая вакуум в резервуаре.
4. Подержите некоторое время корректор после втягивания соска в резервуар, не допуская сильных болевых ощущений.
5. Снимите корректор, предварительно сжав баллон.
6. Повторите процедуру несколько раз. Количество повторений зависит от чувствительности груди.

Использование корректора во время беременности рекомендовано в первый и второй триместр при не очень чувствительной груди.

Алгоритм процедуры аналогичен использованию корректора до беременности.

Чтобы быстрее достичь результата, дополняйте применение корректора с вытягиванием соска пальцами, прокручиванием его тремя пальцами вправо и влево.

Внимание! Не рекомендуется использовать корректор соска в последний триместр беременности.

Использование корректора при грудном вскармливании рекомендовано для вытягивания соска непосредственно перед кормлением, чтобы ребёнок мог легче его захватить. Алгоритм процедуры аналогичен использованию корректора до беременности.

Время воздействия корректора должно быть согласовано с врачом.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е.Н. Игутов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

Фото медицинского изделия с упаковкой

Корректор формы соска по ТУ9398-025-17707123-2016

2023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

"Корректор формы колба СТАНДАРТ"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
_____Е.Н. Игутов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU