АЛЬПИНА ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

Фото медицинского изделия с упаковкой

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017

Июль 2023

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Медицинское изделие с многократным применением
(цветной чертеж)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Молочное с частицами резервуар
(цвет белый)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Облако со стеклянным резервуаром
(цвет голубой)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
10 (десять) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е.Н. Игутов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

Макеты упаковки

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017

Июль 2023

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Использование изделия: перед применением [illegible] консультироваться со специалистом (врачом). Перед [illegible] ением баллон и резервуар дезинфицируют [illegible] чением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар оставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока.
В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.
Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к 3А, стр. 1036.
Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
АЛЬПИНА ПЛАСТ
Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Срок годности/службы - не установлен.

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

МОЛОКООТСОС СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ.

Руководство по эксплуатации:
Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.
Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения соскового-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, настит, трещин сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.
Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.
Побочные действия: отсутствуют.
Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.
Меры предосторожности:
- не использовать молокоотсос при наличии на приемочной поверхности резервуара механических повреждений;
- не допускать болевых ощущений при использовании.
Материал резервуара - стекло.
Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
Утилизация: при использовании в домашних условиях изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Изготовлено:

PANTONE 634 C
PANTONE 311 C

CMYK

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МОЛОКООТСОС

С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Использование изделия: перед применением [illegible] консультироваться со специалистом (врачом). Перед [illegible] нением баллон и резервуар дезинфицируют [illegible] чением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока.

В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alp.na-plast.ru www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.

Не подлежит обязательному подтверждению соответ- [illegible] в РФ.

[illegible] тийный срок эксплуатации - 2 года со дня [illegible] чения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы - не установлен.

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

МОЛОКООТСОС С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ.

Руководство по эксплуатации:

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков, поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:

- не использовать молокоотсос при наличии на приемочной поверхности резервуара механических повреждений;
- не допускать болевых ощущений при использовании.

Материал резервуара - поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по «классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

4 607046 748222

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Изготовлено:

PANTONE 634 C

PANTONE 311 C

CMYK

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АЛЬПИНА ПЛАСТ

ИЗГОТОВЛЕНО:
ДАЙЫНДАЛҒАН:

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

ПЛАСТИК ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРҒЫШ

Қолданылуы: гипогалактия, емшектің қатаюы, емшек ұшығының жарылшақтығы, аналықтың, ісіңкіреткіш, лактостаздың емдеу және профилактикалық мақсат; емшек ұшығынан жұмсартып бос тартылмаған лактостаз деңгейі және сақтау лактацияны стимуляциялау.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: Терінің жергілікті зақымдануында, емшек ұшығының кілегей қабығында емшектің, жақсы сезімталдығында.

Жағымсыз әсерлері: жоқ.

Пайдалану ерекшеліктері: жоқ.

Сақтық шаралары:
– ұйқыдағы жақын қатынастың бетпе-бет механикалық зақымдануын болдырмау үшін сүт сорғышты пайдалануға болмайды;
– пайдалану кезінде ауырсыну болмауы керек.

Бұйымды пайдалану. Қолданар алдында емізгішті (дартпаны) кемсіз керек. Қолданар алдында баллон мен ыдысты 30±5 минут бойы дистильденгенген суда қайнатумен дезинфекциялайды. Бұйымдағы толығымен суға батырып, одан кейін суды қайнату керек. Дезинфекциялық ұстау уақытын сәтті басталуы тегіс қоректі керек.

Сүтсорғышты қолданар алдында қолды сабынмен жуып, кейінгі жылы суменшаю керек. Баллонды сынып, емшік ұшы сүтсорғыш қақпағымен, орталығында болғандай етіп, қуысы жоқ ыдыстың ыдысын кедергі тұйық болмауы. Сорғышты бастапқы күйіне келтіру үшін емізгішті тарту қолдың жаңа сүтті сақтағышқа өтпейді. Қол баллонды сақтауға дейін қысып, қимылдарды қатаңсыз орындау тиіс.

Сүйектік ұйқыны ұзақтау емізгіш дейін тесіңдер. Содан кейін емшек сүтін жинауға және сақтауға арналған тығыздық немесе пакетке құйыңдар. Сақтау болғанын және кедергі сүтпен сүтсорғыш басқаратын және бұрын, бөліктерін жуыңыз.

Сақтау тастар ауырсынуды тұқылдатуды керек. Егер сақтау тастар кезінде ауырсыну сезілсе және от басылмаса – онда қандағы кедергі дұрыс қойылмаған. Сүтсорғышты дұрыс тастау және аппаратты дұрыс сақтау керек.

Сүтсорғыш бөліктерін қолданғанан кейін сабынды қолданып пайдаланып, ыстық сумен жуып және кептіру керек.

Сүтсорғыш жиынтық кемтік. Сүтсорғыштың тұтынушылық қасиеттерін жоғалтпаған кейін утилизациялау керек.

Бұйымның материалы – поликарбонат.

Утилизация. Үй жағдайында пайдалану кезінде тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан бұйым медициналық қалдықтарды А класы бойынша (СанПиН 2.1.7.2790) утилизациялауға жатады – тұрмыстық қалдықтармен бірге утилизациялауға жатады (ХТК полиэтилена шығарылуы мүмкін). Утилизациялау әдісімен кемтір тазалау дезинфекциялау керек.

Сақтау шарттары: Бұйым қалталарға күйінде болмеде, +5-тен +40°С-ге дейінгі температурада және ауаның, салыстырмалы ылғалдылығы 25°С-да 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. Бұйым тікелей түсетін күн сәулесінің әсерінен қорғалуы тиіс.

Өндіруші: «Альпина Пласт» ЖШК. Ресей, 141503, Мәскеу обл., Клин қ., Ленинград тас. орн. 88 км, к. 3А, 123б оф. Тел.: +7 (495) 781-03-66 alpina@alpina-plast.ru

Өкілдіктің уәкілетті өкілі: Қазақстан Республикасы орналасқа тұтынушыдардың медициналық бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстар-ды) қабылдайтын және медициналық бұйымның пресудан кейінгі құпіялығын қадағалауға жауапты ұйым: «Болгар Калтед» ЖШС, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 221/2 үй, пошта индексі 050016, телефон +7 (727) 313-24-21, bolgar5@ck.ru

Жасалған
ын-plast.ru
ық № РЗН 2016/7359 15.07.2020.
ық мерзімсіз мерзімді растауға жатпайды.
ғ алғанның кепілді мерзімі – тұтынушы алған күннен бастап 2 жыл.
Сақтаудың кепілді мерзімі – дайындалған күннен бастап 5 жыл.
Жарамдылық мерзімі өтуі мерзімі – анықталмаған.
Беларусь Республикасындағы Дистрибьютор: «Болгар Беларусь» ЖШС, 220124, Минск қ., М. Лыньковой көш., 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-28.

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Молокоотсос с пластиковым резервуаром.

Руководство по эксплуатации

Молокоотсос предназначен для использования нормальными матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях стимуляции и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гипогалактия, нагрубание груди, аномальные особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков, поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:
– не использовать молокоотсос при наличии на приплодочной поверхности резервуара механических повреждений;
– не допускать болевых ощущений при использовании.

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 20±5 минут. Изделие погружать полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движение вытягивая, отжимая баллон до конца. Жидкость поступит в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершении сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу не нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Материал резервуара – поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинские отходы – подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Производитель: ООО «Альпина Пласт».
Россия, 141503, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 7674346 alpina@alpina-plast.ru

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/7359 от 15.07.2020
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Срок годности стерилизации – не установлен.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛГАР Беларусь».
220124, г. Минск, ул. М. Лыньковой, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-28.

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

4 607046 745542

АРТ. 2020021022

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АЛЬПИНА ПЛАСТ

ИЗГОТОВЛЕНО:
ДАМЫНДАҒЫ:

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

KAZ

ШЫНЫ ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРҒЫШ

Басқарылатын сүтсорғыш ТШ 32.50.50-031-17707123-2017

Сүт лактацияны, сүтті сауып тастауға және лактостазды профилактикалауға арналған. Көлемі кемінде 180 мл. Бала үшін аналогы пайдалануға арналған.

Қолданылуы: гипогалактия, ишемия, қалқаны, лактостаз профилактикалық, анатомиялық, конкилиттер, ыстықтауды емдеу және профилактикалық мақсат, ишемия ұшынды жоқтығы, табиғи емізудан кейін бас тартқанда лактостазды дамыту және сақтау, лактацияны стимуляциялау.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: терінің жергілікті ауруларында, ишемия ұшын одан әрі терезеде ишемия, жоғары сезімталдығында.

Жанама әсерлері: жоқ.

Пайдалануға шектеулер: жоқ.

Сақтық шаралары:
– ыдыстың жарық, жансыздығы бүтіндігін механикалық зақымдануға;
– белгісіз сүт сорғышты пайдалануға болмайды;
– пайдалану кезінде зиянды сезімге жол бермеу керек.

Бұйымды пайдалану қолдану ұйымда мамандың (дәрігердің) көмегі керек.

Қолдану алдында баллон мен ыдысты 20±5 минут бойы дистиллирленген суда қайнатумен дезинфекциялайды. Бұйымды тоңазытқыш сұйықтығы, одан кейін суда қайнату керек. Дезинфекциялық ұстау уақытын есептеуді қайнаған сәттен бастайды. Сүтсорғышты жинау керек, 01° үшін ыдысты баллонның тегіне қарағанда. Сүтсорғышты қолданар алдында қолды сабынмен жуып, кептіру жолы сүлгімен сүрту керек. Баллонды тығыз, ишемия ұшы сүтсорғышқа ұстағыдай етіп, қайда жабыстап сүтсорғышқа ұшынан өздігінен тығыз басылады. Баллонды бірінші босатыңыз, ишемия ұшын сыққыш пайда болады және сүтті сауу қажеттілігі өтеледі. Қол баллонды сондай-ақ сақтап, қажеттілігі жоғалған ұшынды.

Сүтсорғыш ыдысқа қажетті көлемге дейін түседі, содан кейін ишемия сүтін қажетіне және сақтауға арналған бөлшектерге ишемия қолданады. Сауып болғаннан кейін жуған сүтпен сүртіңіз, сүтсорғышты тазалаған және барлық бөлшектерін жуыңыз.

Сауып тастау ұсынылады тұлдақтарды керек. Егер сауып тастау кезінде ауырсыну сезілсе және ісі басылмаса – онда кеңесіңізбен кездесу дұрыс қобылмағын. Сауды дұрыс тастату және аптаратты дұрыс қолдану керек.

Сүтсорғышы белгілеген қолданғаннан кейін сабынмен кептіріңіз пайдаланыс кезінде, сүмен жуып және кептіру керек.

Сүтсорғышы жиынтық кемтіліді. Сүтсорғыштың тұтынушының, қасиеттері жағдайының кейін утилизациялау керек.

Ұқсатылған материалы – шыны.

Сақтау шарттары: Бұйым қалтаның күйінде бөлмеде, +5-тен +40°С-ге дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 25°С-де 80% дан аспайтын жерде сақтау керек. Бұйым тікелей түсетін күн сәулесінен ағарне рыналмауы тиіс.

Утилизация: ұй жағдайында пайдалану кезінде тұтынушының қасиеттерін жоғалтқан бұйым медициналық қалдықтарды А класы бойынша (СанПиН 2.1.7.2790) утилизациялауға жатады – тұрмыстық қалдықтармен бірге утилизациялауға жатады (КТР, толығырақ шолғарлы мүмкін). Утилизациялау алдында ылғал тазалау дезинфекциялау керек.

Өндіруші: «Альпина Пласт» ЖШК, Россия, 141603, Московская обл., Клин к., Ленинградское ш., стр. 8В км, к. 3А, ГСП. Тел. +7 (495) 787-93-66. dpms@alpina-plast.ru

Өндіруінің уәкілетті өкілі: Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушыларды медициналық бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды қабылдайтын және медициналық бұйымның тәжірибе көзқарасын қадағалауға жауапты ұйым: «Болтер Келлер» ЖШС, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 227/2 үй, пошта индексі 050016, телефон +7 (727) 313-24-21, bolter5@bk.ru

Ресейде жасалған
- alpina-plast.ru
- а) уақыт № РЗН 2016/7359 15.07.2020
- б) тағайындалған мерзімге дейін жарамды.
- в) өндіріс кезеңде мерзім – тұтынушы алған күннен бастап 2 жыл.
- Ұзақ кезеңде мерзім – дайындалған күннен бастап 5 жыл.

Жарамдылық мерзімі: ету мерзімі – анықталмаған.

Беларусь Республикасындағы Дистрибьютор: «Болтер Келлер» ЖШС, 220124, Минск қ., М. Лыньков көш, 123Б, кәб. 4. Тел. +375 (17) 173-63-20

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

RUS

Молокоотсос со стеклянным резервуаром.

Руководство по эксплуатации

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях стимуляции и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гипогалактия, нагрубание груди, анатомические особенности строения молочно-кровяного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков, поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отхода от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:
– не использовать молокоотсос при наличии на приемлемой поверхности резервуара механических повреждений;
– не допускать посторонних воздействий при использовании.

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 20±5 минут. Изделие погружать полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать. Для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Смять баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Руки должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль, и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Материал резервуара – стекло.

Условия хранения: изделие должно храниться в упаковочном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинские отходы – подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Производитель: ООО «Альпина Пласт».
Россия, 141630, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., пер. 8В км, к 3А, стр. 1Б/Б. Тел. +7 (495) 787-93-66. dpms@alpina-plast.ru

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/7359 от 15.07.2020
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы – не установлен.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛТЕАР Беларусь».
220124, г. Минск, ул. М. Лыньков, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 173-63-20.

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

4 607046 745559

АРТ. 2020011022

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОФИЛАКТИКА ЛАКТОСТАЗА

Молокоотсос
с пластиковым резервуаром

Малышок!

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017

Руководство по эксплуатации см. на внутренней стороне упаковки.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков, поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Материал резервуара: поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020 г. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем. Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы — не установлен.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ (ВРАЧОМ).

Изготовлено:

СДЕЛАНО В РОССИИ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Производитель:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 1035.
Тел.: +7 (495) 787-93-66
+7 (495) 181-50-42/43
www.alpina-plast.ru
malish-ok.info
info@alpina-plast.ru

Дистрибьютор в Республике Беларусь:
ООО «БОЛЕЛ» Беларусь»,
220124, г. Минск,
ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

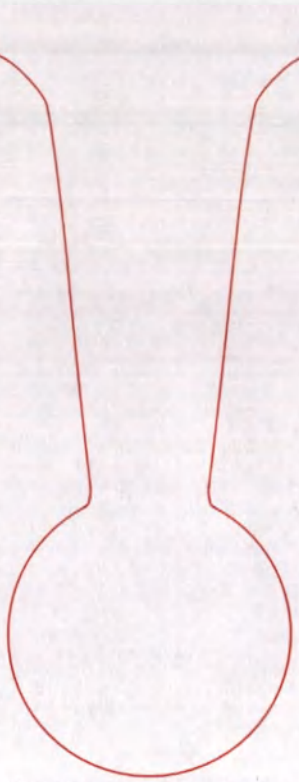

Молокоотсос с пластиковым резервуаром

Руководство по эксплуатации

(вложено на потребительскую упаковку, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно п.8 Приказ №11н Минздрава РФ от 19 января 2017 г.)

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гипоплактация, набухание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:

— не использовать молокоотсос при наличии на приёмочной поверхности резервуара механических повреждений;

— не допускать болевых ощущений при использовании.

Материал резервуара: поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Использование изделия:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ (ВРАЧОМ).

Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки, плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, а молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание нужно сразу же прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Утилизация: изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией очистить, продезинфицировать.

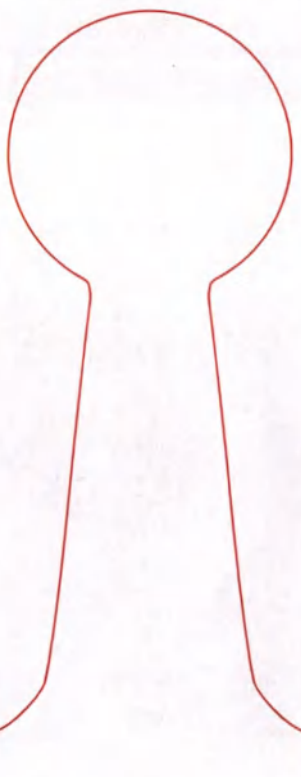

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

МалышОК!

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Производитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к.3А, стр. 1036.
Тел.: +7 (495) 787-93-66.
alpina@alpina-plast.ru

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Руководство по эксплуатации см. на внутренней стороне упаковки.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы – не устанавливен.
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕДА» Беломед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-93-20.

Арт. 2022024212

4 607046 747225

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

ИЗГОТОВЛЕНО:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

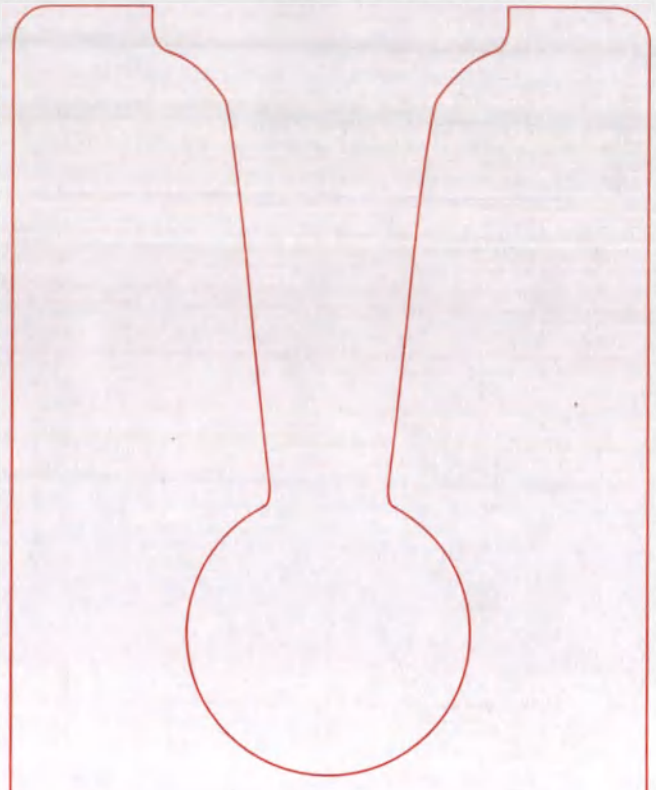

RUS **Молокоотсос с пластиковым резервуаром.**

Руководство по эксплуатации

(нанесено на потребительскую упаковку, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и также применение безопасно п.8 Приказа №911н Минздрава РФ от 19 января 2017г.)

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:

– не использовать молокоотсос при наличии на приемочной поверхности резервуара механических повреждений;

– не допускать болевых ощущений при использовании.

Материал резервуара – поликарбонат.

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов – подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

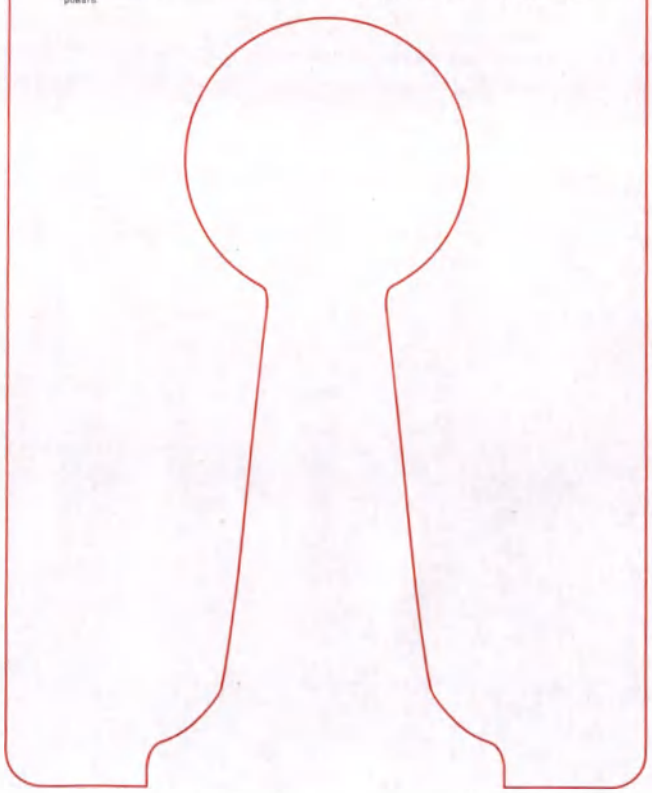

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока.

В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к.3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru.
www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы - не установлен.

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

МОЛОКООТСОС С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ.

Руководство по эксплуатации:
Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:
- не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений;
- не допускать болевых ощущений при использовании.

Материал резервуара - поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать

4 607046 748222

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Изготовлено:

PANTONE 634 C

PANTONE 311 C

CMYK

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока.

В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к.3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru.
www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ
Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы - не установлен.

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

МОЛОКООТСОС СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ.

Руководство по эксплуатации:
Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:
- не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений;
- не допускать болевых ощущений при использовании.

Материал резервуара - стекло.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Изготовлено:

PANTONE 634 C
PANTONE 311 C

CMYK

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

АЛЬПИНА ПЛАСТ

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

НАЗНАЧЕНИЕ:
ДАННЫЕ ДАТЧИКА:

KAZ **ПЛАСТИК ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРҒЫШ**

Қолмен басқарылатын сүтсорғыш ТІШ 32.50.50-031-17707123-2017

Сүтсорғыш лактацияны, сүтті сауып тастауға және лактостазды профилактикалау мақсатында босанғаннан кейінгі кезеңде әйелдерге және бала емізетін аналарға пайдалануға арналған.

Қолданылуы: гиперлактация, емшектің қатаюы, емізік-ареолы кешен құрылымының анатомиялық ерекшеліктері, лактостазды емдеу және профилактикалау; мастит; емшек ұшының жарылуы; табиғи емізуден уақытша бас тартқанда лактацияны демеу және сақтау, лактацияны стимуляциялау.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: Терінің жергілікті ауруларында, емшек ұшы қанап тұрғанда, емшектің жоғары сезімталдығында.

Жағымсыз әсерлері: жоқ.

Пайдалануға шектеулер: жоқ.

Сақтық шаралары:
- ыдыстың жазық жанасатын беткейінде механикалық зақымданулар болса, сүт сорғышты пайдалануға болмайды;
- пайдалану кезінде ауыруды сезінуге жол бермеу керек.

Бұйымды пайдалану: Қолданар алдында мәзмәнмен (дәрігермен) кеңесу керек.

Қолданар алдында баллон мен ыдысты 30±5 минут бойы дистилляцияланған суда қайнатумен дезинфекциялайды. Бұйымды толығымен суға батырып, одан кейін суды қайнату керек. Дезинфекциялық ұстау уақытын есептеу су қайнаған сәттен басталады. Сүтсорғышты жинау керек, ол үшін ыдысты баллонның тесігіне кіріктіру керек.

Сүтсорғышты қолданар алдында қолды сабынмен жуып, кеудені жылы сумен шаю керек. Баллонды сығып, емшек ұшы сүтсорғыш ыдысының ортасында болатындай етіп, қолды жазбастан сүтсорғыш ыдысын кеудеге тығыз басыңыз. Баллонды біртіндеп босатыңыз, натижесінде теріс қысым пайда болады және сүтті сауу қамтамасыз етіледі. Қол баллонды соңына дейін қысып, қимылдарды ырғақты орындауы тиіс.

Сұйықтық ыдысқа қажетті көлемге дейін түседі, содан кейін емшек сүтін жинауға және сақтауға арналған бөтелкеге немесе пакетке құйылады. Сауып болғаннан кейін кеудені сүлгімен сүртіңіз, сүтсорғышты бөлшектеп және барлық бөлшектерін жуыңыз.

Сауып тастау ауырсынуды туындатпауы керек. Егер сауып тастау кезінде ауырсыну сезілсе және ол басылмаса – онда қондырғы кеудеге дұрыс қойылмаған. Саууды дереу тоқтату және аппаратты дұрыс орнату керек.

Сүтсорғыш бөліктерін қолданғаннан кейін сабынды ерітіндіні пайдаланып ыстық сумен жуып және кептіру керек.

Сүтсорғыш жөндеуге келмейді. Сүтсорғыштың тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін утилизациялау керек.

Ыдысының материалы – поликарбонат.

Утилизация: үй жағдайында пайдалану кезінде тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан бұйым медициналық қалдықтарды А класы бойынша (СанЕпиН 2.1.7.2790) утилизациялауға жатады – тұрмыстық қалдықтармен бірге утилизациялауға жатады (ҚТҚ полигонына шығарылуы мүмкін). Утилизациялау алдында өнімді тазалау, дезинфекциялау керек.

Сақтау шарттары: Бұйым қапталған күйінде бөлмеде, +5-тен +40°С-ге дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 25°С-де 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. *Бұйым тікелей түсетін күн сәулесінің әсеріне ұшырамауы тиіс.*

Өндіруші: «Альпина Пласт» ЖШҚ, Ресей, 141603, Мәскеу обл., Клин қ., Ленинград т-лы, аум. 88 км, к. 3А, 103Б құр. Тел.: + 7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru

Өндірушінің уәкілетті өкілі: Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және медициналық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйым: «Болеар Казмед» ЖШС, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 221/2 үй, пошта индексі 050016, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolear5@bk.ru

Ресейде жасалған

www.alpina-plast.ru

Тіркеу куәлігі № РЗН 2018/7359 15.07.2020.

РФ-да сәйкестікті міндетті растауға жатпайды.

Пайдаланудың кепілді мерзімі – тұтынушы алған күннен бастап 2 жыл.

Сақтаудың кепілді мерзімі – дайындалған күннен бастап 5 жыл.

Жарамдылық/қызмет ету мерзімі – анықталмаған.

Беларусь Республикасындағы Дистрибьюторы: «Болеар Белмед» ЖШҚ, 220124, Минск қ., М. Лыньков к-сі, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

RUS **Молокоотсос с пластиковым резервуаром.**

Руководство по эксплуатации

(нанесено на потребительскую упаковку, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно п.8 Приказ №11н Минздрава РФ от 19 января 2017г.)

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:
- не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений.
- не допускать болевых ощущений при использовании.

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Материал резервуара – поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов – подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Производитель: ООО «Альпина Пласт».
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к.3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru.

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы – не установлен.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

4 607046 745542

АРТ. 2020021022

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

KAZ **ШЫНЫ ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРҒЫШ**

Қолмен басқарылатын сүтсорғыш ТШ 32.50.50-031-17707123-2017

Сүтсорғыш лактацияны, сүтті сауып тастауға және лактостазды профилактикалау мақсатында босанғаннан кейінгі кезеңде әйелдерге және бала емізетін аналарға пайдалануға арналған.

Қолданылуы: гипералактация, емшектің қатаюы, емізік-ареолы кешен құрылымының анатомиялық ерекшеліктері, лактостазды емдеу және профилактикалау; мастит; емшек ұшының жарылуы; табиғи емізуден уақытша бас тартқанда лактацияны демеу және сақтау; лактацияны стимуляциялау.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: терінің жергілікті ауруларында; емшек ұшы қанап тұрғанда; емшектің жоғары сезімталдығында.

Жағымсыз әсерлері: жоқ.

Пайдалануға шектеулер: жоқ.

Сақтық шаралары:
- ыдыстың жазық жанасатын беткейінде механикалық зақымданулар болса, сүт сорғышты пайдалануға болмайды;
- пайдалану кезінде ауыруды сезінуге жол бермеу керек.

Бұйымды пайдалану: қолданар алдында маманмен (дәрігермен) кеңесу керек.

Қолданар алдында баллон мен ыдысты 30±5 минут бойы дистилляцияланған суда қайнатумен дезинфекциялайды. Бұйымды толығымен суға батырып, одан кейін суды қайнату керек. Дезинфекциялық ұстау уақытын есептеу су қайнаған сәттен бастайды. Сүтсорғышты жинау керек, ол үшін ыдысты баллонның тесігіне кіріктіру керек. Сүтсорғышты қолданар алдында қолды сабынмен жуып, кеудені жылы сумен шаю керек. Баллонды сығып, емшек ұшы сүтсорғыш ыдысының ортасында болатындай етіп, қолды жазбастан сүтсорғыш ыдысын кеудеге тығыз басыңыз. Баллонды біртіндеп босатыңыз, нәтижесінде теріс қысым пайда болады және сүтті сауу қамтамасыз етіледі. Қол баллонды соңына дейін қысып, қимылдарды ырғақты орындауы тиіс.

Сұйықтық ыдысқа қажетті көлемге дейін түседі, содан кейін емшек сүтін жинауға және сақтауға арналған бөтелкеге немесе пакетке құйылады. Сауып болғаннан кейін кеудені сүлгімен сүртіңіз, сүтсорғышты бөлшектеп және барлық бөлшектерін жуыңыз.

Сауып тастау ауырсынуды тудыратынын керек. Егер сауып тастау кезінде ауырсыну сезілсе және ол басылмаса – онда қондырғы кеудеге дұрыс қойылмаған. Саууды дереу тоқтату және аппаратты дұрыс орнату керек.

Сүтсорғыш бөліктерін қолданғаннан кейін сабынды ертіндіні пайдаланып ыстық сумен жуып және кептіру керек.

Сүтсорғыш жөндеуге келмейді. Сүтсорғыштың тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін утилизациялау керек.

Ыдысының материалы – шыны.

Сақтау шарттары: Бұйым қапталған күйінде бөлмеде, +5-тен +40°С-ге дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 25°С-де 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. *Бұйым тікелей түсетін күн сәулесінің әсеріне ұшырамауы тиіс.*

Утилизация: үй жағдайында пайдалану кезінде тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан бұйым медициналық қалдықтарды А класы бойынша (СанЕмН 2.1.7.2790) утилизациялауға жатады – тұрмыстық қалдықтармен бірге утилизациялауға жатады (ҚТК полигоніна шығарылуы мүмкін). Утилизациялау алдында өнімді тазалау, дезинфекциялау керек.

Өндіруші: «Альпина Пласт» ЖШҚ, Ресей, 141603, Мәскеу обл., Клин қ., Ленинград т-лы, аум. 88 км, к. 3А, 103Б құр. Тел.: + 7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru

Өндірушінің уәкілетті өкілі: Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және медициналық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйым: «Болеар Казмед» ЖШС, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 221/2 үй, пошта индексі 050016, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolear5@bk.ru

Ресейде жасалған

www.alpina-plast.ru

Тіркеу куәлігі № РЗН 2018/7359 15.07.2020.

РФ-да сәйкестікті міндетті растауға жатпайды.

Пайдаланудың кепілді мерзімі – тұтынушы алған күннен бастап 2 жыл.

Сақтаудың кепілді мерзімі – дайындалған күннен бастап 5 жыл.

Жарамдылық/қызмет ету мерзімі – анықталмаған.

Беларусь Республикасындағы Дистрибьюторы: «Болеар Белмед» ЖШҚ, 220124, Минск қ., М. Лыньков к-сі, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

RUS **Молокоотсос со стеклянным резервуаром.**

Руководство по эксплуатации

(нанесено на потребительскую упаковку, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и также применение безопасно п.8 Приказ №911н Минздрава РФ от 19 января 2017г.)

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гипералактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения соскового-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:
- не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений;
- не допускать болевых ощущений при использовании.

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Материал резервуара – стекло.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов – подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Производитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к.3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы – не установлен.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

МОЛОКООТСОС
СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

4 607046 745559

АРТ. 2020011022

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

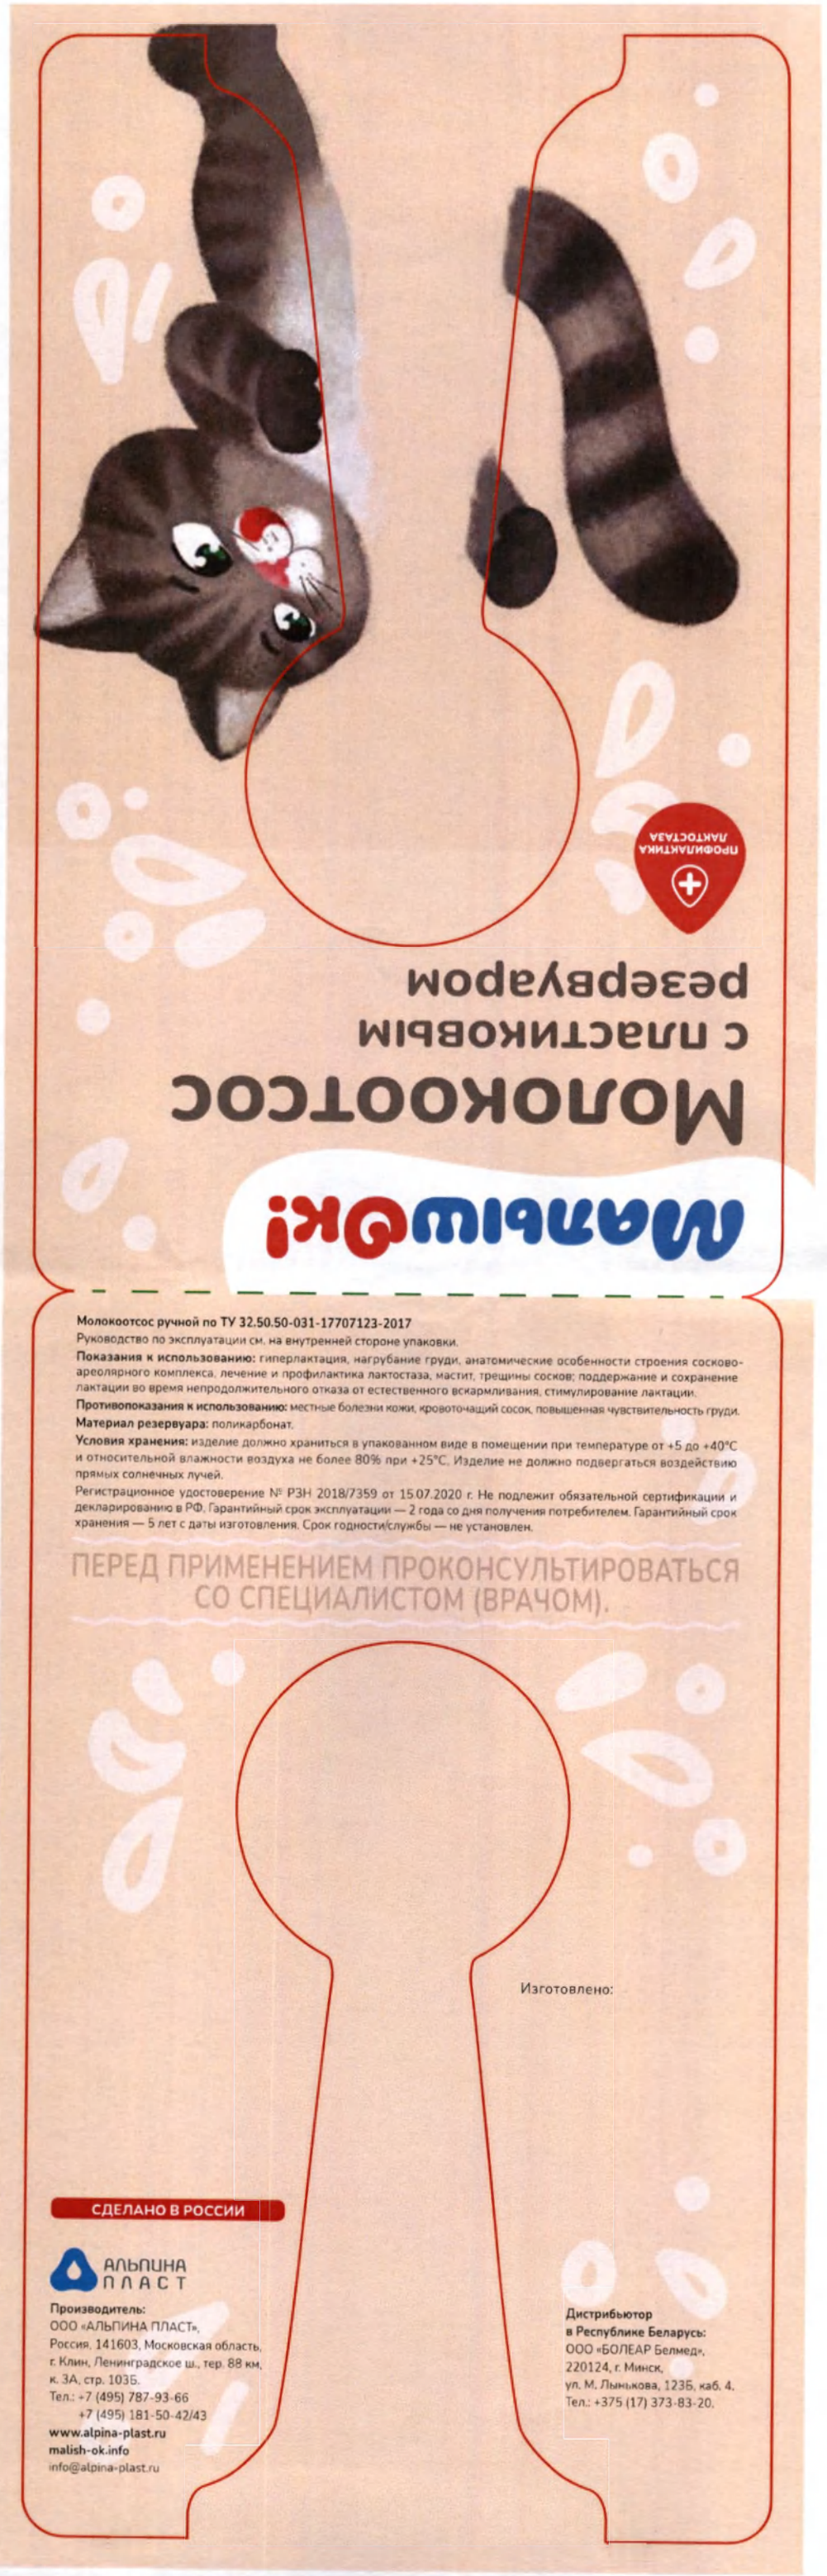

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017

Руководство по эксплуатации см. на внутренней стороне упаковки.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Материал резервуара: поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020 г. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем. Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы — не установлен.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ (ВРАЧОМ).

СДЕЛАНО В РОССИИ

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Производитель:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км,
к. 3А, стр. 1035.
Тел.: +7 (495) 787-93-66
+7 (495) 181-50-42/43
www.alpina-plast.ru
malish-ok.info
info@alpina-plast.ru

Изготовлено:

Дистрибьютор
в Республике Беларусь:
ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск,
ул. М. Лыньковa, 123Б, каб. 4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

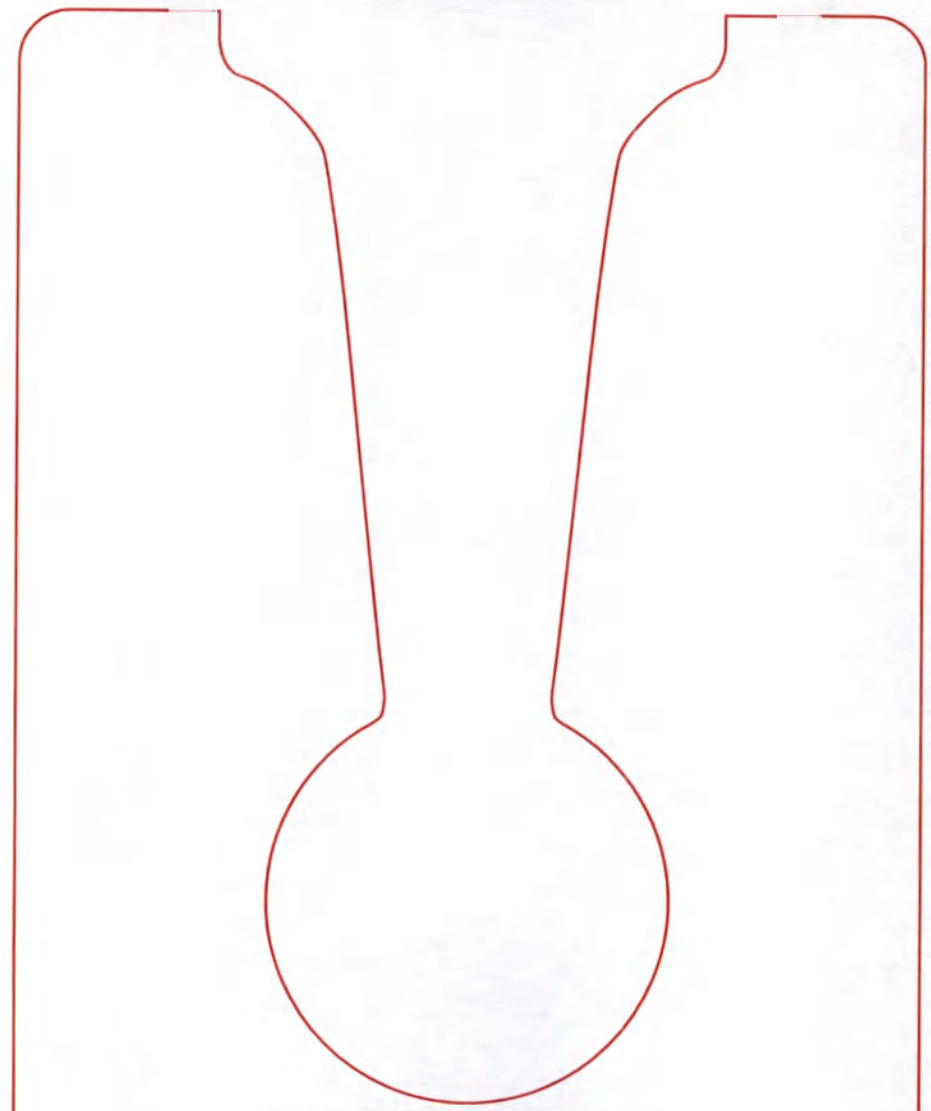

Молокоотсос с пластиковым резервуаром

Руководство по эксплуатации

(нанесено на потребительскую упаковку, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно п.8 Приказ №11н Минздрава РФ от 19 января 2017 г.)

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания, стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:

— не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений

— не допускать болевых ощущений при использовании.

Материал резервуара: поликарбонат.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Использование изделия:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ (ВРАЧОМ).

Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки, плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, а молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит – скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание нужно сразу же прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Утилизация: изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией очистить, продезинфицировать.

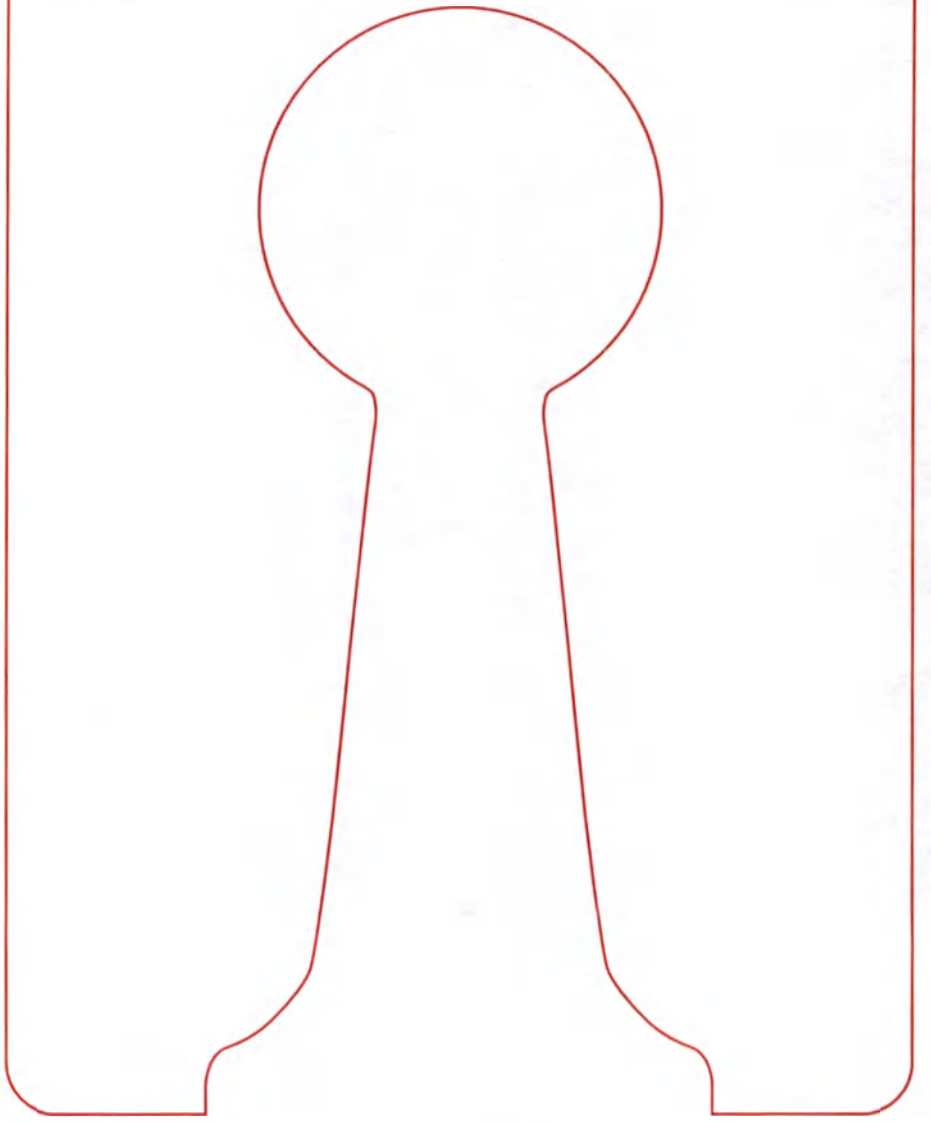

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

MalyshOK!

АЛЬПИНА ПЛАСТ

Производитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к.3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66.
alpina@alpina-plast.ru

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.
Руководство по эксплуатации см. на внутренней стороне упаковки.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Арт. 2022024212

4 607046 747225

ИЗГОТОВЛЕНО:

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

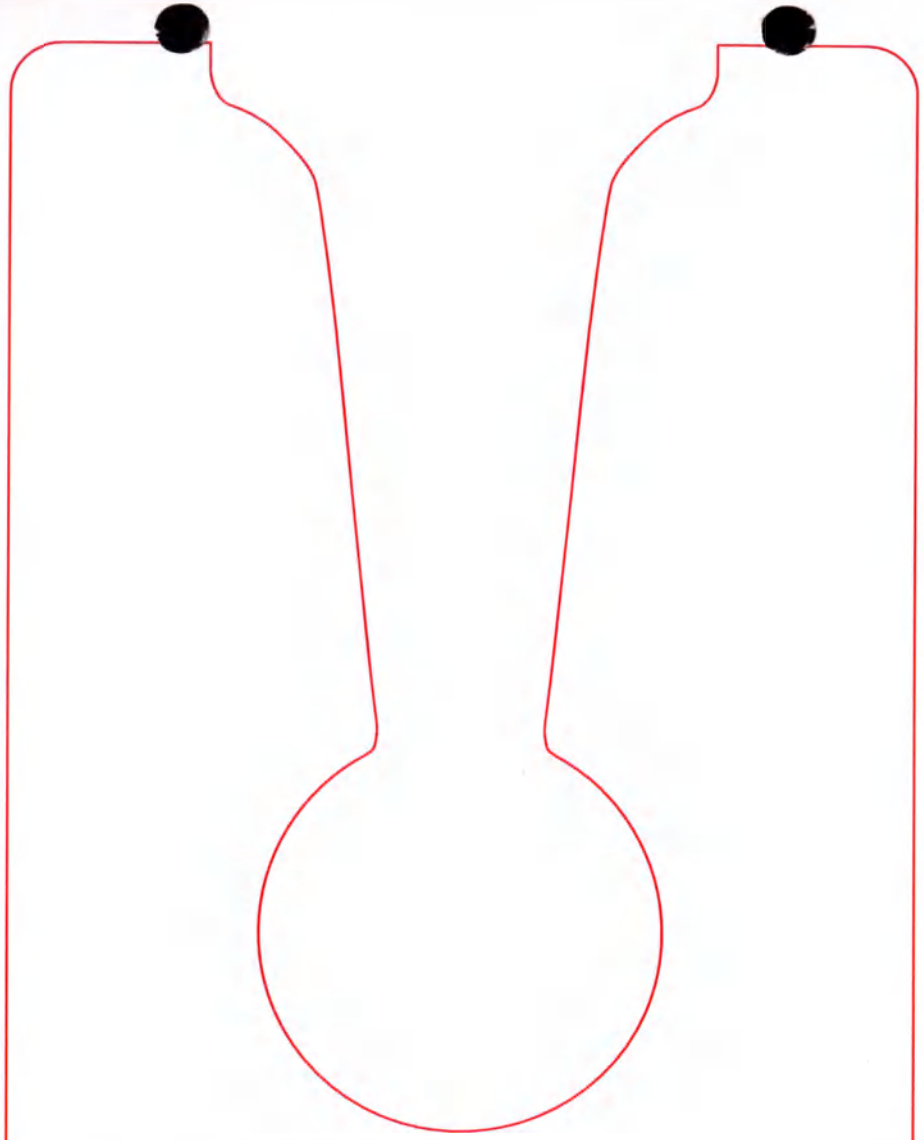

RUS **Молокоотсос с пластиковым резервуаром.**

Руководство по эксплуатации

(нанесено на потребительскую упаковку, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно п.8 Приказ №11н Минздрава РФ от 19 января 2017г.)

Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование лактации.

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности:

– не использовать молокоотсос при наличии на приваточной поверхности резервуара механических повреждений;
– не допускать болевых ощущений при использовании.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов — подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

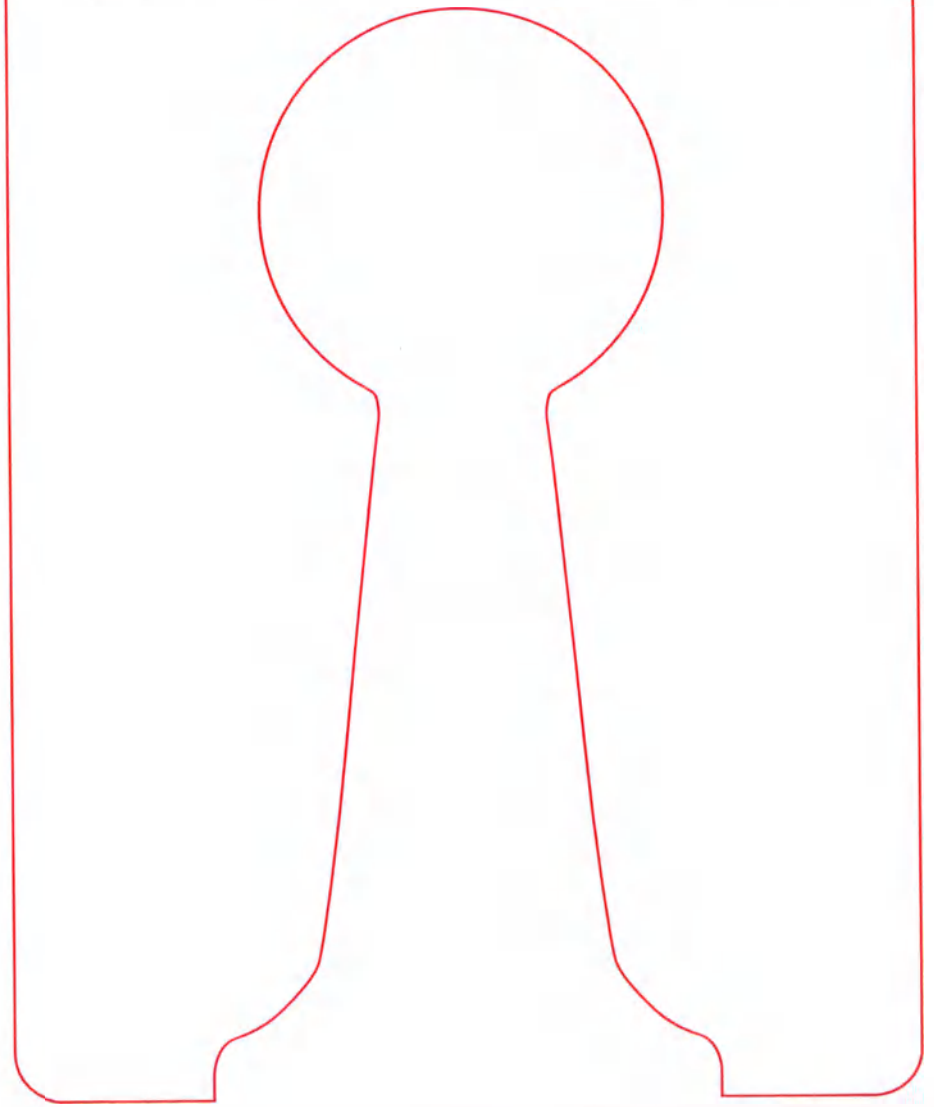

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(семнадцать) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е.Н. Игутов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU