АЛЬПИНА ПЛАСТ

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
_____ Е.Н. Игутов
«15» марта 2018 г.
М.П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
17707123-32.50.50-026РЭ

Банки медицинские вакуумные по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018

2018 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Содержание

1	Описание и работа.....	3
1.1	Назначение изделия.....	3
1.2	Технические характеристики.....	3
1.3	Состав изделия.....	18
1.4	Устройство и работа.....	28
1.5	Маркировка.....	28
1.6	Упаковка.....	29
2	Показания к применению.....	29
3	Противопоказания к применению	30
4	Использование по назначению.....	30
4.1	Эксплуатационные ограничения.....	30
4.2	Использование изделия	30
4.3	Техническое обслуживание (уход за изделием).....	31
5	Хранение.....	31
5.1	Условия хранения.....	31
5.2	Гарантийные обязательства	32
6	Транспортирование.....	32
7	Утилизация.....	32
8	Контактные данные производителя.....	32
9	Перечень применяемых производителем стандартов	33
	Приложение 1.	34
	Приложение 2. Лист регистрации изменений	46

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Настоящая эксплуатационная документация устанавливает эксплуатационные характеристики на «Банки медицинские вакуумные по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018», варианты исполнения:

- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;
- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;
- Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм,2шт;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.;
- СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Банки медицинские вакуумные (далее банки) предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж: антицеллюлитный, косметический, лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Сфера применения: для индивидуального и профессионального использования (в медицинских учреждениях и в домашних условиях).

Функциональное назначение: лечение и профилактика.

Область медицинского применения – физиотерапия.

Потенциальный потребитель –медицинский персонал или лица не имеющие медицинского образования.

Банки вакуумные относятся к медицинским изделиям многоразового использования и выпускаются в нестерильными.

Согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034 код ОКПД 2 32.50.50.000.

Согласно Приказу Минздрава России № 4н банки по степени потенциального риска применения в медицинской практике имеет класс 1, вид медицинского изделия № 188080. По виду контакта с организмом человека, банки вакуумные относятся к группе А.3.10 «Изделия, кратковременно контактирующие с кожей (неповрежденной)».

Область медицинского применения: физиотерапия.

Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

1.2 Технические характеристики

Основные параметры и характеристики банок вакуумных представлены в таблице № 1, на рисунках: 1-13.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 1.

№ п.п.	Наименование изделия	Наименование параметра	Значение параметра
1	Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия))	высота изделия, мм	H = 92±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 11±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,5
		масса изделия, г	m= 37±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
2	Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия))	высота изделия, мм	H = 89±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 22±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,5
		масса изделия, г	m= 40±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
3	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия))	высота изделия, мм	H = 85±5;
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 33±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 43±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
4	Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	«Медлабстекло» (Россия)	диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 42±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 47±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
5	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3, компанией ООО «Медлабстекло» (Россия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 50±3
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 54±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
6	Банка вакуумная Ø50 мм (пластиковый резервуар производства ООО «Альпина Пласт» (Россия))	высота изделия, мм	H = 100±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 50±3
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 49±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
7	Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 11±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,5
		масса изделия, г	m= 37±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
8	Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия))	толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 22±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 40±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
9	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 33±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,5
		масса изделия, г	m= 43±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
10	Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор») (Россия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 42±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 47±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
11	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 50±3
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 54±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
12	Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар изготовлен: из	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))	вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 11±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,5
		масса изделия, г	m= 37±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
13	Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 22±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 40±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
14	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 33±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,5
		масса изделия, г	m= 43±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
15	Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 42±2
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 47±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
16	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар	высота изделия, мм	H = 91±5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 50±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))	высота баллона, мм	H_1 = 56±3
		вместимость баллона, мл	V= 42±5
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 3±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 50±3
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 12±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 1,2±0,25
		масса изделия, г	m= 54±5
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
17	Банка вакуумная Ø70 мм (резервуар с соединением «оливой» изготовлен из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия)	высота изделия, мм	H = 145±7,5
		диаметр баллона, мм	D_1 = 60±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 80±4
		вместимость баллона, мл	V= 84±10
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 4±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 70±4
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 14±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 3±0,5
		масса изделия, г	m= 125±25
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н
18	Банка вакуумная Ø70 мм (резервуар с соединением «гребенкой» изготовлен из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия)	высота изделия, мм	H = 145±7,5;
		диаметр баллона, мм	D_1 = 60±3
		внутренний диаметр горловины баллона, мм	d_1 = 7±0,4
		высота баллона, мм	H_1 = 80±4
		вместимость баллона, мл	V= 84±10
		толщина стенки баллона, мм	S_1= 4±1
		диаметр резервуара (привалочной части), мм	D_2 = 70±4
		наружный диаметр горловины резервуара, мм	d_2 = 10±1
		толщина стенки резервуара, мм	S_2 = 3±0,5
		масса изделия, г	m= 125±25
		прочность соединения баллон-резервуар (усилие разъединения), Н (кН)	35-50 Н
		минимальное усилие нажатия на баллон, Н (кН)	18Н

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид банок медицинских с конструктивными элементами представлен на рисунках №№ 1 - 17.

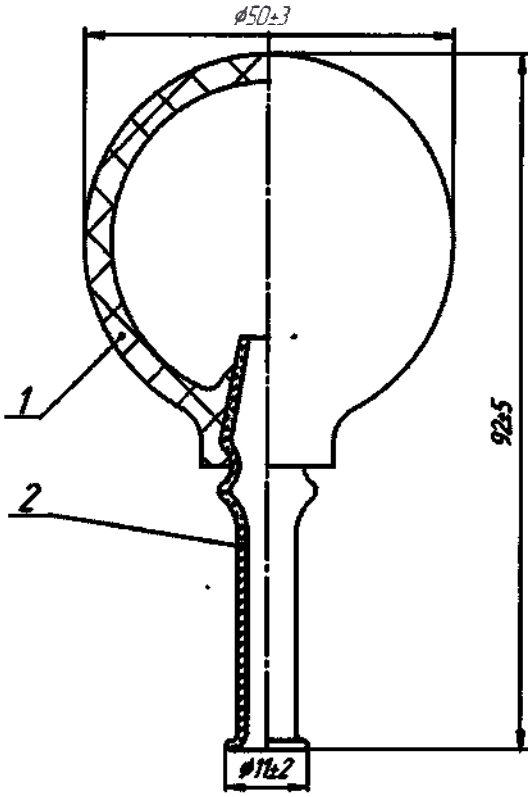

Рисунок 1

Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия)). 1 – баллон, 2 – резервуар.

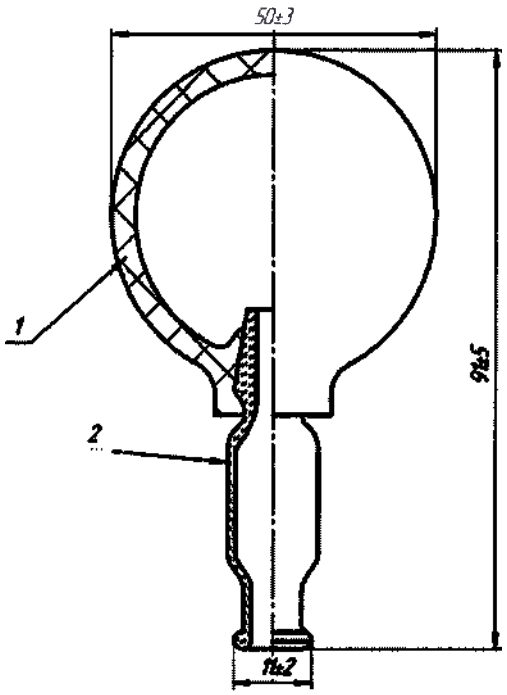

Рисунок 2

Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия)). 1 – баллон, 2 – резервуар.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

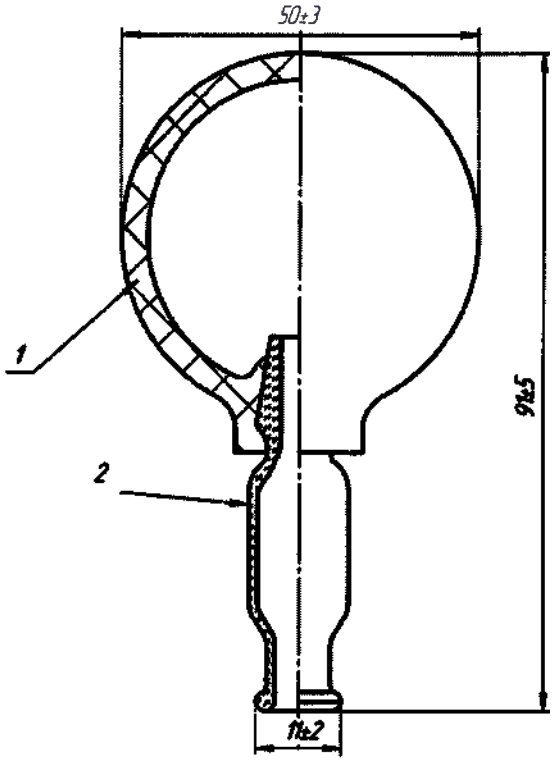

Рисунок 3

Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия)).
1 – баллон, 2 – резервуар.

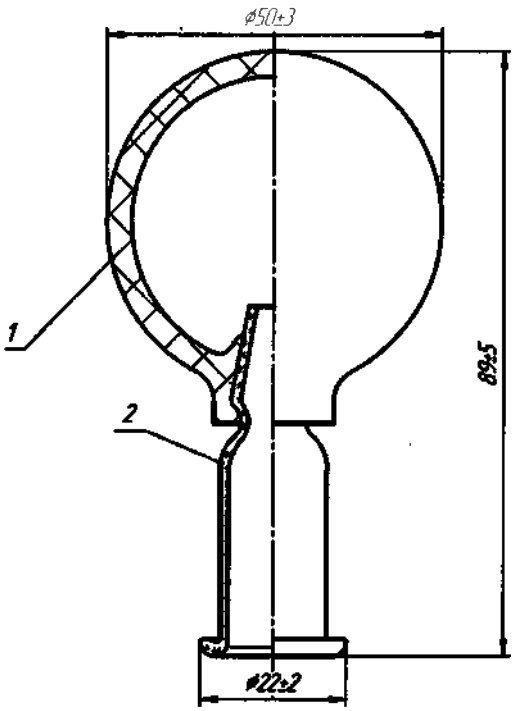

Рисунок 4

Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия)). 1 – баллон, 2 – резервуар

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

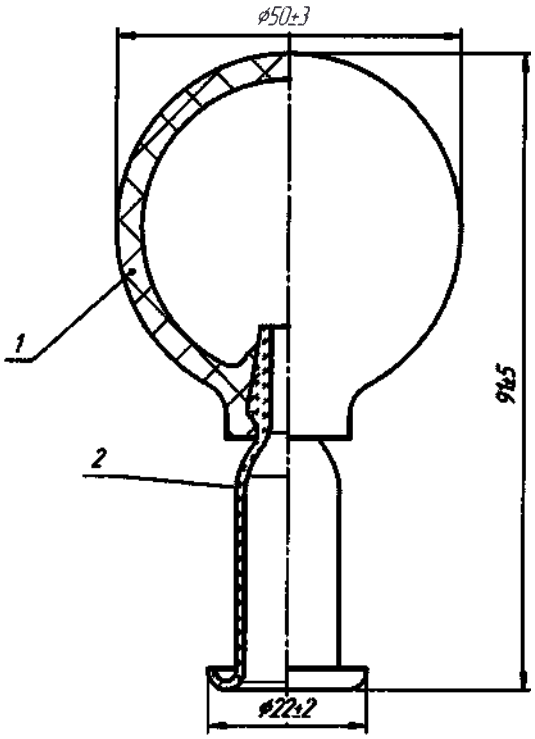

Рисунок 5

Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия)

1 – баллон, 2 – резервуар

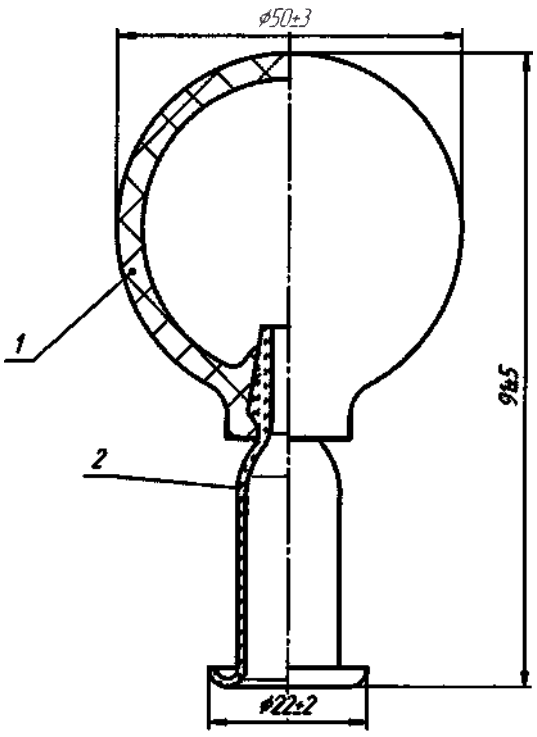

Рисунок 6

Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))

1 – баллон, 2 – резервуар

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

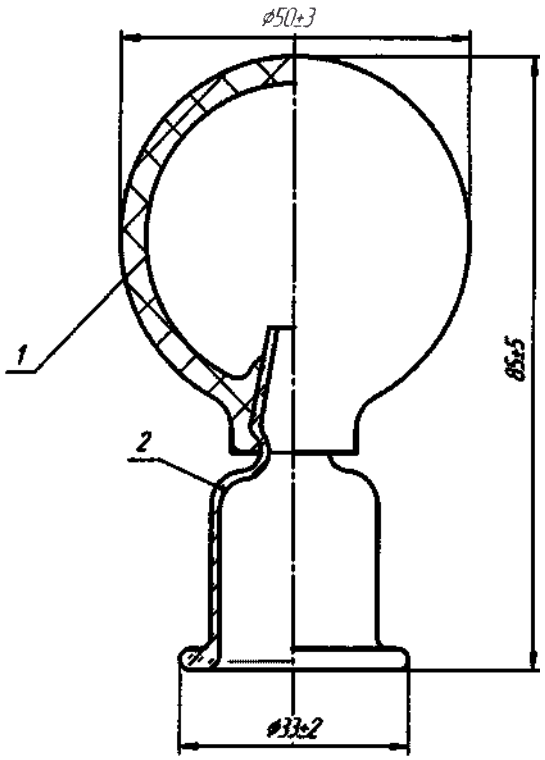

Рисунок 7

Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия)). 1 – баллон, 2 – резервуар

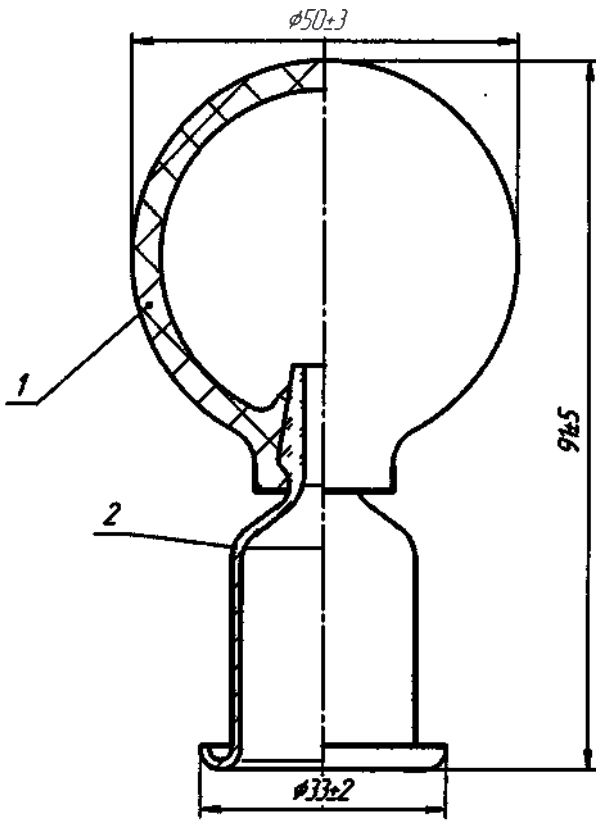

Рисунок 8

Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия)).

1 – баллон, 2 – резервуар.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

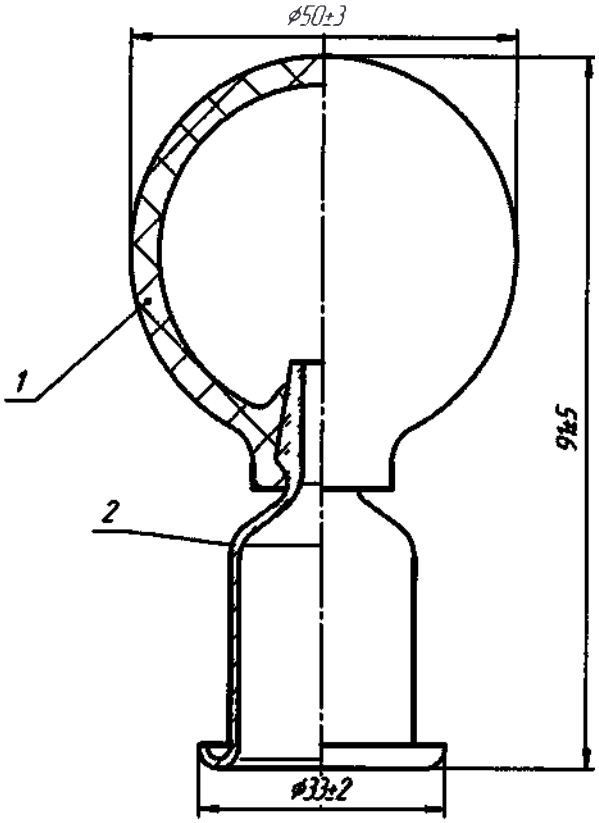

Рисунок 8

Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия)).
1 – баллон, 2 – резервуар.

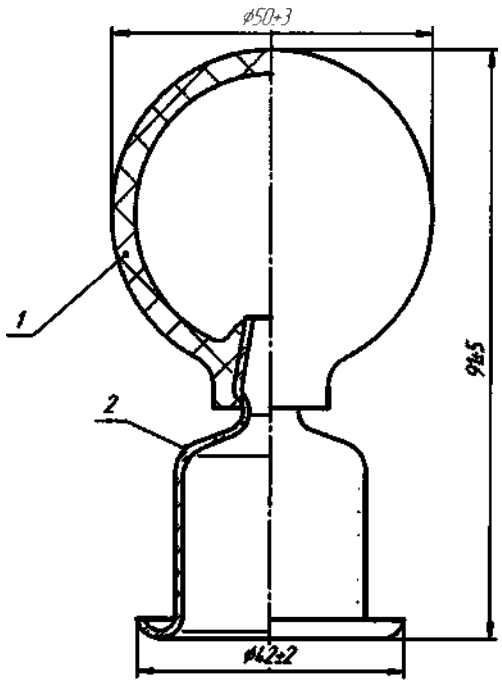

Рисунок 9

Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия)). 1 – баллон, 2 – резервуар.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

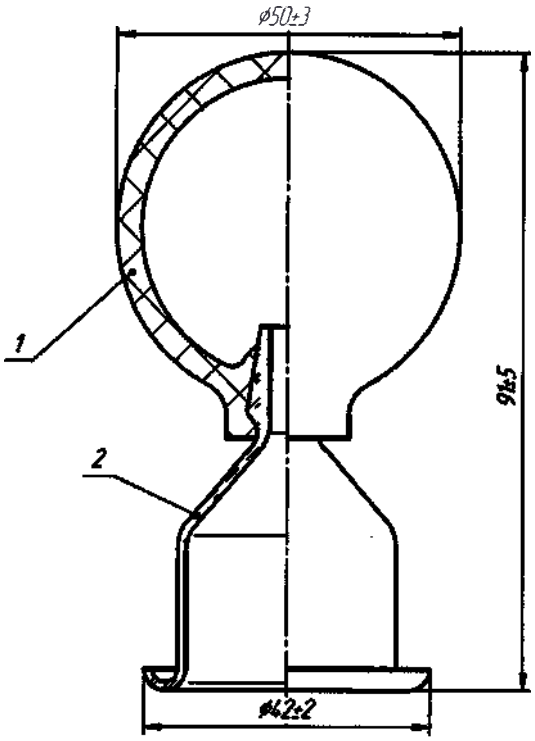

Рисунок 10

Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия)).

1 – баллон, 2 – резервуар.

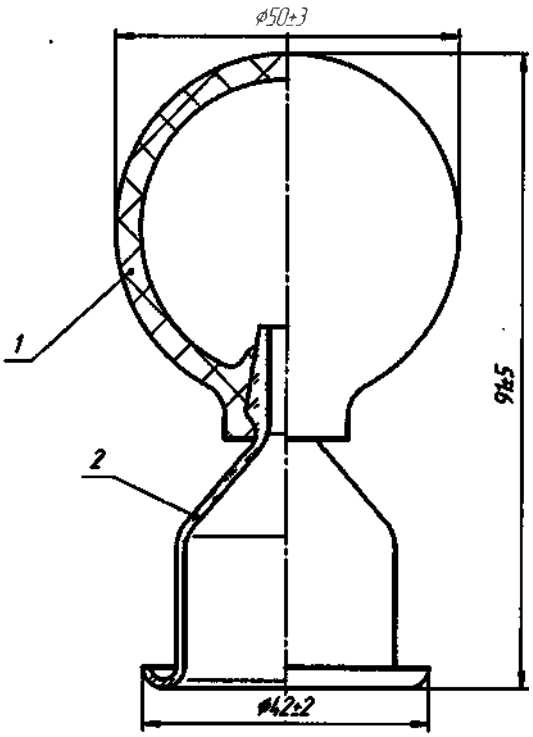

Рисунок 11

Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия)).

1 – баллон, 2 – резервуар.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

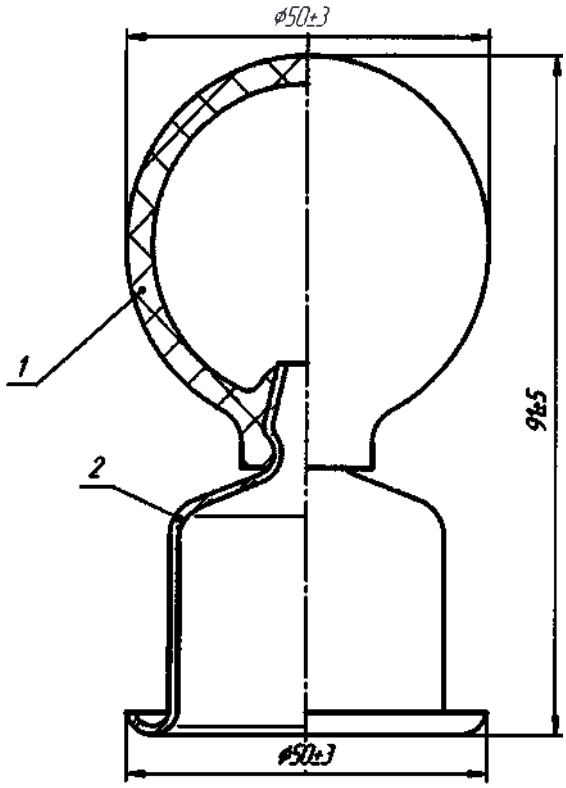

Рисунок 12

Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия)). 1 – баллон, 2 – резервуар.

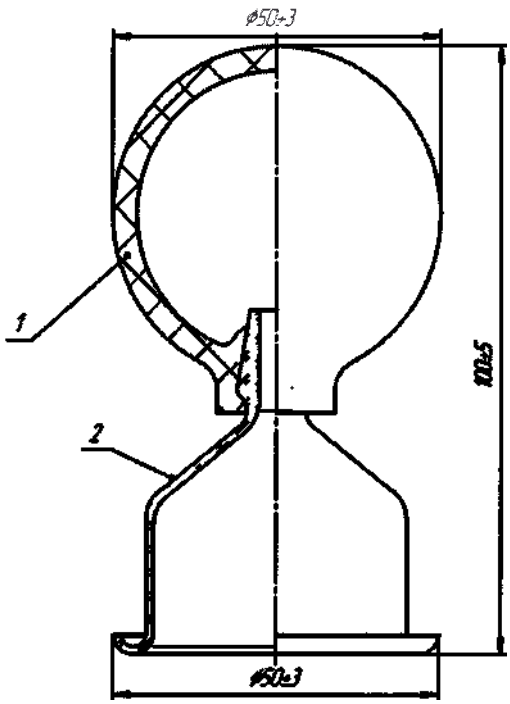

Рисунок 13

Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар изготовлен: из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия))

1 – баллон, 2 – резервуар

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

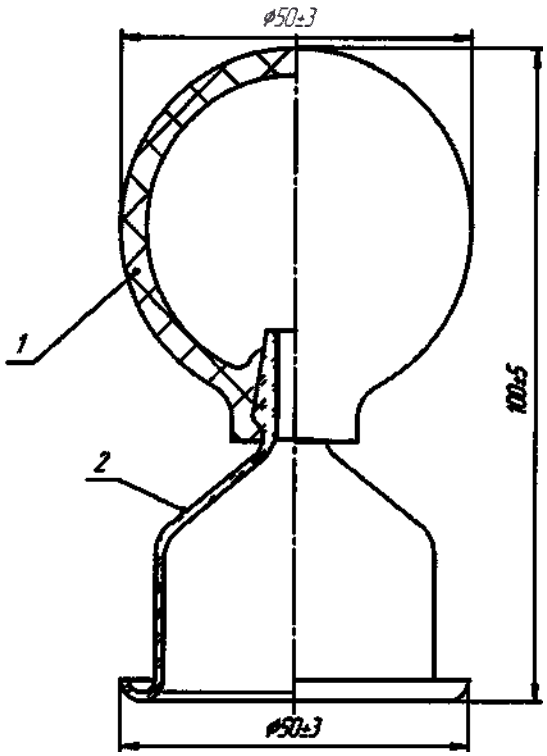

Рисунок 14

Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар изготовлен: из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))

1 – баллон, 2 – резервуар

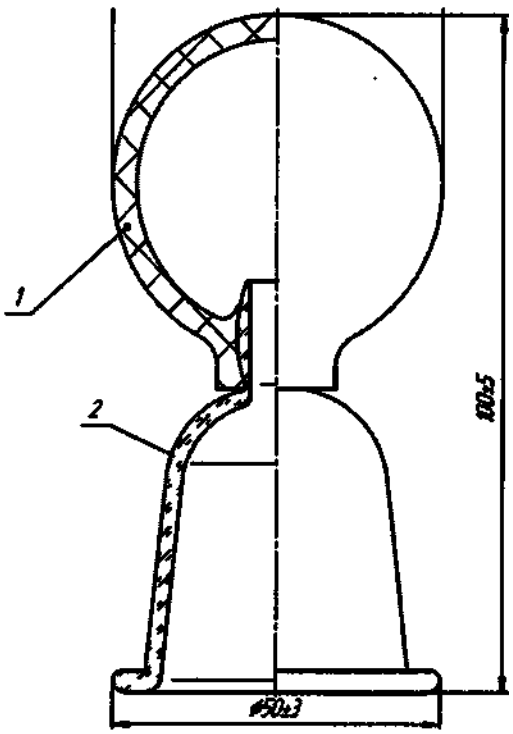

Рисунок 15

Банка вакуумная Ø50 мм

(пластиковый резервуар производства ООО «Альпина Пласт» (Россия))

1 – баллон, 2 – резервуар

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

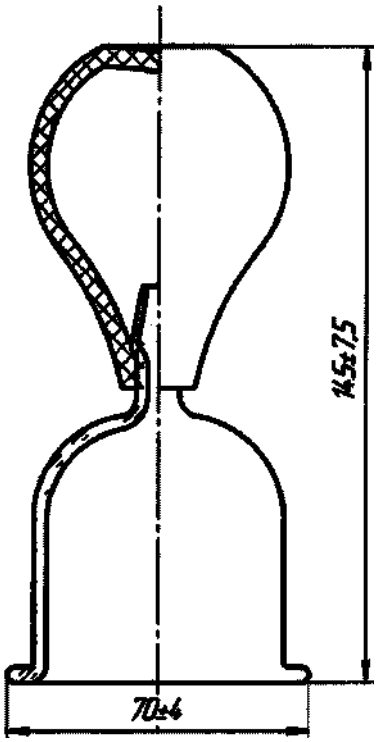

Рисунок 16

Банка вакуумная Ø70 мм (резервуар с соединением «оливой» изготовлен из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия)

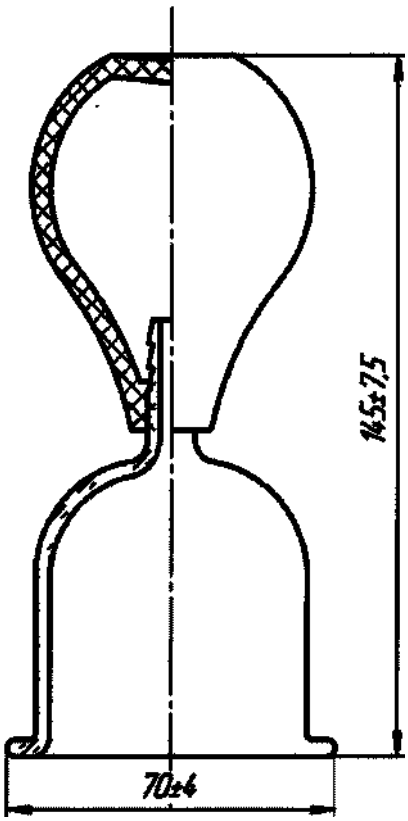

Рисунок 17

Банка вакуумная Ø70 мм (резервуар с соединением «гребенкой» изготовлен из боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3, компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.3 Состав изделия

Состав банки: 1 – баллон, 2 – резервуар (рис. 1-2).

Материалы - применяемые для изготовления банок медицинских соответствуют требованиям ТУ 32.50.50-026-17707123-2018 (представлены в таблице 2).

Таблица № 2

Исполнение	Цвет баллона	Материалы изготовления
Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм , 8шт	Голубой	1. Баллоны изготовлены из *пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по* ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из *стекла марки НС-3* компанией ООО «Медлабстекло» Россия, по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018; или из *стекла марки Simax* компанией ПАО «Химлаборприбор» Россия, по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКВЫЕ, Ø50 мм , 8шт	Голубой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия) из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).
Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.	Голубой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.	**Голубой**	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Золотой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К 12135 желтая серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-розовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К-Rhodamine Red»; «К10100 Белая»; «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-фиолетовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; - «PO.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый», производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из из *боросиликатного*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		стекла, DURAN типа 3.3 компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
Баки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.	Голубой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия) из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).
Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм	Голубой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуар изготовлен из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-фиолетовый	1. Баллон изготовлен из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; - «PO.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый», производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05; 2. Резервуар изготовлен из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	Голубой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	Серебристо-фиолетовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; - «РО.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый», производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05; 2. Резервуары изготовлены из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22мм, Ø33 мм, 2 шт.	**Голубой**	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» Россия, по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» Россия, по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ Ø11 мм,Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.	Голубой	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-розовый (Ø 11мм, Ø 33 мм) Серебристо-фиолетовый (Ø 22 мм, Ø 50 мм)	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: • розовый серебристый: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «K-Rhodamine Red»; «К10100 Белая»; «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; • фиолетовый серебристый: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия по ТУ 2354-001-

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		18365892-2002 ; - «РО.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый» производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-розовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К-Rhodamine Red»; «К10100 Белая»; «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-фиолетовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; - «РО.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый» производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05 ; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Ø11, Ø22, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.	**Голубой**	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-розовый (Ø 11мм, Ø 33 мм) Серебристо-фиолетовый (Ø 22 мм, Ø 42 мм) Золотой (Ø 50 мм)	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: • розовый серебристый: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «K-Rhodamine Red»; «К10100 Белая»; «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; • фиолетовый серебристый: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; - «РО.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый» производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05; • золотой: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марка: «К 12135 Желтая серебристая колеровочна паста») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
	Серебристо-розовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «K-Rhodamine Red»; «К10100 Белая»; «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		(Германия).
	Серебристо-фиолетовый	1. Баллоны изготовлены из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К12130 серебристая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; - «РО.N.612, Паста колер. "ПалИж" ПОЛИМЕР "О", фиолетовый» производства ООО «Новый Дом», Россия, по ТУ 2463-010-49630959-05; 2. Резервуары изготовлены из стекла марки НС-3 компанией ООО «Медлабстекло» (Россия), по ТУ 23.19.26-016-04-18213009-2018 или из стекла марки Simax компанией ПАО «Химлаборприбор» (Россия), по ТУ 302-01-2014, или из *боросиликатного стекла, DURAN типа 3.3* компанией GmbH Glasbläserei Schneider (Германия).
СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм	**Голубой**	1. Баллон изготовлен из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера - «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10600 Голубая», «К10650 Ультрамариновая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия) из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).
	Розовый	1. Баллон изготовлен из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера: «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К-Rhodamine Red»; «К10100 Белая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия), из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).
	Красный	1. Баллон изготовлен из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров: «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10400 Красная»; «К10100 Белая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия), из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).
	Фиолетовый	1. Баллон изготовлен из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колеров:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		«Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К Purple Пурпурный»; «К10100 Белая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия), из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).
	Желтый	1. Баллон изготовлен из пластизоля поливинилхлоридного «Альпина Пласт» по ТУ 2241-015-17707123-2012 производства ООО «Альпина Пласт» (Россия), марка рецептуры – ПМ23 (бесцветный) с использованием колера: «Высококонцентрированная пигментная паста на основе фталатных (ДОФ, ДИНФ) и безфталатных (ДОА, мезамол и т.д.) пластификаторов (Марки: «К10820 Лимонная»; «К10100 Белая») производства ООО «Спика Технология», Россия, по ТУ 2354-001-18365892-2002; 2. Резервуары изготовлены компанией ООО «Альпина Пласт» (Россия), из поликарбоната марки LEXAN™ 124R-111-BAG-01-01-00 производства компании SABIC INNOVATIVE PLASTICS B.V. (Испания).

Комплектность изделий представлена в таблице № 3.

Таблица № 3.

Комплектность изделий

№ п/п	Наименование изделия	Кол. шт.	Номер технической документации
1	**Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8шт**		
1.1	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: стекло)	8	17707123-32.50.50-026-005И1 или 17707123-32.50.50-026-005И2 или 17707123-32.50.50-026-005И3
1.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
1.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
2	**Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8 шт.**		
2.1	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: поликарбонат)	8	17707123-32.50.50-026-006И
2.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
2.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
3	**Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2 шт.**		
3.1	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар: стекло)	2	17707123-32.50.50-026-003И1 или 17707123-32.50.50-026-003И2 или 17707123-32.50.50-026-003И3
3.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
3.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
4	**Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.**		
4.1	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: стекло)	2	17707123-32.50.50-026-005И1 или 17707123-32.50.50-026-005И2 или 17707123-32.50.50-026-005И3
4.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
4.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5	**Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.**		
5.1	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: поликарбонат)	2	17707123-32.50.50-026-006И
5.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
5.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
6	**Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм**		
6.1	Банка вакуумная Ø70 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-007И1 или 17707123-32.50.50-026-007И2
6.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
6.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
7	**Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм, 2шт.**		
7.1	Банка вакуумная Ø70 мм (резервуар: стекло)	2	17707123-32.50.50-026-007И1 или 17707123-32.50.50-026-007И2
7.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
7.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
8	**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.**		
8.1	Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-002И1 или 17707123-32.50.50-026-002И2 или 17707123-32.50.50-026-002И3
8.2	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-003И1 или 17707123-32.50.50-026-003И2 или 17707123-32.50.50-026-003И3
8.3	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
8.4	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
9	**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø50 мм, Ø33 мм, Ø22 мм, Ø11 мм, 4 шт.**		
9.1	Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-001И1 или 17707123-32.50.50-026-001И2 или 17707123-32.50.50-026-001И3
9.2	Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-002И1 или 17707123-32.50.50-026-002И2 или 17707123-32.50.50-026-002И3
9.3	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-003И1 или 17707123-32.50.50-026-003И2 или 17707123-32.50.50-026-003И3
9.4	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-005И1 или 17707123-32.50.50-026-005И2 или 17707123-32.50.50-026-005И3
9.5	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
9.6	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
10	**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø50 мм, Ø42 мм, Ø33 мм, Ø22 мм, Ø11 мм, 5 шт.**		
10.1	Банка вакуумная Ø11 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-001И1 или 17707123-32.50.50-026-001И2 или 17707123-32.50.50-026-001И3
10.2	Банка вакуумная Ø22 мм (резервуар:	1	17707123-32.50.50-026-002И1 или

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	стекло)		17707123-32.50.50-026-002И2 или 17707123-32.50.50-026-002И3
10.3	Банка вакуумная Ø33 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-003И1 или 17707123-32.50.50-026-003И2 или 17707123-32.50.50-026-003И3
10.4	Банка вакуумная Ø42 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-004И1 или 17707123-32.50.50-026-004И2 или 17707123-32.50.50-026-004И3
10.5	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: стекло)	1	17707123-32.50.50-026-005И1 или 17707123-32.50.50-026-005И2 или 17707123-32.50.50-026-005И2
10.6	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
10.7	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У
11	**СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм**		
11.1	Банка вакуумная Ø50 мм (резервуар: поликарбонат)	1	17707123-32.50.50-026-006И
11.2	Руководство по эксплуатации*	1	17707123-32.50.50-026РЭ
11.3	Потребительская упаковка	1	17707123-32.50.50-026У

Примечание:

1. Руководство по эксплуатации может быть нанесено на потребительскую упаковку, вложено внутрь упаковки (на листе-вкладыше).
2. * в части информации, необходимой для доведения до потребителя (объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно п.8 Приказ № 11н Минздрава РФ от 19 января 2017г.).
3. Цвет баллона в соответствии с таблицей 2.

1.4 Устройство и работа

Банки вакуумные представляют собой изделия, состоящие из баллона для создания вакуума и резервуара, который непосредственно соприкасается с местом всасывания.

В результате создания отрицательного давления вакуумной частью (баллоном) обеспечивается присасывание резервуара банки к поверхности кожи. Создание вакуума происходит за счет механической работы (сжимания рукой) баллона.

Баночный массаж (кинетическая вакуум-терапия) - процедура, предполагающая воздействие на тело с помощью создаваемого пониженного давления (вакуума), вследствие чего происходит ускорение обменных процессов в организме, повышается тонус и эластичность мышц; улучшение работы кровеносной системы; снижение болевого синдрома при мышечном напряжении, повышается сопротивляемость организма.

1.5 Маркировка

1.5.1 На баллоне изделия способом гравировки в форме, при необходимости, может быть указан тип или номер баллона.

На потребительской упаковке или на вкладыше в потребительскую упаковку типографским методом или на самоклеящемся стикере печатной краской должна быть указана следующая информация:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя и его место нахождения (юридический адрес);
- наименование и/или обозначение изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения;
- дата изготовления (месяц, год или число, месяц, год);
- код партии, с предшествующем словом «LOT» или номер серии (при необходимости);
- штрих-код (при необходимости);
- артикул (при необходимости);
- гарантийный срок эксплуатации;
- гарантийный срок хранения;
- материал резервуара;
- сведения о назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, эксплуатационных ограничениях;
- меры предосторожности;
- дополнительная информация (при необходимости):
- о зарегистрированной продукции компании «Альпина Пласт»;
- ссылка на публикации по баночному массажу (н-р: «Баночный самомассаж. Мгновенный лифтинг-эффект». Автор Елена Каркукли).

На потребительской упаковке может быть указан товарный знак (знак обслуживания) «Альпина Пласт», «AIRCUPS».

1.5.2 Транспортная маркировка груза должна содержать:
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, юридический адрес;
- наименование и количество изделий;
- основные и дополнительные надписи по ГОСТ 14192;
- масса брутто;
- дата изготовления (месяц, год или число, месяц, год);
- код партии, с предшествующим словом «LOT» или номер серии (при необходимости);
- артикул (при необходимости);
- штрих-код (при необходимости);
- штамп ОТК (при необходимости).

При поставках банок со стеклянным резервуаром дополнительно должно быть указано «Осторожно: стекло!» или «Осторожно: хрупкое!», или эквивалент .

При поставке на экспорт дополнительно должно быть указано «Сделано в России».

1.6 Упаковка

Упаковка банок обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Каждое изделие упаковано в потребительскую упаковку – коробку (бокс) из ПЭТФ-пленки по ТУ 2255-001-90190458-2011 или ПВХ-пленки по ГОСТ 25250 (конструкция «ласточкин хвост») или пакет из полиэтилена по ГОСТ 16338 или ГОСТ 16337 с хедером из картона по ГОСТ 7933, или в коробку (бокс) из картона по ГОСТ 33781 (конструкция «ласточкин хвост»), или в подарочную упаковку (коробку с крышкой на магните) из картона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

переплетного по с ложементом из пенополиуретана эластичного «ЭЛАБЛОК» по ТУ 2254-001-70465083-2009.

Материалы и конструкция упаковки не оказывают вредного влияния на содержимое (подтверждается наличием документа о соответствии требованиям «Технического регламента Таможенного союза №005/2011 «О безопасности упаковки»). Материалы и конструкция упаковки не должны оказывать вредного влияния на содержимое (подтверждается наличием документа о соответствии требованиям «Технического регламента Таможенного союза №005/2011 «О безопасности упаковки»).

Банки в потребительской таре упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511, ГОСТ 13514, ГОСТ 9142. По согласованию с потребителем количество изделий в транспортной упаковке может изменяться.

Каждый ящик оклеен полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 или другими вспомогательными упаковочными материалами, обеспечивающими сохранность изделий.

2. Показания к применению:

- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8шт.; Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8шт.:

Воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромиозиты, невралгии, невриты и периневриты, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, период реабилитации после операций.

- Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.:

Миозиты, нейромиозиты, остеохондроз, невралгия, период реабилитации после операций.

- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.; Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.; Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм; Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм, 2шт.:

Избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног, невралгии, невриты, период реабилитации после операций.

- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2шт.; Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.; Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.:

Косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, отеки.

- СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм:

Воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромиозиты, невралгии, невриты и периневриты, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, период реабилитации после операций, избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног.

3. Противопоказания к применению: Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет; кровотечения любого характера; повышенное артериальное давление; лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен; злокачественные и доброкачественные опухоли.

Возможные побочные эффекты отсутствуют

Риски применения медицинского изделия

Опасные ситуации	**Вред**
Загрязнение изделия в процессе	Перекрестное инфицирование.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

использования при несоблюдении требований дезинфекции	
Токсичность используемых материалов.	Отравление
Несоблюдение условий транспортирования и дезинфекции могут привести к образованию трещин и сколов на привалочной поверхности резервуара из стекла.	Повреждение кожных покровов пациента
Неправильное регулирование степени вакуума сжатием баллона согласно чувствительности пациента.	Возникновение болевых ощущений при использовании, травм (гематома)
Недостаточное управление производственными процессами может привести к продаже изделий с дефектами.	При наличии трещин и сколов на привалочной поверхности возможно повреждение кожных покровов пациента.
Неправильное хранение может привести к травмированию детей (если ребенок разбил банку)	Повреждение кожных покровов
Неправильное проведение дезинфекции.	Отравление продуктами распада

4. Использование по назначению.

4.1 Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов, не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);

- банки хранить в недоступном для детей месте.

4.2 Использование изделия:

Перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду. затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку необходимого диаметра: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу/лицу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями, по направлению массажных линий (см. схему массажа), массируйте тело, удерживая банку за резервуар (за баллон при косметическом массаже).

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений. После применения, банку разобрать и промыть детали.

Приложение 1 - дополнительная инструкция, схема массажа по использованию банок:

- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;
- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;
- СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение 2 - дополнительная инструкция, схема массажа по использованию банок:
- Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.
Приложение 3 - дополнительная инструкция, схема массажа по использованию банок:
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм,2шт);
Приложение 4 - дополнительная инструкция, схема массажа по использованию банок:
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.;

Перед применением банок вакуумных проконсультироваться со специалистом (врачом).

4.3 Техническое обслуживание (уход за изделием).

Перед применением изделие продезинфицировать.

Для увеличения срока службы изделия минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами, после применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать. Банки вакуумные ремонту не подлежат. После утраты потребительских свойств банки подлежат утилизации.

5. Хранение

5.1 Условия хранения

Условия хранения банок в упаковке предприятия-изготовителя – группа 1 по ГОСТ 15150 (Изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°С).

При хранении ящики с изделиями, обеспечивающие их целостность, должны быть уложены по высоте.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.2 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие банок вакуумных требованиям технических условий ТУ 32.50.50-026-17707123-2018 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

При возникновении обоснованной рекламации производитель принимает неисправную продукцию для проведения технической экспертизы и принятия решений по рекламации. В случае установленного производственного дефекта изделие заменяется на аналогичное за счет завода-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы – не установлен.

Примечание: Согласно Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" «Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона».

6. Транспортирование

Изделия в упакованном виде транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования изделий – по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150.

Изделия транспортируются морским путём в соответствии с «Правилами безопасности перевозки грузов». Вид отправки – контейнеры по ГОСТ 20435 с коэффициентом использования 0,9.

Транспортирование в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

7. Утилизация

При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

8. Контактные данные производителя

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альпина Пласт»
(ООО «Альпина Пласт»).

Юр. адрес: Производство ООО «Альпина Пласт», Россия, 141600, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Перечень применяемых производителем национальных стандартов

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
Приказ Минздрава № 4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий.
ГОСТ 24105-80	Изделия из пластмасс. Термины и определения дефектов
МУ 287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.
ГОСТ Р 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
Технический регламент Таможенного союза №005/2011	«О безопасности упаковки»
ГОСТ 13511-2006	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия.
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия.
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний.
ГОСТ 20435-75	Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия.
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
ГОСТ 7329-91	Изделия из стекла химико-лабораторного и электровакуумного. Метод поляризационно-оптического измерения разности хода лучей.
ГОСТ 2.610-2006	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Руководство по эксплуатации*(краткая)

• Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;

• Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8шт. (далее «Банки вакуумные лечебные»), предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж - лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Показания к применению

Воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромиозиты, невралгии, невриты и периневрити, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, период реабилитации после операций.

Противопоказания к применению

Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов. Не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра.

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);

- банки хранить в недоступном для детей месте.

Использование изделия:

Дезинфекция: перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона.

Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу/лицу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями, по направлению массажных линий (см. схему массажа), массируйте тело, удерживая банку за резервуар.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

Утилизация

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Рекомендации для проведения лечебного массажа:

Курс массажа рассчитан на 15-20 сеансов с интервалом 3-4 дня.

Контактные данные производителя

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альпина Пласт» (ООО «Альпина Пласт»).

Юр. адрес: Производство ООО «Альпина Пласт», Россия, 141600, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА МАССАЖА ЛЕЧЕБНОГО

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ

10-15 мин. на один массируемый участок

Перед проведением любого массажа, требуется предварительно разогреть рабочую зону. Удобнее всего это делать руками.
Критерий выполнения подготовительного массажа – стойкая гиперемия (покраснение кожи) и повышение температуры на массируемом участке тела.

1 ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

15-20 мин. 8-10 сеансов через день

При остеохондрозе делают скользящие массажные движения от поясницы к шее. Особое внимание уделяют массажу зон, расположенных на расстоянии 2-3 см от остистых отростков позвоночника. Движения прямолинейные. При подъёме вверх степень нажима сильная, с образованием складки кожи. Движение вниз без усилий. При шейном остеохондрозе используйте банки ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ.

2 ПРИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

15-20 мин. 8-10 сеансов через день для детей старше 2 лет

При простудных заболеваниях, бронхитах, пневмонии - массируют спину от нижних углов лопаток к плечам, боковые поверхности грудной клетки, а также от мечевидного отростка грудины к левому и правому плечу. Под действием баночного массажа отходит мокрота, улучшается дыхание, снижается температура тела. После окончания процедуры больного надо укутать одеялом, дать стакан чая с малиной или лимоном.

3 ПРИ МИОЗИТАХ, РАДИКУЛИТЕ

15-20 мин. 8-10 сеансов через день

При миозитах поясничных мышц массируют вдоль поясницы, при миозитах мышц предплечья - мышцы задней поверхности шеи и спины. При пояснично-крестцовом радикулите - поясничную область. Если боль иррадирует в ногу, массируют заднюю поверхность ноги от подколенной ямки к ягодичной складке.

4 СТАТИЧЕСКАЯ ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ

5-15 мин. 5-8 сеансов

При статической вакуум-терапии накладывают банки на грудной отдел спереди и сзади, на поясничную область справа и слева от позвоночника, вдоль седалищного нерва по задней поверхности бедра. При установке банок на тело ребенка, ослабленным больным и людям с чувствительной кожей необходимо регулировать степень вакуума путем неполного сжатия баллона.

5 АУТОГЕМОТЕРАПИЯ

30-60 сек.

В целях повышения иммунитета у ослабленных, длительно болеющих людей, применяется методика аутогемотерапии. Суть методики заключается в наложении на кожу ягодиц банок в режиме большого вакуума (сильно сжатый баллон).

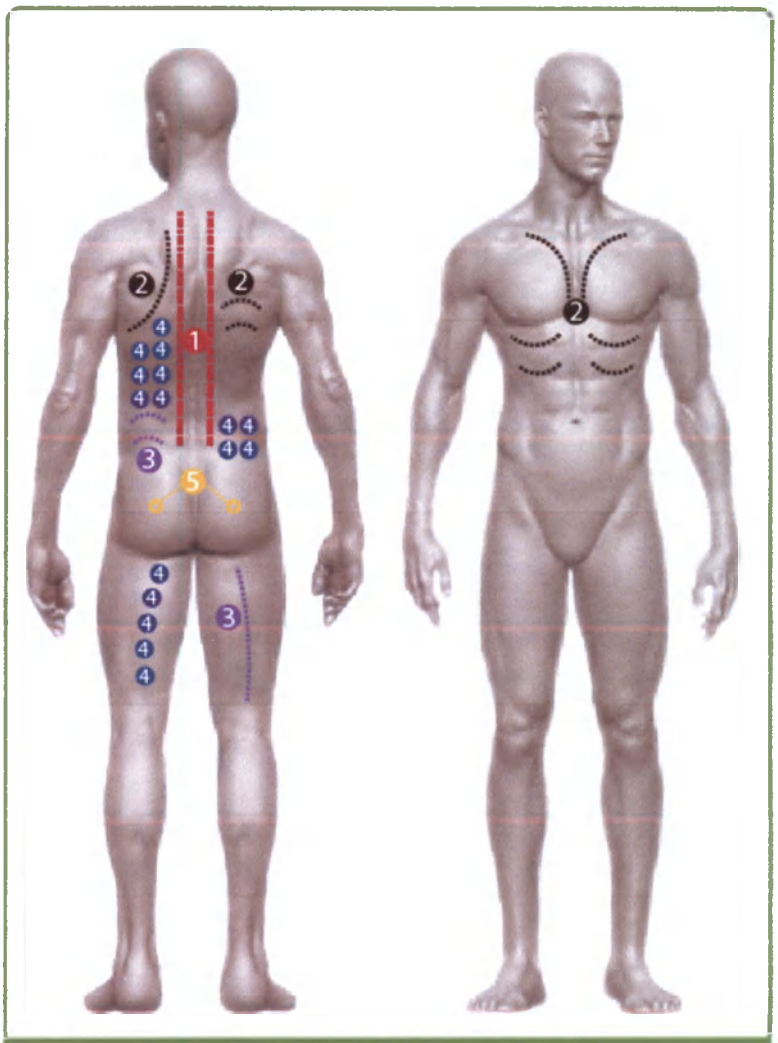

СХЕМА БАНОЧНОГО МАССАЖА

1 при остеохондрозе
2 при простудных заболеваниях, бронхитах, пневмонии
3 при миозитах, пояснично-крестцовом радикулите
4 статическая вакуум-терапия
5 аутогемотерапия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации*

Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт. (далее «Банки вакуумные терапевтические») предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж: антицеллюлитный, косметический, лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Показания к применению

Миозиты, нейромиозиты, остеохондроз, невралгия, период реабилитации после операций.

Противопоказания к применению

Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов. Не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра.

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

Использование изделия

Дезинфекция: перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона.

Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установите банку: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями, по направлению массажных линий (см. схему массажа), массируйте тело, удерживая банку за резервуар.

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Утилизация

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Контактные данные производителя

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альпина Пласт» (ООО «Альпина Пласт»).

Юр. адрес: Производство ООО «Альпина Пласт», Россия, 141600, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

СХЕМА МАССАЖА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО

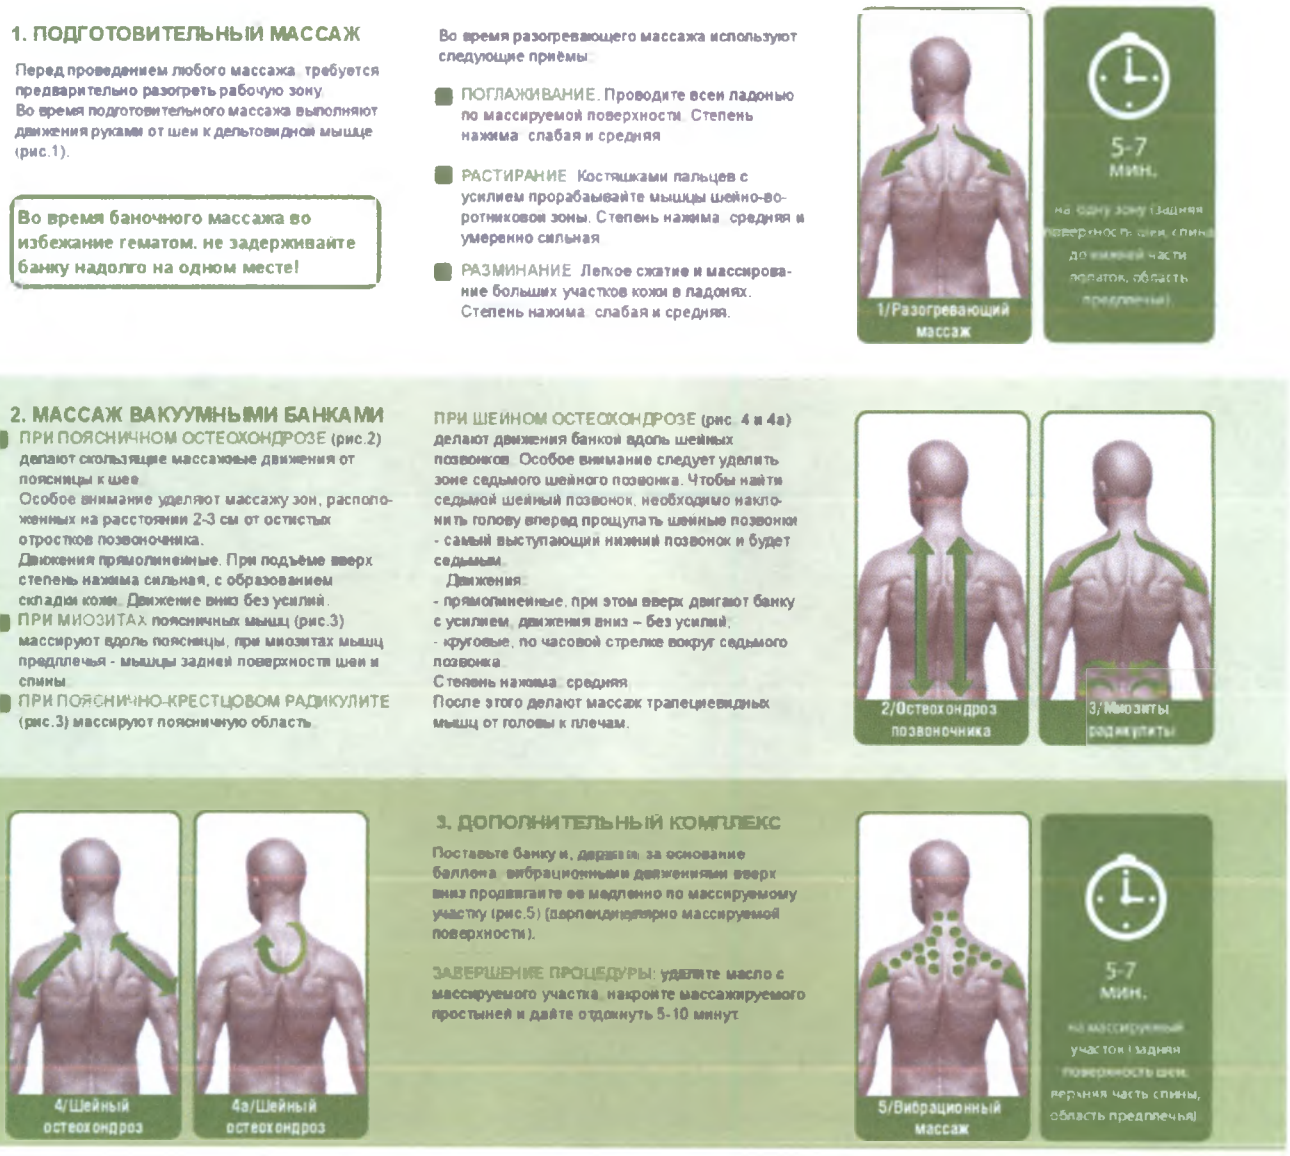

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации*

• Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
• Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
• Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм;
• Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм, 2шт, (далее «Банки вакуумные антицеллюлитные»).

Банки вакуумные антицеллюлитные - Банки медицинские вакуумные (далее банки) предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж - антицеллюлитный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Показания к использованию

Избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног, невралгии, невриты, период реабилитации после операций.

Противопоказания к использованию

Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов, не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра.

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

Использование изделия:

Дезинфекция: перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона.

Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку необходимого диаметра: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями, по направлению массажных линий (см. схему массажа), массируйте тело, удерживая банку за резервуар.

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Утилизация

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Курс массажа рассчитан на 15-20 сеансов с интервалом 3-4 дня.
Общая рекомендация: количество повторений по одной массажной линии 2-3 раза.

Контактные данные производителя

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альпина Пласт»
(ООО «Альпина Пласт»).
Юр. адрес: Производство ООО «Альпина Пласт», Россия, 141600, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

СХЕМА АНТИЦЕЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА

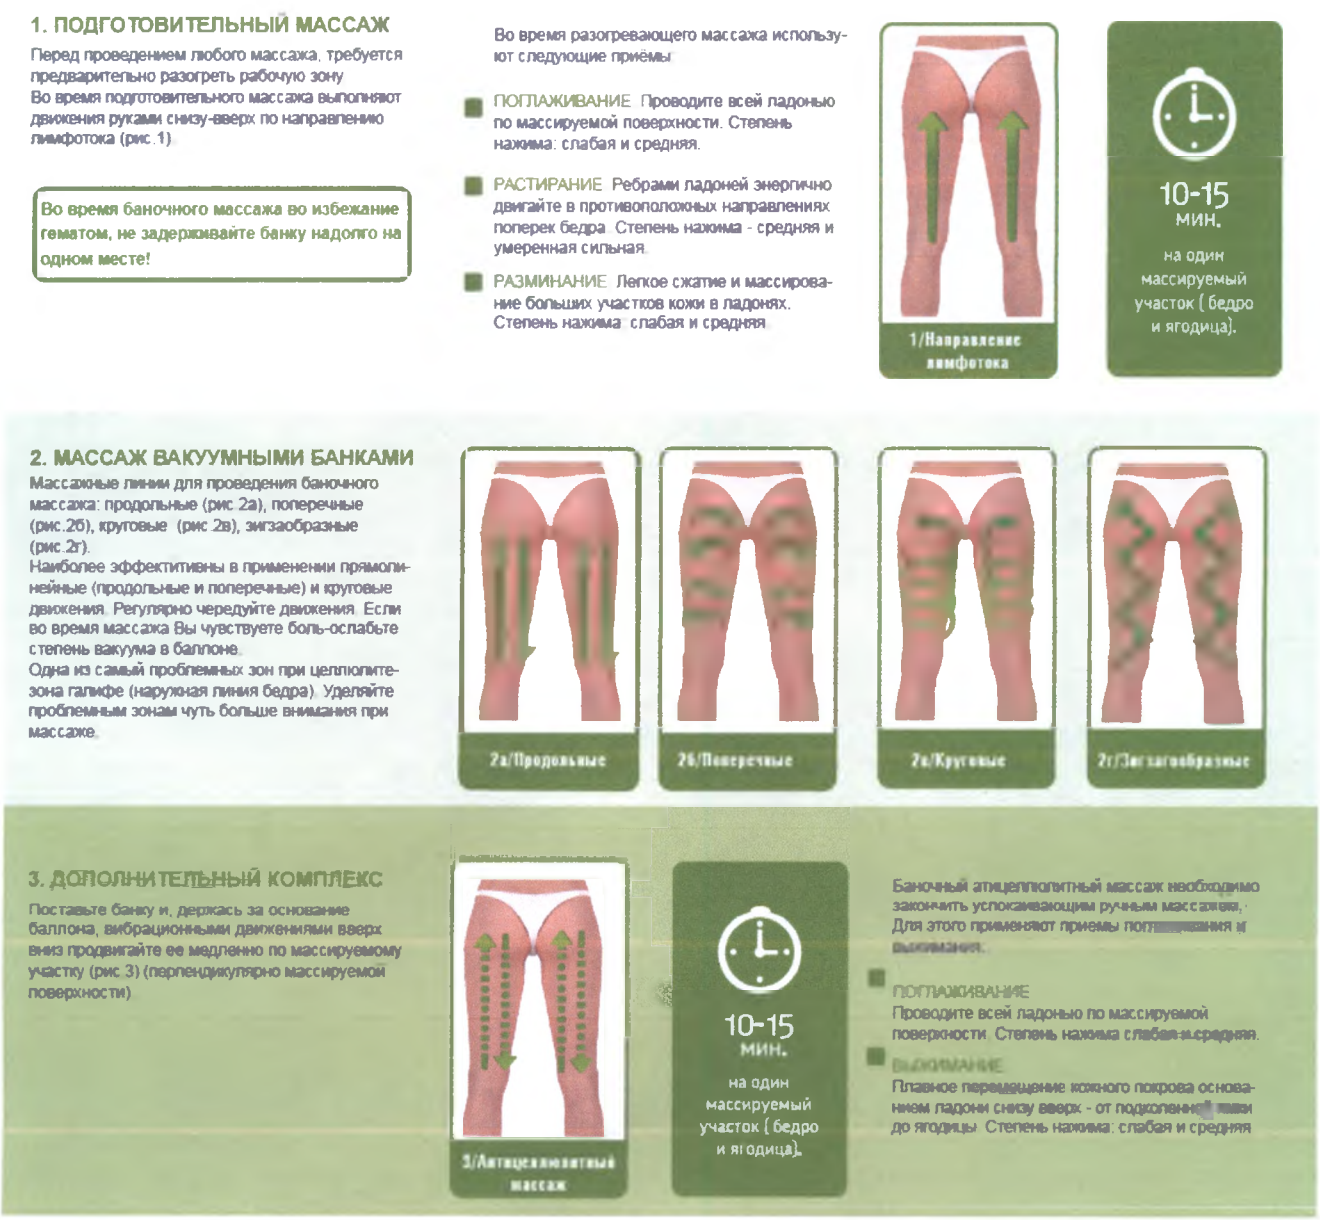

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации*

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2шт.;

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт. (далее – «Банки вакуумные косметические») предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж - косметический), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Показания к использованию

Косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, отеки.

Противопоказания к использованию

Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов.

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

Использование изделия:

Дезинфекция: перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона.

Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку необходимого диаметра: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу/лицу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями, по направлению массажных линий (см. схемы массажа), массируйте тело, удерживая банку за баллон.

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

Утилизация

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Рекомендации для проведения косметического массажа:

Перед массажем очистите лицо. На чистое лицо нанесите масло или крем. Кожа должна быть эластичной и мягкой.

1. **Массаж шеи** – см. схему массажа.
Используется банка Ø33 мм. Степень вакуума: ниже среднего, слабый.
Эффект: подтягивается кожа, выравнивается линия шеи, устраняются признаки старения.
2. **Формирование овала лица** – см. схему массажа.
Используется банка Ø33 мм, Ø42. Степень вакуума: средняя, сильная.
Эффект: формируется овал лица, подтягивается устраняется обвисание кожи.
3. **Массаж носа** – см. схему массажа.
Используется банка Ø22 мм или Ø11 мм. Степень вакуума: средняя, выше средней.
Эффект: подтягивается кожа, выравнивается линия шеи, устраняются признаки старения.
4. **Аутогемотерапия вокруг глаз и век –** см. схему массажа.
Используется банка Ø11 мм. Степень вакуума: слабая.
Эффект: устраняются отеки, убираются морщины, подтягивается кожа вокруг глаз и век.
5. **Массаж лба, бровей** – см. схему массажа.
Используются банки Ø33, Ø42, Ø50мм. Степень вакуума: средняя, сильная.
Эффект: устраняются морщины, подтягивается кожа, выравниваются линии лба.
6. **Массаж линии губ** – см. схему массажа.
Используются банки Ø11, Ø22, Ø42мм. Степень вакуума: средняя, выше средней.
Эффект: выравнивается линия губ и носогубной складки, устраняются мимические морщины.
7. **Массаж линии подбородка** – см. схему массажа.
Используются банки Ø33, Ø42, Ø50мм. Степень вакуума: средняя, сильная.
Эффект: выравнивается линия подбородка.

Общая рекомендация: количество повторений по одной массажной линии 2-3 раза.

Контактные данные производителя

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альпина Пласт»
(ООО «Альпина Пласт»).
Юр. адрес: Производство ООО «Альпина Пласт», Россия, 141600, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43
www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА МАССАЖА КОСМЕТИЧЕСКОГО

ПОДГОТОВКА К МАССАЖУ

Перед массажем очистите лицо. На чистое очищенное лицо нанесите масло или крем.

❶ МАССАЖ ШЕИ

Эффект: подтягивается кожа, выравнивается линия шеи, устраняются признаки старения.
Используются банки Ø42, Ø33 мм.
Степень вакуума: ниже среднего, слабый.

❷ ФОРМИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА

Эффект: формируется овал лица, подтягивается и устраняется обвисание кожи.
Используются банки Ø50, Ø42, Ø33 мм.
Степень вакуума: средняя, сильная.

❸ МАССАЖ НОСА

Эффект: выравнивается линия носа и носогубная складка, подтягивается кожа.
Используются банки Ø22, Ø11 мм.
Степень вакуума: средняя, выше средней.

④ АУТОГЕМОТЕРАПИЯ ВОКРУГ ГЛАЗ И ВЕК

Эффект: устраняются отеки, убираются морщины, подтягивается кожа вокруг глаз и век.
Используется банка Ø11 мм.
Степень вакуума: слабая.

❺ МАССАЖ ЛБА, БРОВЕЙ

Эффект: устраняются морщины, подтягивается кожа, выравниваются линии лба.
Используются банки Ø50, Ø42, Ø33, Ø22мм.
Степень вакуума: средняя, сильная.

❻ МАССАЖ ЛБА, БРОВЕЙ

Эффект: выравнивается линия губ и носогубной складки, устраняются мимические морщины.
Используются банки Ø42, Ø22, Ø11 мм.
Степень вакуума: средняя, выше средней.

⑦ МАССАЖ ЛИНИИ ПОДБОРОДКА

Эффект: выравнивается линия подбородка.
Используются банки Ø50, Ø42, Ø33 мм.
Степень вакуума: средняя, сильная.

ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

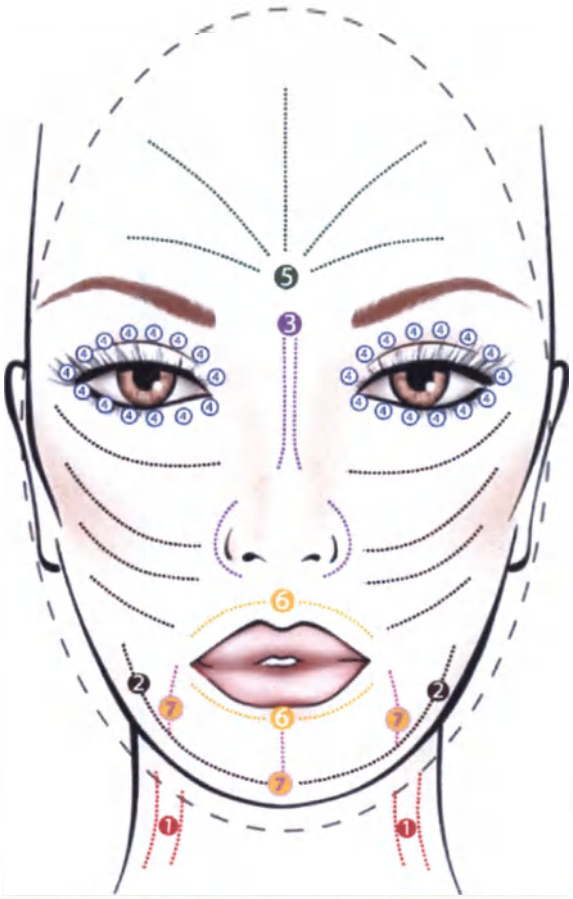

СХЕМА БАНОЧНОГО МАССАЖА

1 массаж шеи
2 формирование овала лица
3 массаж носа
4 аутогемотерапия век
5 массаж лба, бровей
6 массаж линии губ
7 массаж линии подбородка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации*

СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм,

предназначена для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж: антицеллюлитный, косметический, лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

Показания к использованию

Воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромиозиты, невралгии, невриты и периневрит, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, период реабилитации после операций, избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног.

Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Противопоказания к использованию

Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов. Не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра.

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

Использование изделия:

Перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями массируйте тело, удерживая банку за резервуар.

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

Утилизация

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Контактные данные производителя

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альпина Пласт»

(ООО «Альпина Пласт»).

Юр. адрес: Производство ООО «Альпина Пласт», Россия, 141600, Московская область, Клинский район, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43,
www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц после внесения изменения	Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного документа)	Подпись лица, внесшего изменения	ФИО лица, внесшего изменения, дата внесения изменения
	замененных	дополнительных	исключенных	измененных				

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
13 (сорок пять) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альмина Пласт»
_____Е.Н. Игутов

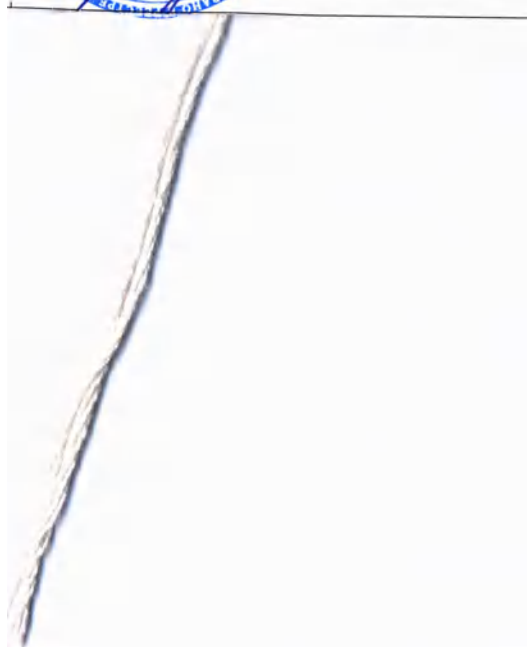

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU