

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, дом 10,
Помещ. I, этаж 14, ком. 30

T: +7 495 739 6931

Φ: +7 495 739 6932

«УТВЕРЖДАЮ»

Лидер по регистрации

Дорофеева Ю.Н.

подпись/печать

«09» июня 2022 года



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями»,

производства

GE Medical Systems Information Technologies, Inc. /

ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз, Инк., США



Фото 1.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft: 1. Стандартный пакет программного обеспечения CardioSoft для анализа ЭКГ на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе

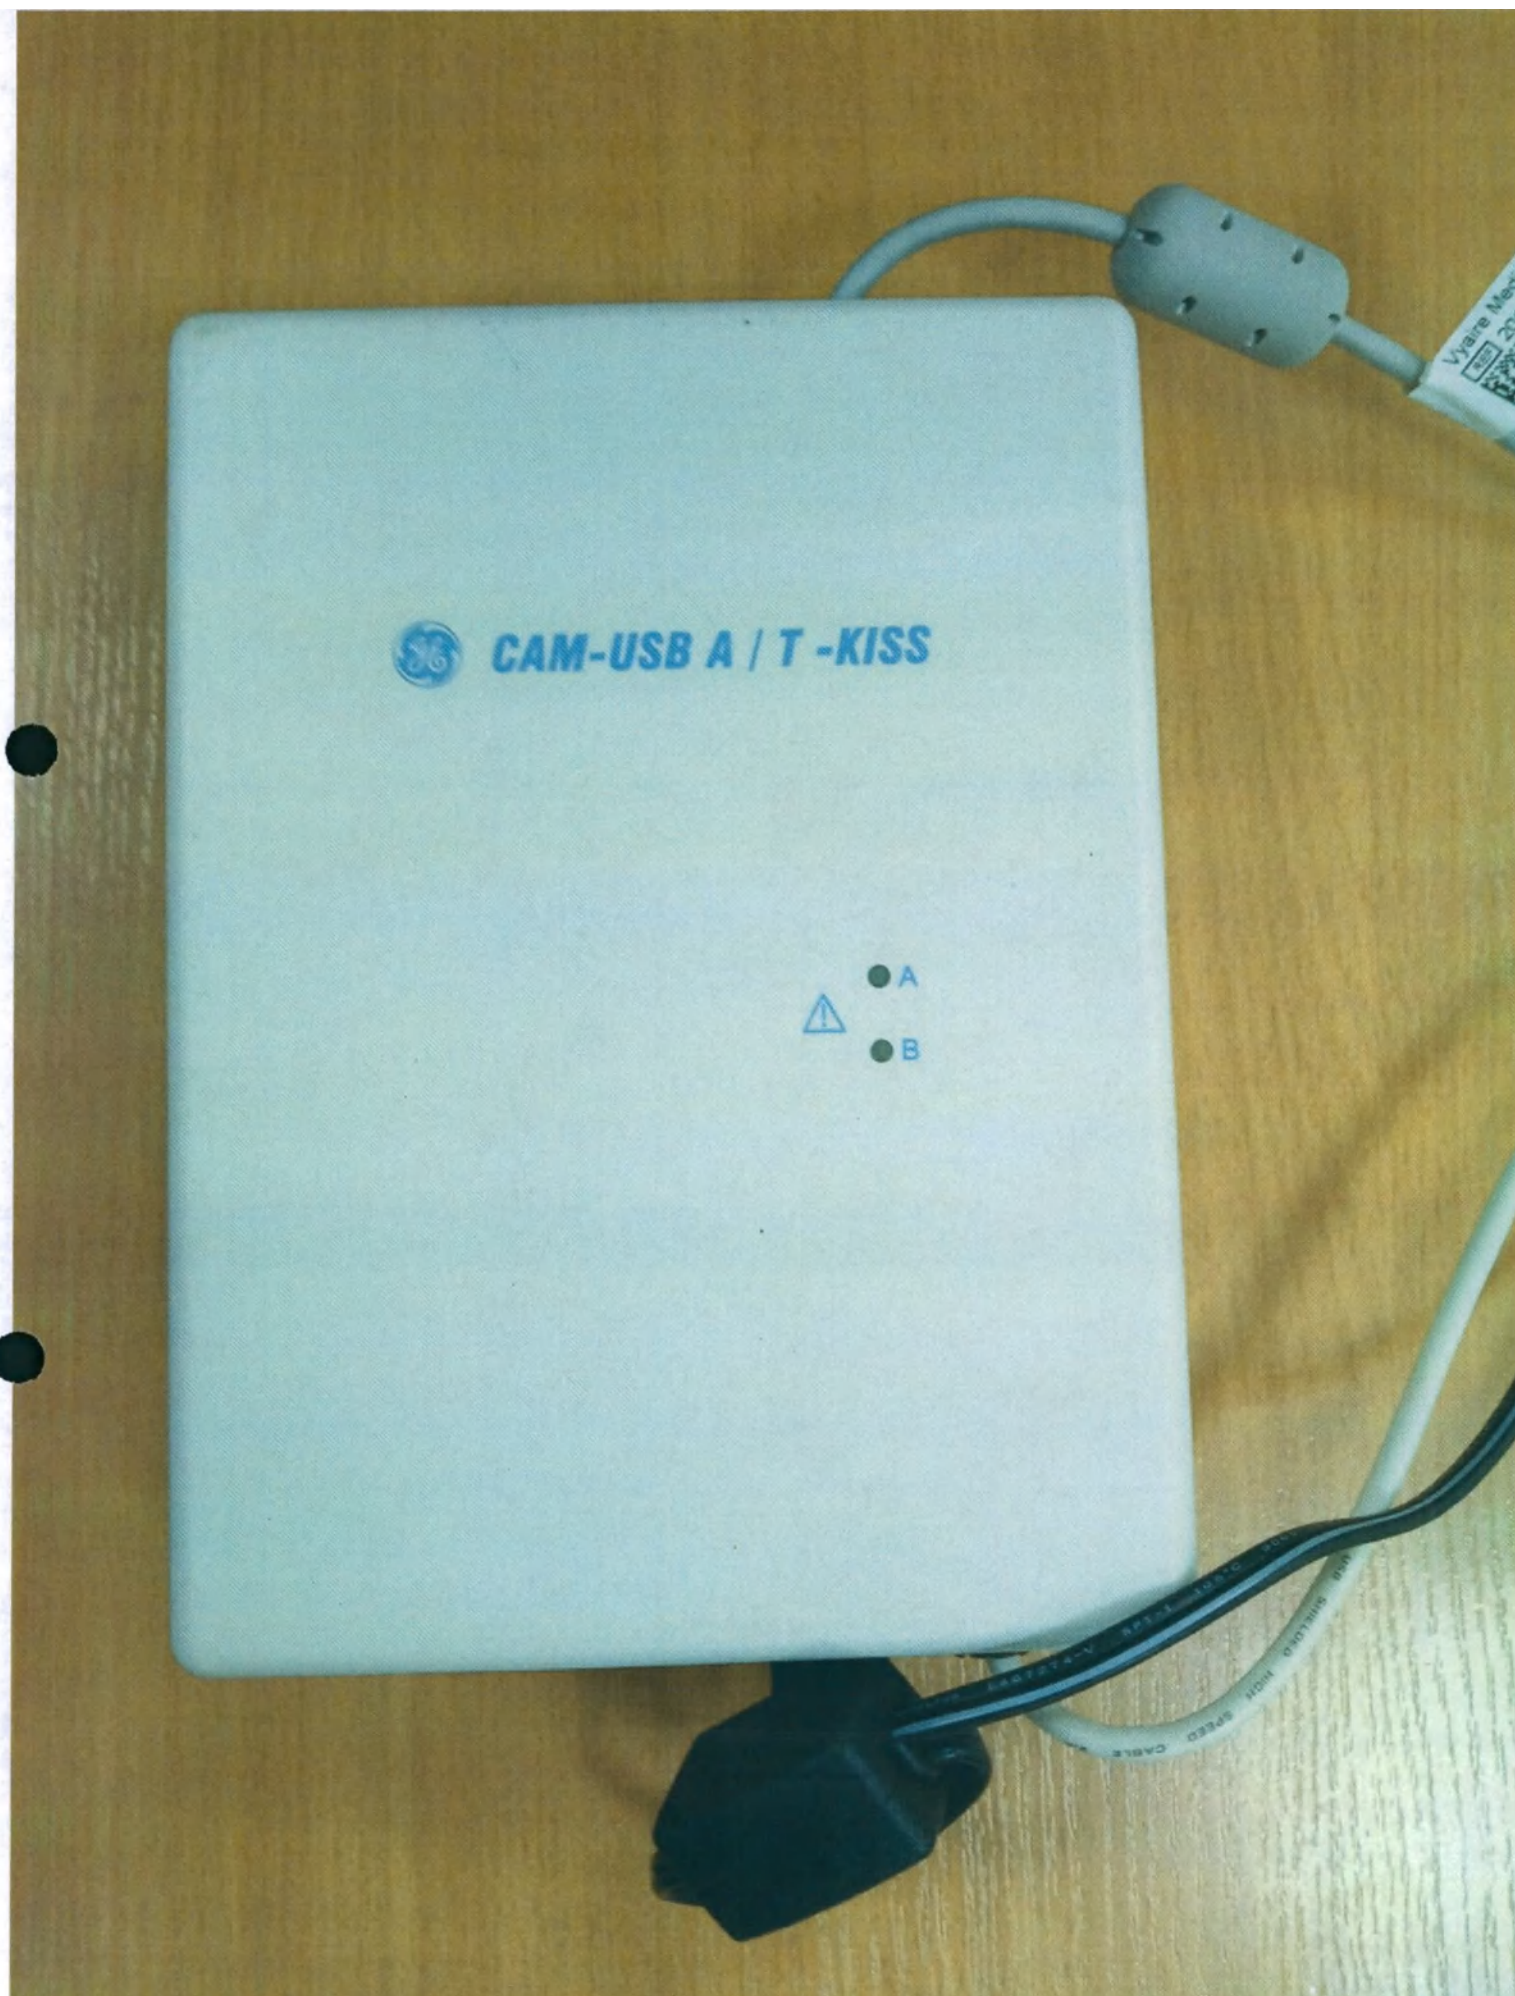


Фото 2.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:

2. Блок интерфейса CAM-USB, производства GE Medical Systems Information Technologies, Inc



Фото 3.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 4.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru, производства GE Medical Systems Information Technologies, Inc



Фото 5.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:

3. Модель функциональной диагностики CAM14 производства GE Medical Systems Information Technologies, Inc
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (маркировка)

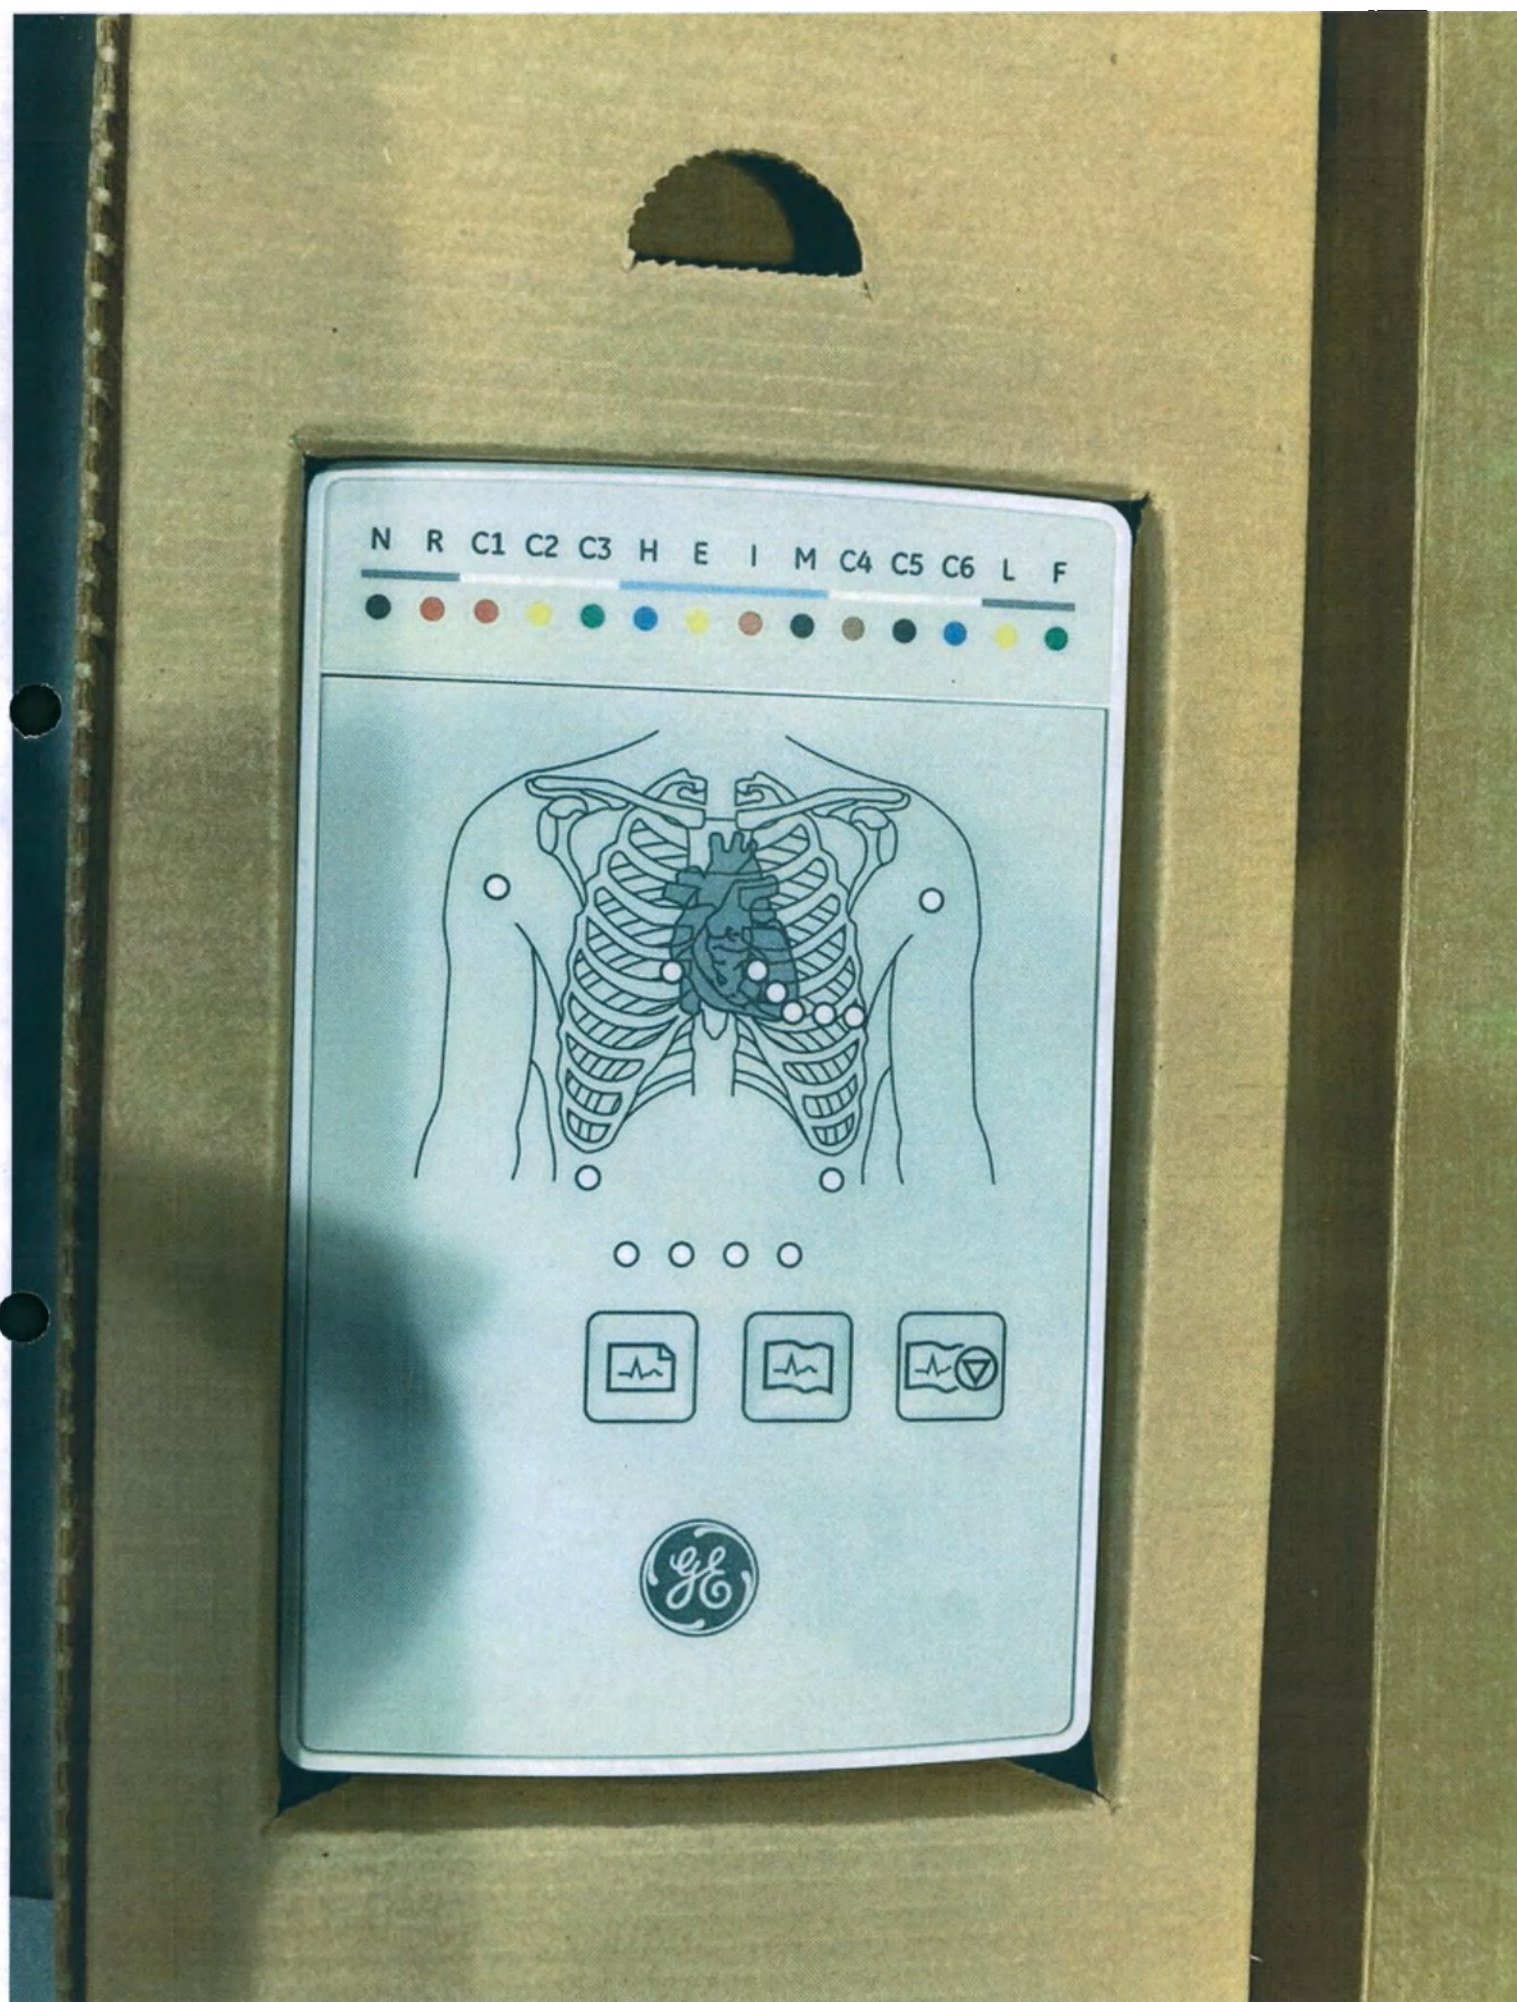


Фото 6.




UDI  **REF** 2091686-001 CAM CONNECT 14
(01) 00840682125307
(21) VU519510064SA
(11) 191218 2019-12-18
SN V U 5 1 9 5 1 0 0 6 4 S A ASSEMBLED IN MEXICO
LBL P/N: 2091684-001

CAM CONNECT 14

 **GE Medical Systems Information Technologies, Inc.** 
8200 W, Tower Ave, Milwaukee, WI 53223 USA
Power input: 5.0V $\overline{\text{---}}$ 1A

 **0459**    

  **IPX4**
Rx Only
ASSEMBLED IN MEXICO

I/b no.-2093044-001

Фото 7.



Фото 8.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:

Беспроводной GEN-ECG 1200, производства GE Medical Systems Information Technologies, Inc

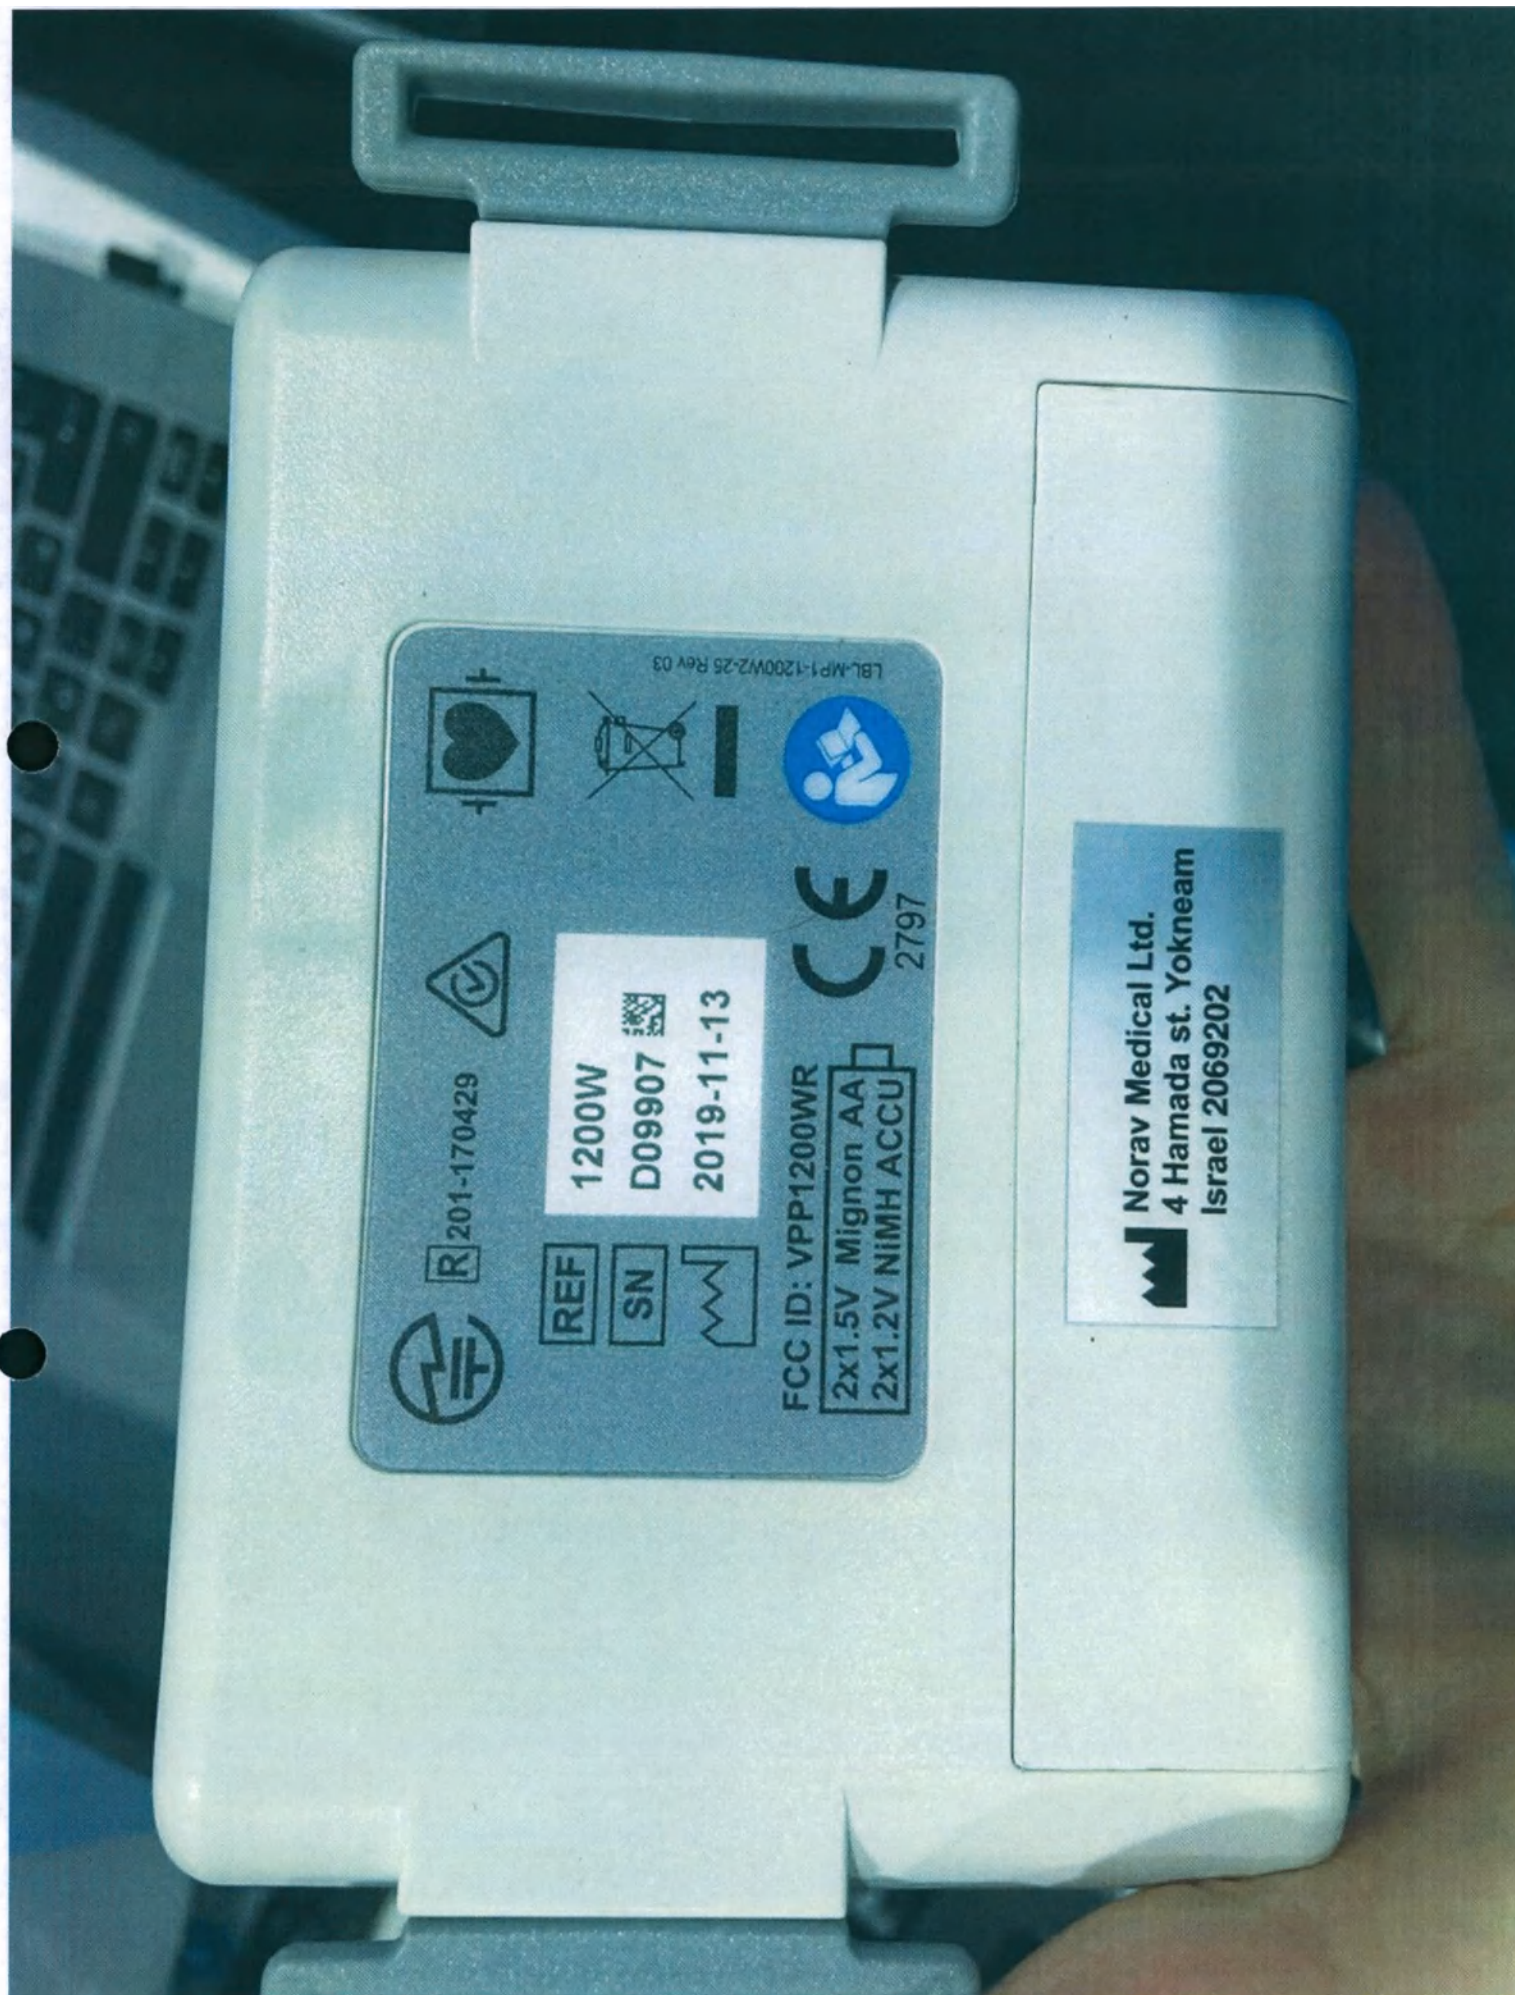


Фото 9.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 5. Молч. пациента беспроводной GEH-ECG 1200, производства GE
 ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 medical Systems Information Technologies, Inc (маркировка)



Фото 10.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:

6. Диск или электронный носитель с документацией с маркировкой

GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Руководство оператора
Код продукта SSG

Версия программного обеспечения 7.0



Фото 11.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft:

GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Версия программного обеспечения 7.0

Руководство по установке и обновлению программного обеспечения

Фото 12.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

CardioSoft:

8. Руководство по установке и обновлению программного обеспечения

GE Healthcare / ДжиИ Хэлскеа

Система наложения электродов KISS

Руководство по эксплуатации

Фото 13.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

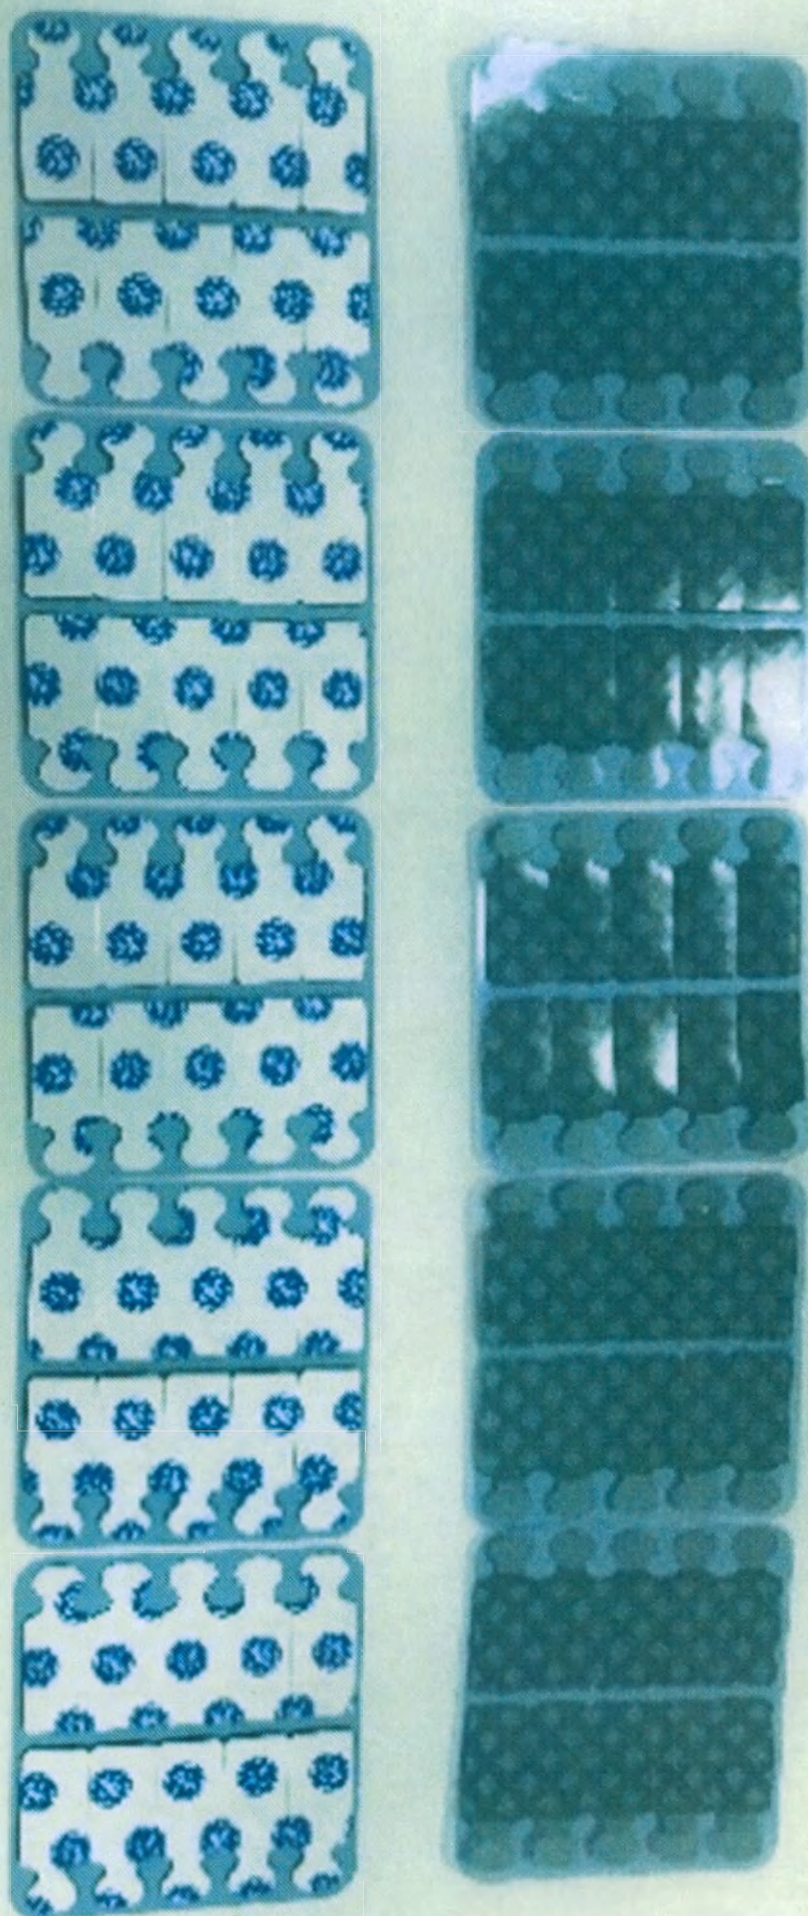


Фото 14.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft: 10. Электроды одноразовые детские.

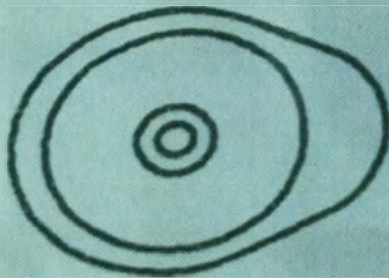



Фото 15.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

SilverTRACE™ ECG Electrodes,
35x41mm Oval, Foam, Solid Gel

00600 / 15:21:05



QTY	30	REF	2014768-001
		GTIN	19005531001951
		LOT	200326-0163
			2023-03-26
(01)19005531001951(10)200326-0163(17)220326			

V2

Фото 16.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft 11. Электроды одноразовые (маркировка).



Фото 17.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft: 12. Электроды одноразовые взрослые.



Фото 18.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 19.

І. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 20.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 15. Беговая дорожка T2100- ST2, производства Full Vision Inc

Фото 21.

MODEL NO. **T2100-ST2**

SN GEDC-2051

REF 2097357-002

Private Label MFG: GE Medical Systems
Information Technologies, Inc
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223, USA

MFG MODEL NO. TMX428 220

MFG PART NO. 317-07927 GE

VOLTAGE: 220/240 SPLIT PHASE ~
220/240 ~

AMPS: 13 HERTS: 50/60


2018-11


FULL VISION INC.
3017 FULL VISION DRIVE,
NEWTON, KANSAS USA 67114-9750



317-160-315





Фото 22.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft: 16. Велозррометр eBike Basic, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН 2017/6303)



Фото 23.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 16. Велозргомметр eBike Basic, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН
2017/6303) (маркировка)



Фото 24.

**I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 16. Велозергометр eBike Comfort, производства ergoline GmbH
(ПУ № РЗН 2017/6303)**



Фото 25.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft: 16. Велоэргометр eBike L, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН 2017/6303)



Фото 26.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 16. Велозргомметр eBike EL, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН
2017/6303)

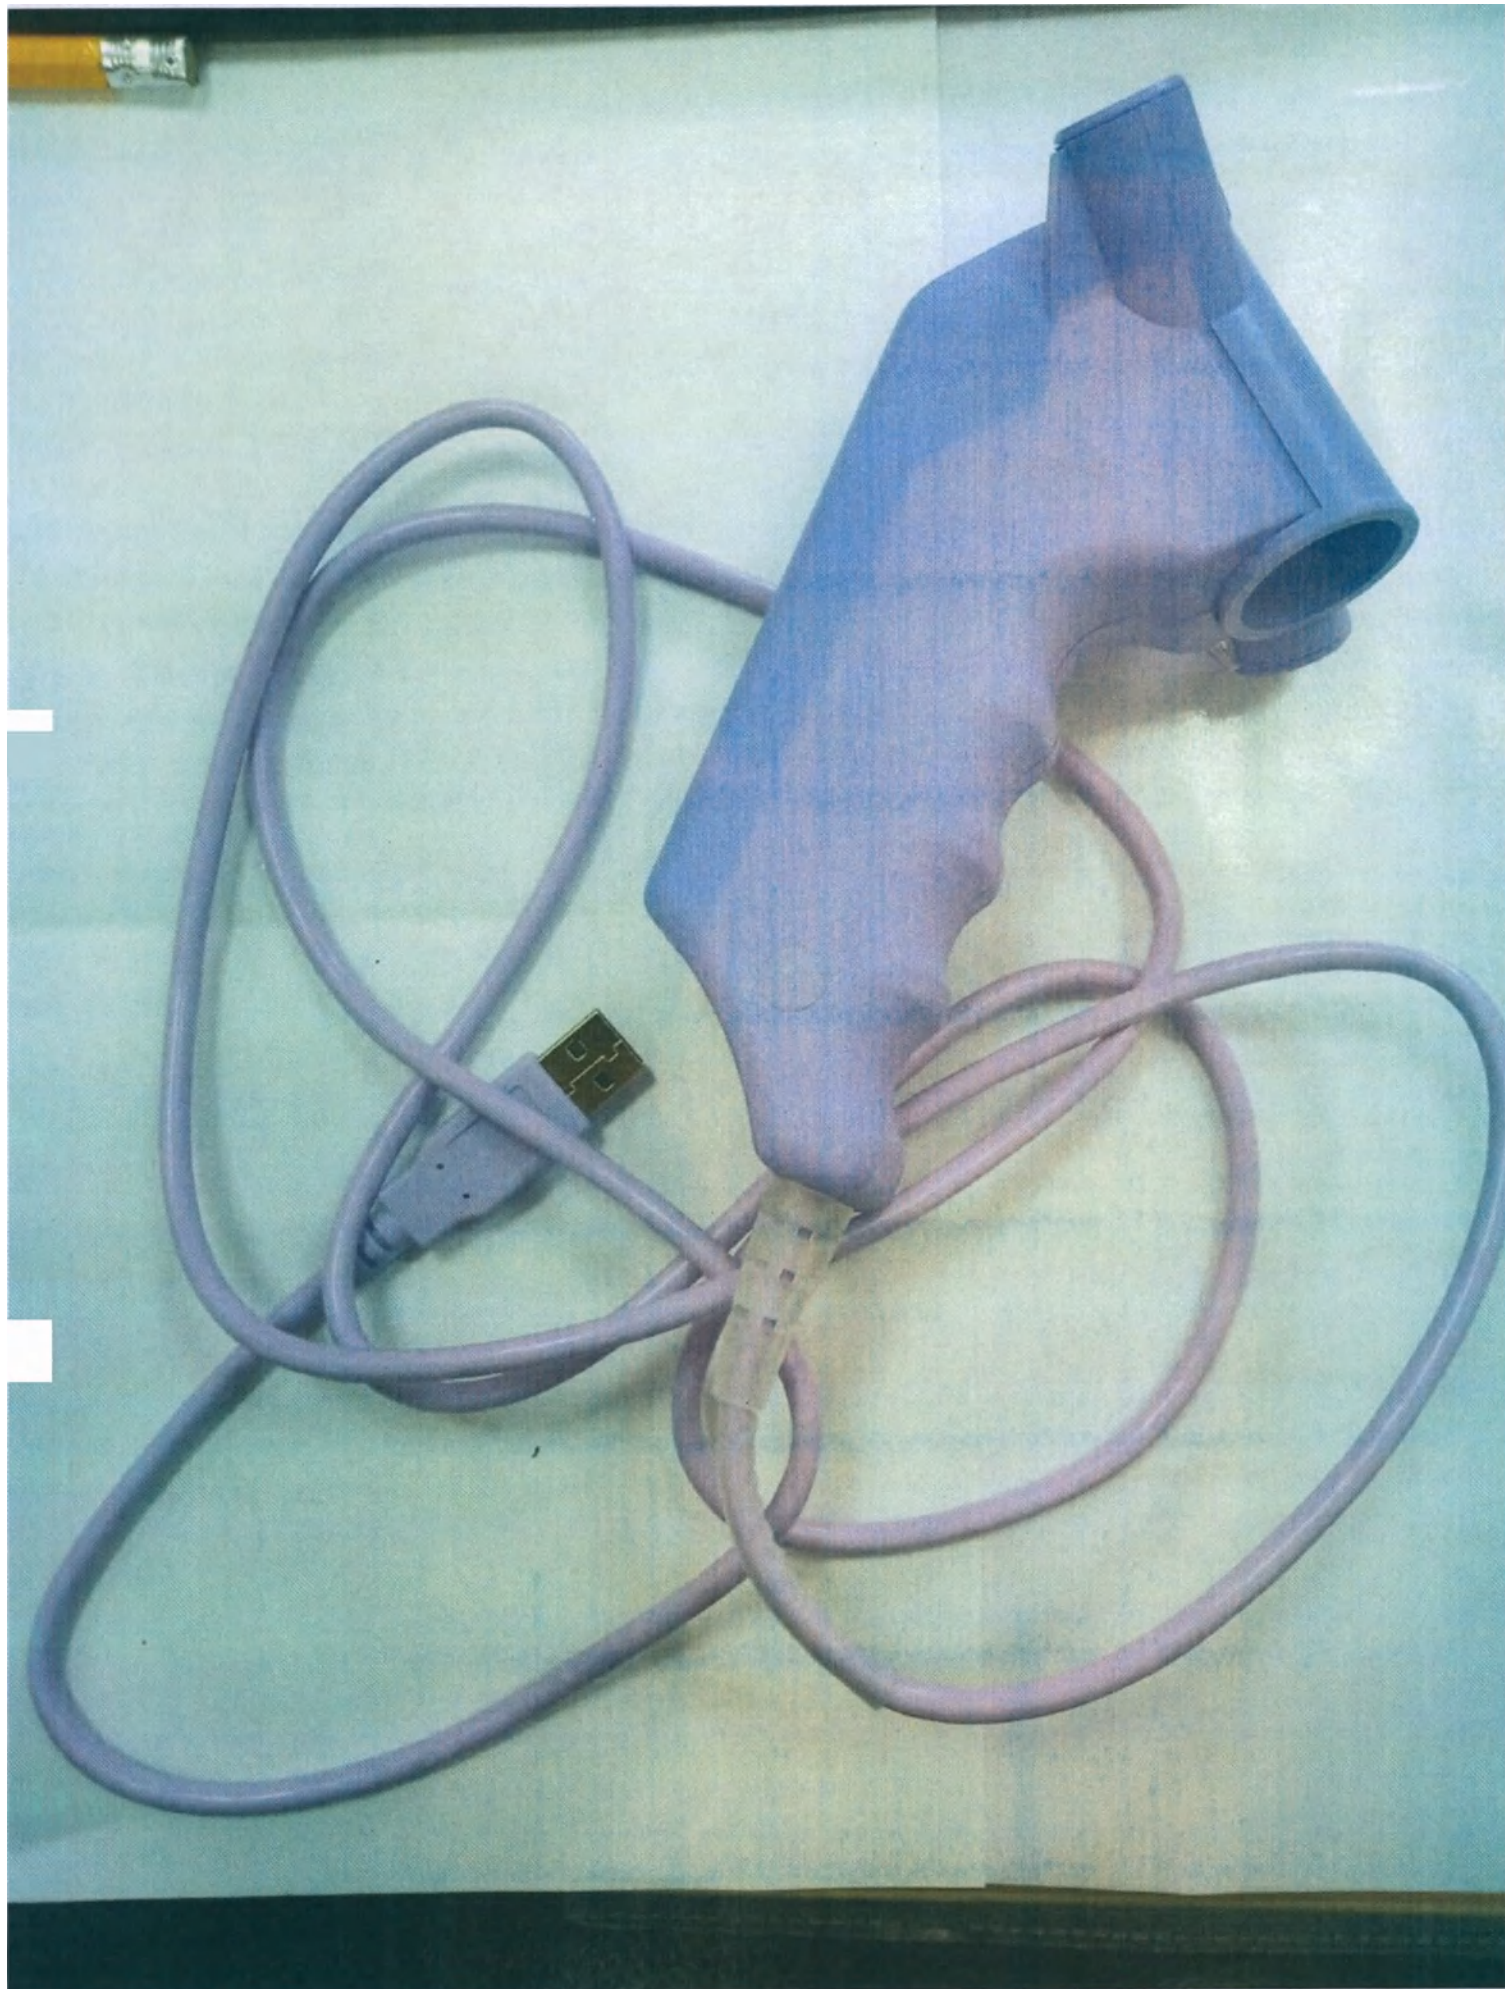


Фото 27.

1. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 17. Спирометр Spiro-SP TrueFlow, производства NDD Medical Technologies



Фото 28.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

CardioSoft: 17. Спирометр Spiro-SP TrueFlow, производства NDD Medical Technologies
 ООО ЦРПМ И INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

(маркировка)



Фото 29.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft 18 Монитор артериального давления, SpO2 Tango M2



Фото 30.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft: 18. Монитор артериального давления, SpO2 Tango M2 (маркировка)



Фото 31.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft: 19. Монитор амбулаторный артериального давления длительного действия
 Тонпорт VI (ПУ № РЗН 2022/17208)



Фото 33.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:



Фото 35.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:



Фото 36.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:

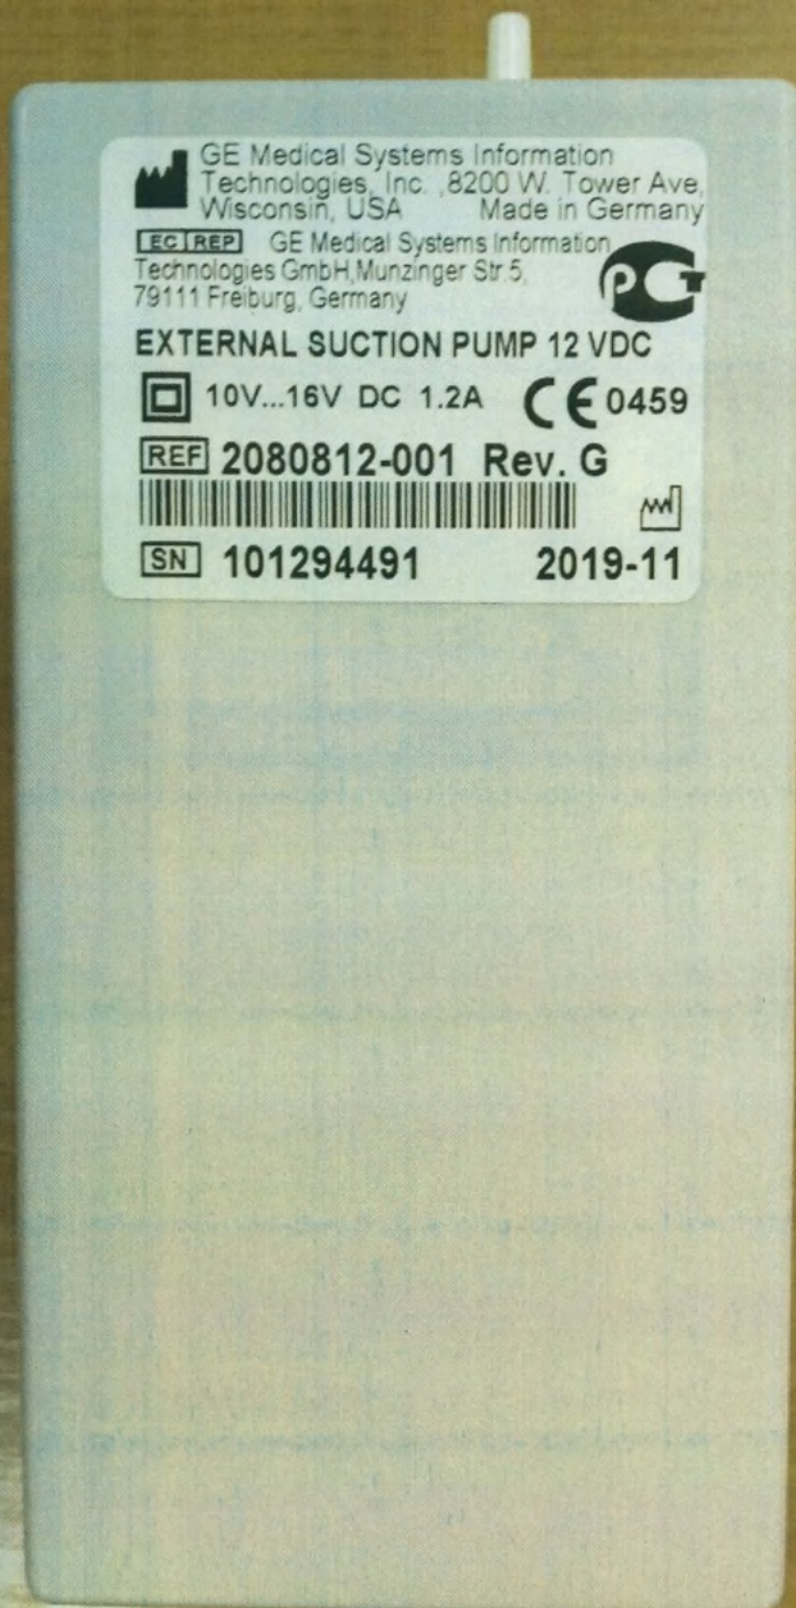


Фото 37.

I. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft:



Фото 38.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

Client: 1. Программный пакет CardioSoft Client для анализа ЭКГ на оптических и/или



Фото 39.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 2. Защитный ключ



Фото 40.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft Client: 3. Диск или электронный носитель с документацией с маркировкой

GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Руководство оператора
Код продукта SSG

Версия программного обеспечения 7.0



Фото 41.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

CardioSoft Client: 4.

Руководство оператора

GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Версия программного обеспечения 7.0

Руководство по установке и обновлению программного обеспечения

Фото 42.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

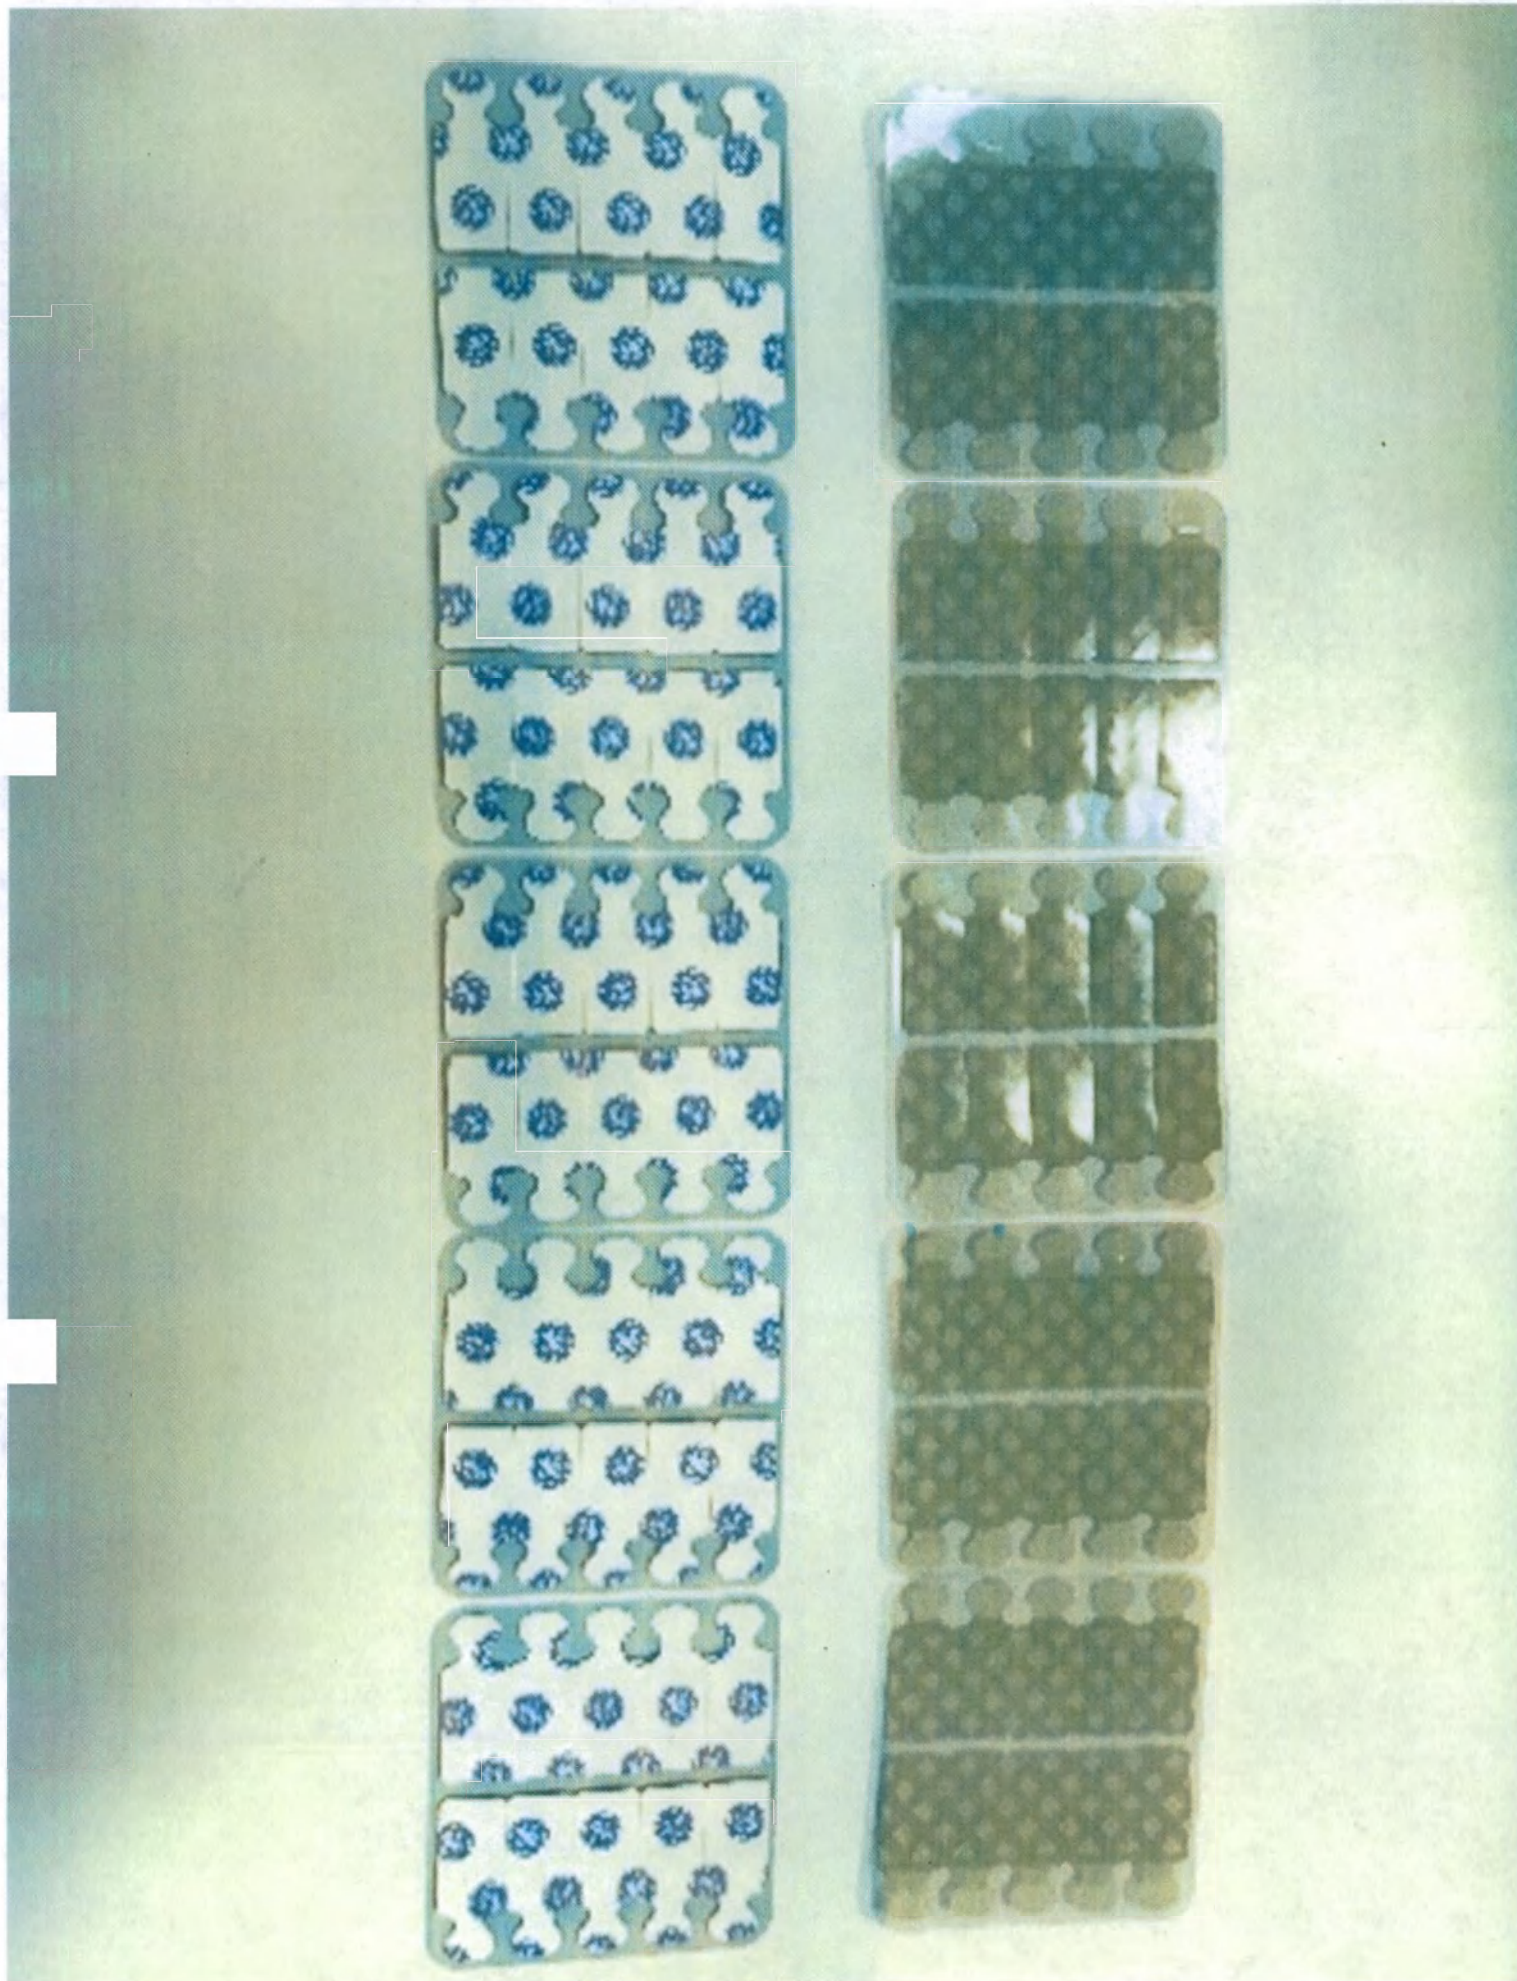


Фото 43.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft Client: 6. Электроды одноразовые детские.



Фото 44.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 45.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft Client: 8. Электроды одноразовые взрослые.



Фото 46.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 47.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 48.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 11. Беговая дорожка T2100- ST2, производства Full Vision Inc



Фото 49.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 12. Велозргометр eBike Basic, производства ergoline GmbH (ПУ №
РЗН 2017/6303)



Фото 50.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 12. Велозергометр eBike Comfort, производства ergoline GmbH (ПУ №
РЗН 2017/6303)



Фото 51.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 12. Велозргомметр eBike L, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН
2017/6303)



Фото 52.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 12. Велозргометр eBike EL, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН
2017/6303)

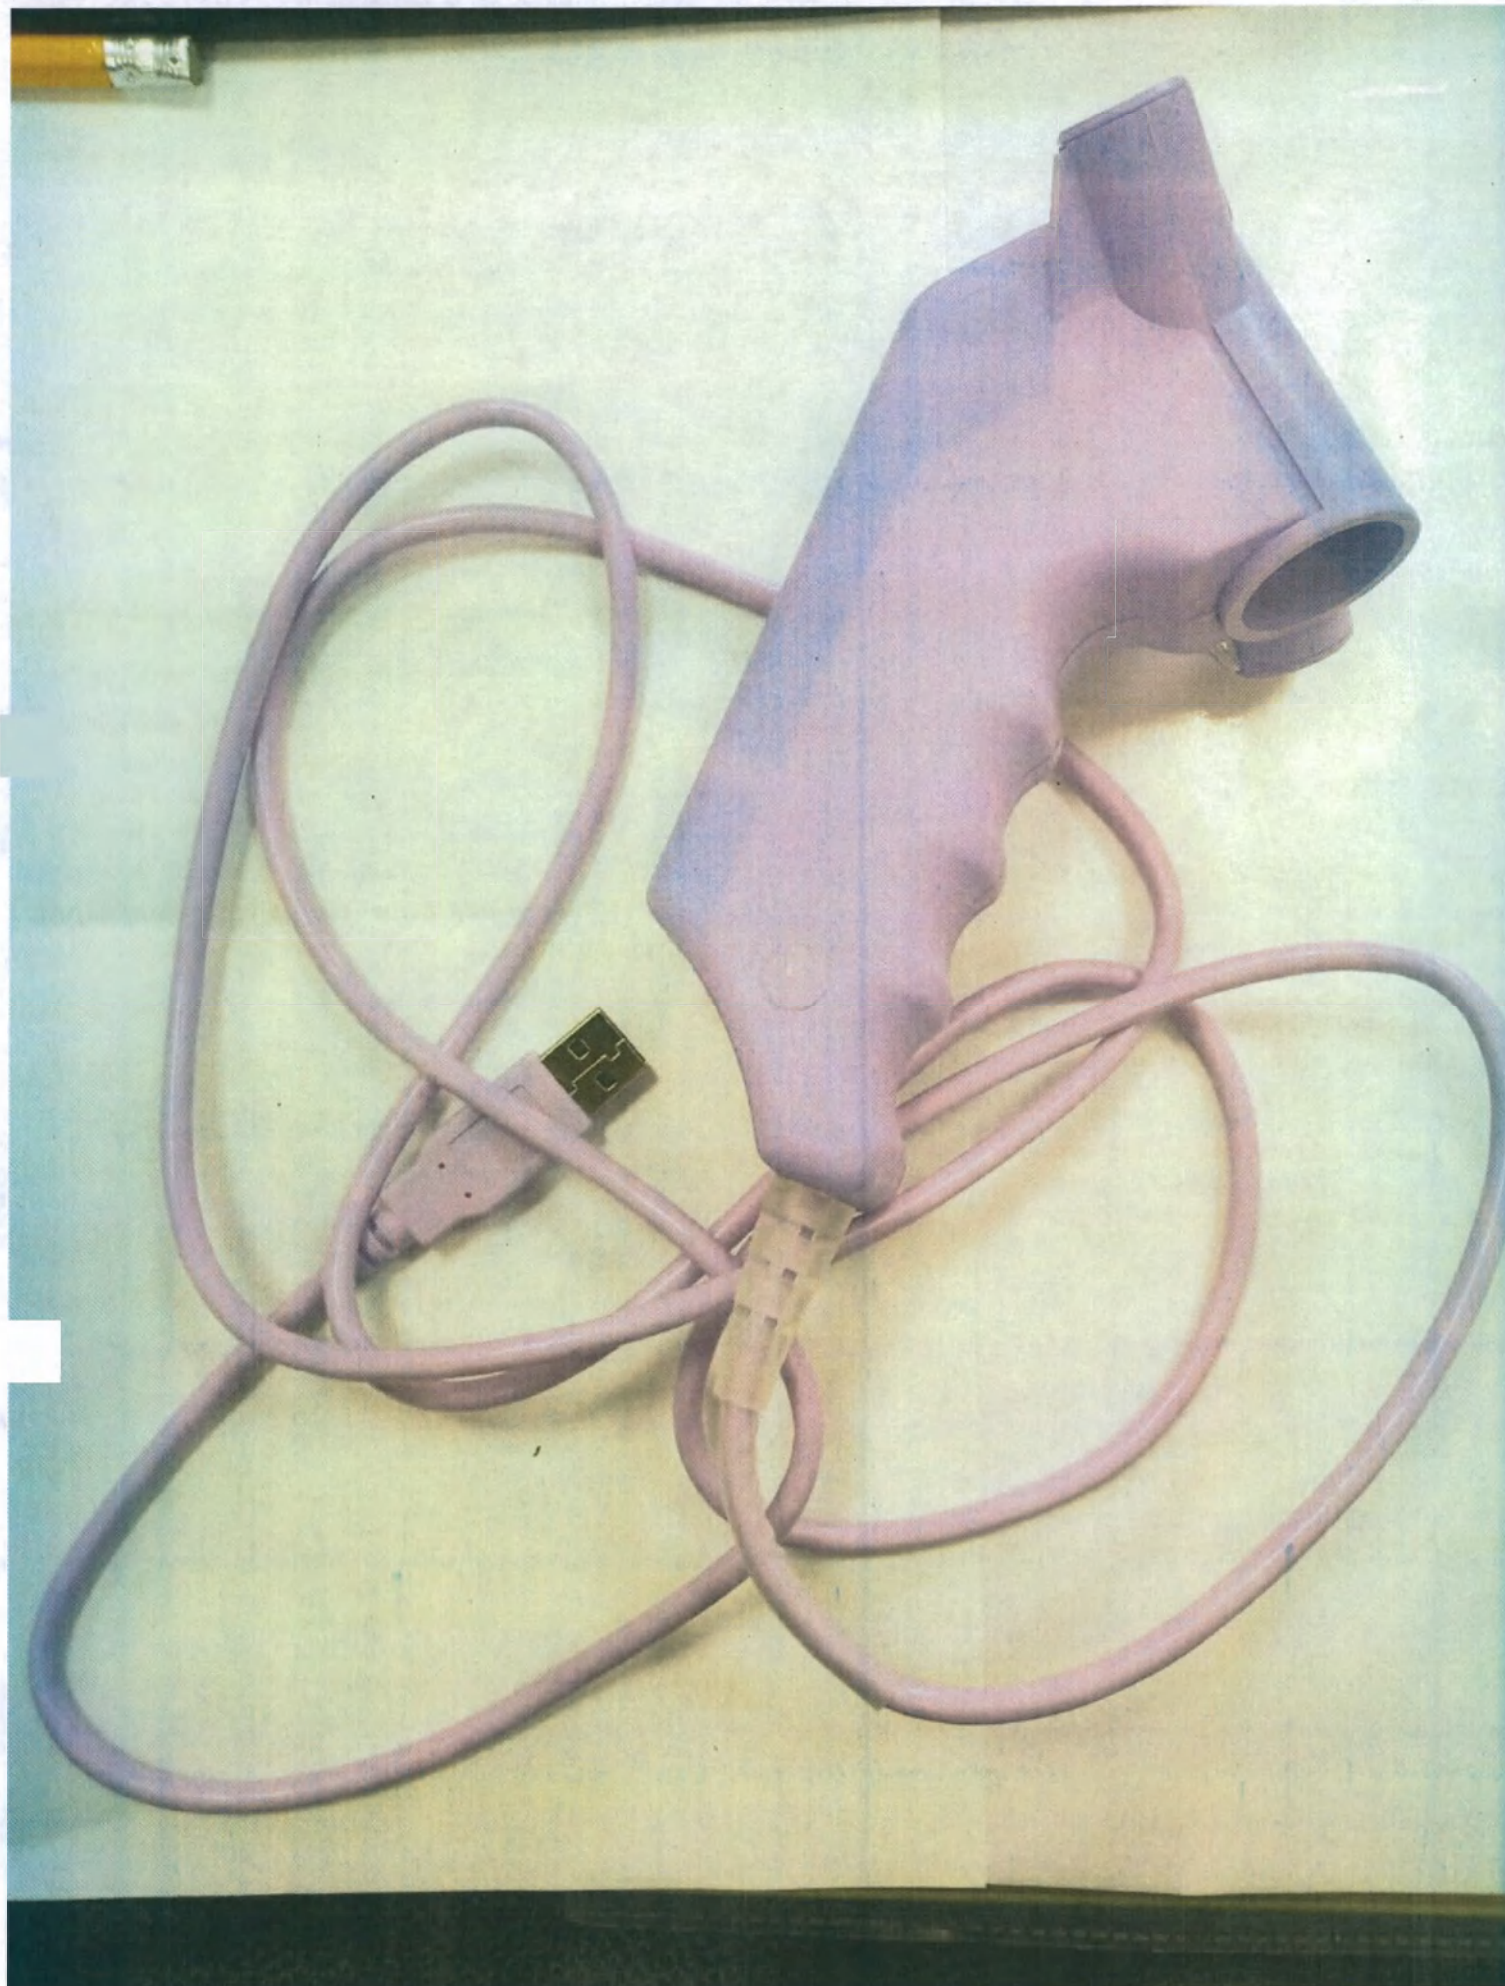


Фото 53.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client: 13. Спирометр Spiro-SP TrueFlow, производства NDD Medical
Technologies



Фото 54.

II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Client 14

Монитор артериального давления, SpO2 Tango M2



Фото 55.


II. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft Client: 15. Монитор амбулаторный артериального давления длительного



Фото 56.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

Viewer: 1. Программный пакет CardioSoft Viewer на оптических и/или электронных носителях



INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

или виртуальных или код активации на бумажном носителе с маркировкой



Фото 57.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 2. Защитный ключ

Фото 58.



GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Руководство оператора
Код продукта SSG

Версия программного обеспечения 7.0



Фото 59.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

CardioSoft Viewer: 4. Руководство оператора

GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Версия программного обеспечения 7.0

Руководство по установке и обновлению программного обеспечения

Фото 60.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных

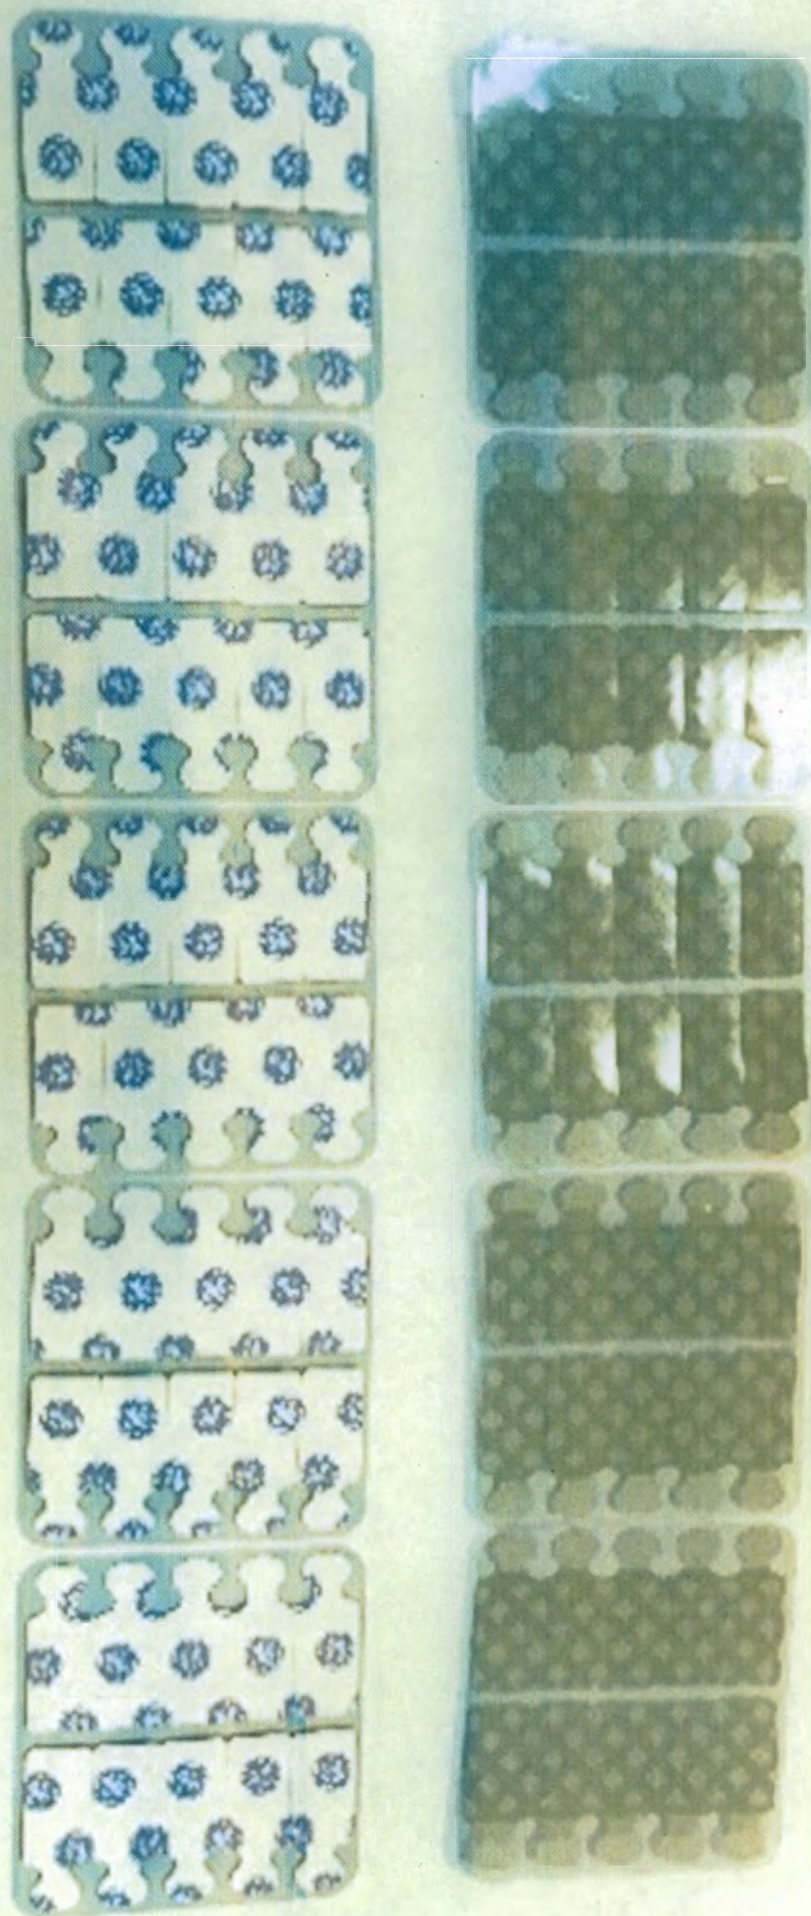


Фото 61.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft Viewer: 6. Электроды одноразовые детские.



Фото 63.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 8. Электроды одноразовые взрослые.



Фото 64.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 65.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных



Фото 66.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 11. Беговая дорожка T2100- ST2, производства Full Vision Inc



Фото 67.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 12. Велозргомметр eBike Basic, производства ergoline GmbH (ПУ №
РЗН 2017/6303)



Фото 68.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 12. Велозргометр eBike Comfort, производства ergoline GmbH (ПУ №
РЗН 2017/6303)



Фото 69.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 12. Велозргомметр eBike L, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН
2017/6303)



Фото 70.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 12. Велоэргометр eBike EL, производства ergoline GmbH (ПУ № РЗН
2017/6303)

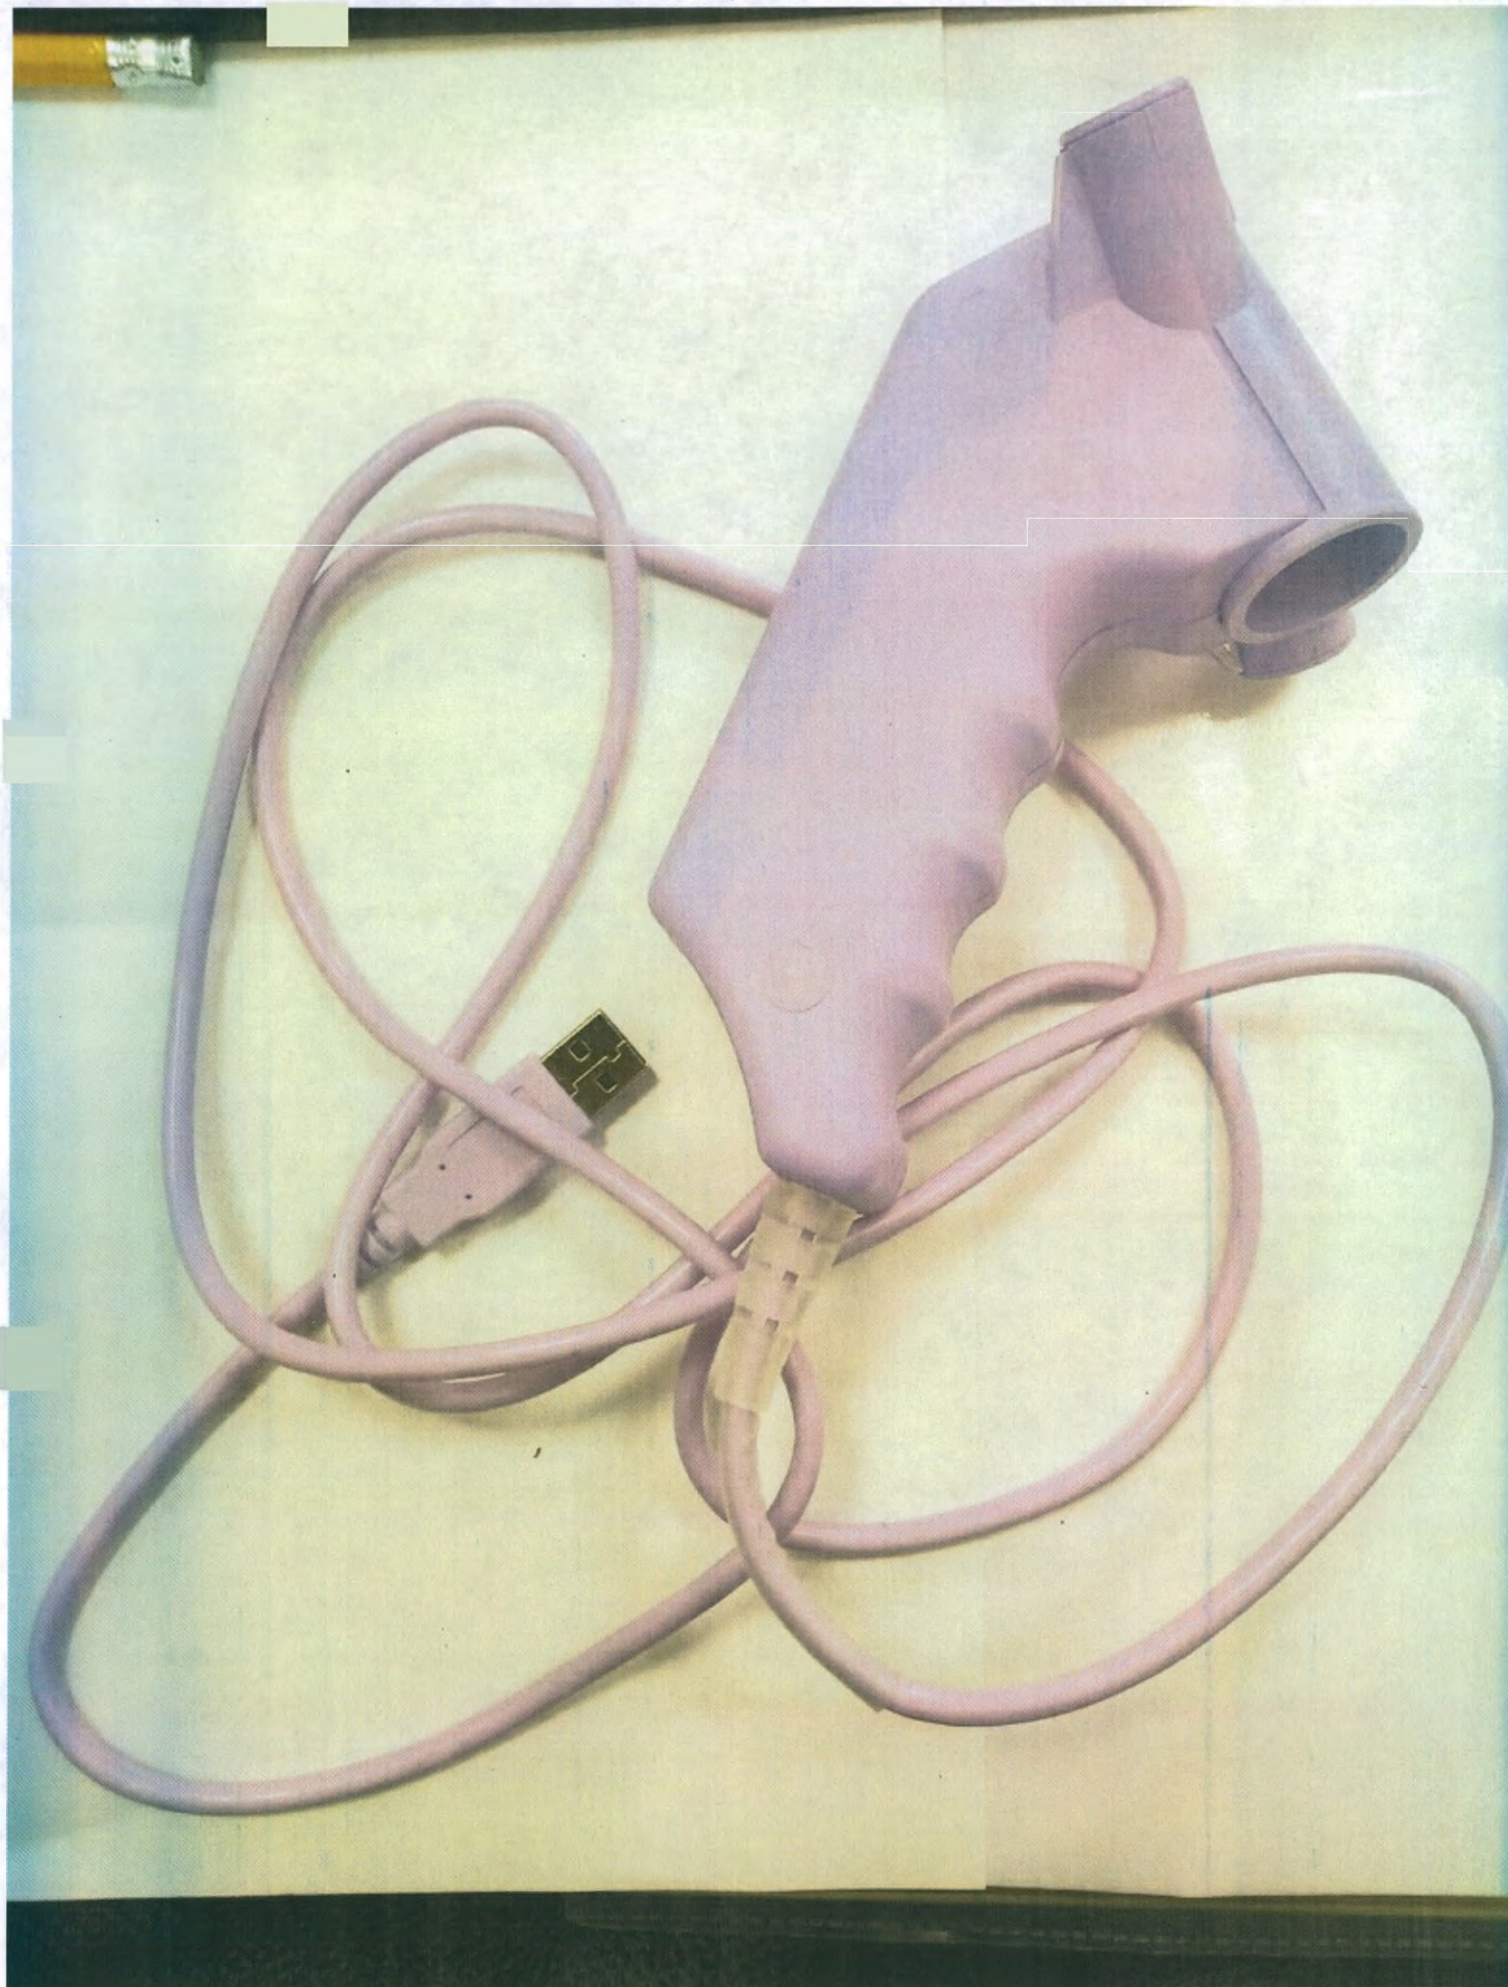


Фото 71.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 13. Спирометр Spiro-SP TrueFlow, производства NDD Medical
Technologies



Фото 72.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
CardioSoft Viewer: 14. Монитор артериального давления, SpO2 Tango M2



Фото 73.

III. Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных
 CardioSoft Viewer: 15. Монитор амбулаторный артериального давления длительного

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352237	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt.	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Print

Help

Фото 74.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 1. Программный ключ для активации

программного обеспечения интерпретации ЭКГ покоя на оптических и/или электронных

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Print

Help

Фото 75.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 2. Программный ключ для активации программного обеспечения гистерезис ST/ЧСС и интерпретация результатов теста с

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM DiCOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Print

Help

Фото 76.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 3. Программный ключ для активации программного обеспечения гистерезис ST/ЧСС на оптических и/или электронных

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt)	717463343454	15
	ERGM Remote View	014625276277	15
	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
	CDRW Archive to External Media		15

Print

Help

Фото 77.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 4. Программный ключ для активации программного обеспечения оценки факторов риска на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	670022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Print

Help

Фото 78.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 5. Программный ключ для активации программного обеспечения измерение ЭКГ покоя на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Print

Help

Фото 79.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 6. Программный ключ для активации программного обеспечения сохранения полного отчета ЭКГ на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Codes** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exero	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Print

Help

Фото 80.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 7. Программный ключ для активации программного обеспечения история ЭКГ на оптических и/или электронных носителях или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DOP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677481230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767427644	15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Print

Help

Фото 81.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 8. Программный ключ для активации программного обеспечения выявления и документирования аритмий на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
	ECGH ECG History (requires acquisition module/h	727336473471	15
	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
	CDRW Archive to External Media		15
	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
	XEMR EMR Interface	755767423644	15
	DICM DICOM Interface	756750374301	15
	ESPI Ergospirometry		15
	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 82.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 9. Программный ключ для активации программного обеспечения комбинированной опции табличного итогового отчета и

System Configuration

General Devices Modem MUSE Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	4022607732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Фото 83.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 10. Программный ключ для активации

программного обеспечения изменения Т-зубца на оптических и/или электронных

носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Options** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exero	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	214575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	378016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 84.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 11. Программный ключ для активации программного обеспечения восстановления предыдущего теста на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NET5 Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	6331104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	TESTS Exercise Test Export Mode (requires Exerci	2473103455087	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765243	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211706624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Фото 85.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 12. Программный ключ для активации программного обеспечения тест с нагрузкой и экспертный режим теста с нагрузкой на носителях и/или виртуальных и/или код активации на

System Configuration

General Devices Modem MUSE **CardioSoft** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425106	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	20WF 20 Waveform Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211706624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Фото 86.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 13. Программный ключ для активации программного обеспечения каскадного экрана в двумерном изображении на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном

System Configuration

General Devices Modem MUSE **System Config** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt	712463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☐	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☐	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module h	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Фото 87.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 14. Программный ключ для активации программного обеспечения теста с нагрузкой на оптических и/или электронных носителях или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **System Options** Country Settings DICOM DCF Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452067	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWPD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICOM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY STHR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 88.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 15. Программный ключ для активации DICOM-

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Options** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exero)	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477246517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106785241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPO Export Data as EXCEL	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWORD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342241726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 89.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 16. Программный ключ для активации

программного обеспечения экспорта данных в форматах Excel или XML на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Options** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exero	247340452657	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection - Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWWD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 90.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 17. Программный ключ для активации программного обеспечения экспорта отчета как файла Word на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **System Configuration** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EXPD Export Report as PDF	217055526657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726063	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI Ergospirometry		15
☒	STHR ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 91.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 18. Программный ключ для активации программного обеспечения экспорта отчета как файла PDF на оптических и/или

System Configuration

General Devices Modern MUSE Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
✗	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exero	247340452667	15
✗	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
✗	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
✗	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
✗	MUSE Browser	437106765241	15
✗	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
✗	ECGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
✗	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
✗	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
✗	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
✗	CDRW Archive to External Media		15
✗	DSPC Screen Display Configuration	342243726061	15
✗	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013	15
✗	ITRD In-Test Trend	631744371607	15
✗	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653	15
✗	XEMR EMR Interface	755767423644	15
✗	DICM DICOM Interface	756750374301	15
✗	ESPI Ergospirometry		15
✗	STHY ST/HR hysteresis	721547003466	15
✗	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 92.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 19. Программный ключ для активации программного обеспечения браузер MUSE на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt	717463343454	15
☒	ERGM Remote View	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/ft	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Фото 93.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 20. Программный ключ для активации программного обеспечения сохранения данных на сетевом сервере на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DIOOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt	717463343454	15
☒	EGMO Remote ECG	014625276277	15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser	662225425105	15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser	415552224360	15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci	247340452667	15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	EOGH ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW Archive to External Media		15

Фото 94.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 21. Программный ключ для активации

программного обеспечения удаленного просмотра на оптических и/или электронных

Install CASE Application

The CASE application should be installed on all CASE workstations. Do not install it on the server.

CAUTIONS

- Install the application only after you configure the CardioSoft network ("Configure the Network" on page 3-23) and save the existing data ("Save Existing Data" on page 3-33).
- Install the application on **ONLY ONE** workstation at a time. Attempting to install it on more than one workstation at the same time may corrupt the installation on **ALL** workstations.

Choose to use either a UNC path or a mapped drive to access the CardioSoft server.

Network Installation using UNC:

1. Log in as local Admin.
2. To install the CASE V7.0 application, launch setup.exe in the directory *C:\Support Software\CASE V7.0\CASE*.
3. At the *Choose Program Files Destination* screen (default *D:\CASE*), click *Next*.
 - At the *Choose Database Destination* screen (default *D:\CASE*), select *Browse*.
 - Do not enter the UNC path directly but select *Network* and browse to the CardioSoft server.
 - Double-click the server name and enter User Name and Password of the Network User.
 - If the CASE system is part of a Domain, then enter [Domain Name] \ [Network User].
 - Now select the shared folder *cardio*.
 - Verify that the UNC path name of the shared folder *cardio* (e.g. *server\cardio*) is displayed in the *Path* edit box.
 - Click *Confirm*.

NOTE

If a network error message is shown, ensure that the server firewall does not block the incoming request.

4. Finish the installation and reboot the system as prompted.

NOTE

If Expert Mode was enabled at the beginning of the installation procedure, the Application Data directory can be selected on a *CITRIX* server. This directory contains CASE-related files, such as configuration and log files. By default, the Application Data directory is set to *D:\CASE*.

Network Installation using a mapped drive:

1. Log in as local Admin.
2. Map the next available drive letter (e.g. *F:*) to the *cardio* shared folder on the CardioSoft server.

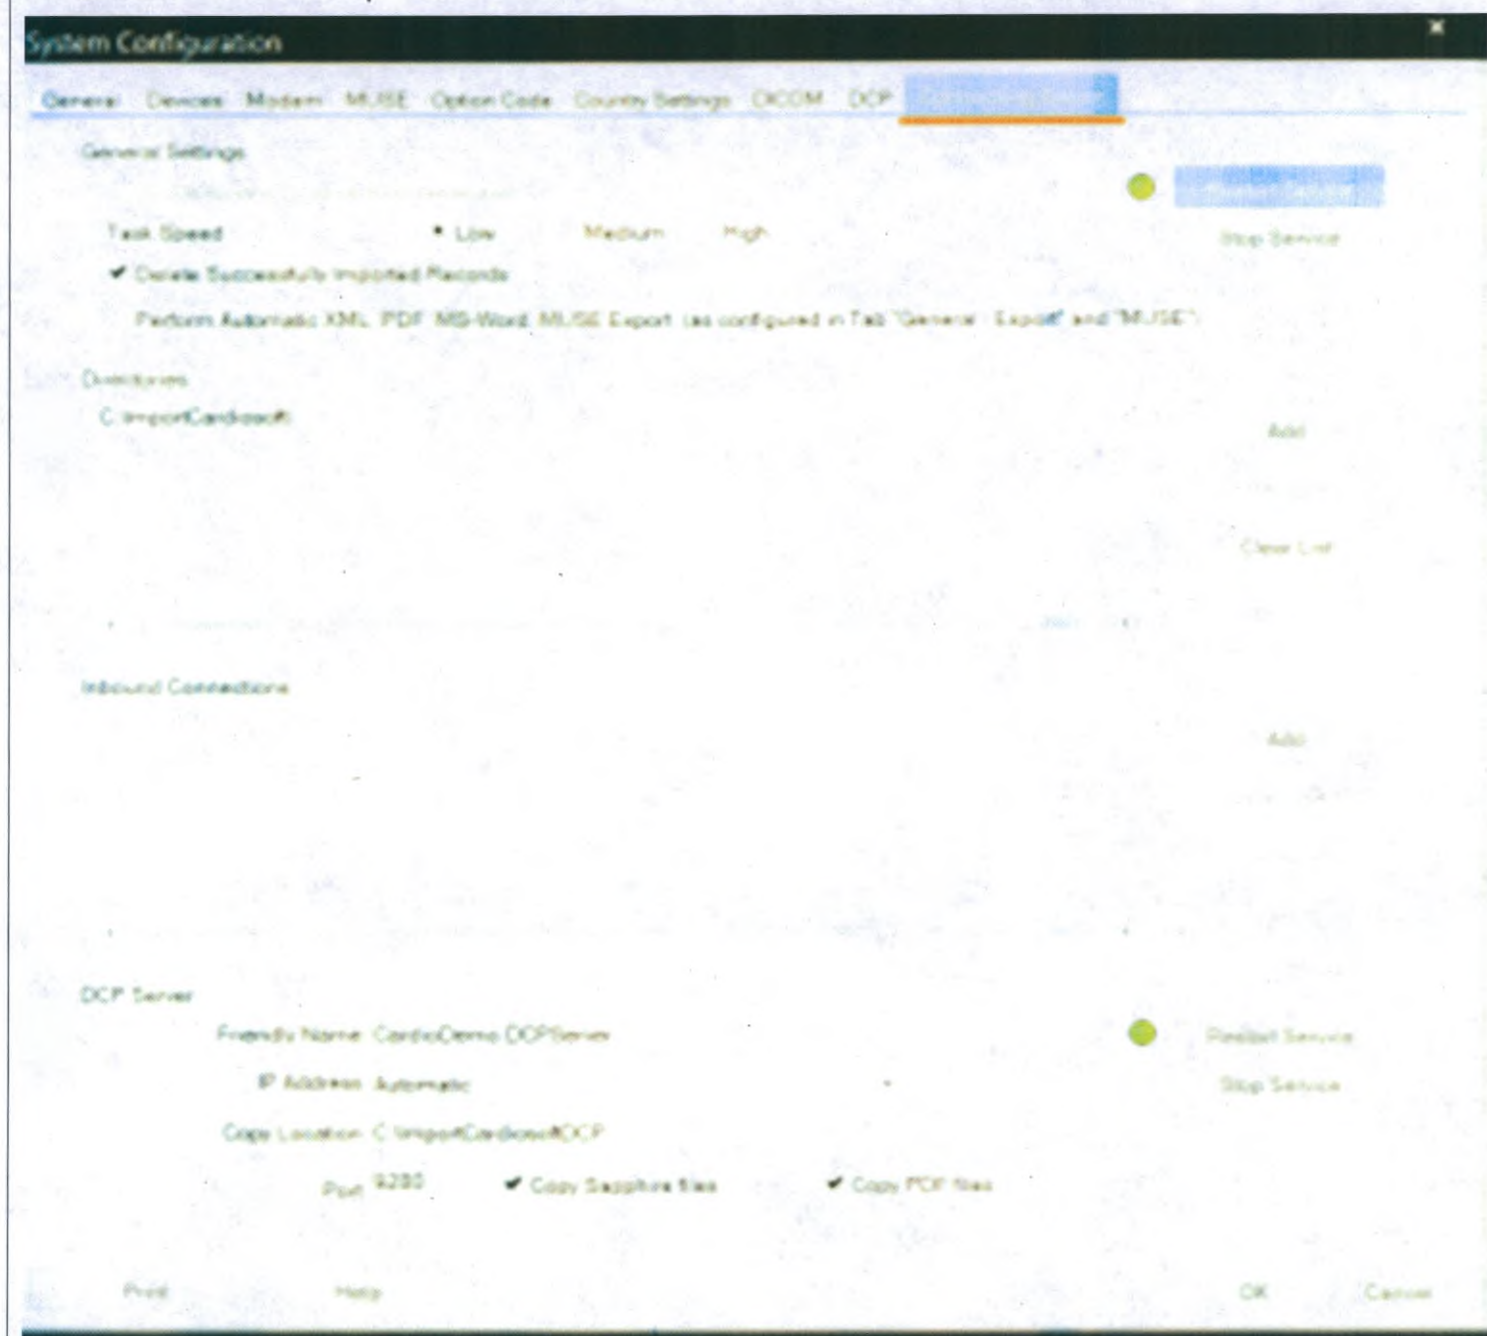


Фото 96.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 23. Программный ключ для активации программного обеспечения сервера соединений на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

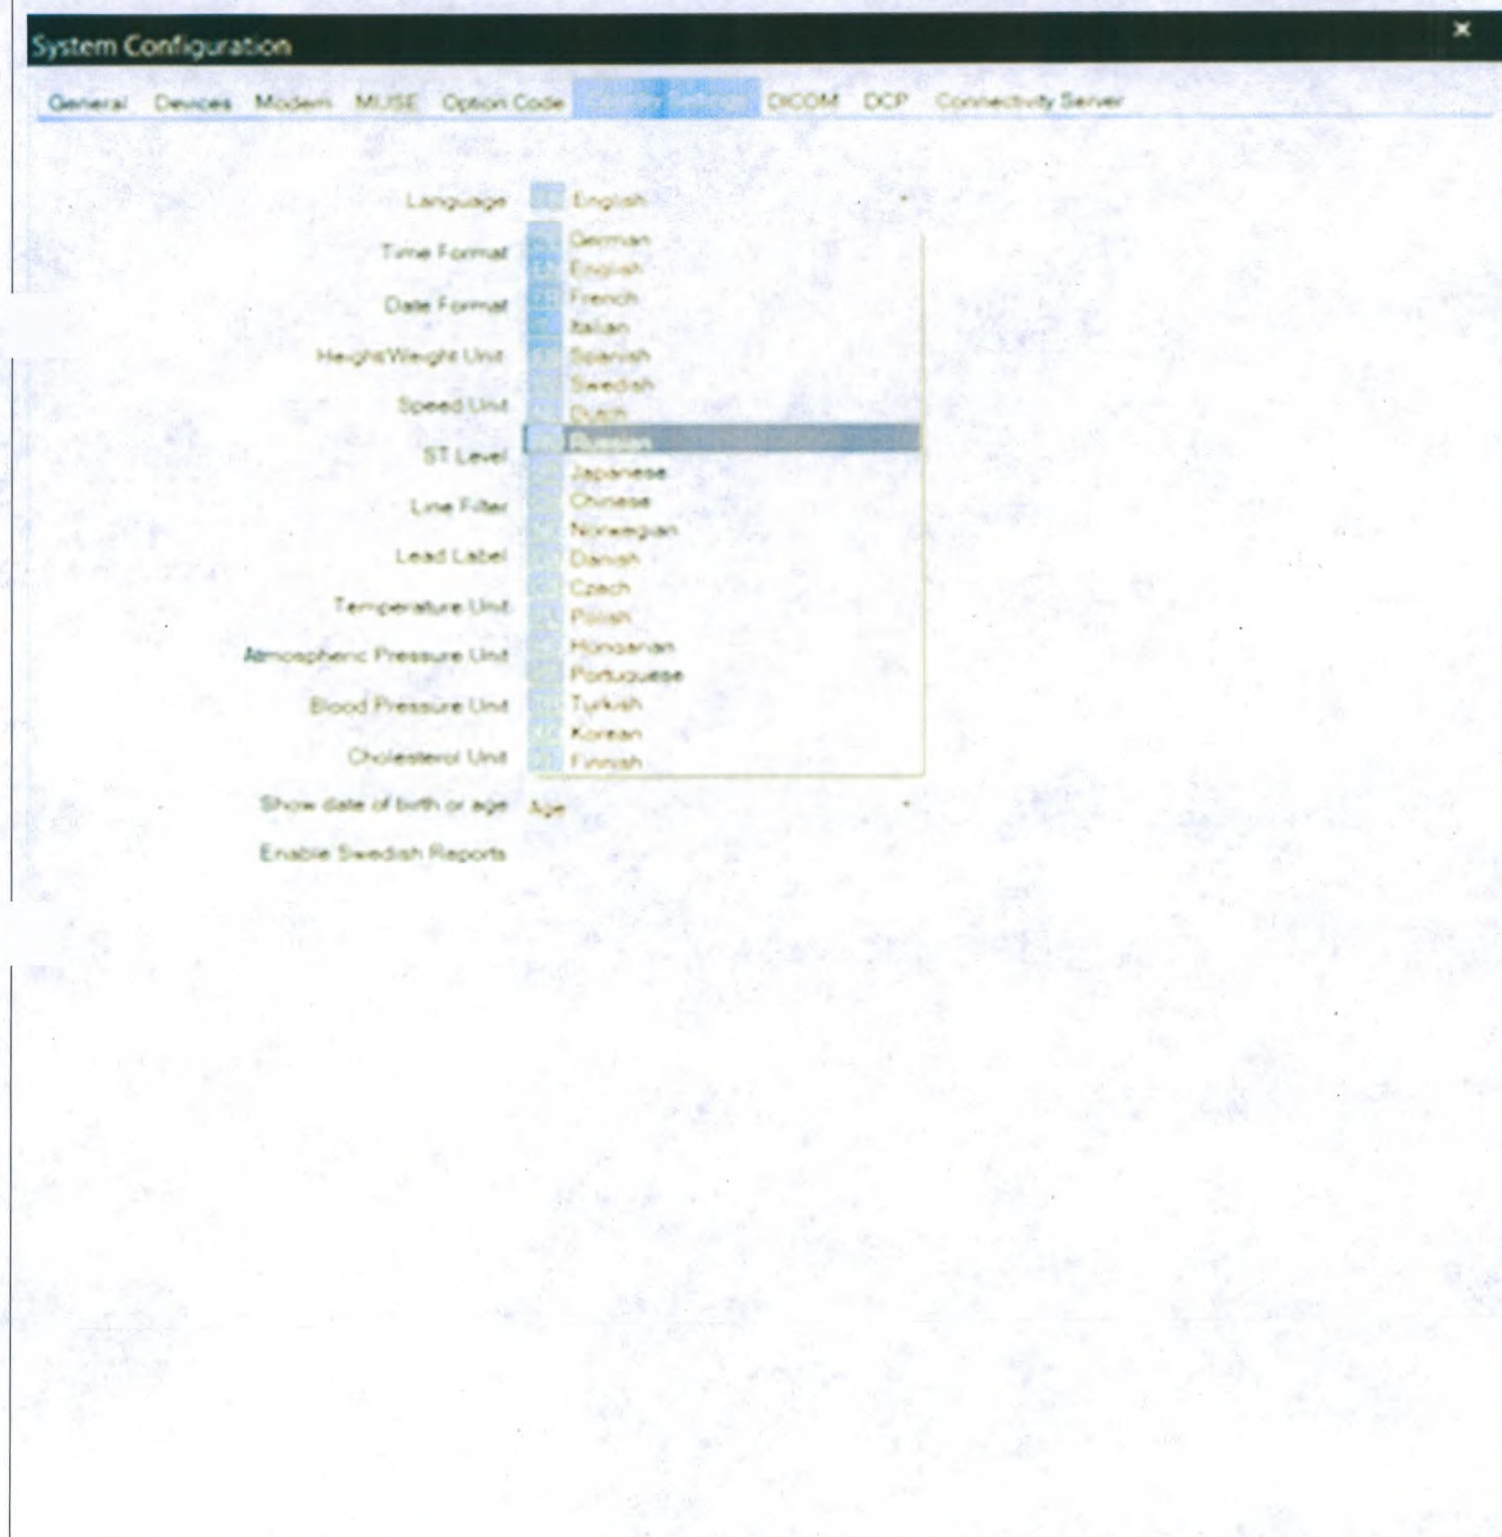


Фото 97.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 24. Программный пакет русскоязычного

System Configuration

General Devices Modem MUSE Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware k	123 15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	123 15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	123 15
☒	BRWS	MUSE Browser	123 15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	123 15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition mo	123 15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	123 15
☒	EPDF	Export Report as PDF	123 15
☒	EWRD	Export Report as WORD	123 15
☒	CDRW	Archive to External Media	123 15
☒	DSPC	Screen Display Configuration	123 15
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	123 15
☒	ITRD	In-Test Trend	123 15
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	123 15
☒	XEMR	EMR Interface	123 15
☒	FLLX	Floating License for number of users 0	123 15
☒	DICM	DICOM Interface	123 15
☒	ESPI	Ergospirometry	123 15
☒	STHY	ST/HR hysteresis	123 15
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	123 15

Фото 98.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 25. Программный ключ для активации программного обеспечения интерфейс EMR (XEMR) на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **System Config** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware k	123	15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	123	15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	123	15
☒	BRWS MUSE Browser	123	15
☒	RISK Risk Factors and Scores	123	15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition mo	123	15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	123	15
☒	EPDF Export Report as PDF	123	15
☒	EWRD Export Report as WORD	123	15
☒	CDRW Archive to External Media	123	15
☒	DSPC Screen Display Configuration	123	15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	123	15
☒	ITRD In-Test Trend	123	15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	123	15
☒	XZMR EMI Interface	123	15
☒	FLLX Floating License for number of users 0	123	15
☒	DICM DICOM Interface	123	15
☒	ESPI Ergospirometry	123	15
☒	STHY STHR hysteresis	123	15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	123	15

Фото 99.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 26. Программный ключ для активации программного обеспечения для проведения спирометрических тестов на оптических и/или электронных носителях и/или виртуальных и/или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Configuration** Country Settings DICOM DCF Connectivity Server

		Option Code	Expiration
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware &	123
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	123
☒	2DWF	2D Waveform Display	123
☒	BRWS	MUSE Browser	123
☒	RISK	Risk Factors and Scores	123
☒	ECGH	ECG History (requires expansion mo	123
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	123
☒	EPCF	Export Report as PDF	123
☒	EWWD	Export Report as WORD	123
☒	CDRW	Archive to External Media	123
☒	DSFC	Screen Display Configuration	123
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	123
☒	ITRD	In-Test Trend	123
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	123
☒	XEMR	EMR Interface	123
☒	FLLX	Floating License for number of users	0 123
☒	DICM	DICOM Interface	123
☒	ESPI	Ergonomics	123
☒	STHR	STHR System	123
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	123

Фото 100.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

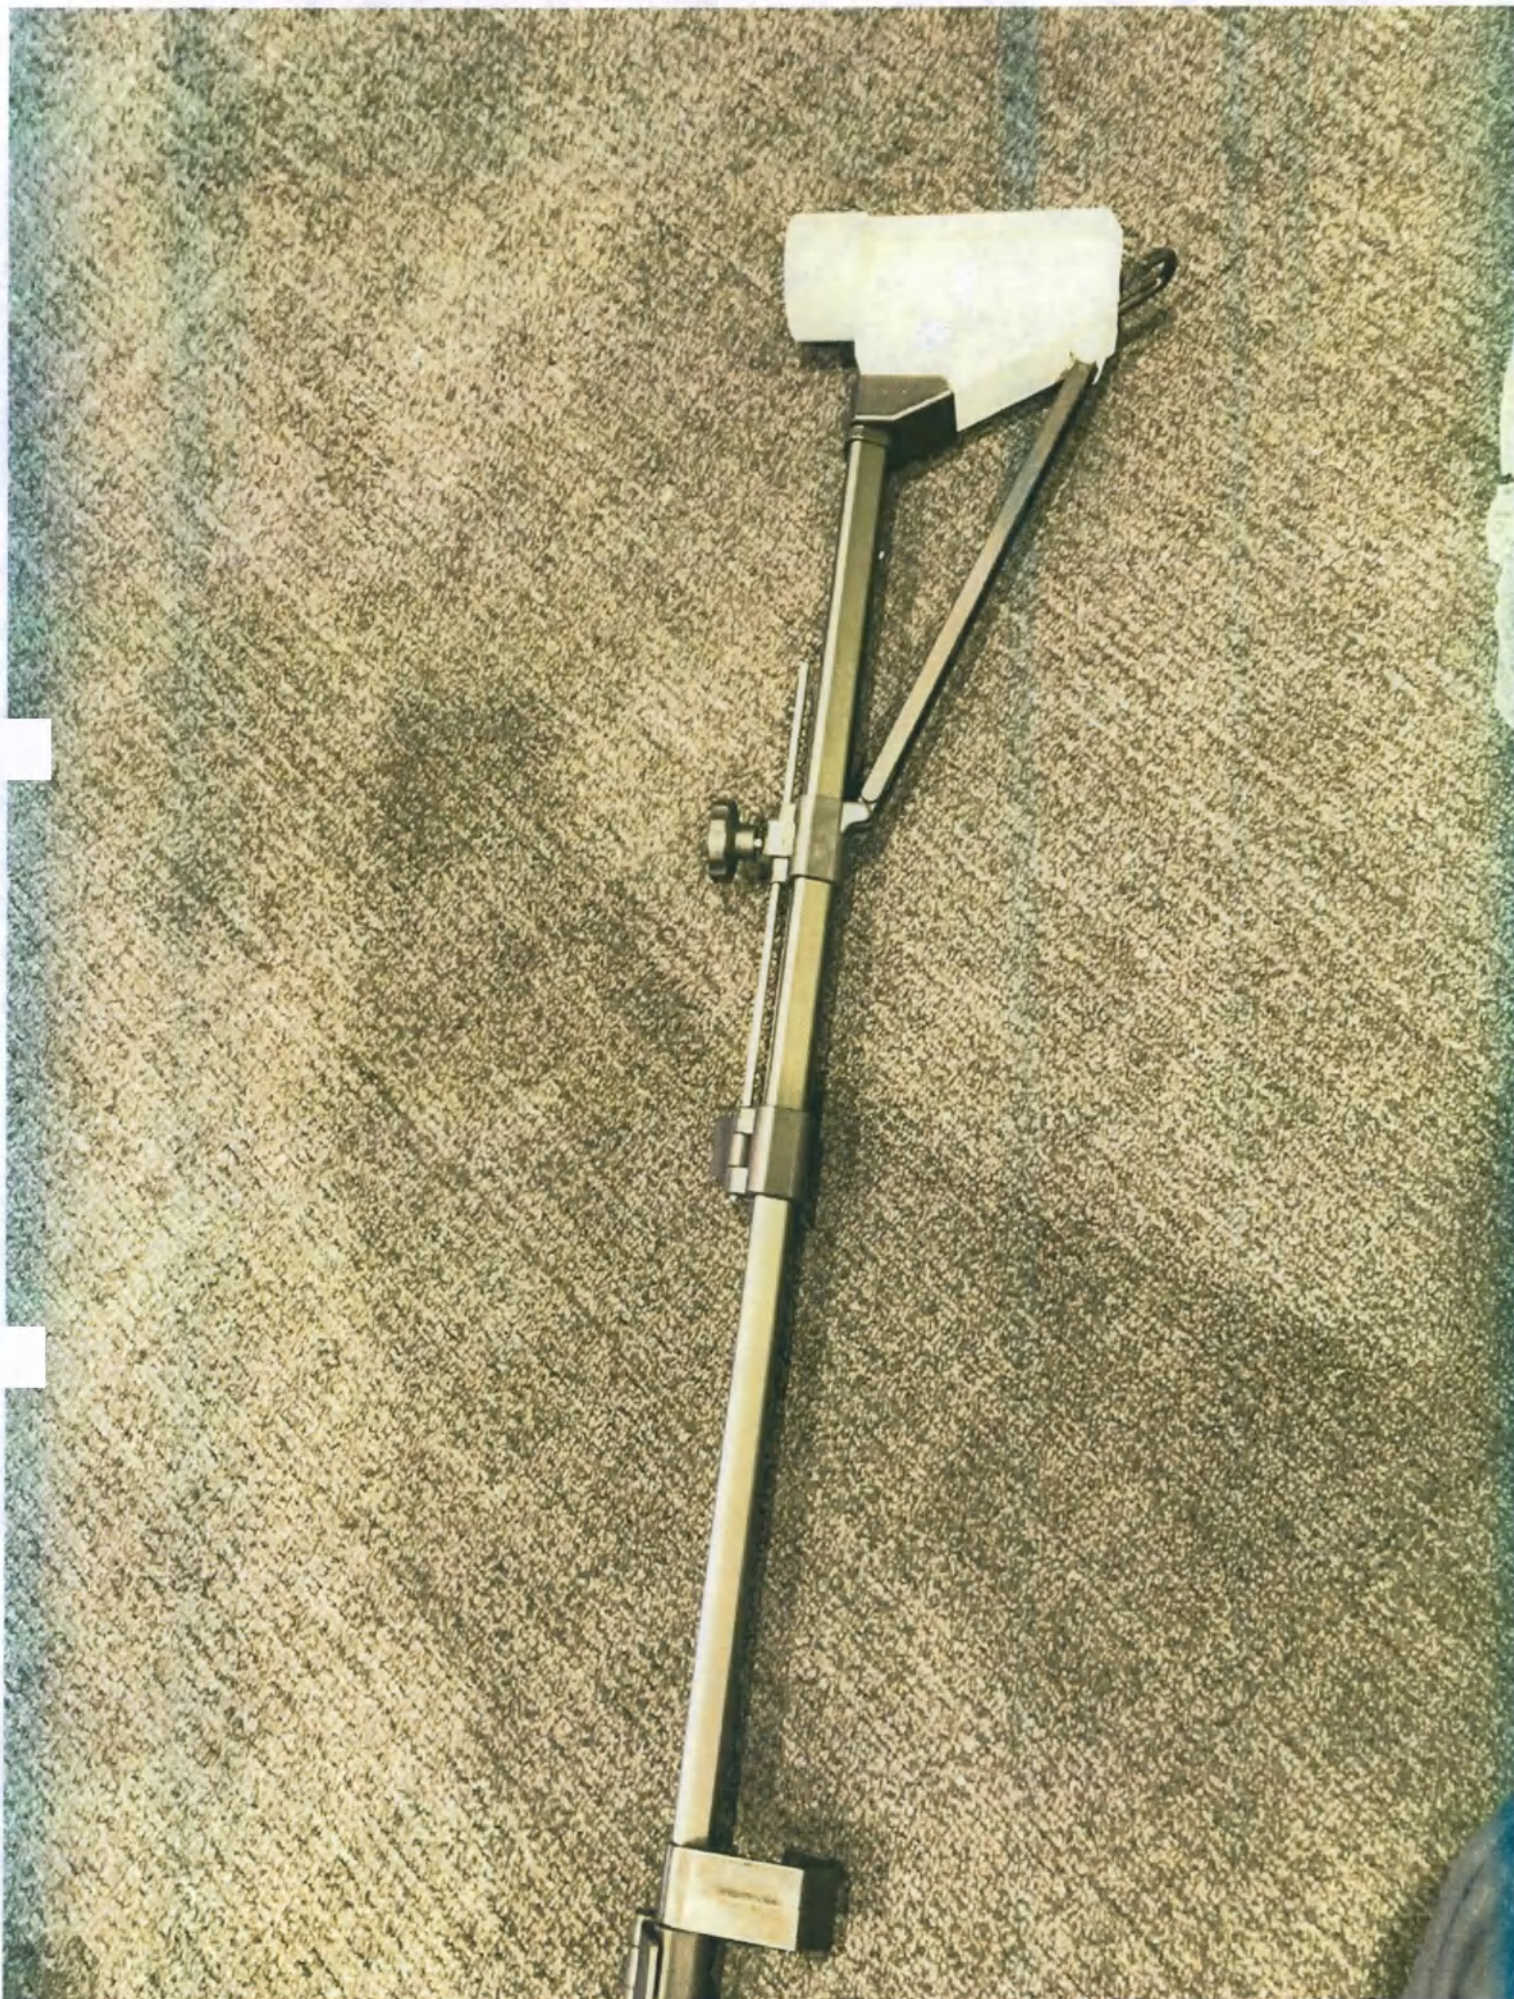


Фото 101.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

с принадлежностями. Принадлежности: 28. Кронштейн поворотный к системе наложения электродов KISS.

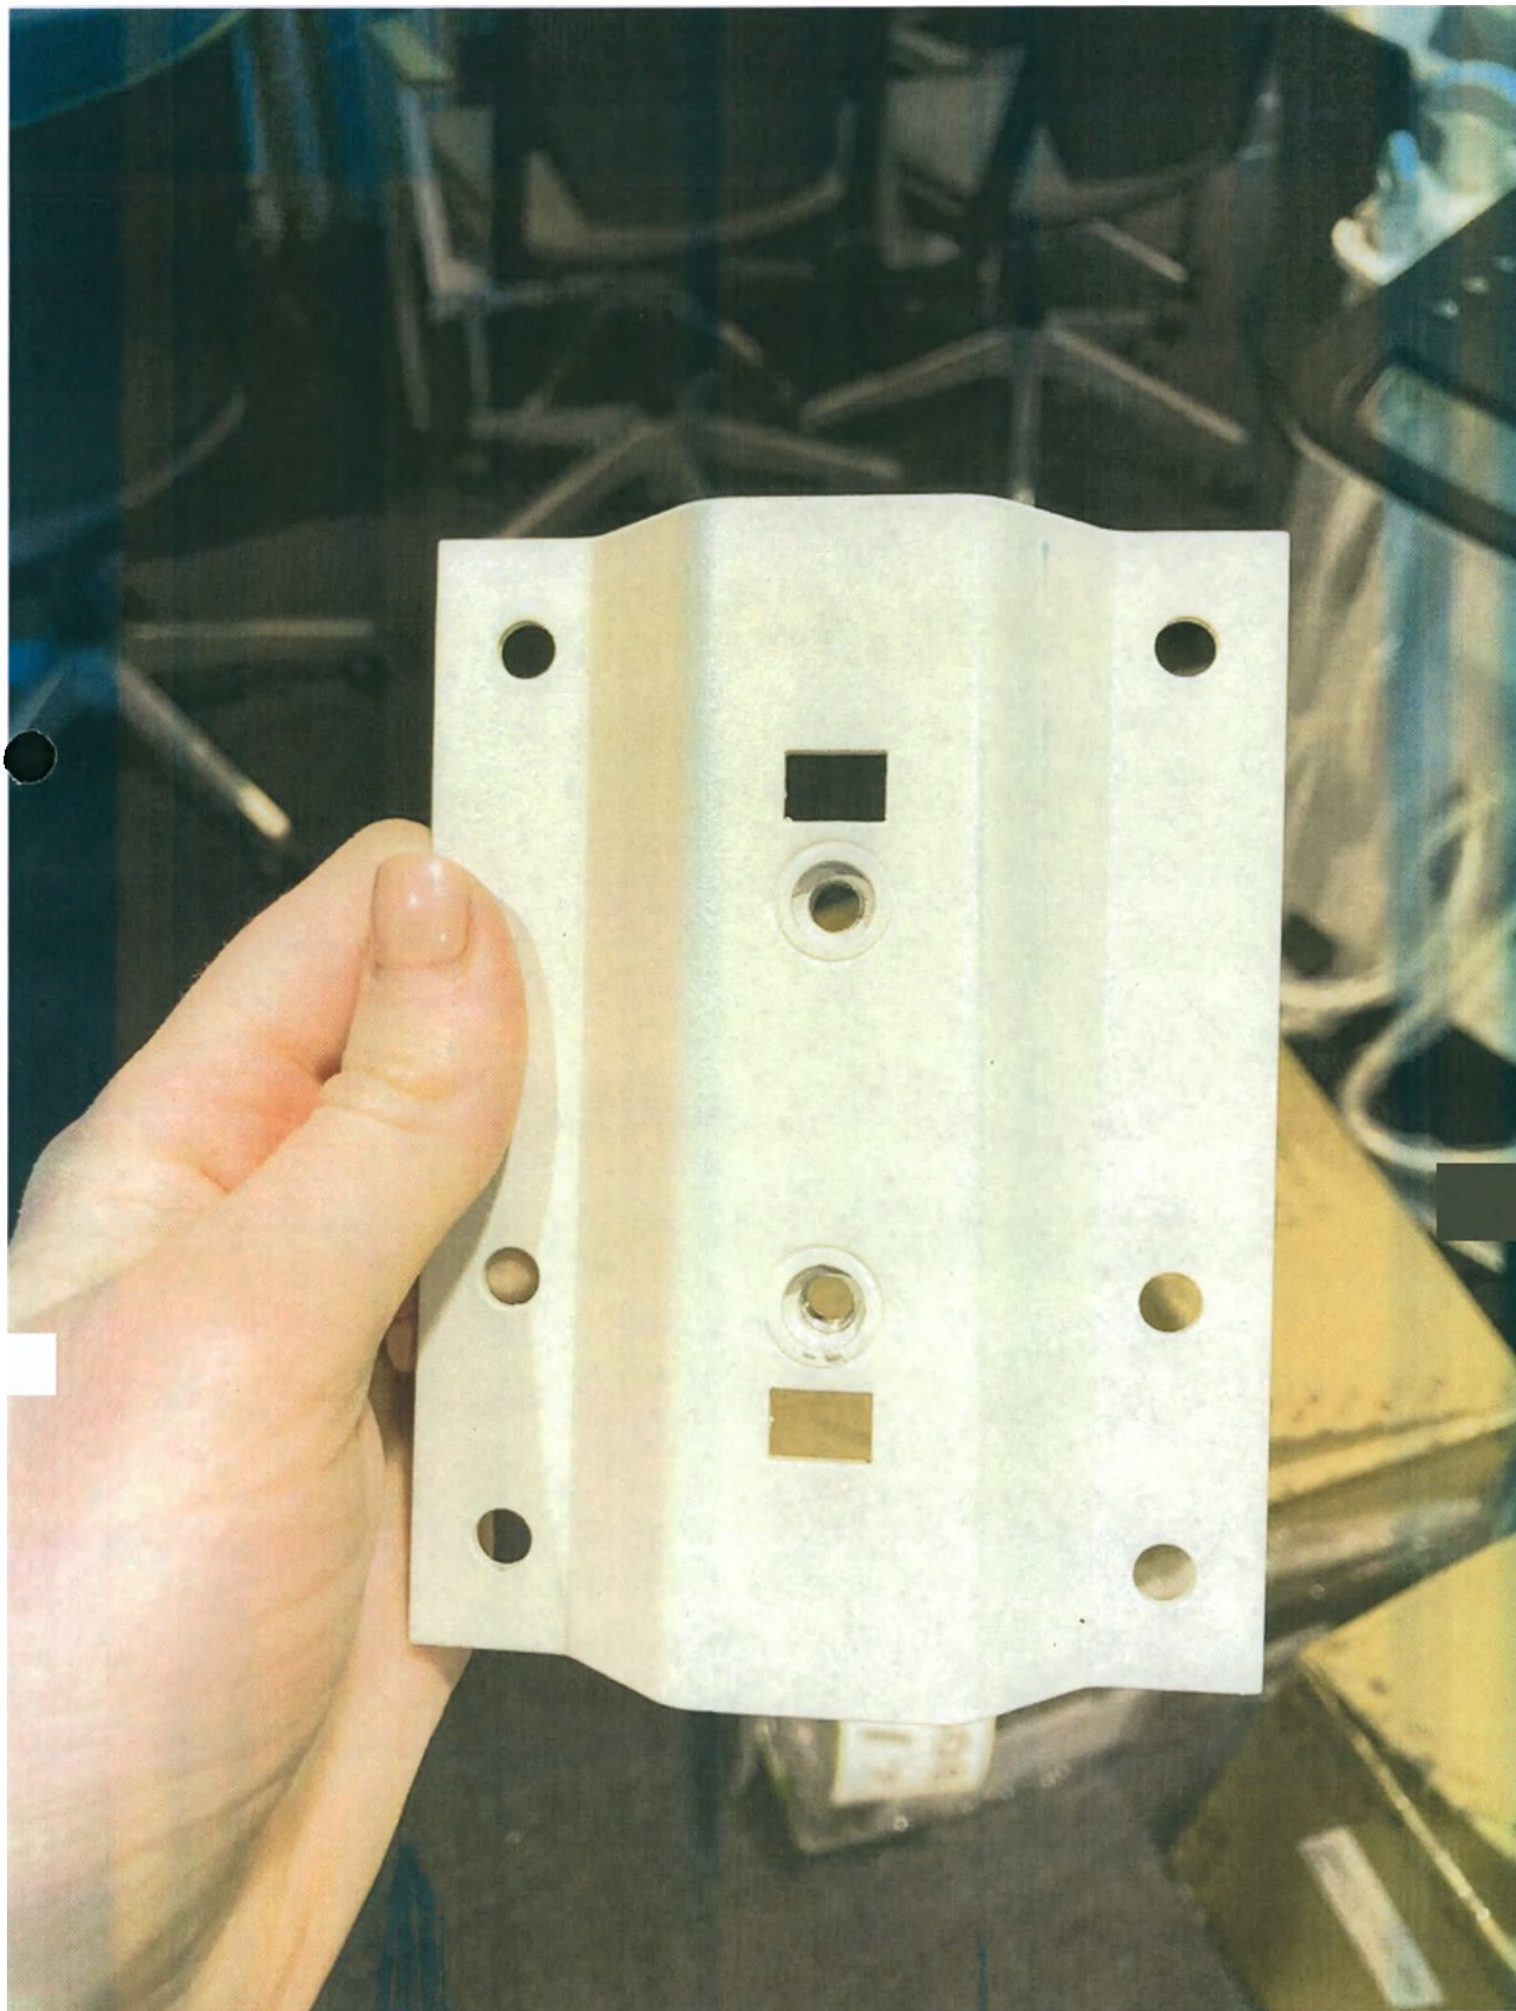


Фото 102.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft



Фото 103.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft[®]
с принадлежностями: Принадлежности: 30. Крепление настольное для системы
наложения электродов KISS.

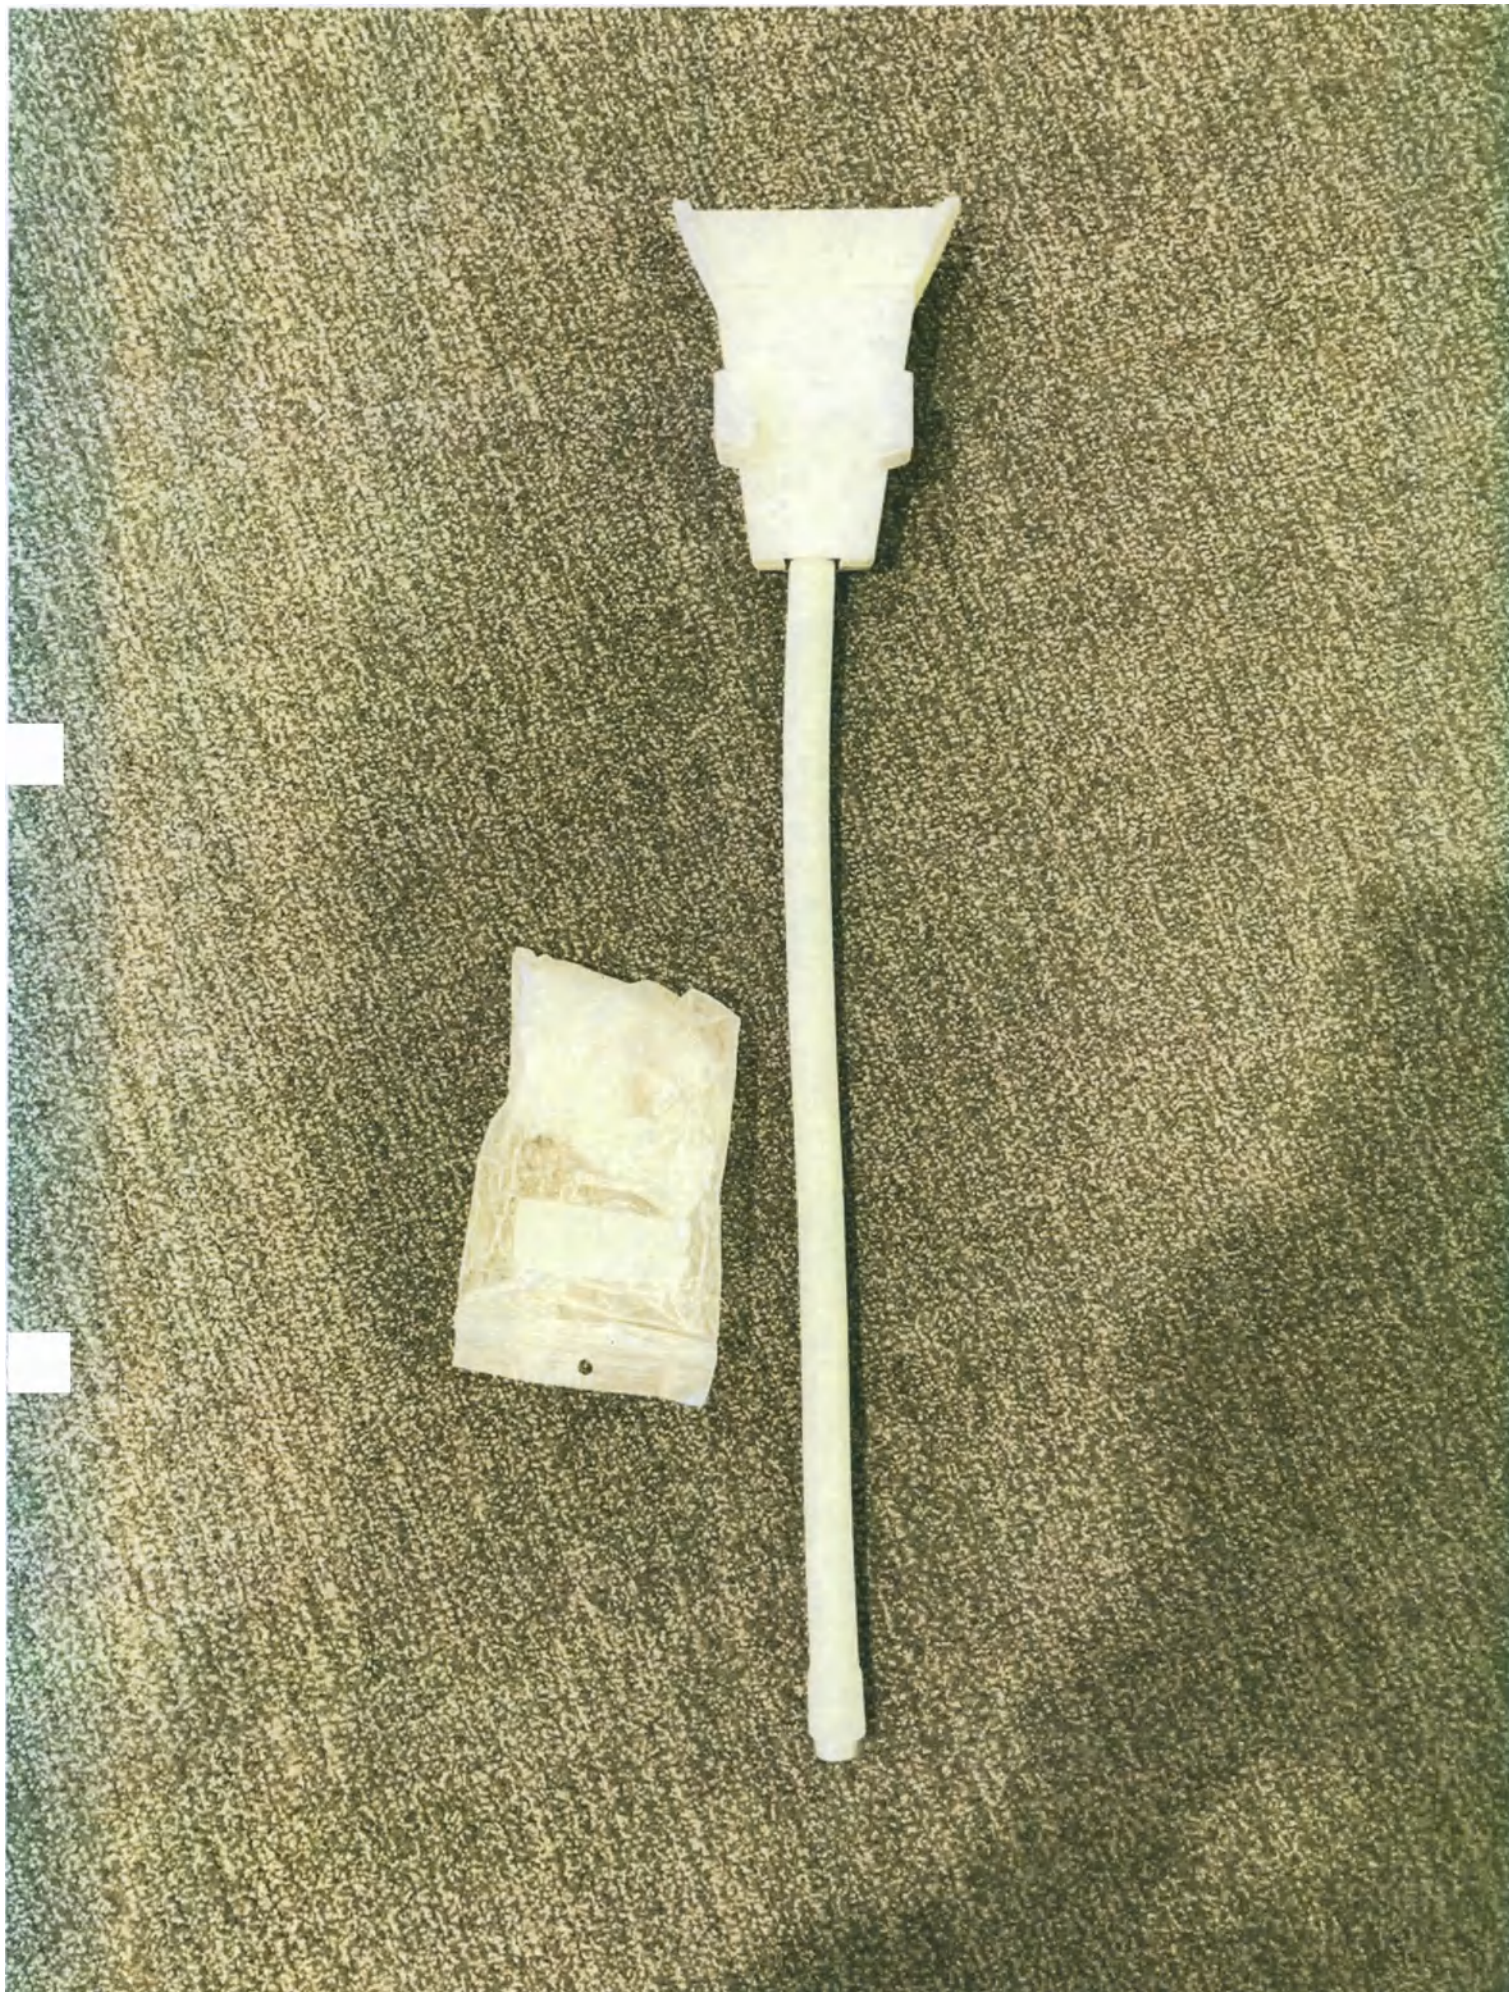


Фото 104.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 31. Крепление на велоэргометре для наложения
электродов KISS.



Фото 105.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 32. Адаптеры - переходники для системы наложения электродов KISS

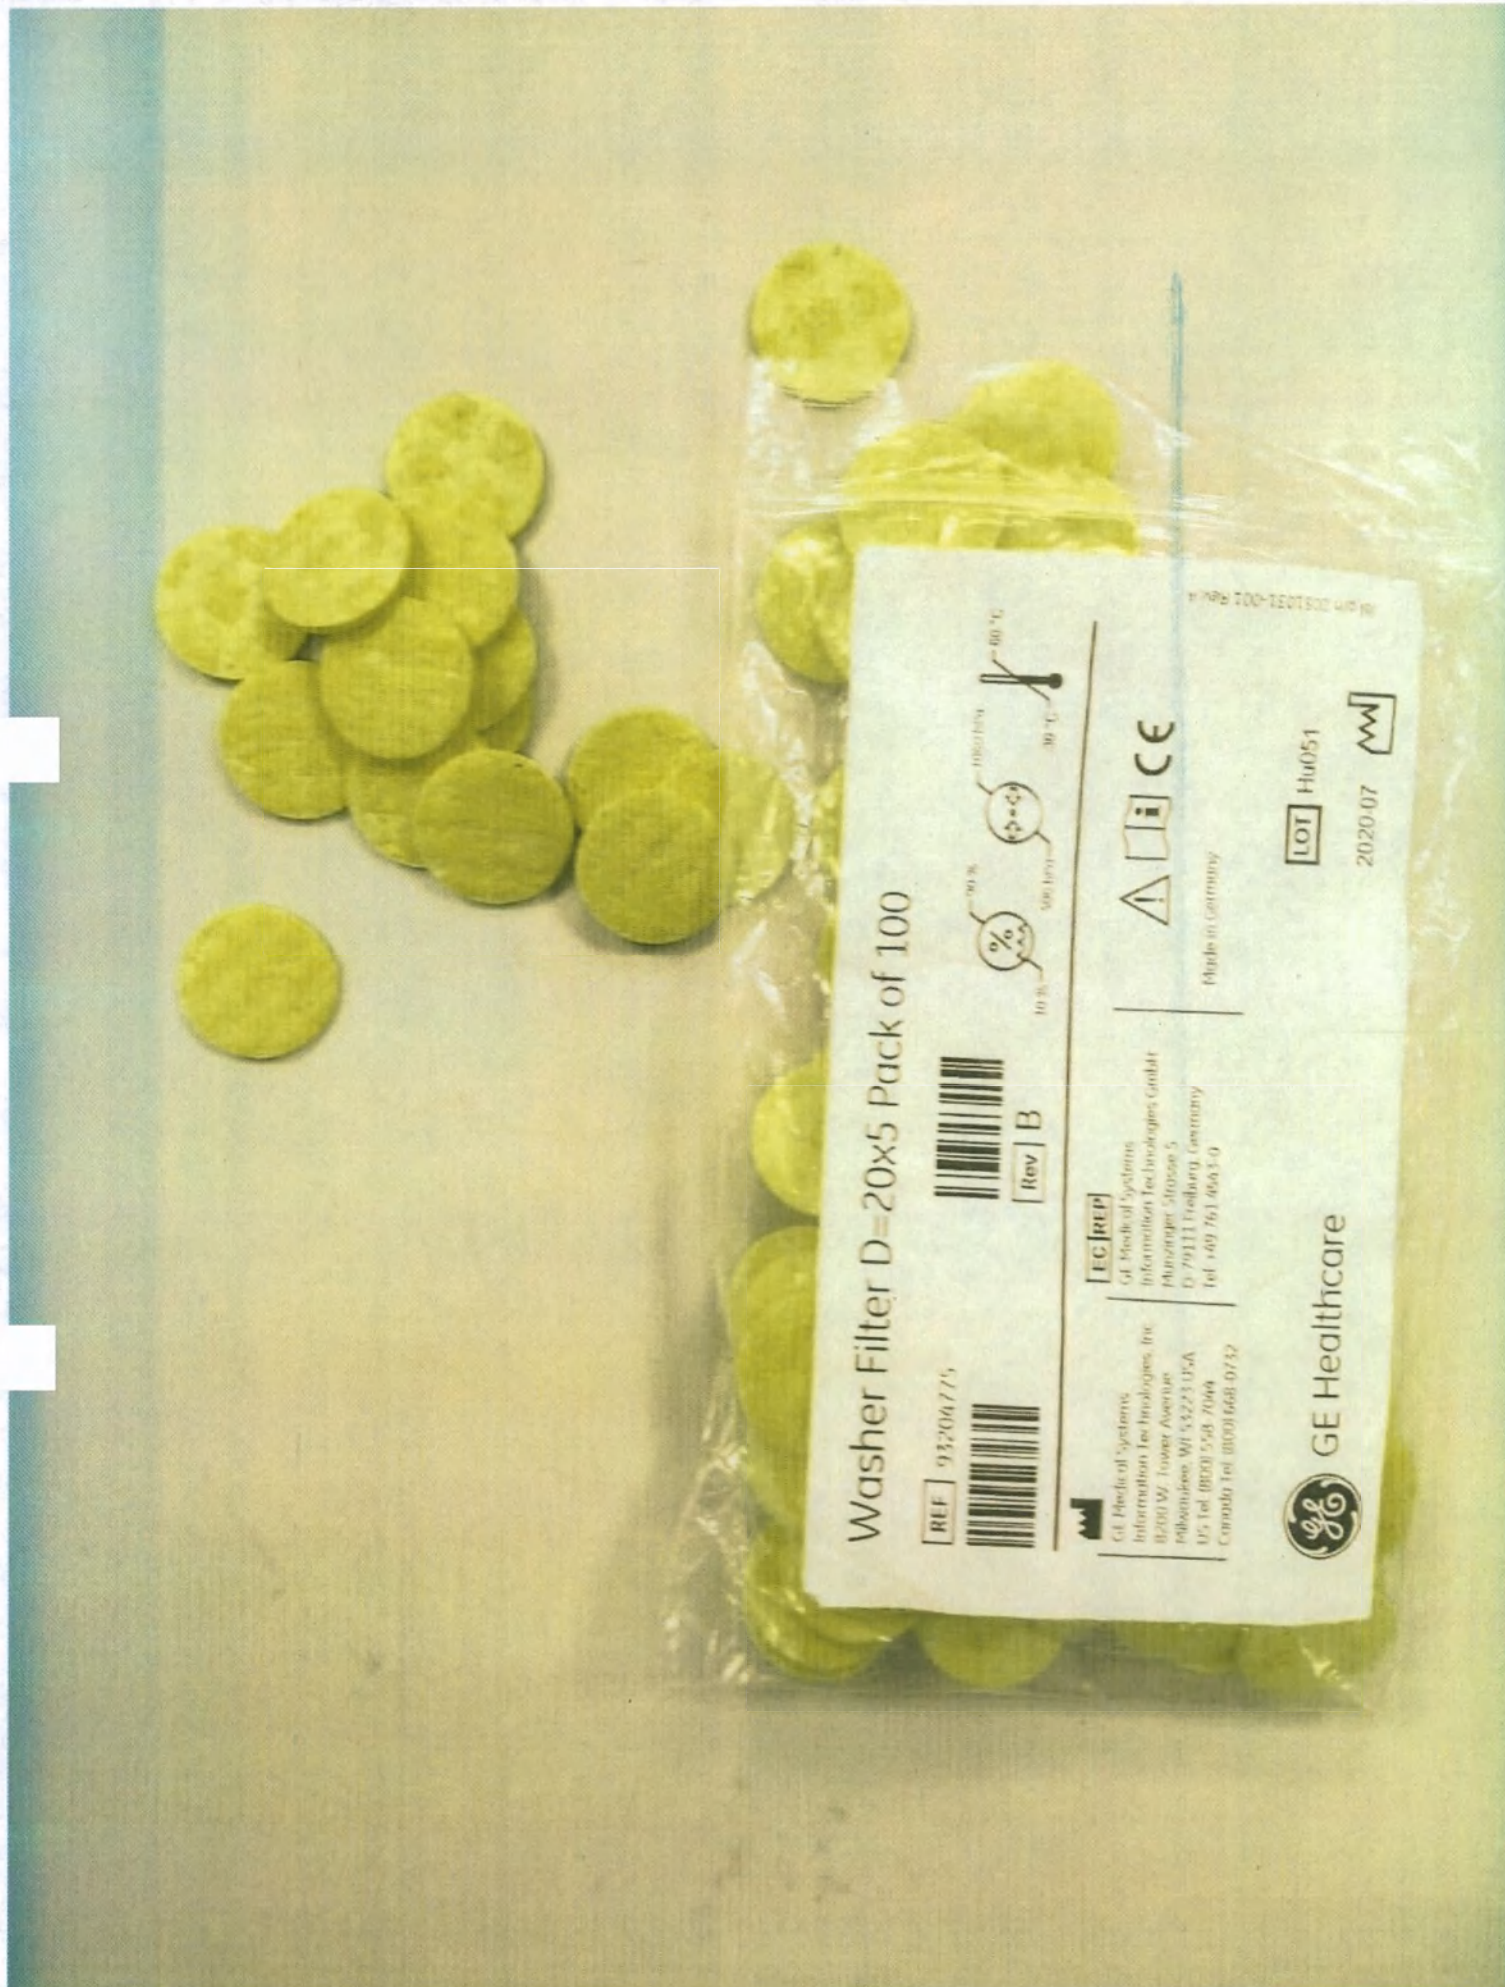


Фото 106.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 33. Фильтры одноразовые для системы наложения электродов KISS



Фото 107.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 34. Дополнительные электроды для отведений по Франку

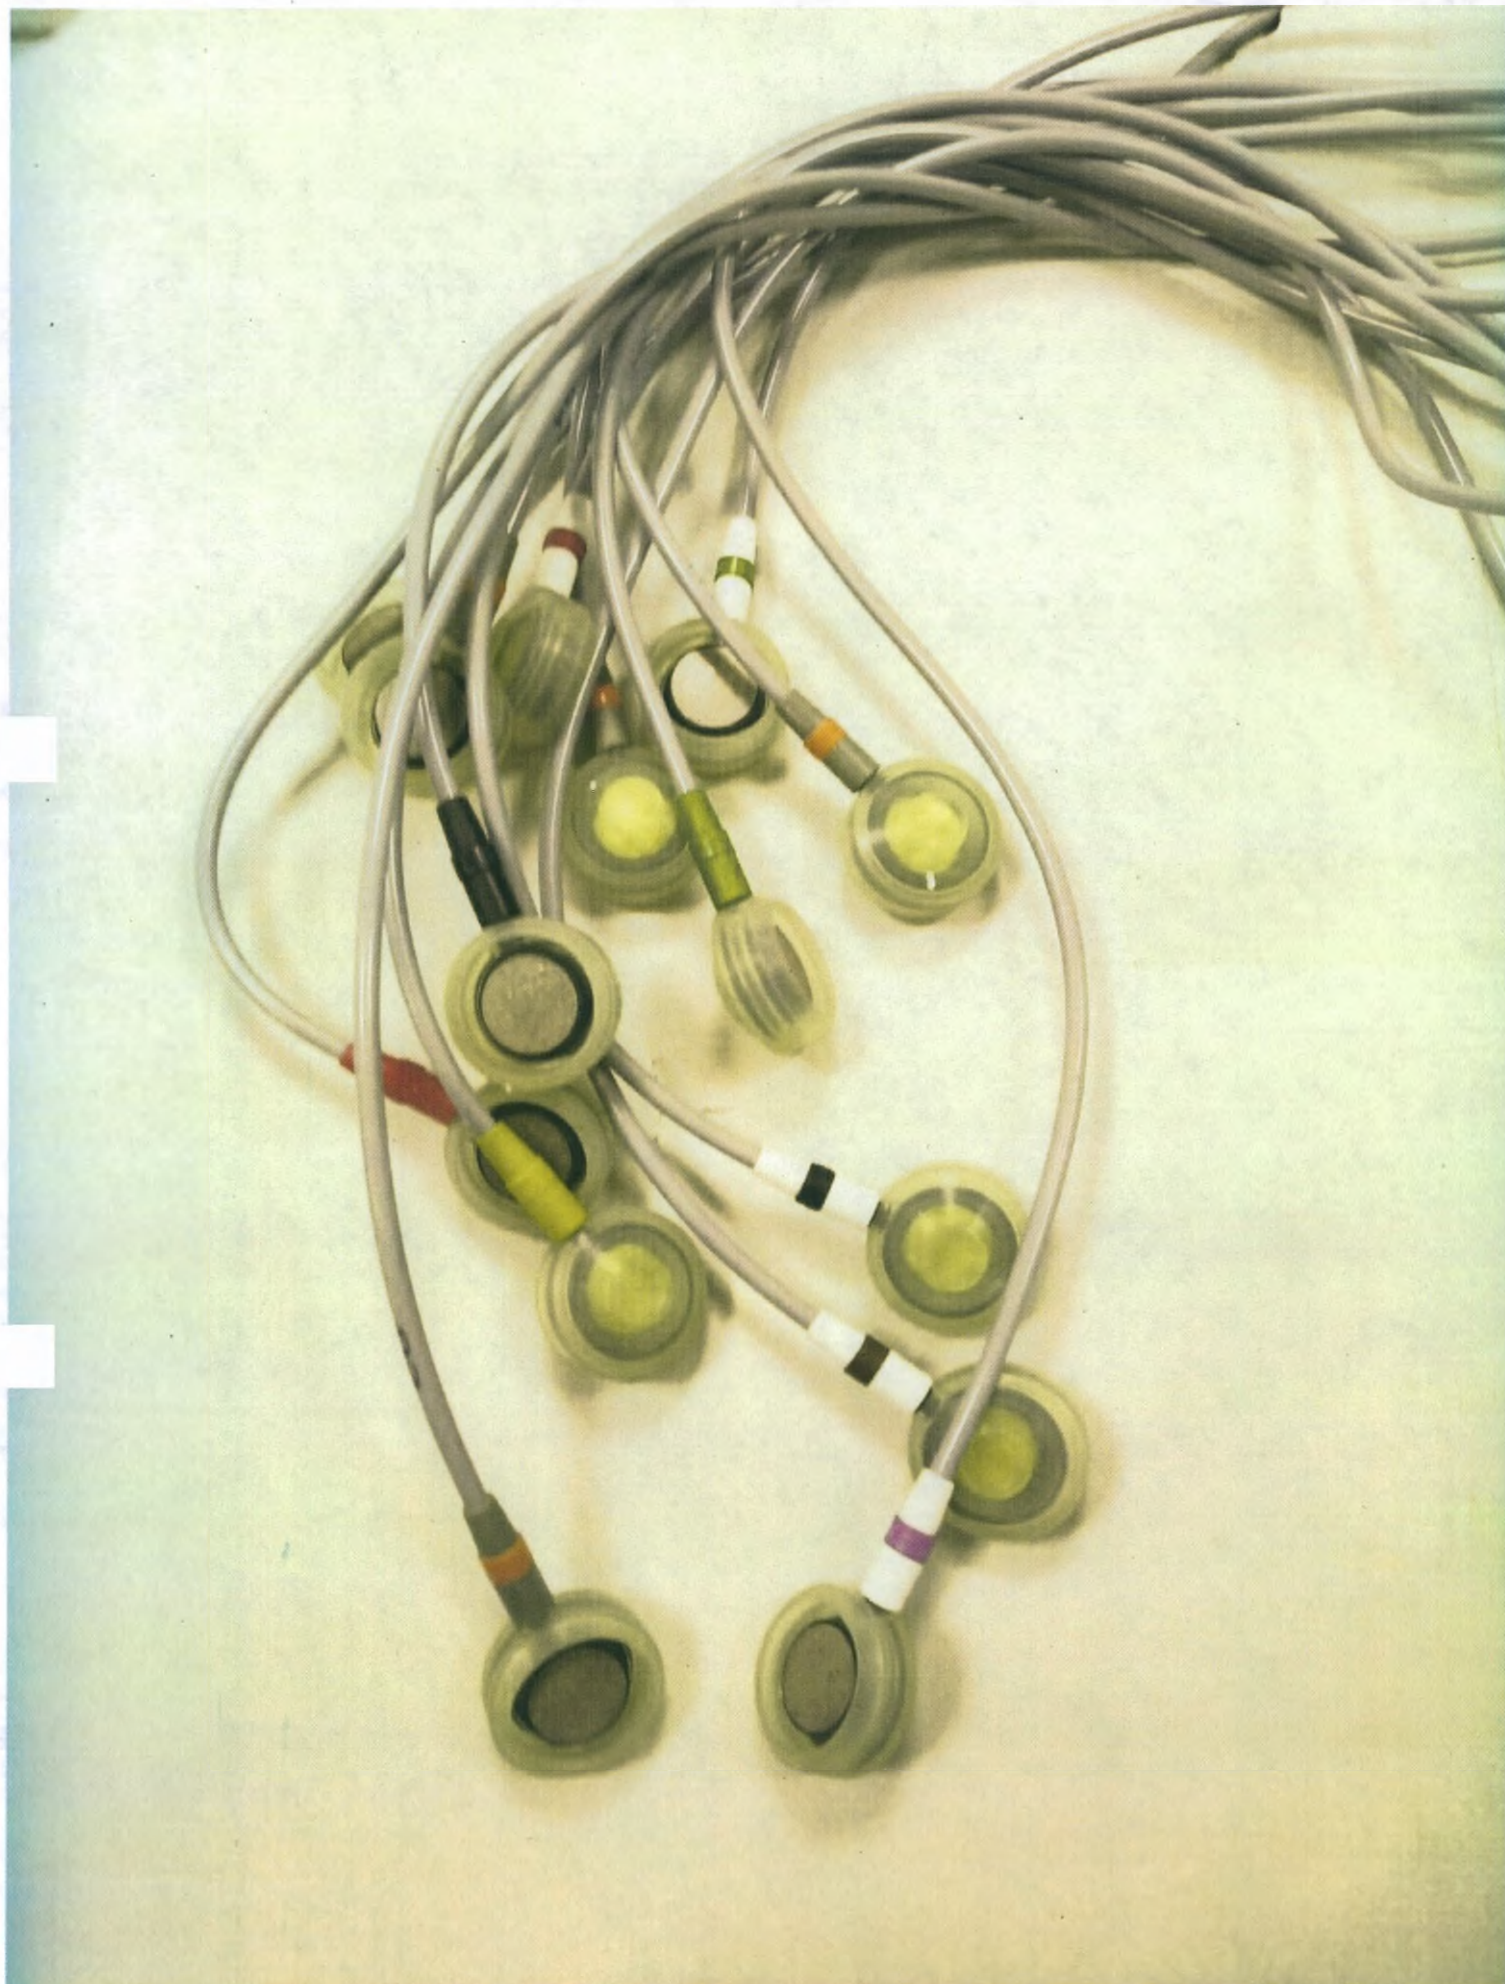


Фото 108.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 35. Дополнительные электроды для отведений по NEHB



Фото 109.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

А1-А4



Фото 110.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

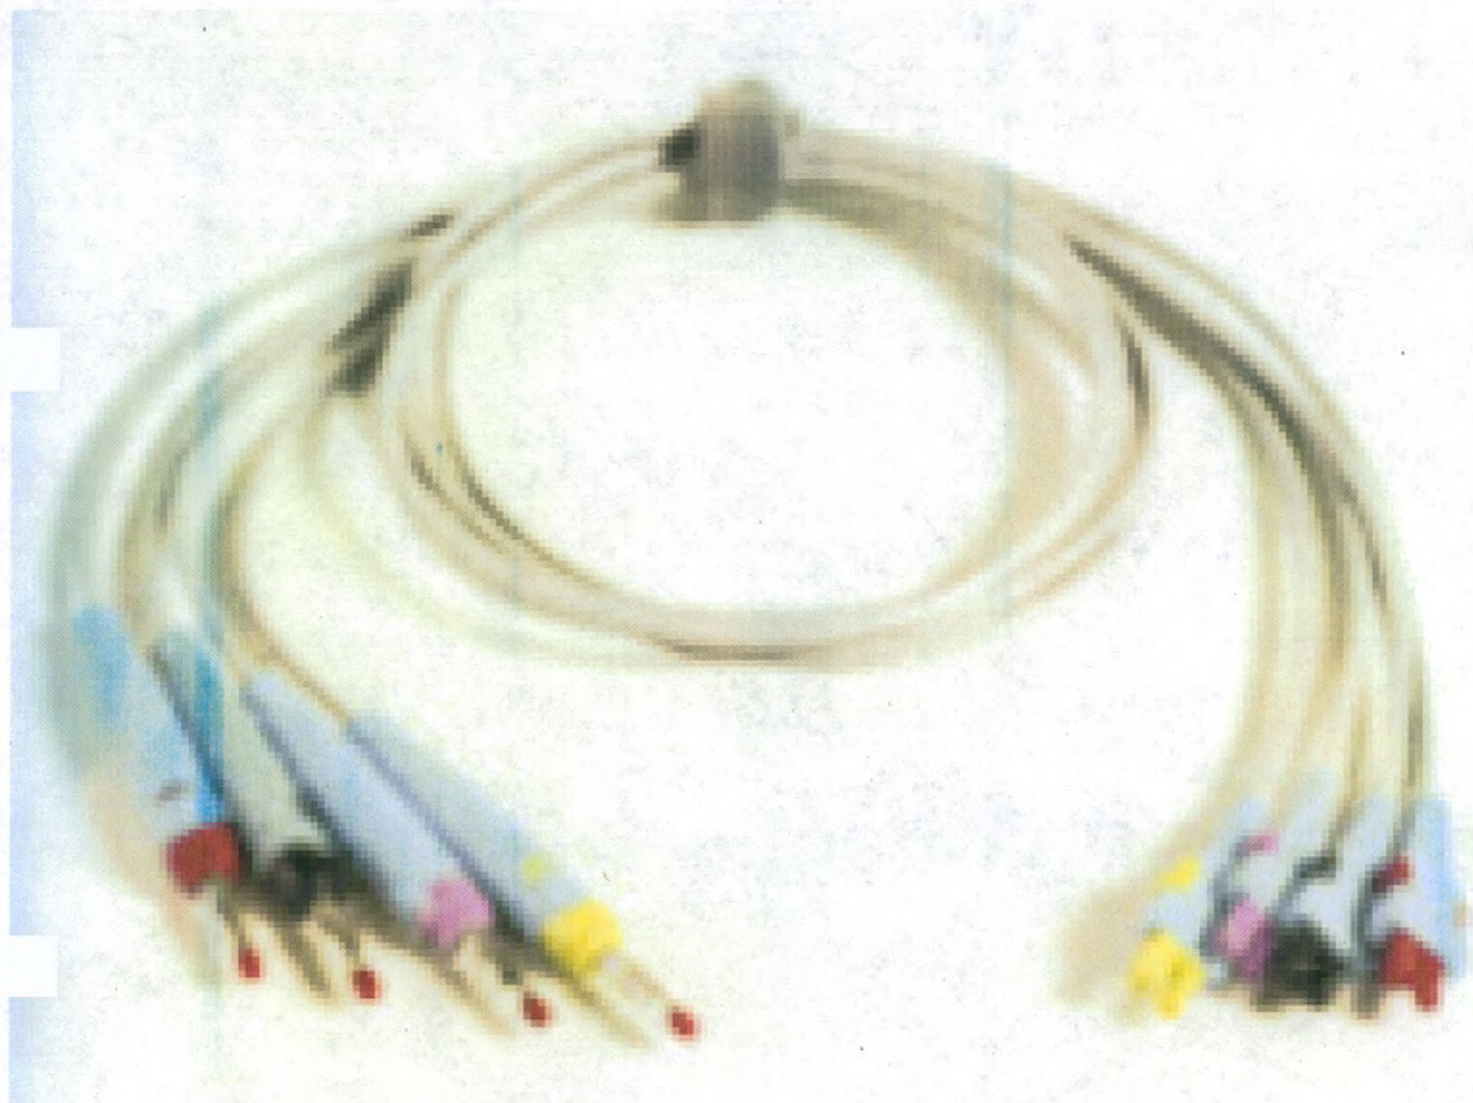


Фото 111.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 38. Набор разъемов для ЭКГ, штекер типа «банан», 4 разъема в наборе, IEC

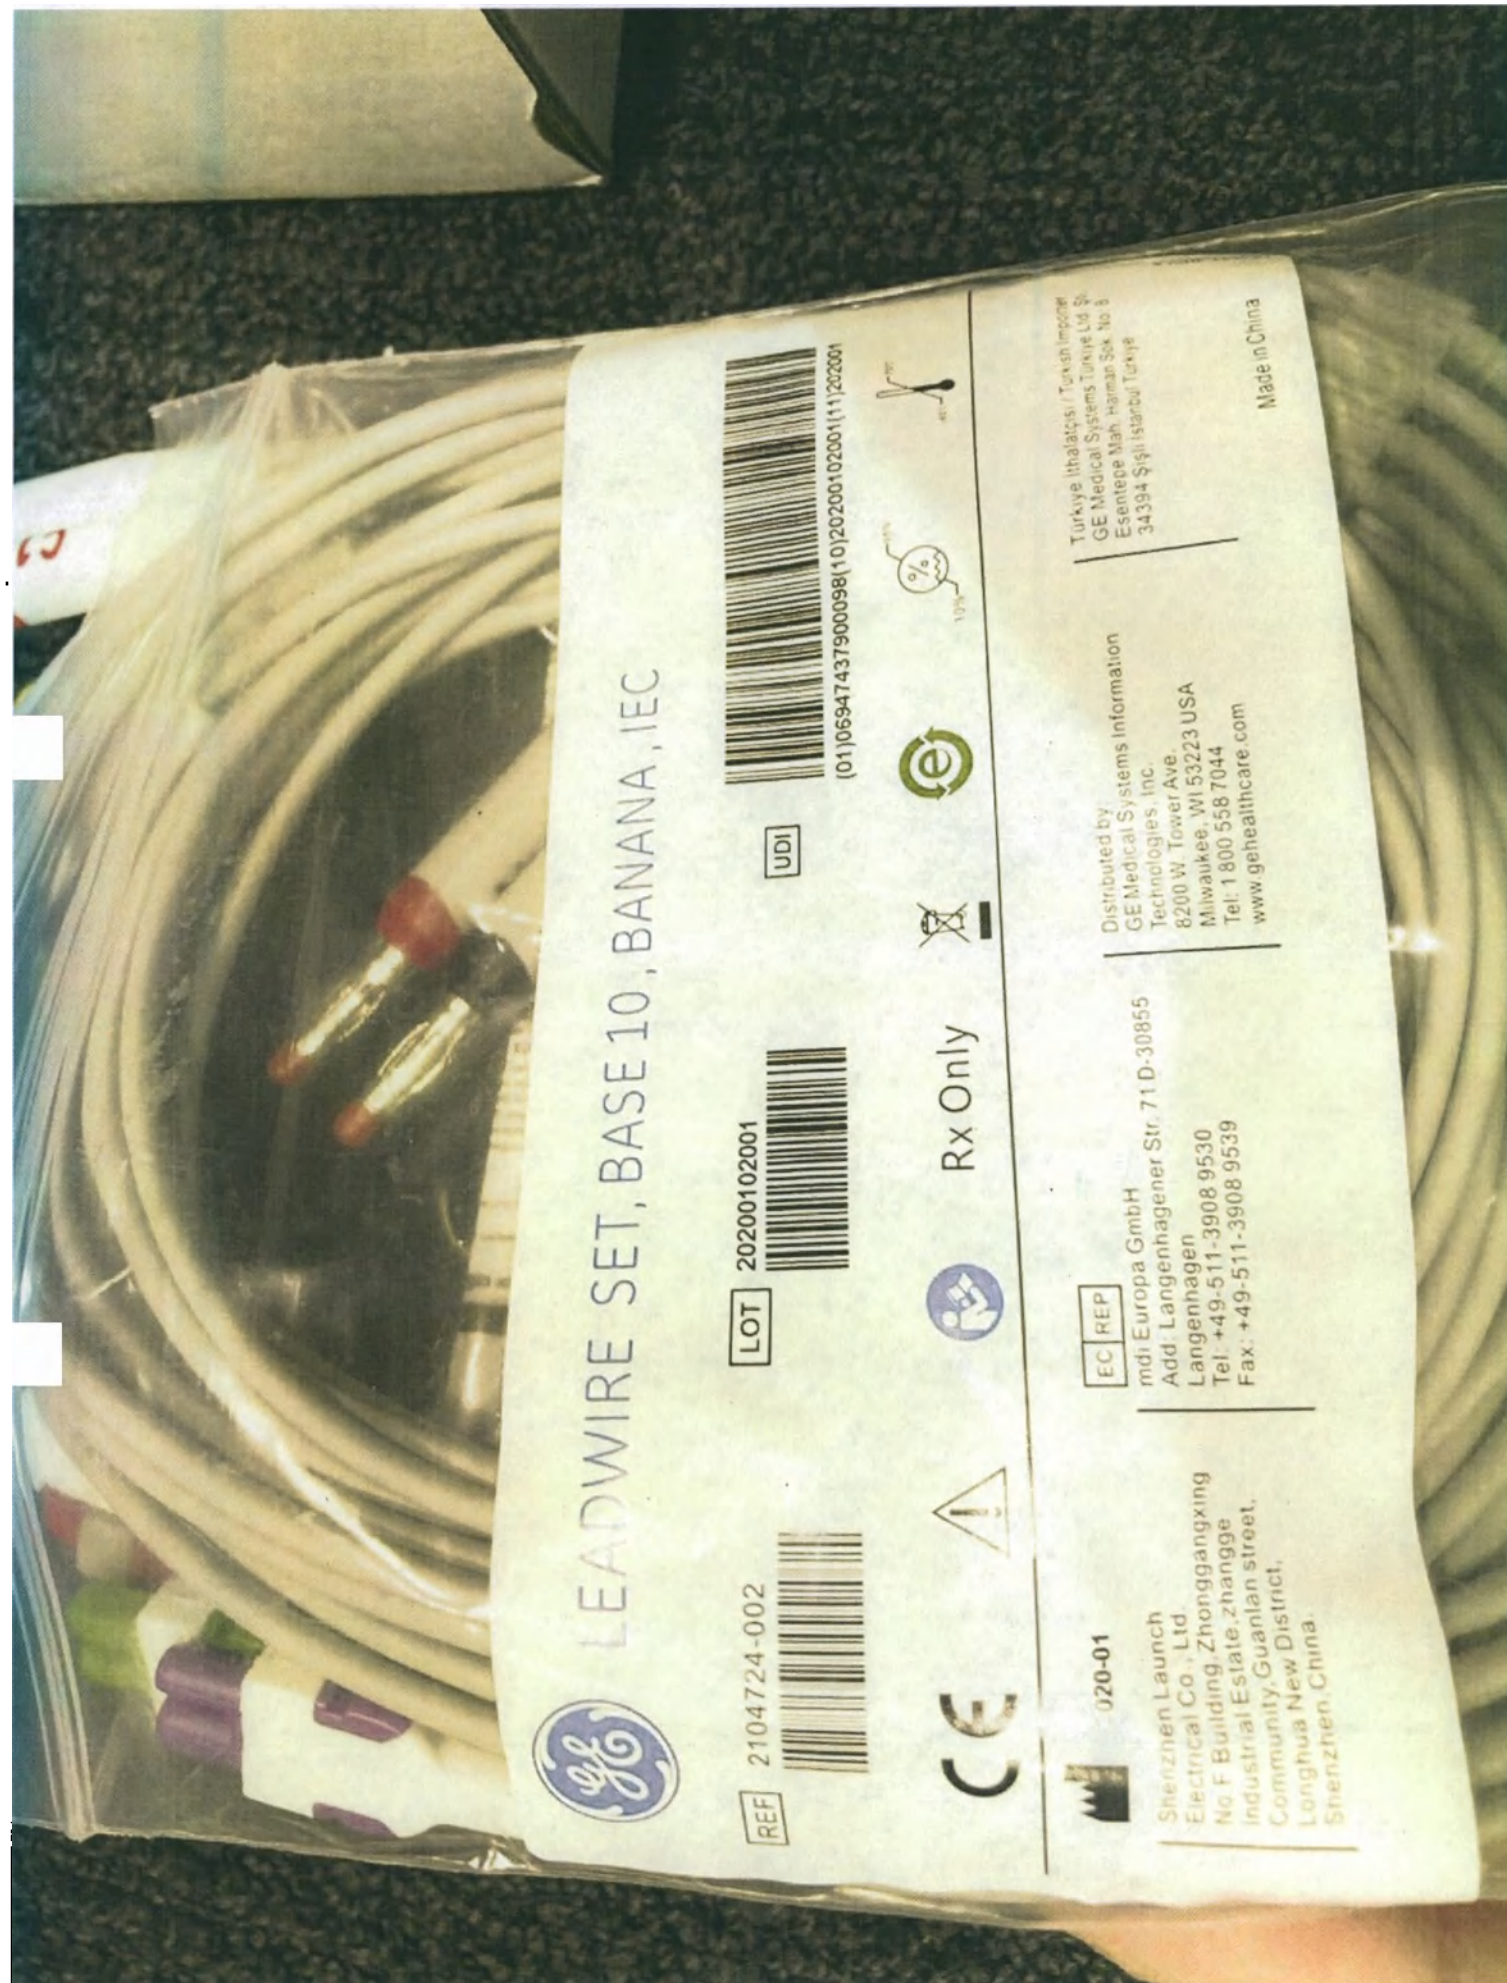


Фото 112.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 39. Набор разъемов для ЭКГ, штекер типа

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 0 разъемов в наборе, IEC с маркировкой



Фото 113.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 40. Набор разъемов для ЭКГ, штекер типа «граббер», 4 разъема в наборе, IEC



LEADWIRE SET, BASE 10, GRABBER, IEC

REF 2104748-001



LOT 20200115001




UDI



(01)06947437900135(10)20200115001(11)200100



Rx Only



2020-01

Shenzhen Launch
Electrical Co., Ltd.
No. F Building, Zhonggangxing
Industrial Estate, Zhangge
Community, Guanlan street,
Longhua New District,
Shenzhen, China.

EC REP

mdi Europa GmbH
Add: Langenhagener Str. 71 D-30855
Langenhagen
Tel: +49-511-3908 9530
Fax: +49-511-3908 9539

Distributed by:
GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
8200 W. Tower Ave.
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: 1 800 558 7044
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçısı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti
Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Şişli İstanbul Türkiye

Made in China

- EN Leadwire Set, Base 10, Grabber, IEC
- BG Комплект отвеждания, базови 10; захващане, IEC
- HR Komplet odvoda, osnovni 10 kom., sa hvataljkom, IEC
- CS Souprava vodičů, 10 základních, Grabber, IEC

- LV Novadījumu vadu komplekts, pamata 10, satvērējs, IEC
- LT Elektrodų laidų rinkinys, 10 laidų „Grabber“ tipo, IEC
- NO Ledningssett, Base 10, grabber, IEC
- PL Zestaw przewodów odprowadzeniowych, podstawy 10, uchwyty, IEC
- PT-BR Conjunto do fio de derivação, Base 10, Grampo, IEC

EN Grande ledningssæt, base 10, Grabber, IEC

NI Elektrodų laidų rinkinys, 10 laidų „Grabber“ tipo, IEC

Фото 114.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSo с принадлежностями: Принадлежности: 41. Набор разъемов для ЭКГ, штекер типа «граббер». 10 разъемов в наборе. IEC с маркировкой

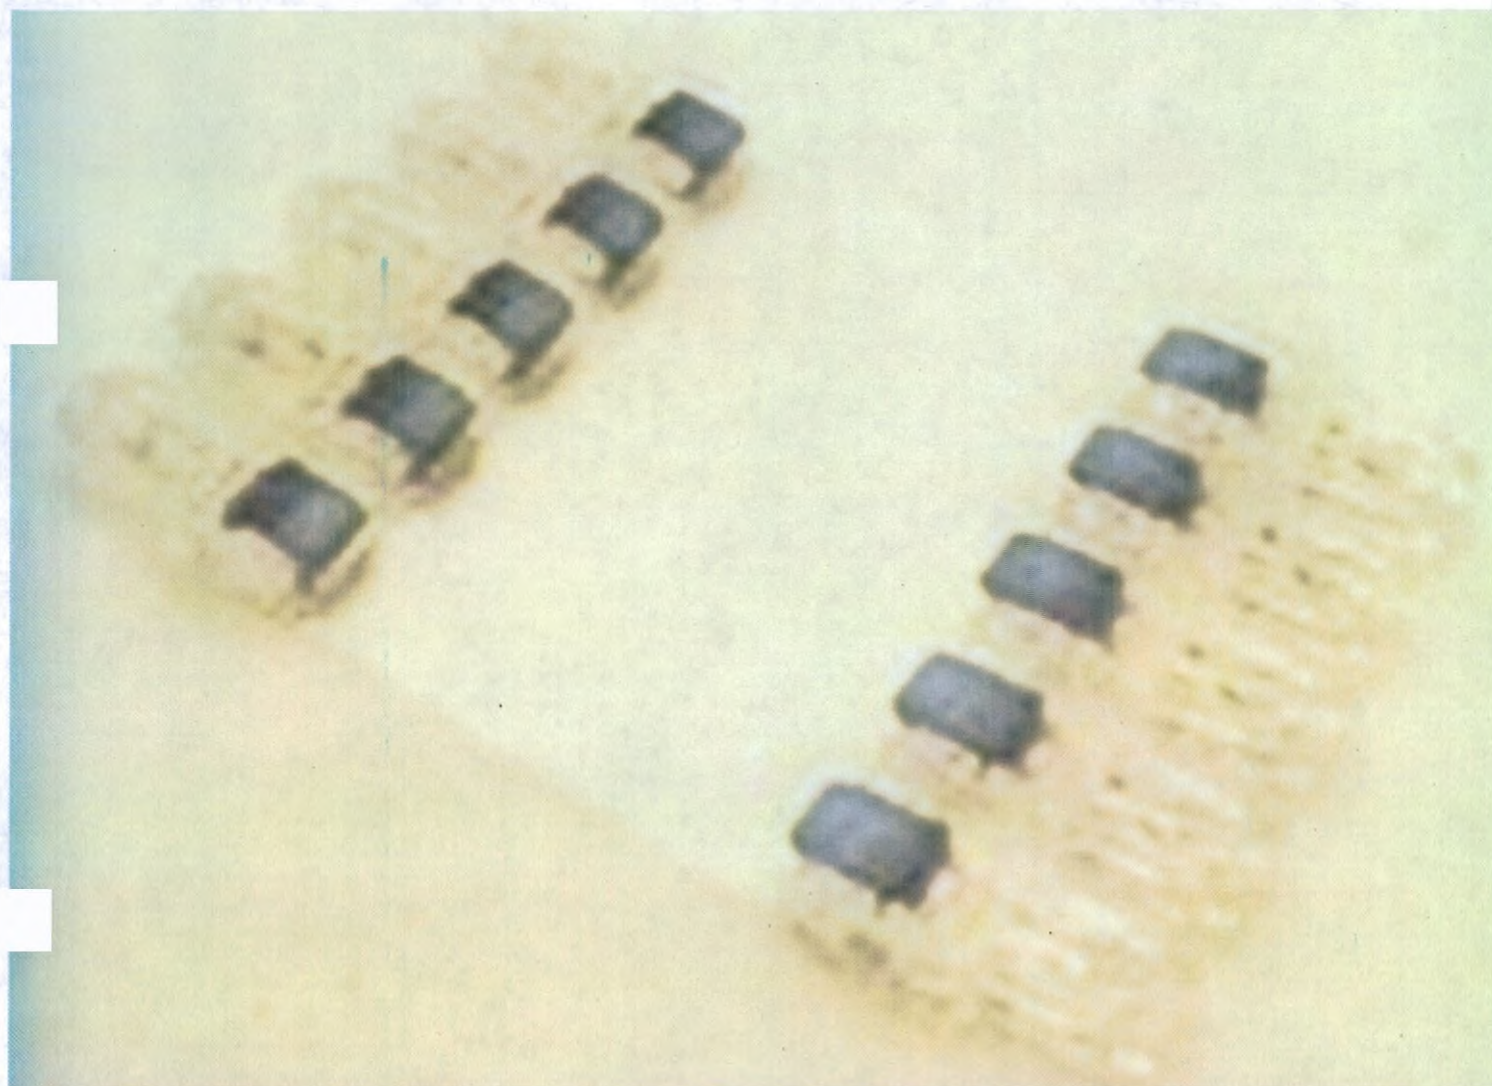


Фото 115.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 42. Набор переходников для ЭКГ, 10
переходников в наборе



ADAPTER CLIP, WIDE MOUTH CLIP, 14 PACK

REF

2104729-001

LOT

20190905001



UDI




(01)06947437950116(10)20190905001(11)201909

CE



Rx Only

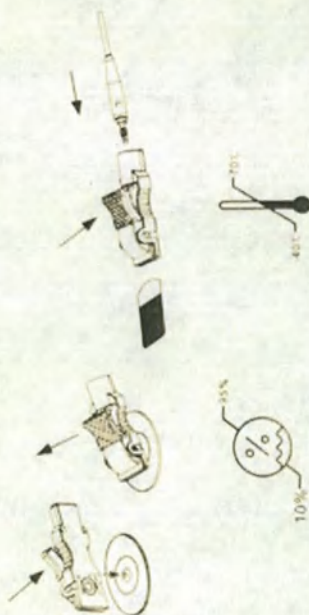

2019-09

Shenzhen Launch
Electrical Co., Ltd
No. F Building Zhonggangxing
Industrial Estate, Zhangge
Community Guanlan street,
Longhua New District,
Shenzhen, China

EC REP

mdi Europa GmbH
Add: Langenhagener Str 71 D-30855
Langenhagen
Tel: +49-511-3908 9530
Fax: +49-511-3908 9539

Distributed by:
GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
8200 W. Tower Ave.
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: 1 800 558 7044
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçısı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti
Esentepe Mah. Harman Sok. No. 8
34394 Şişli İstanbul Türkiye

Made in China

LA0841 REV A

EN Adapter Clip, Wide Mouth Clip, 14 pack

BG АдAPTER КЛИП, широк клипс, 14 в опаковка

HR Spojnica s adapterom, široka spojnica, 14 komada

CS Svorkový adapter, široká svorka

DA Adapterklemme, klemme med bred mund, pakke med 14 stk

NL Adapterklem, brede klemmening, pakket van 14

LV Adaptera klipsis, plats klipsis, iepakojuma 14 gab

LT Adapterio spaustukas, plačiaziotis spaustukas, 14 vnt

NO Adapterklippe, vidåpen munnklippe, 14 pakke

PL Zacisk adaptera, zacisk szeroki, zestaw 14 szt

PT-Zacisk adaptera, zacisk szeroki, zestaw 14 szt

Фото 116.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 43. Набор переходников для ЭКГ, 14



Фото 117.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 44. Проводники на 10 отведений



Фото 118.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru Принадлежности: 45. Проводники на 14 отведений

GE Healthcare

CardioSoft™ V7.0

Руководство оператора
Код продукта SSG

Версия программного обеспечения 7.0



Фото 119.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

с принадлежностями. Принадлежности: 46. Справочное руководство на бумажных,
электронных или оптических носителях информации

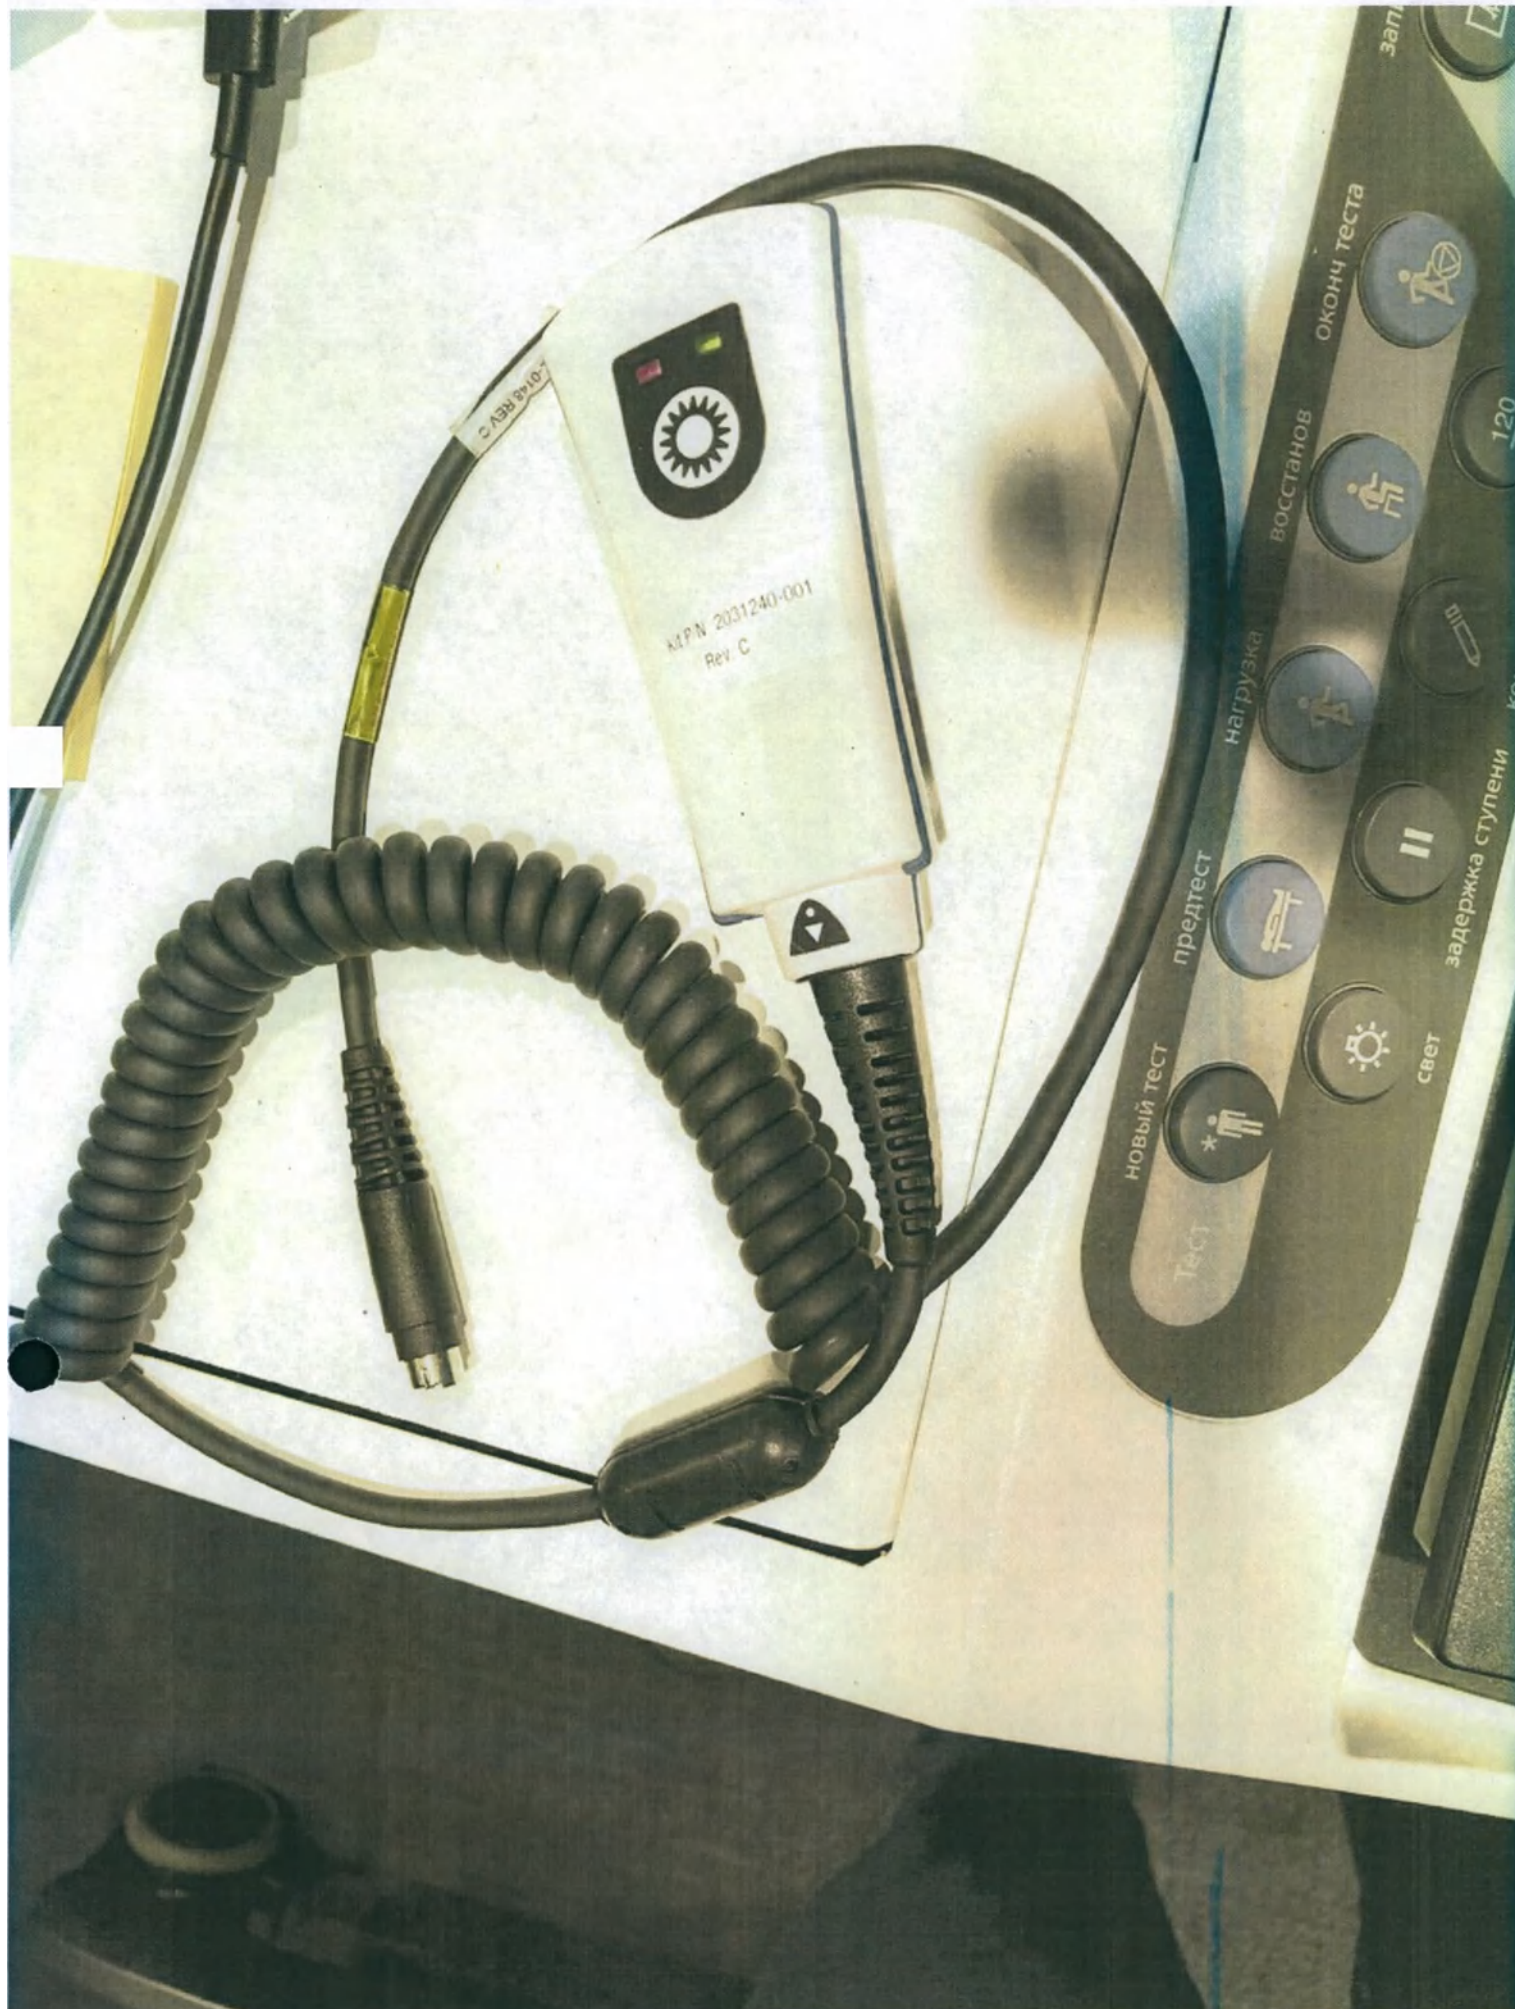


Фото 120

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Поднадлежности: 47. USB устройство для чтения штрих кодов



Фото 121.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

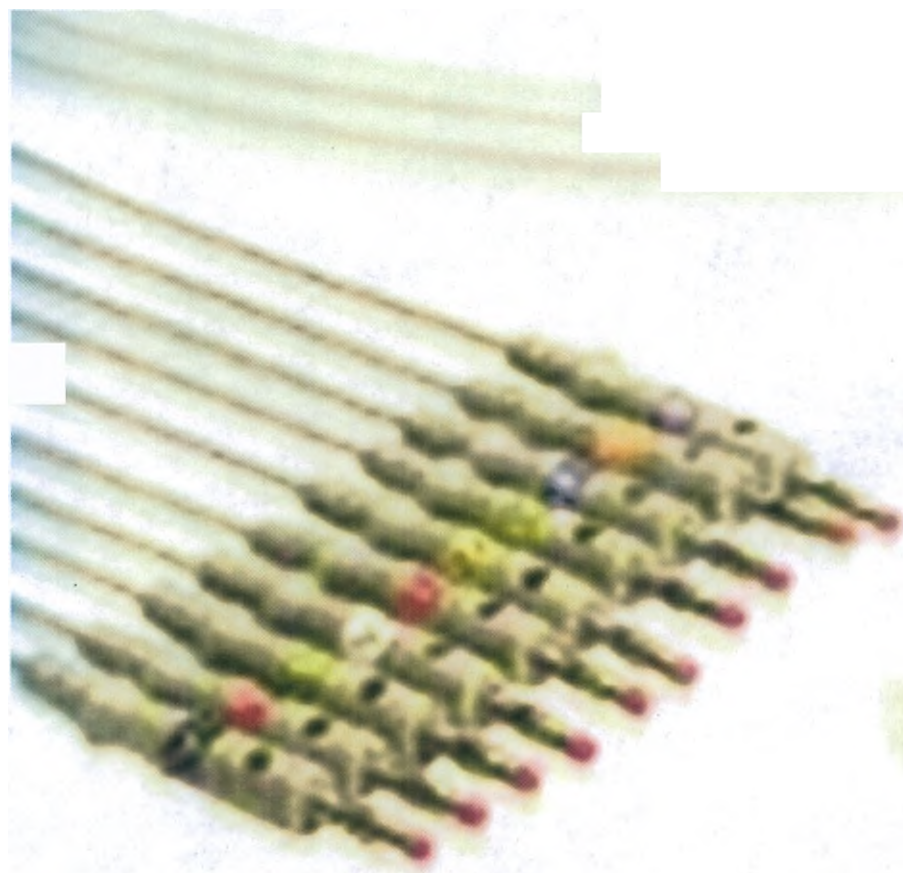


Фото 122.



Фото 123.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

с принадлежностями. Принадлежности: 50. Кабель соединительный к беговой дорожке

T2100- ST2

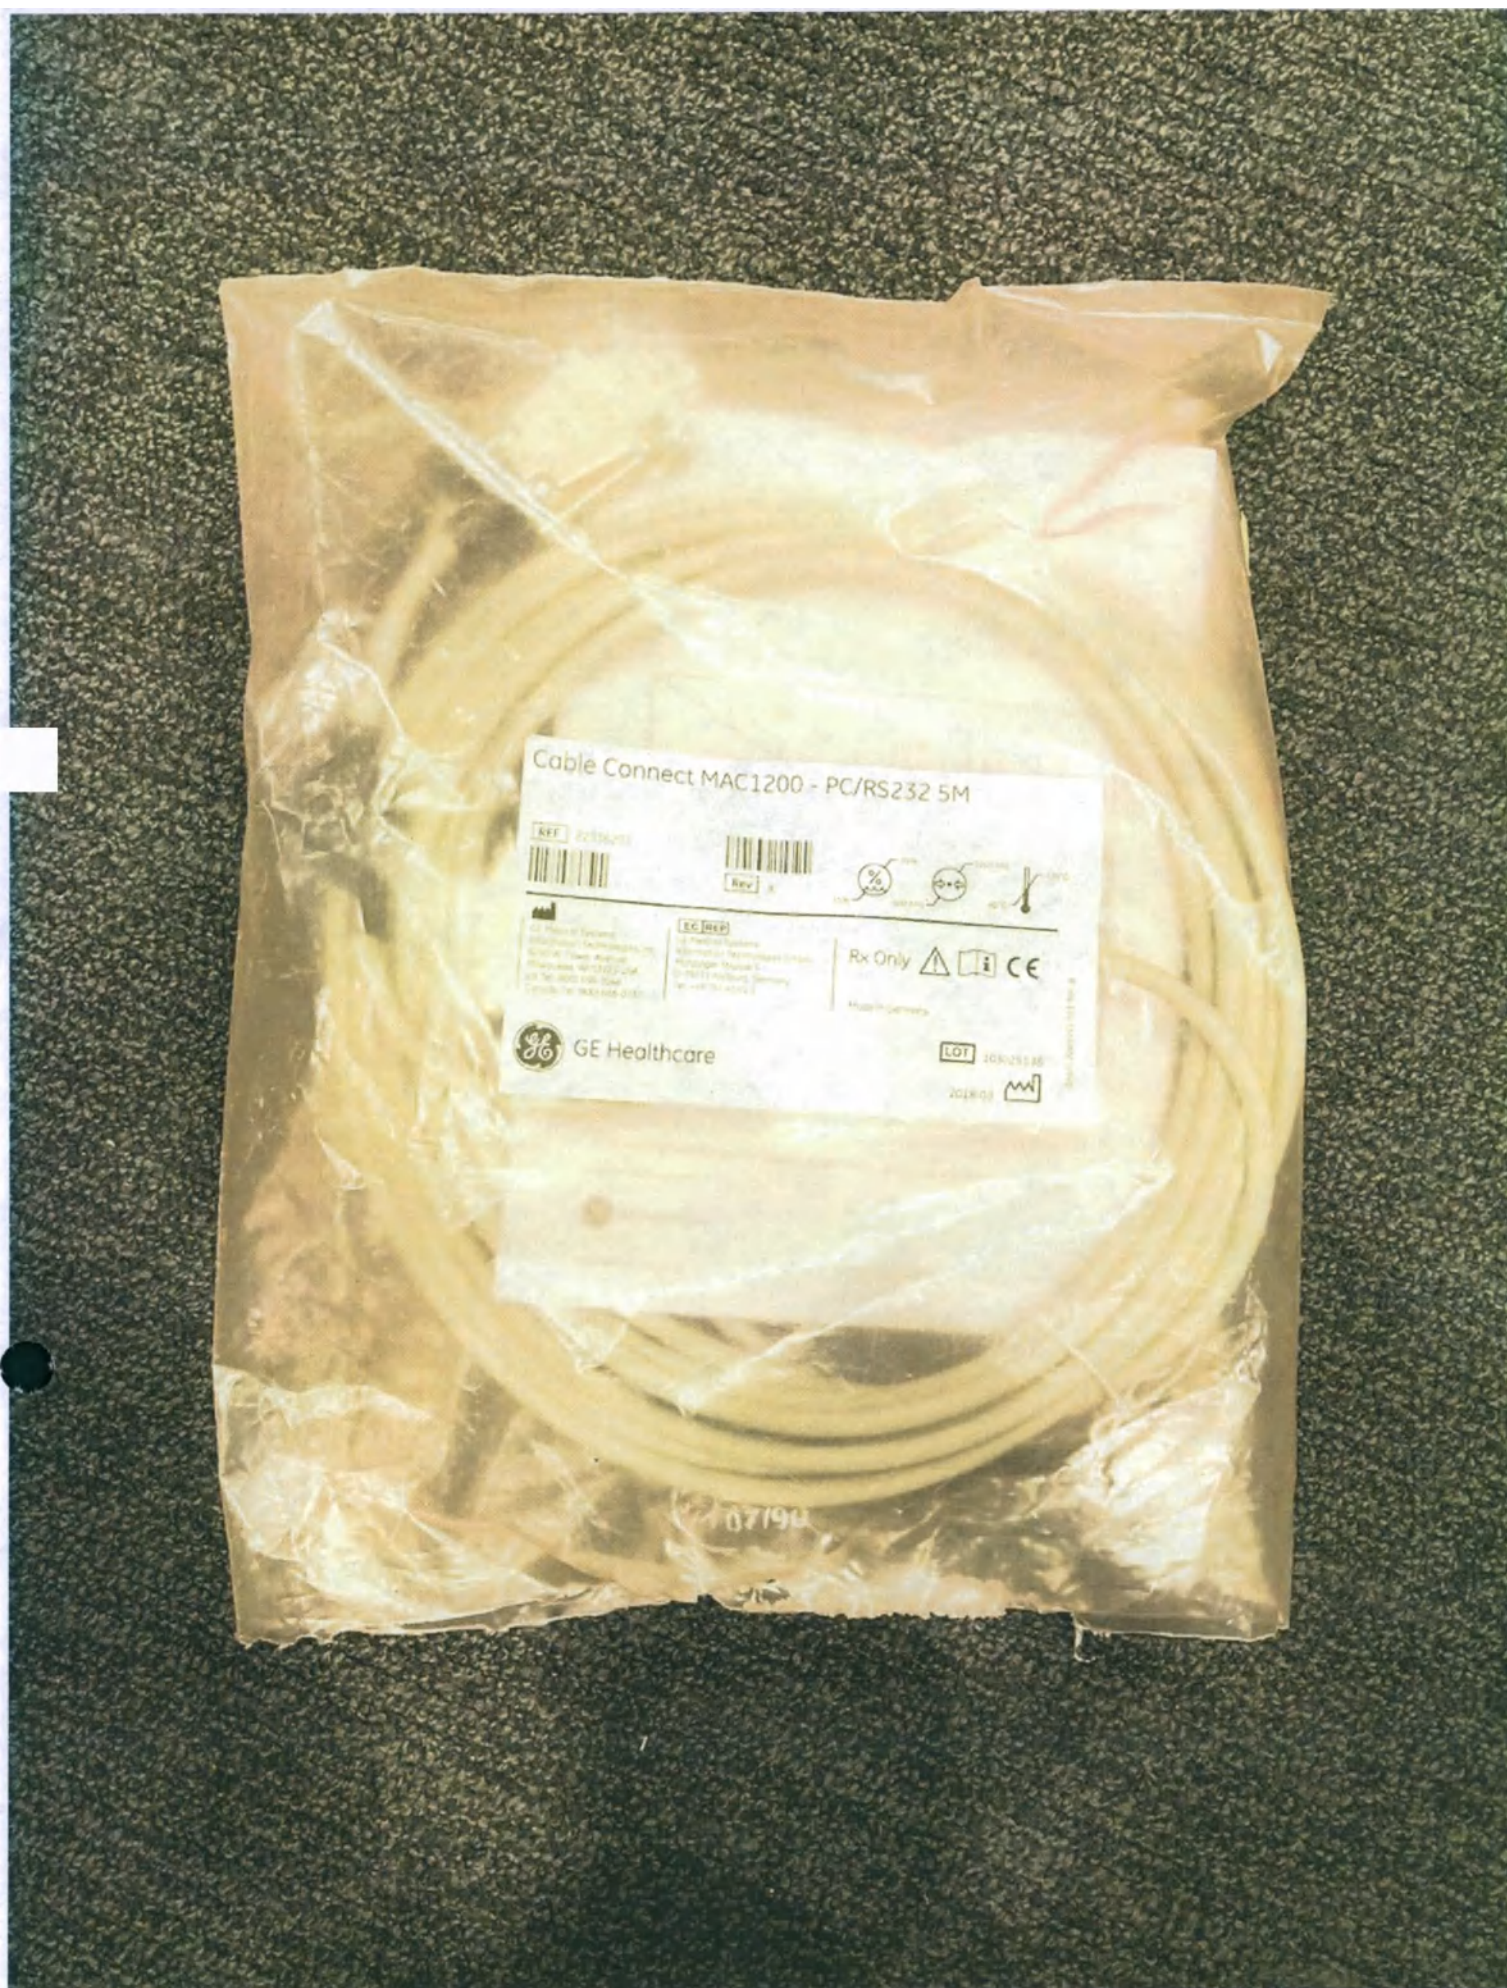


Фото 124.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 51. Кабели соединительные для велоэргометров



Фото 125.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями. Принадлежности: 52. Спреи электродные (не более 200 мл/флаконе,
не более 20 флаконов/упаковке (не более 50 шт.)).

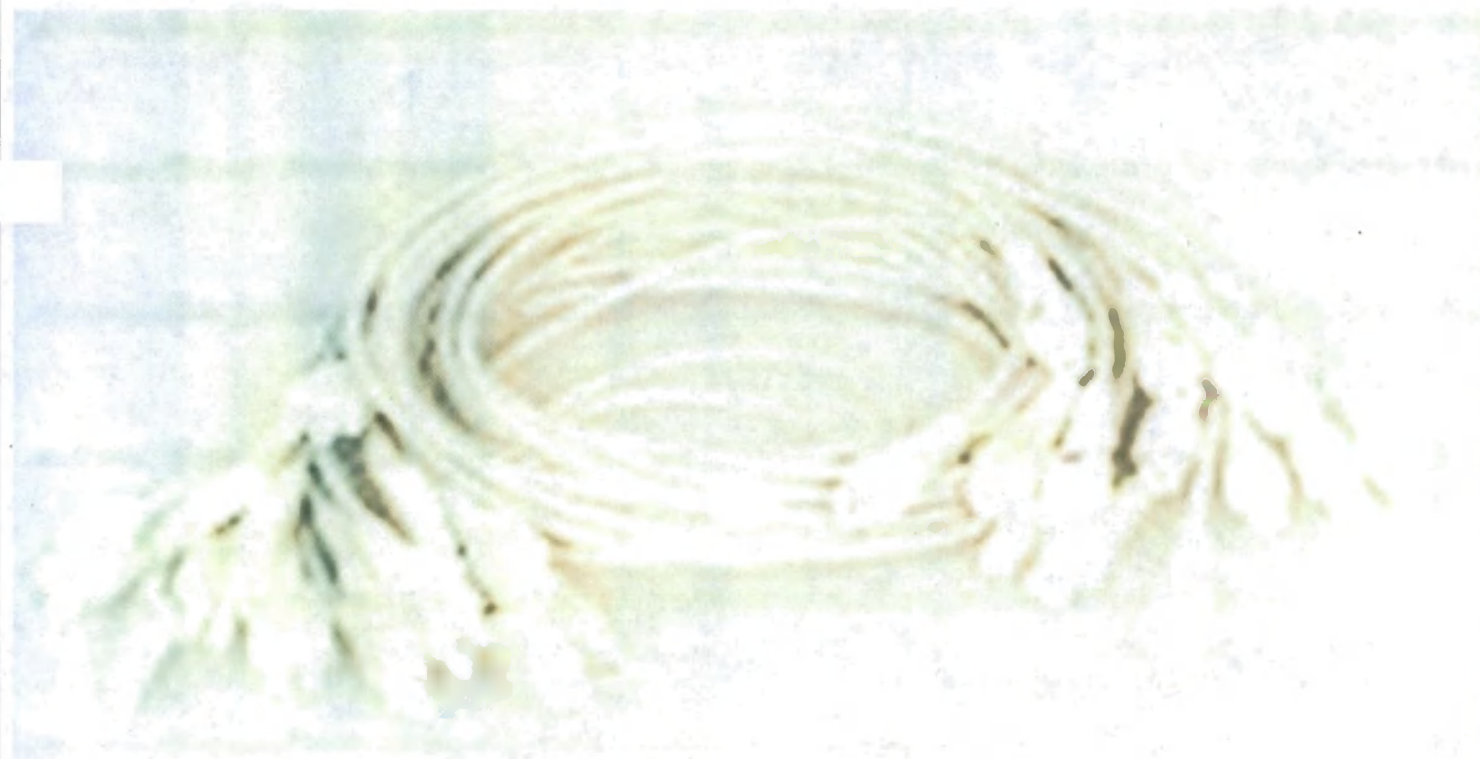


Фото 126.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 53. Проводники на 14 отведений для системы
наложения электродов KISS



Фото 127.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 54. Заглушки для распределительного блока
системы KISS

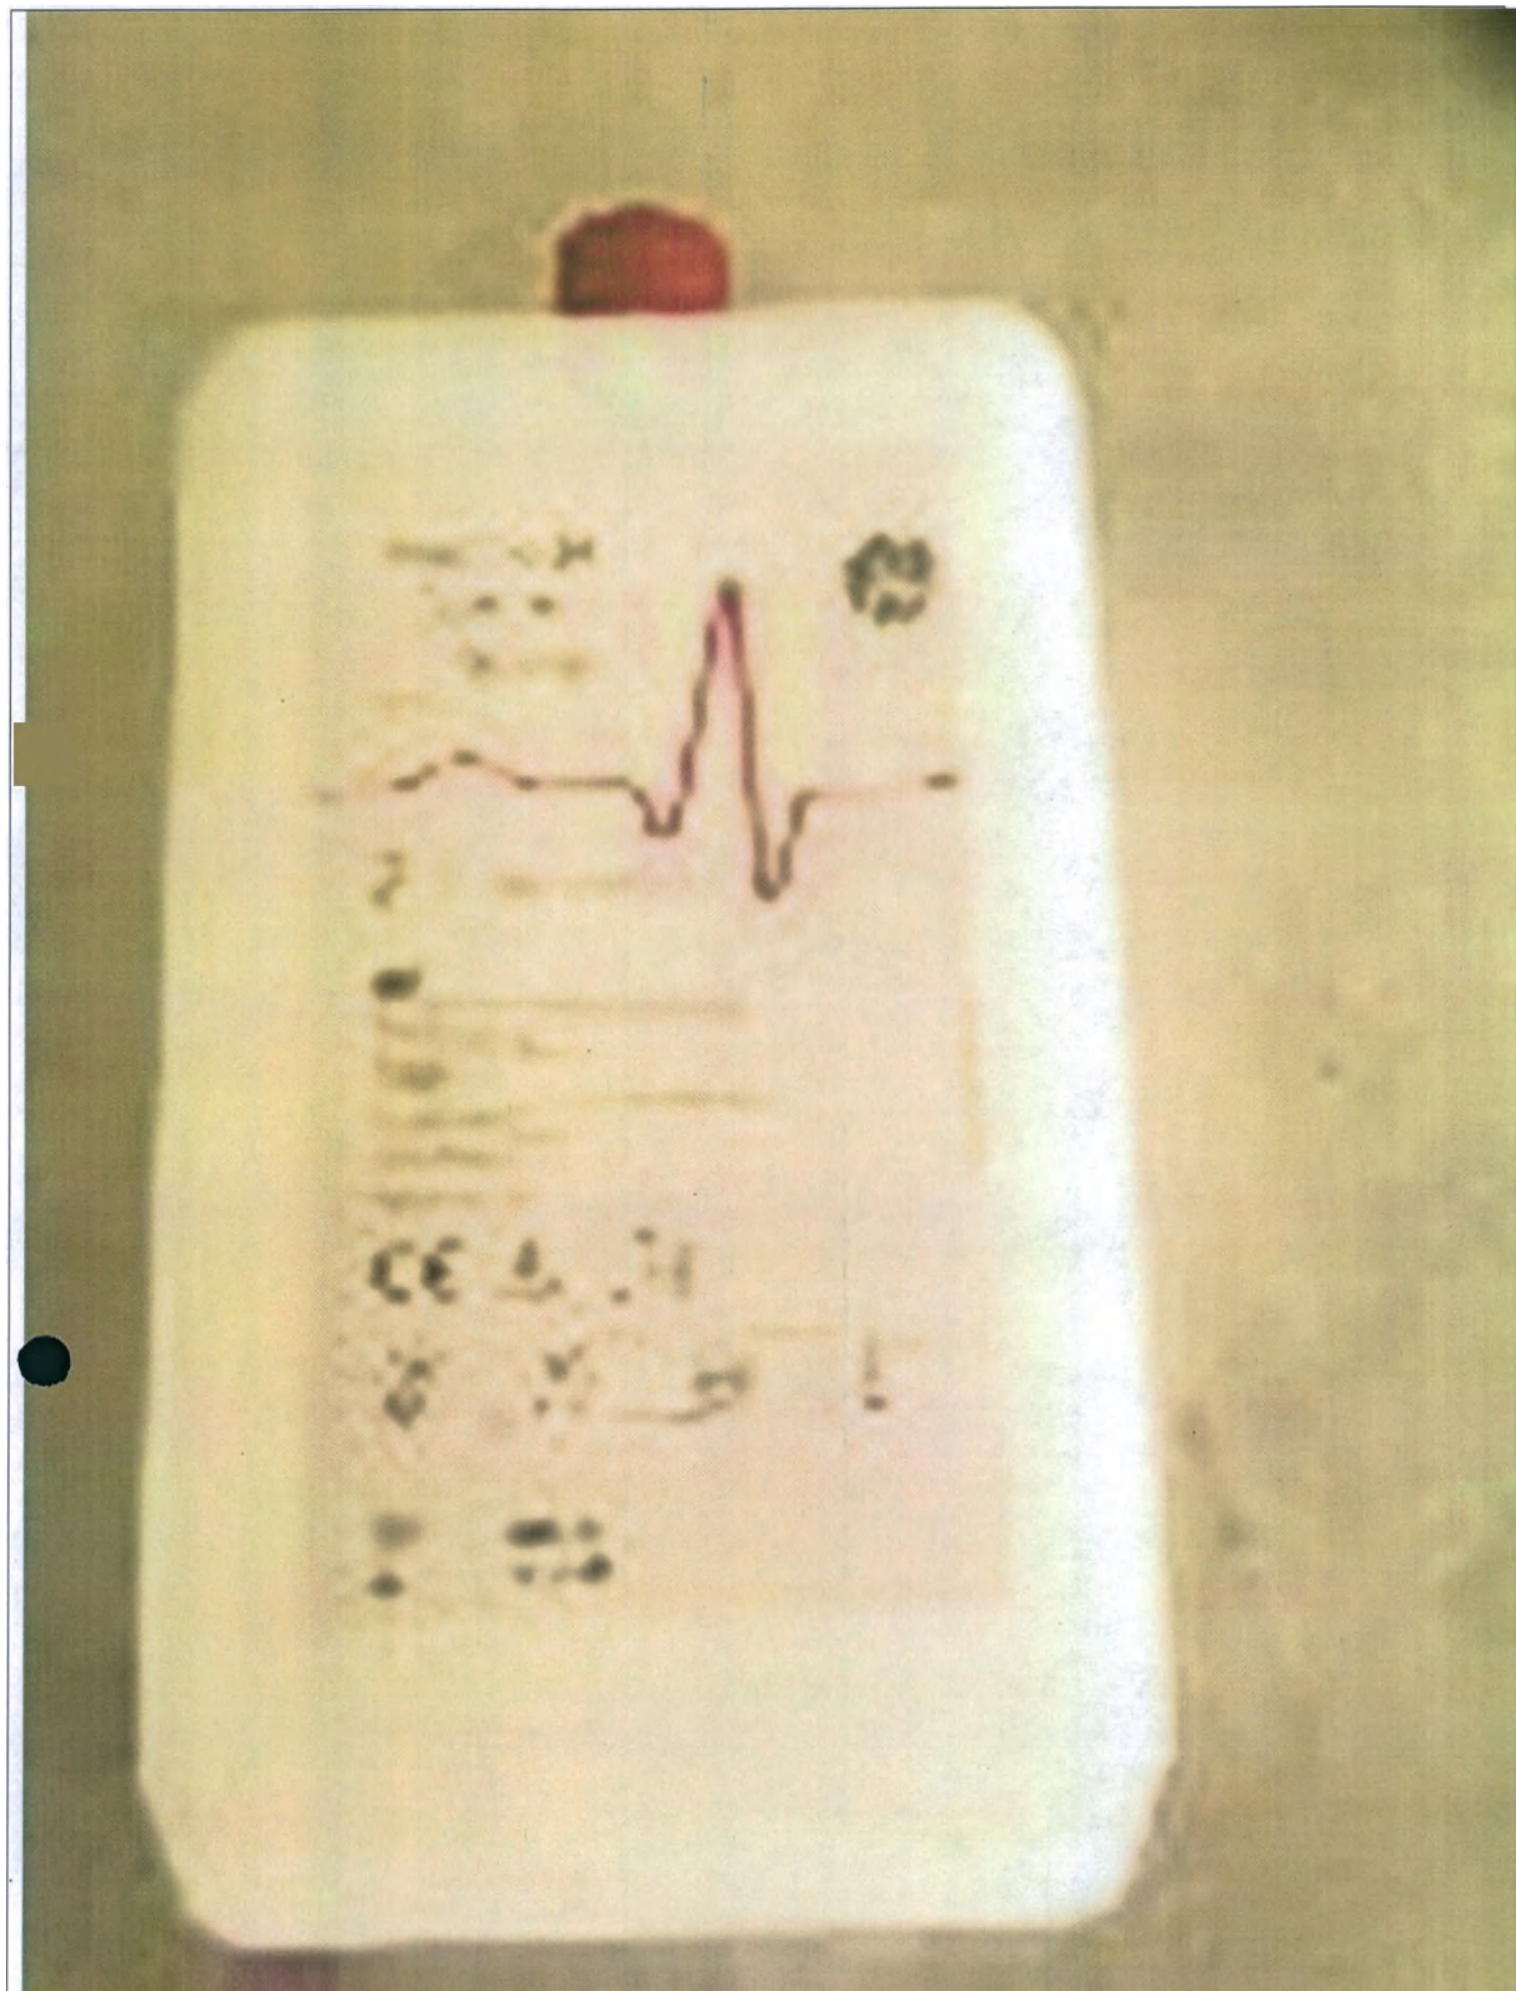


Фото 128.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 55. Спрей электродный контактный объемом не
более 2000 мл



Фото 129.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft



Фото 130.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 57. Носовой зажим

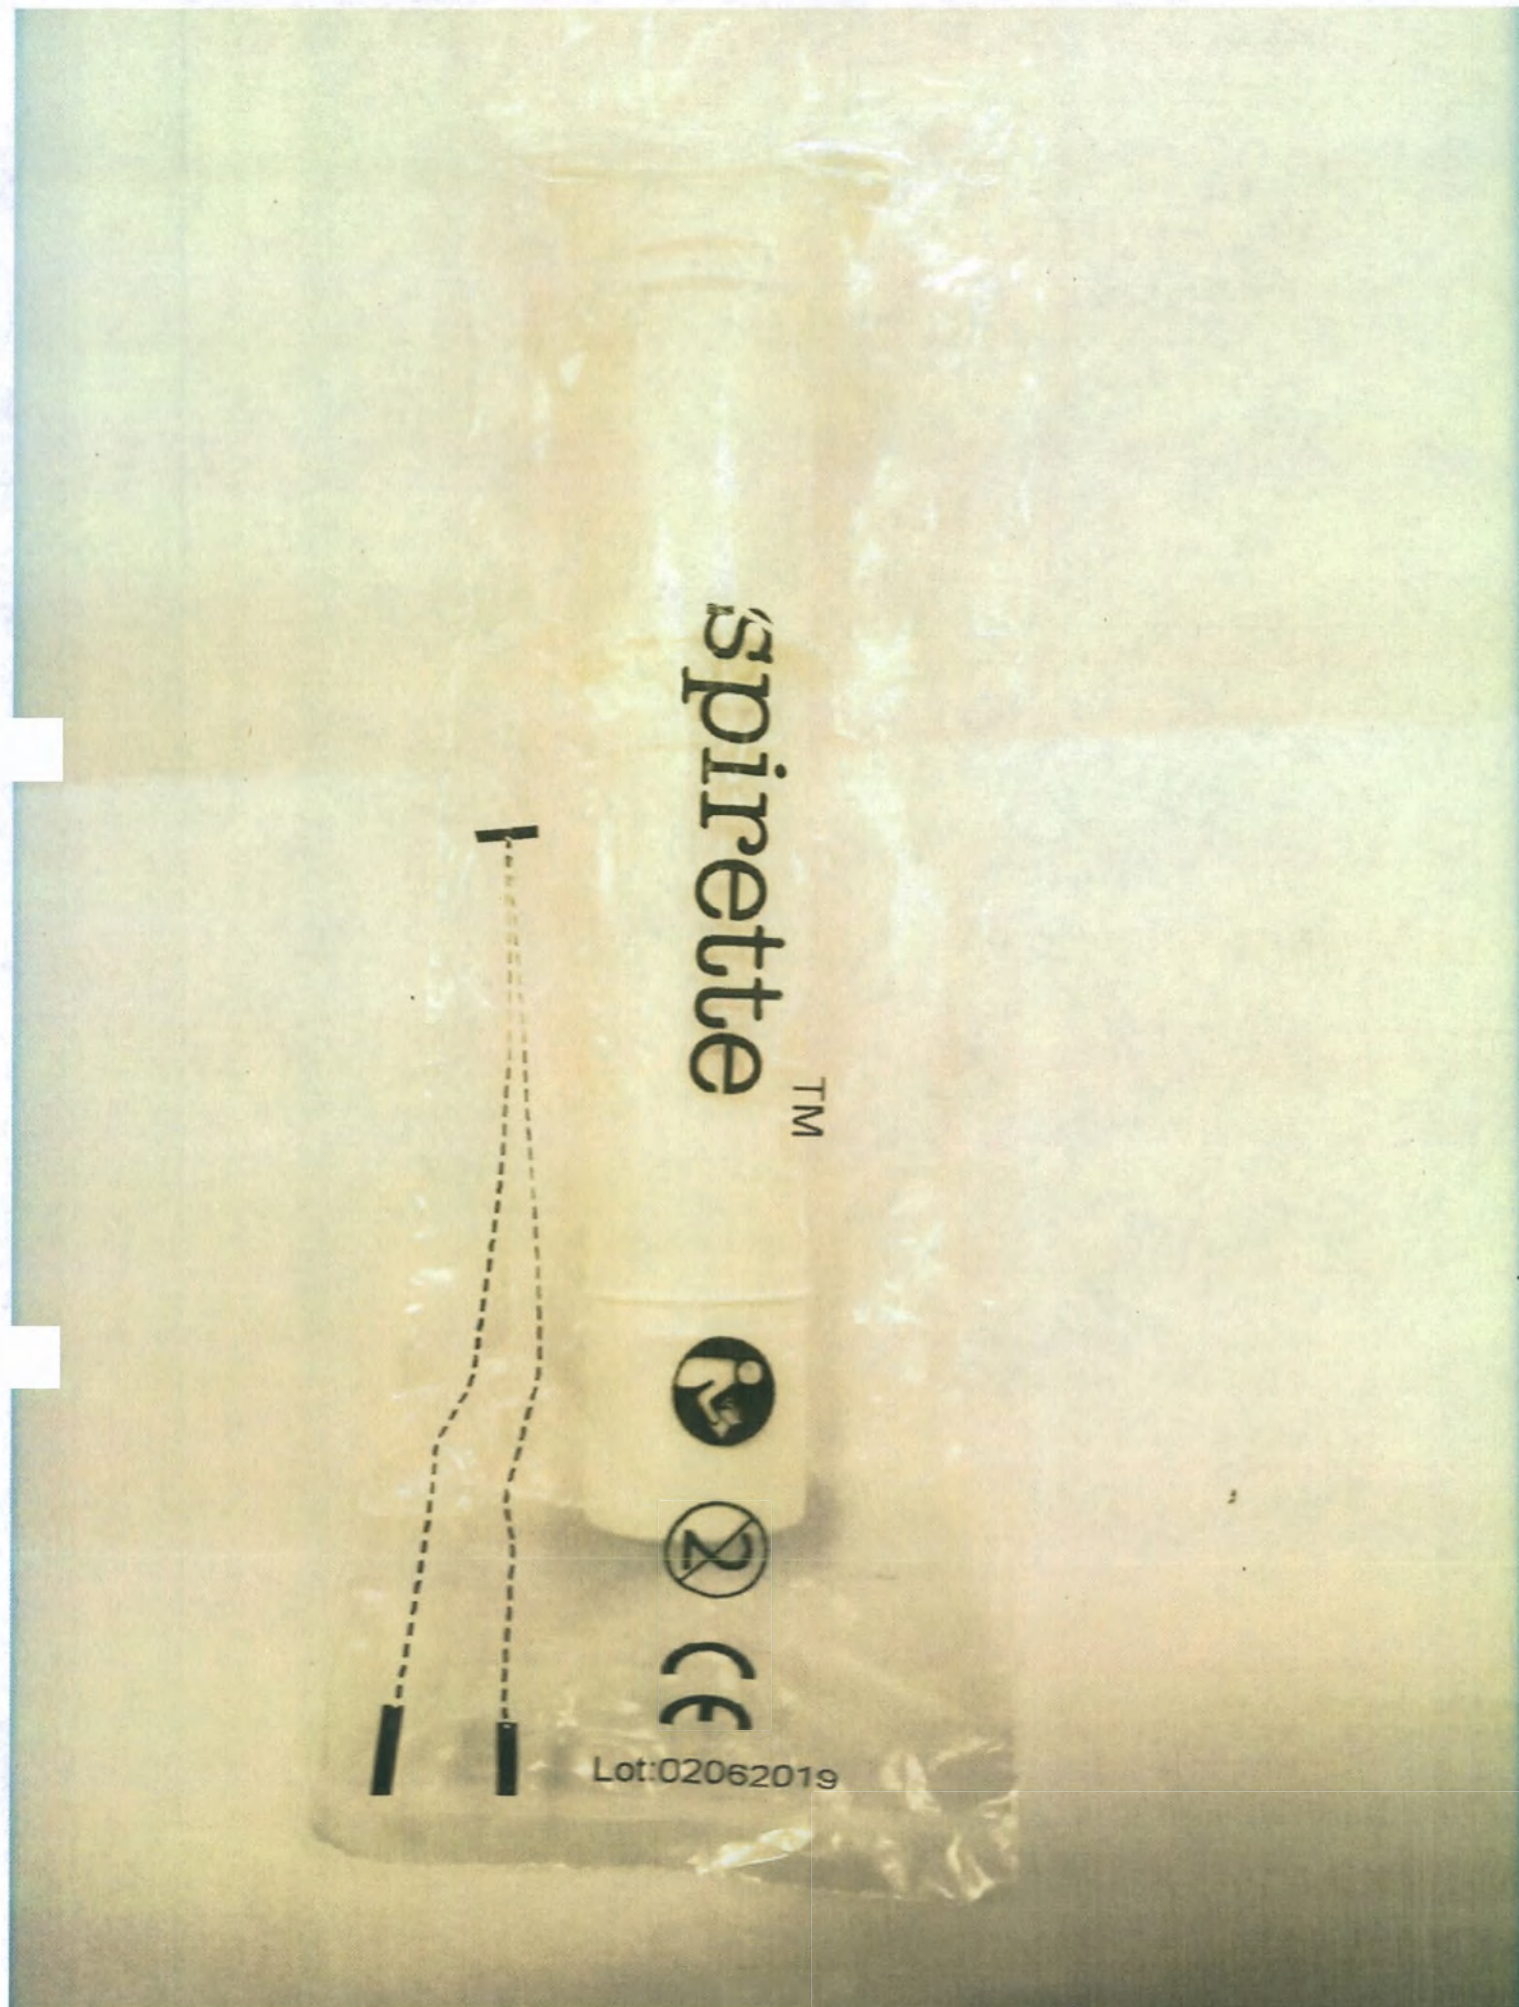


Фото 131.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

С принадлежностями: Принадлежности: 58. Загубник

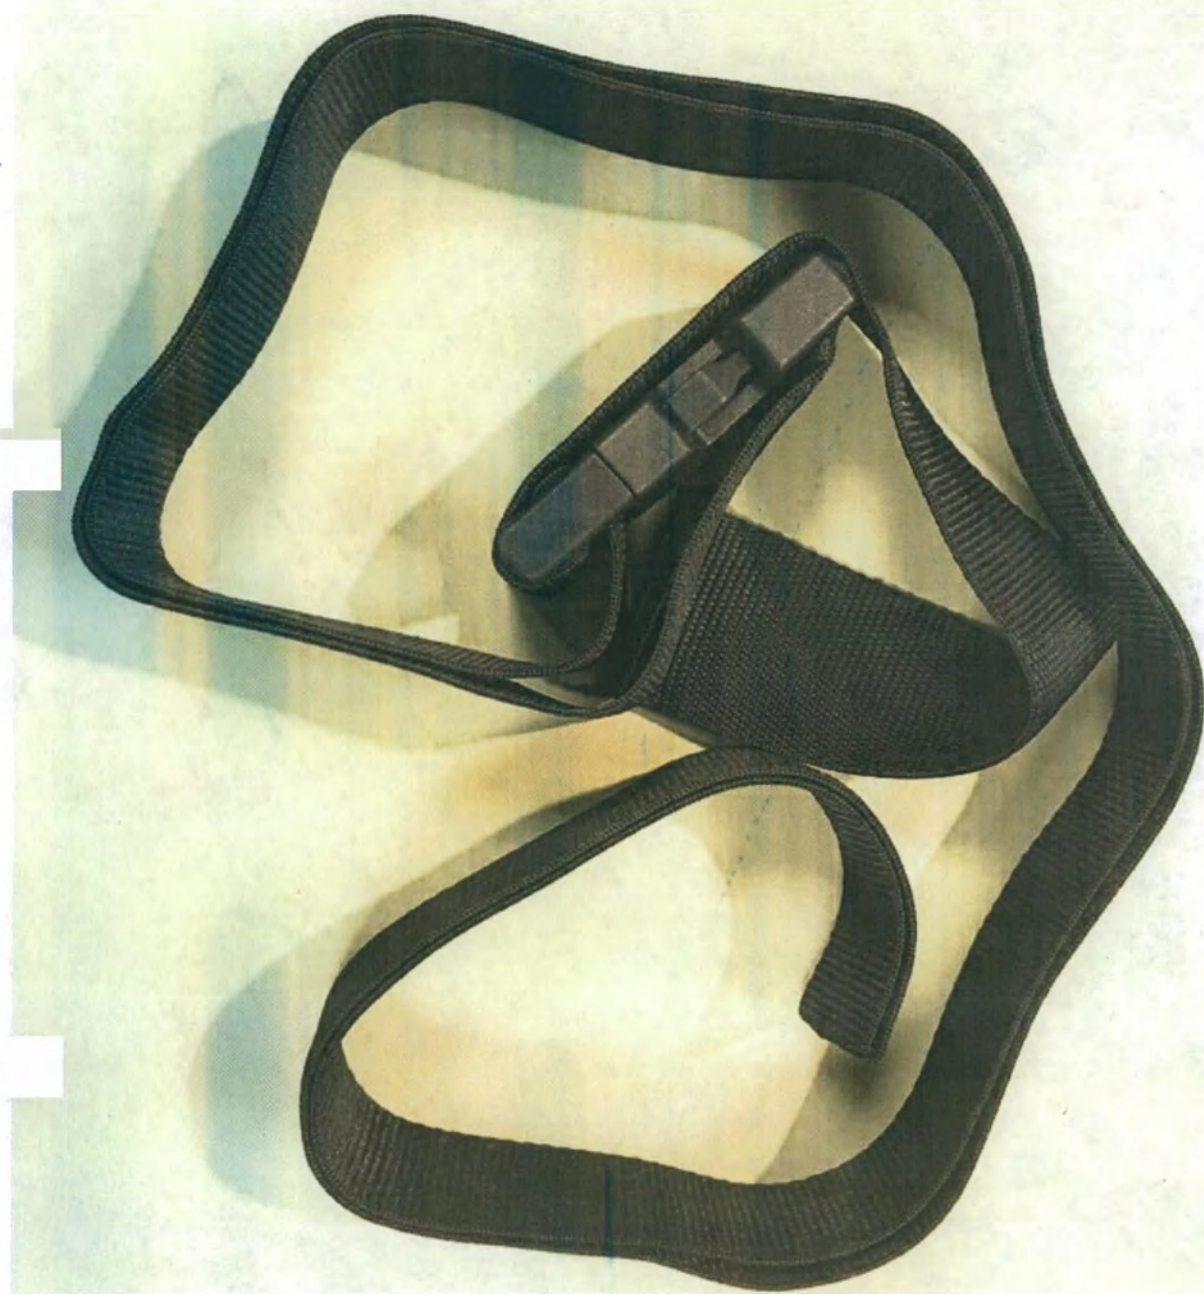


Фото132.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 59. Ремень для модуля пациента



Фото 133.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Принадлежности: 60. Чехол для модуля сбора данных

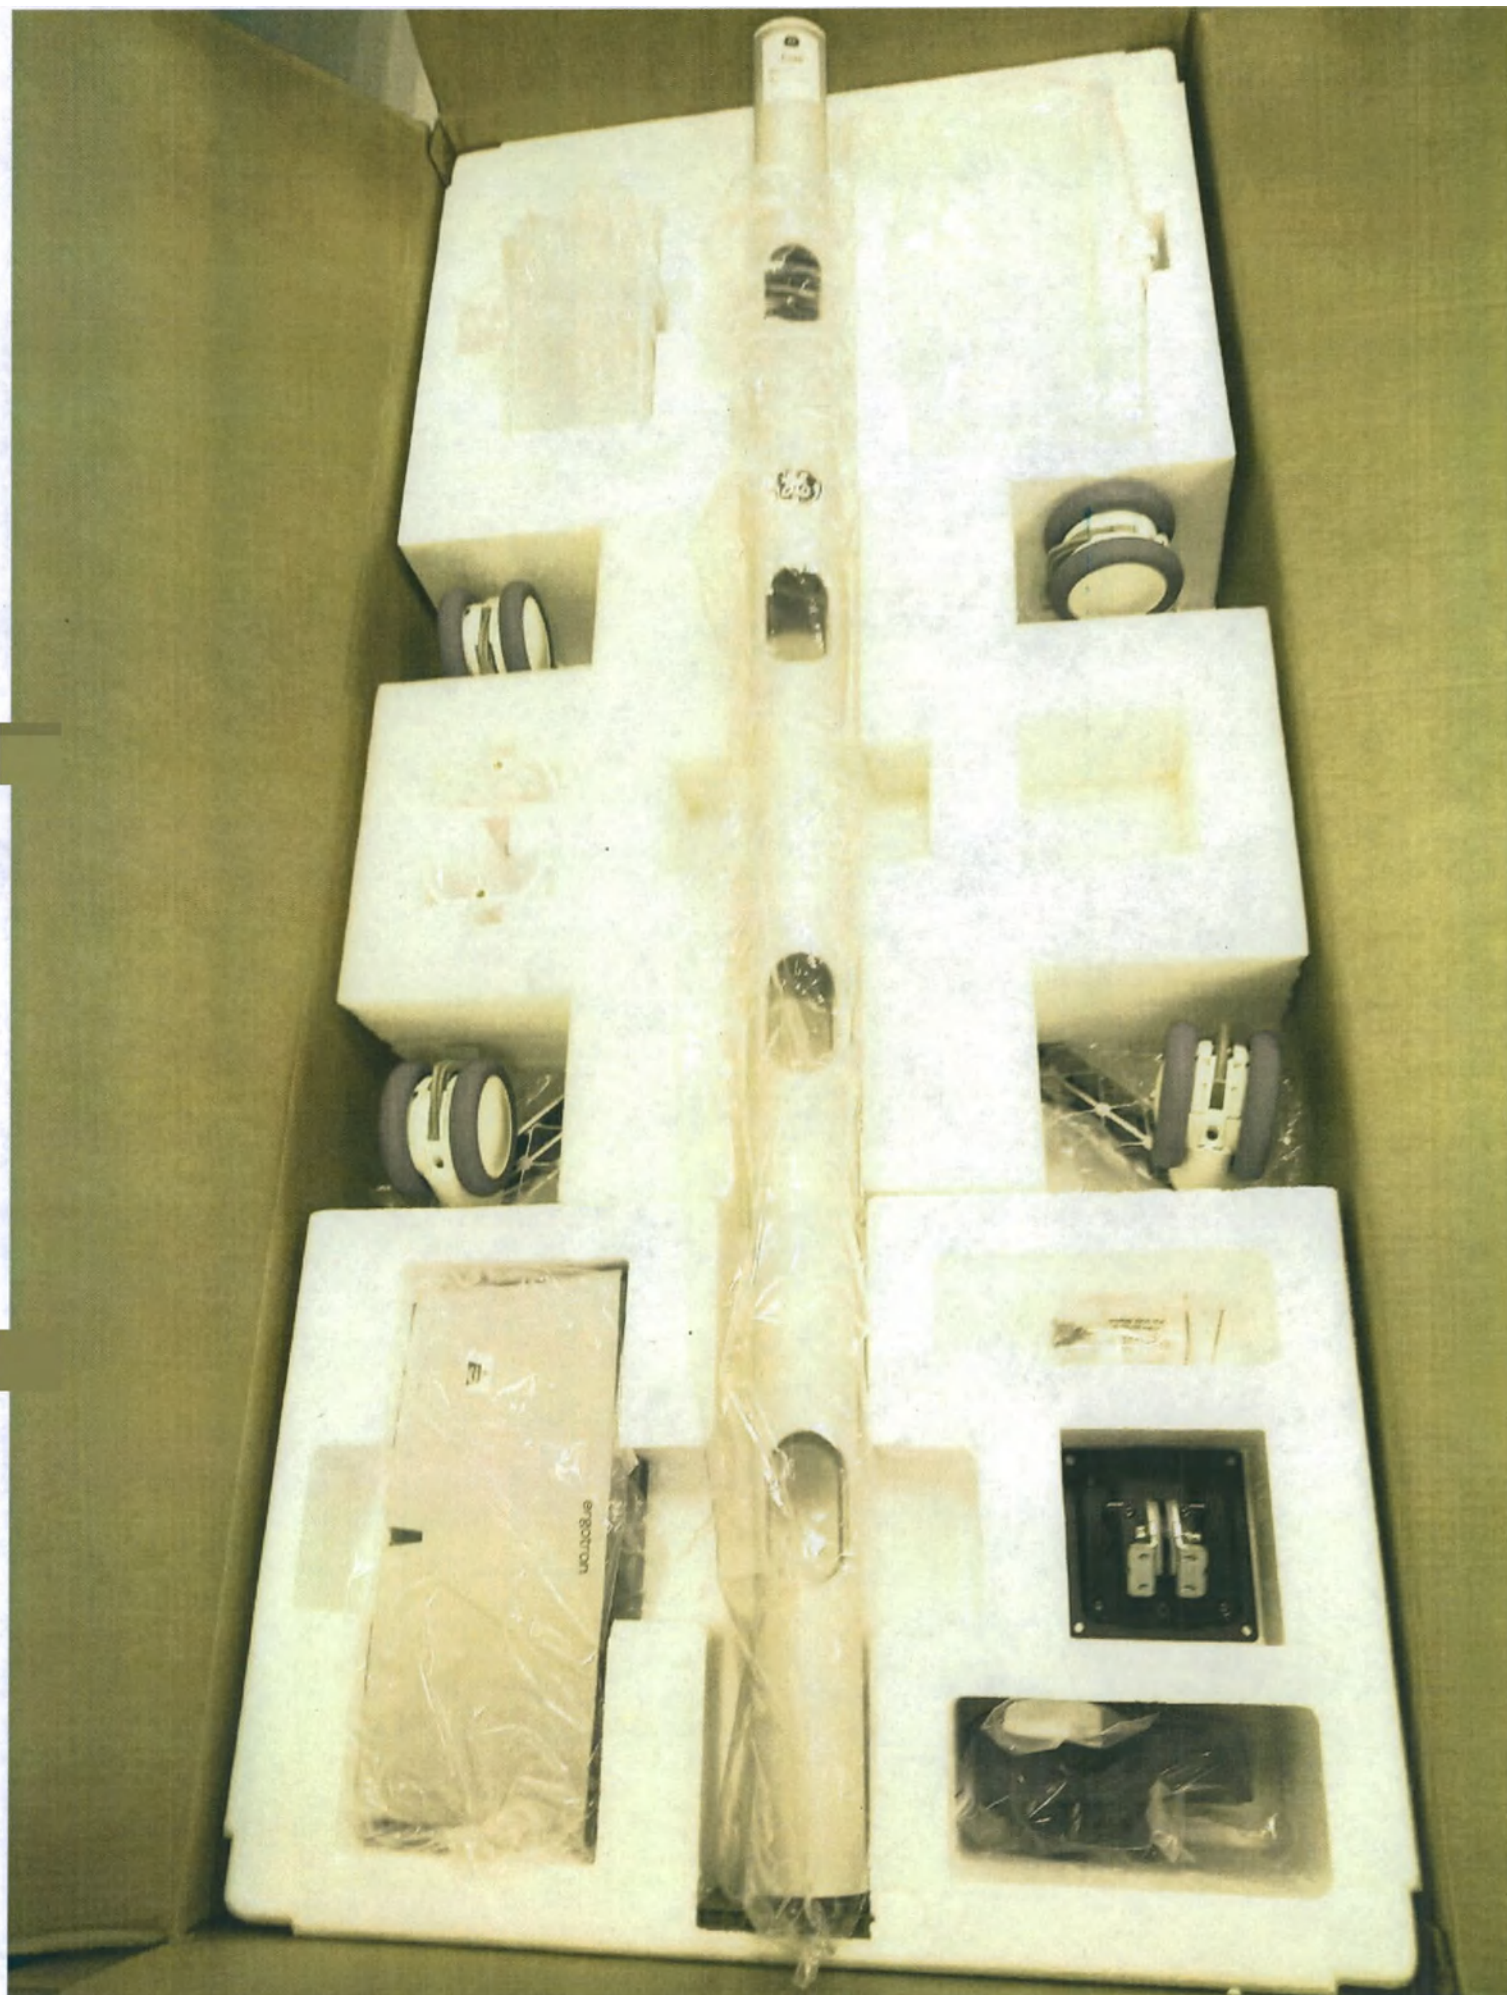


Фото 134.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 61. Консоль в упаковке

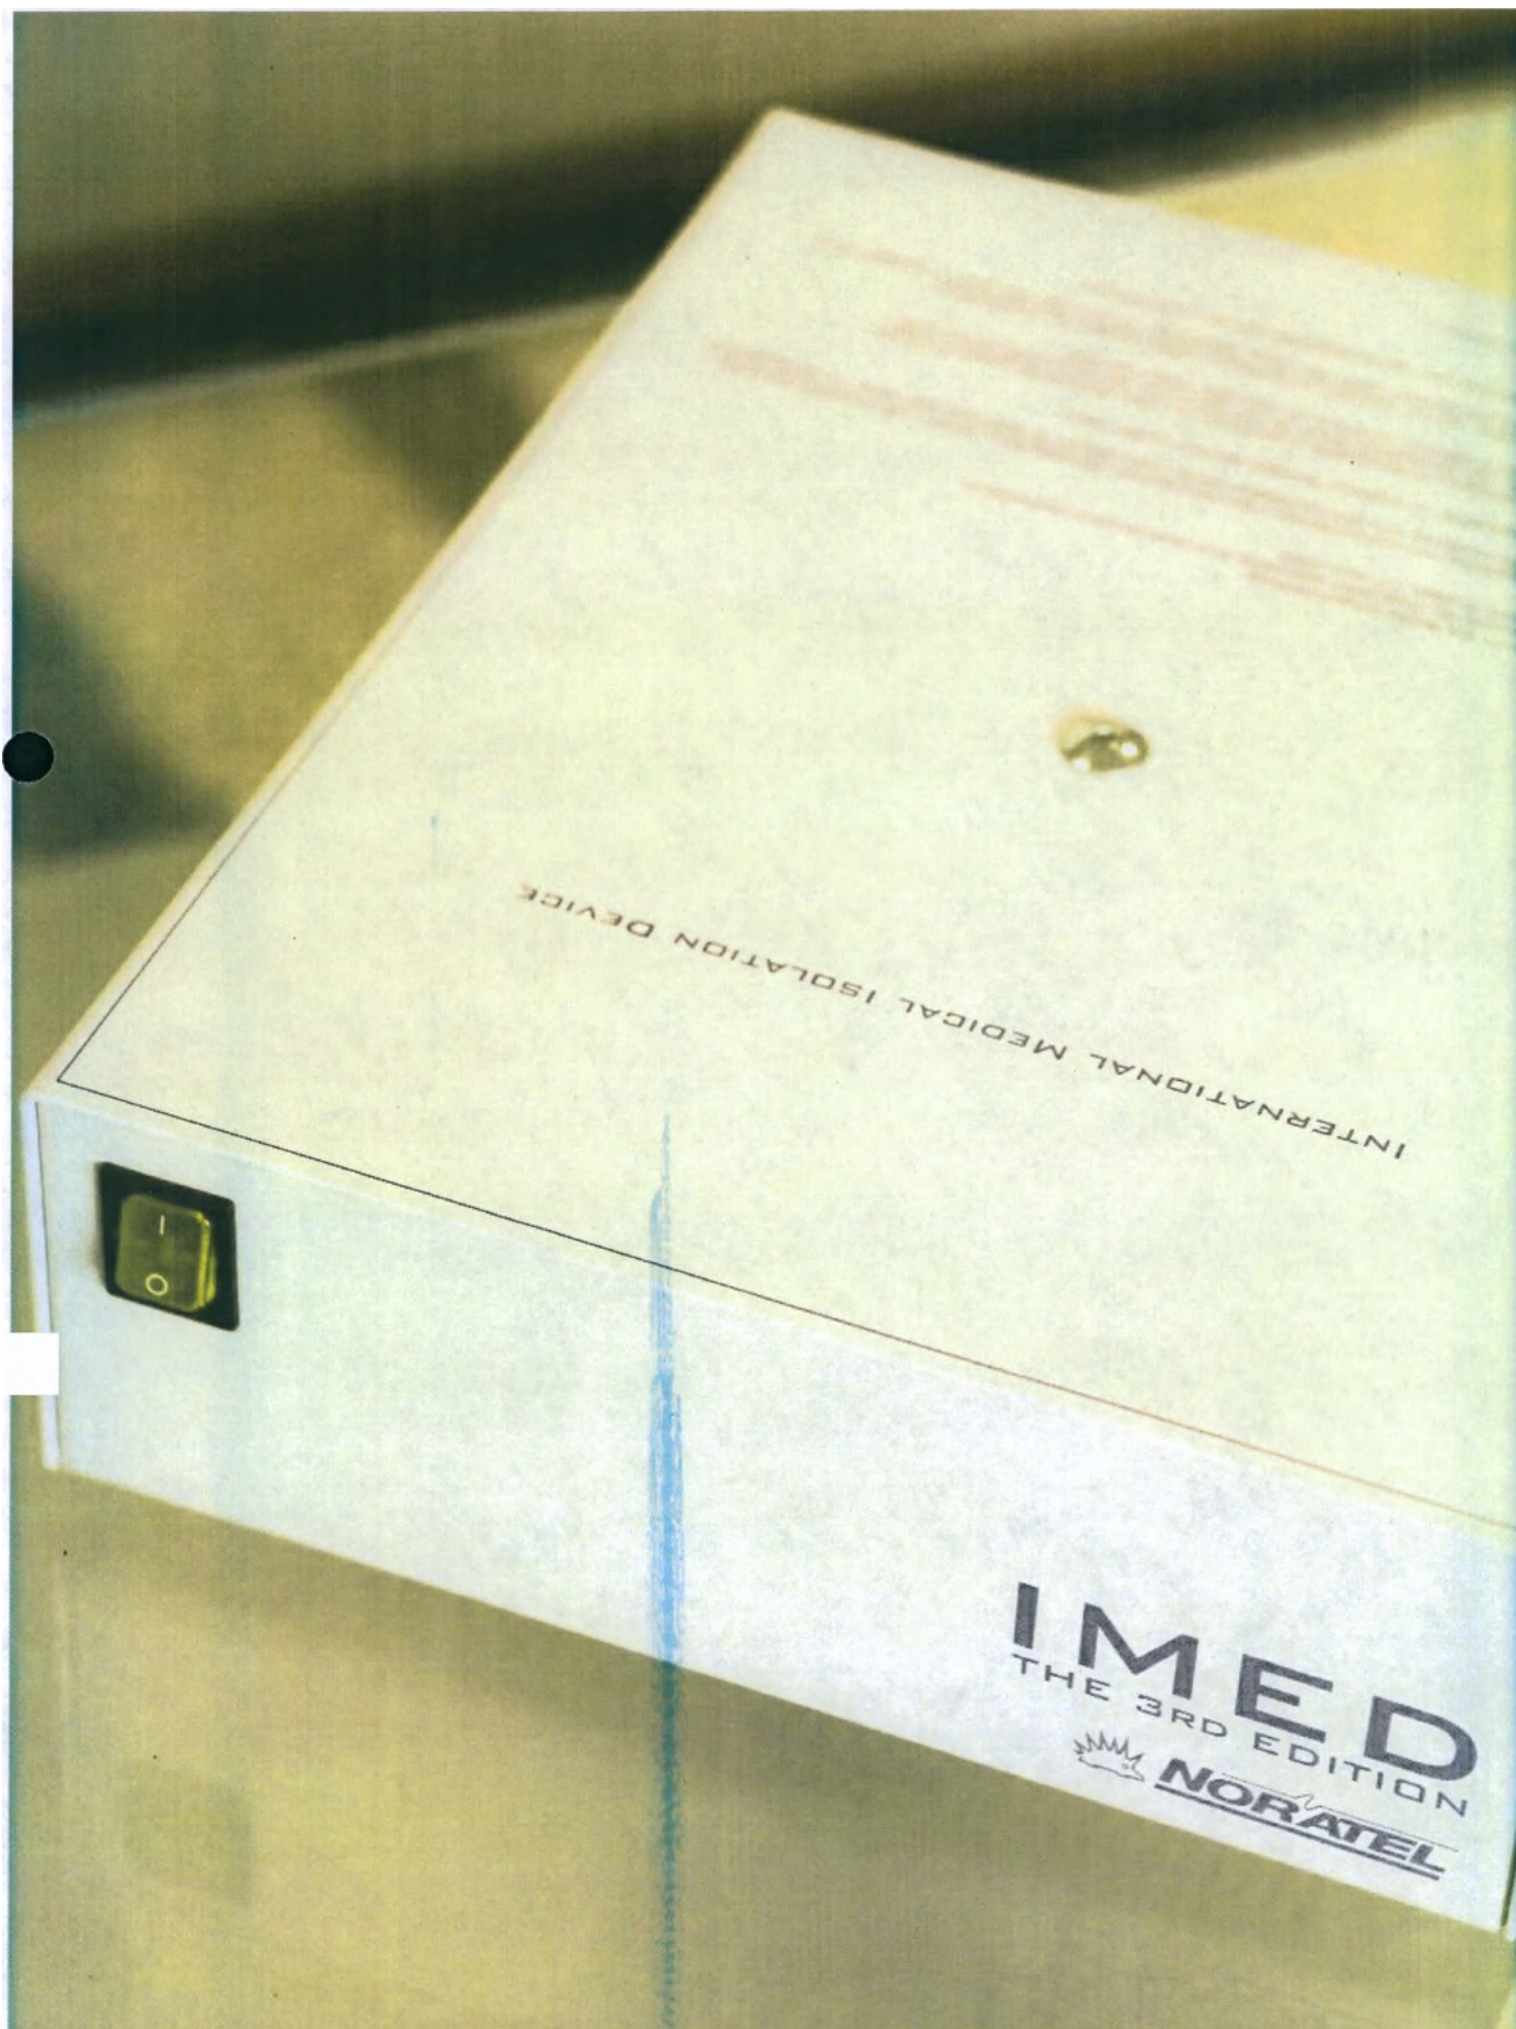


Фото 135.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

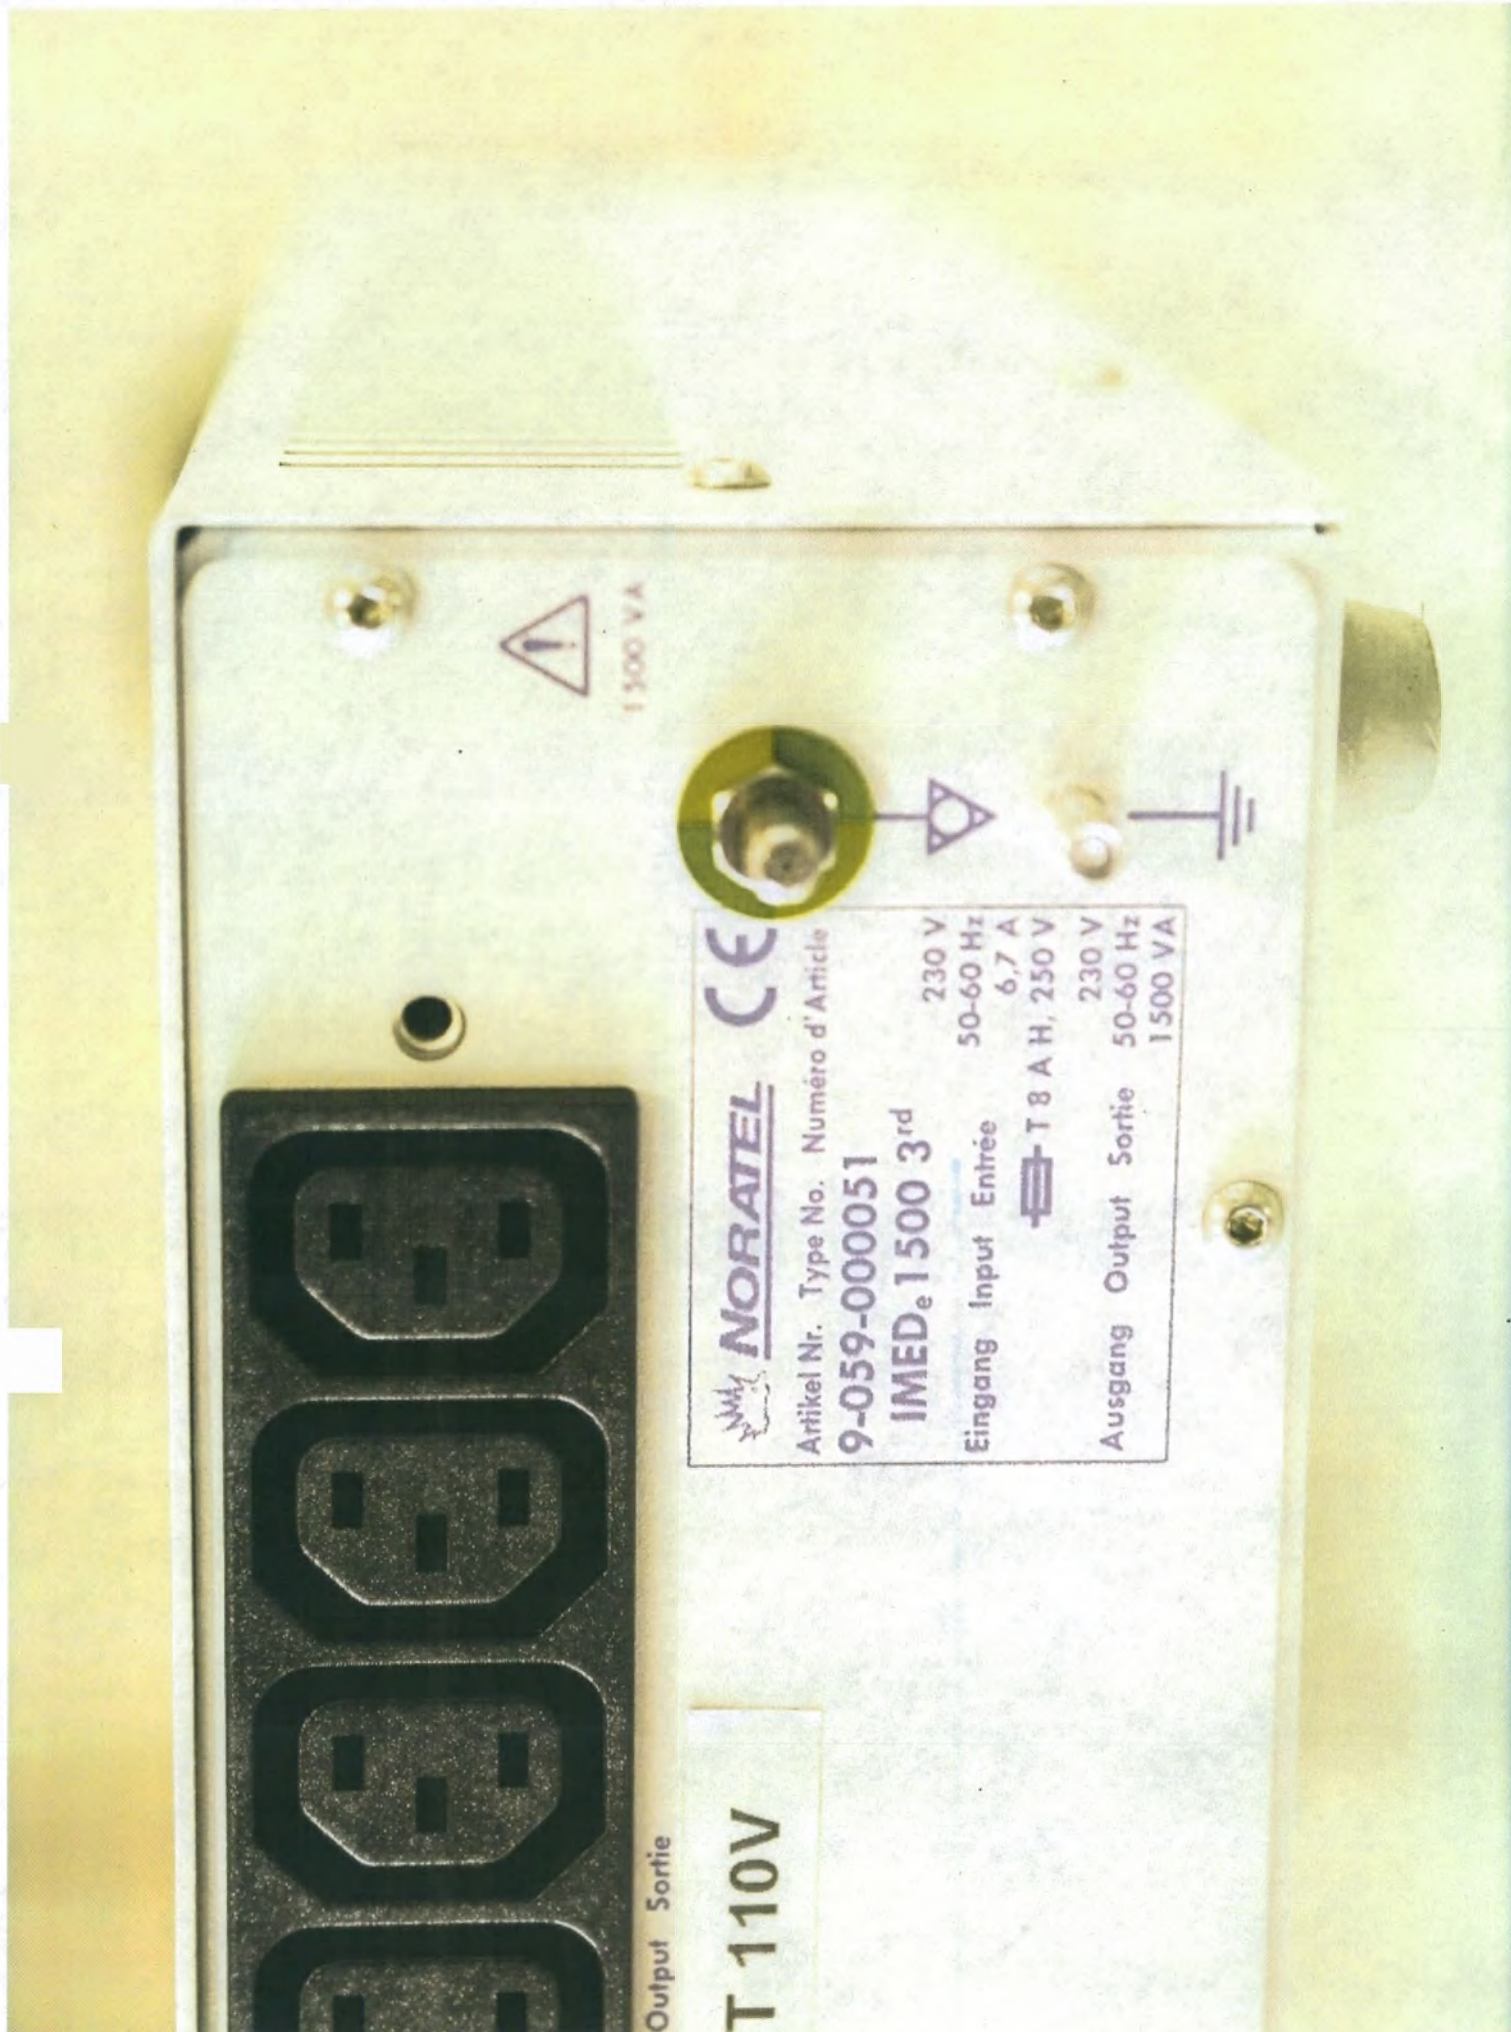


Фото 136.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft



Фото 137.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности: Принадлежности: 63.

Корзина консоли

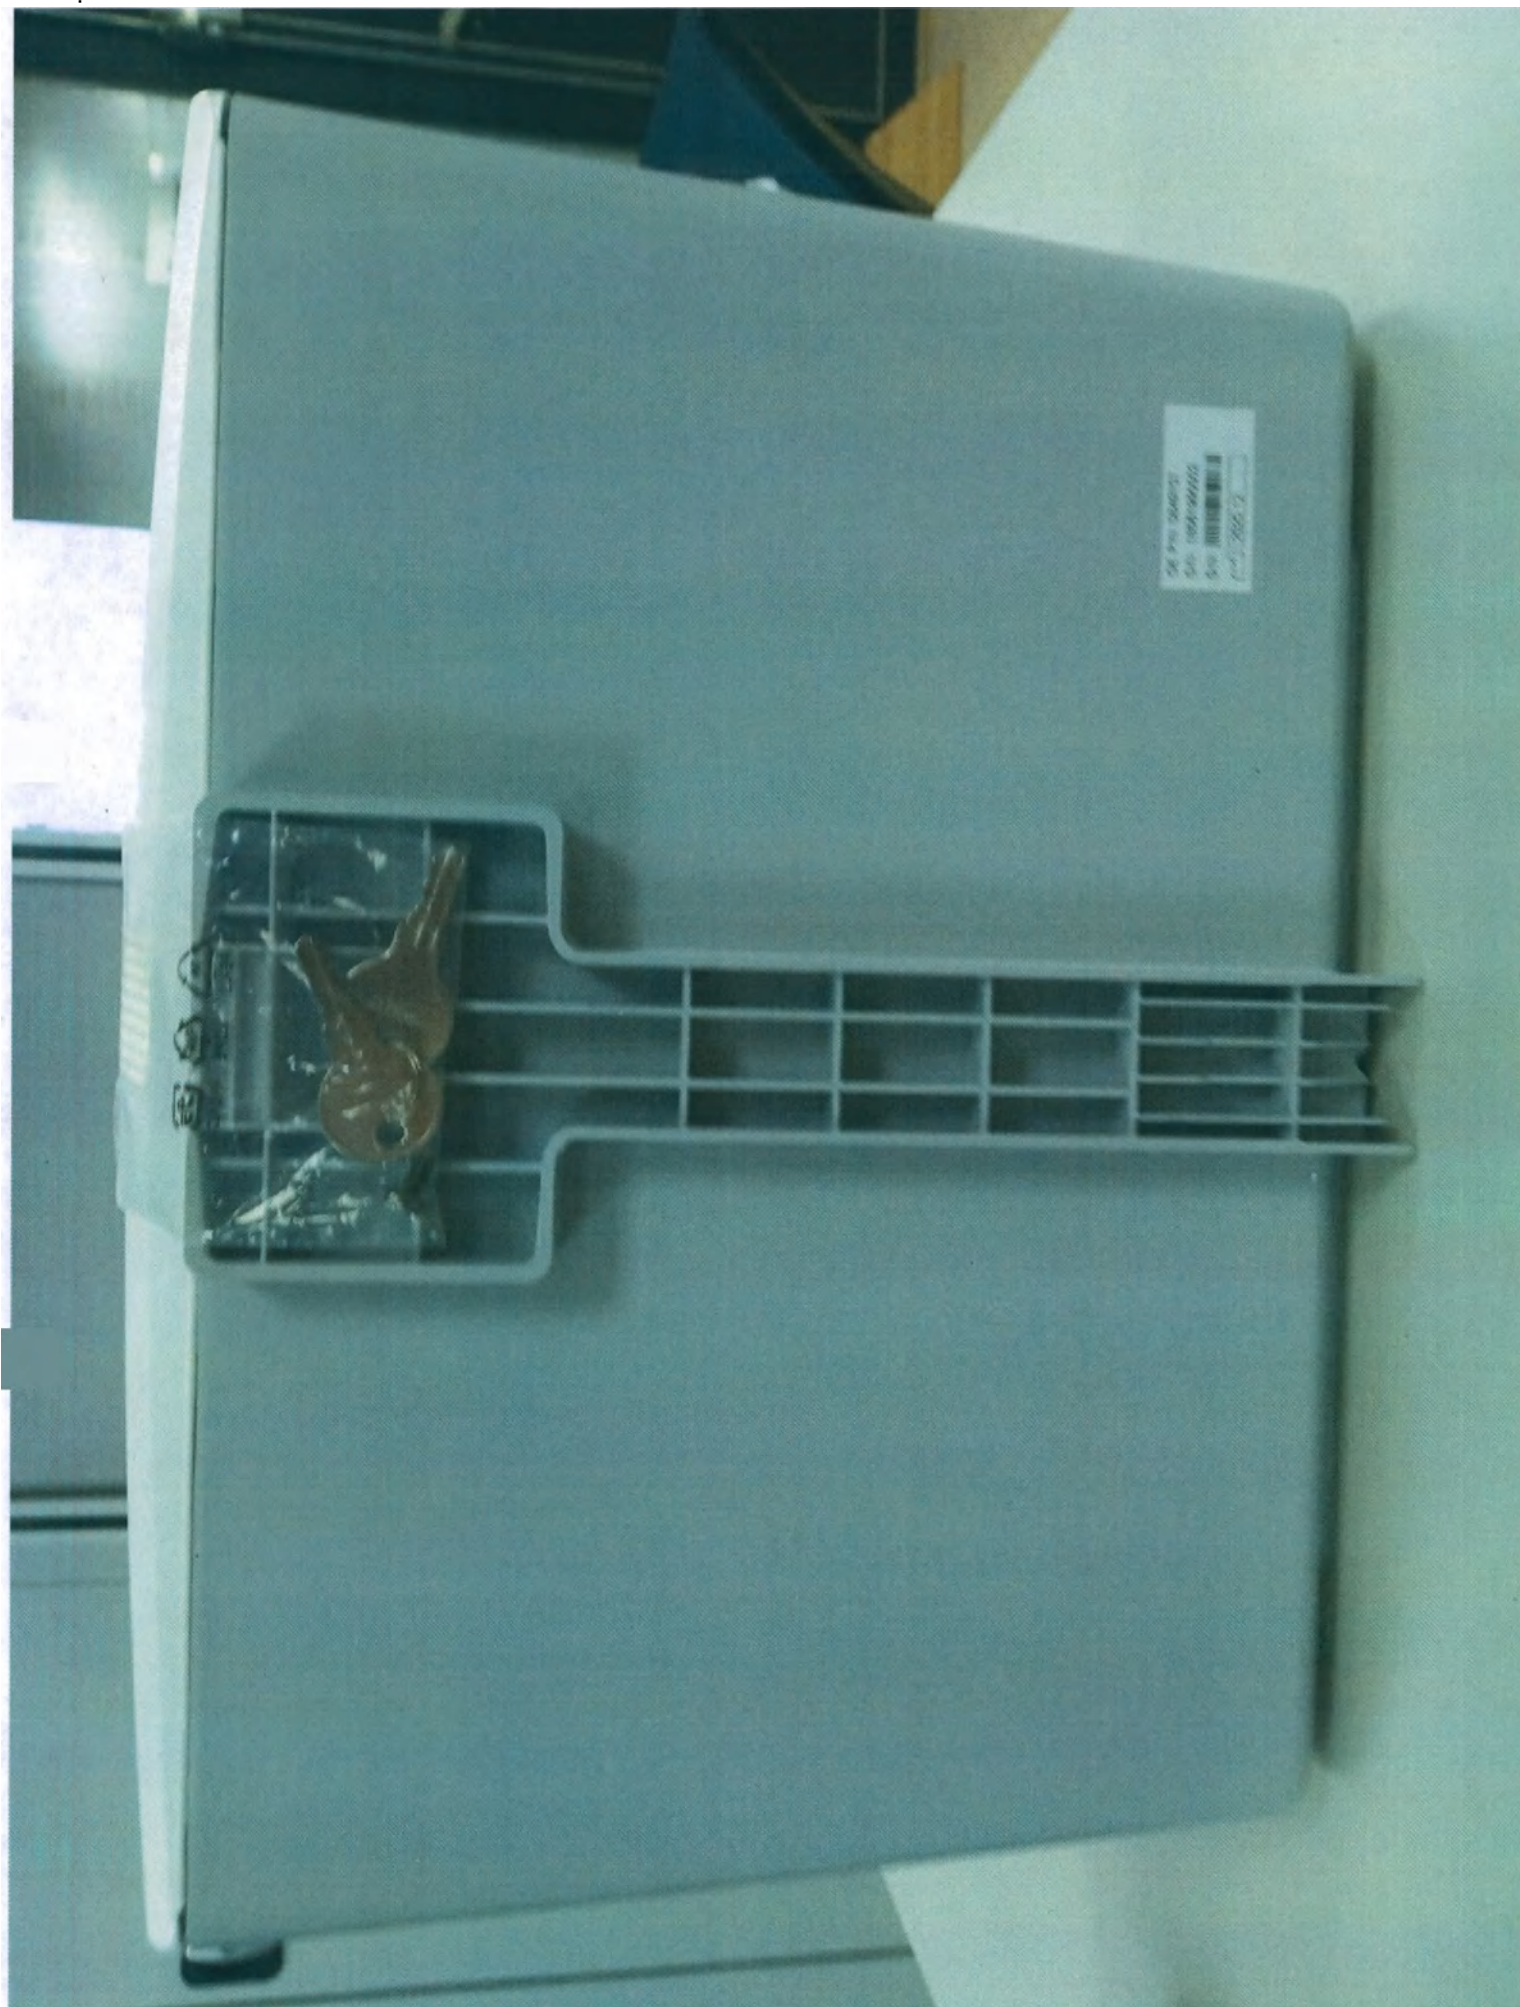


Фото 138.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

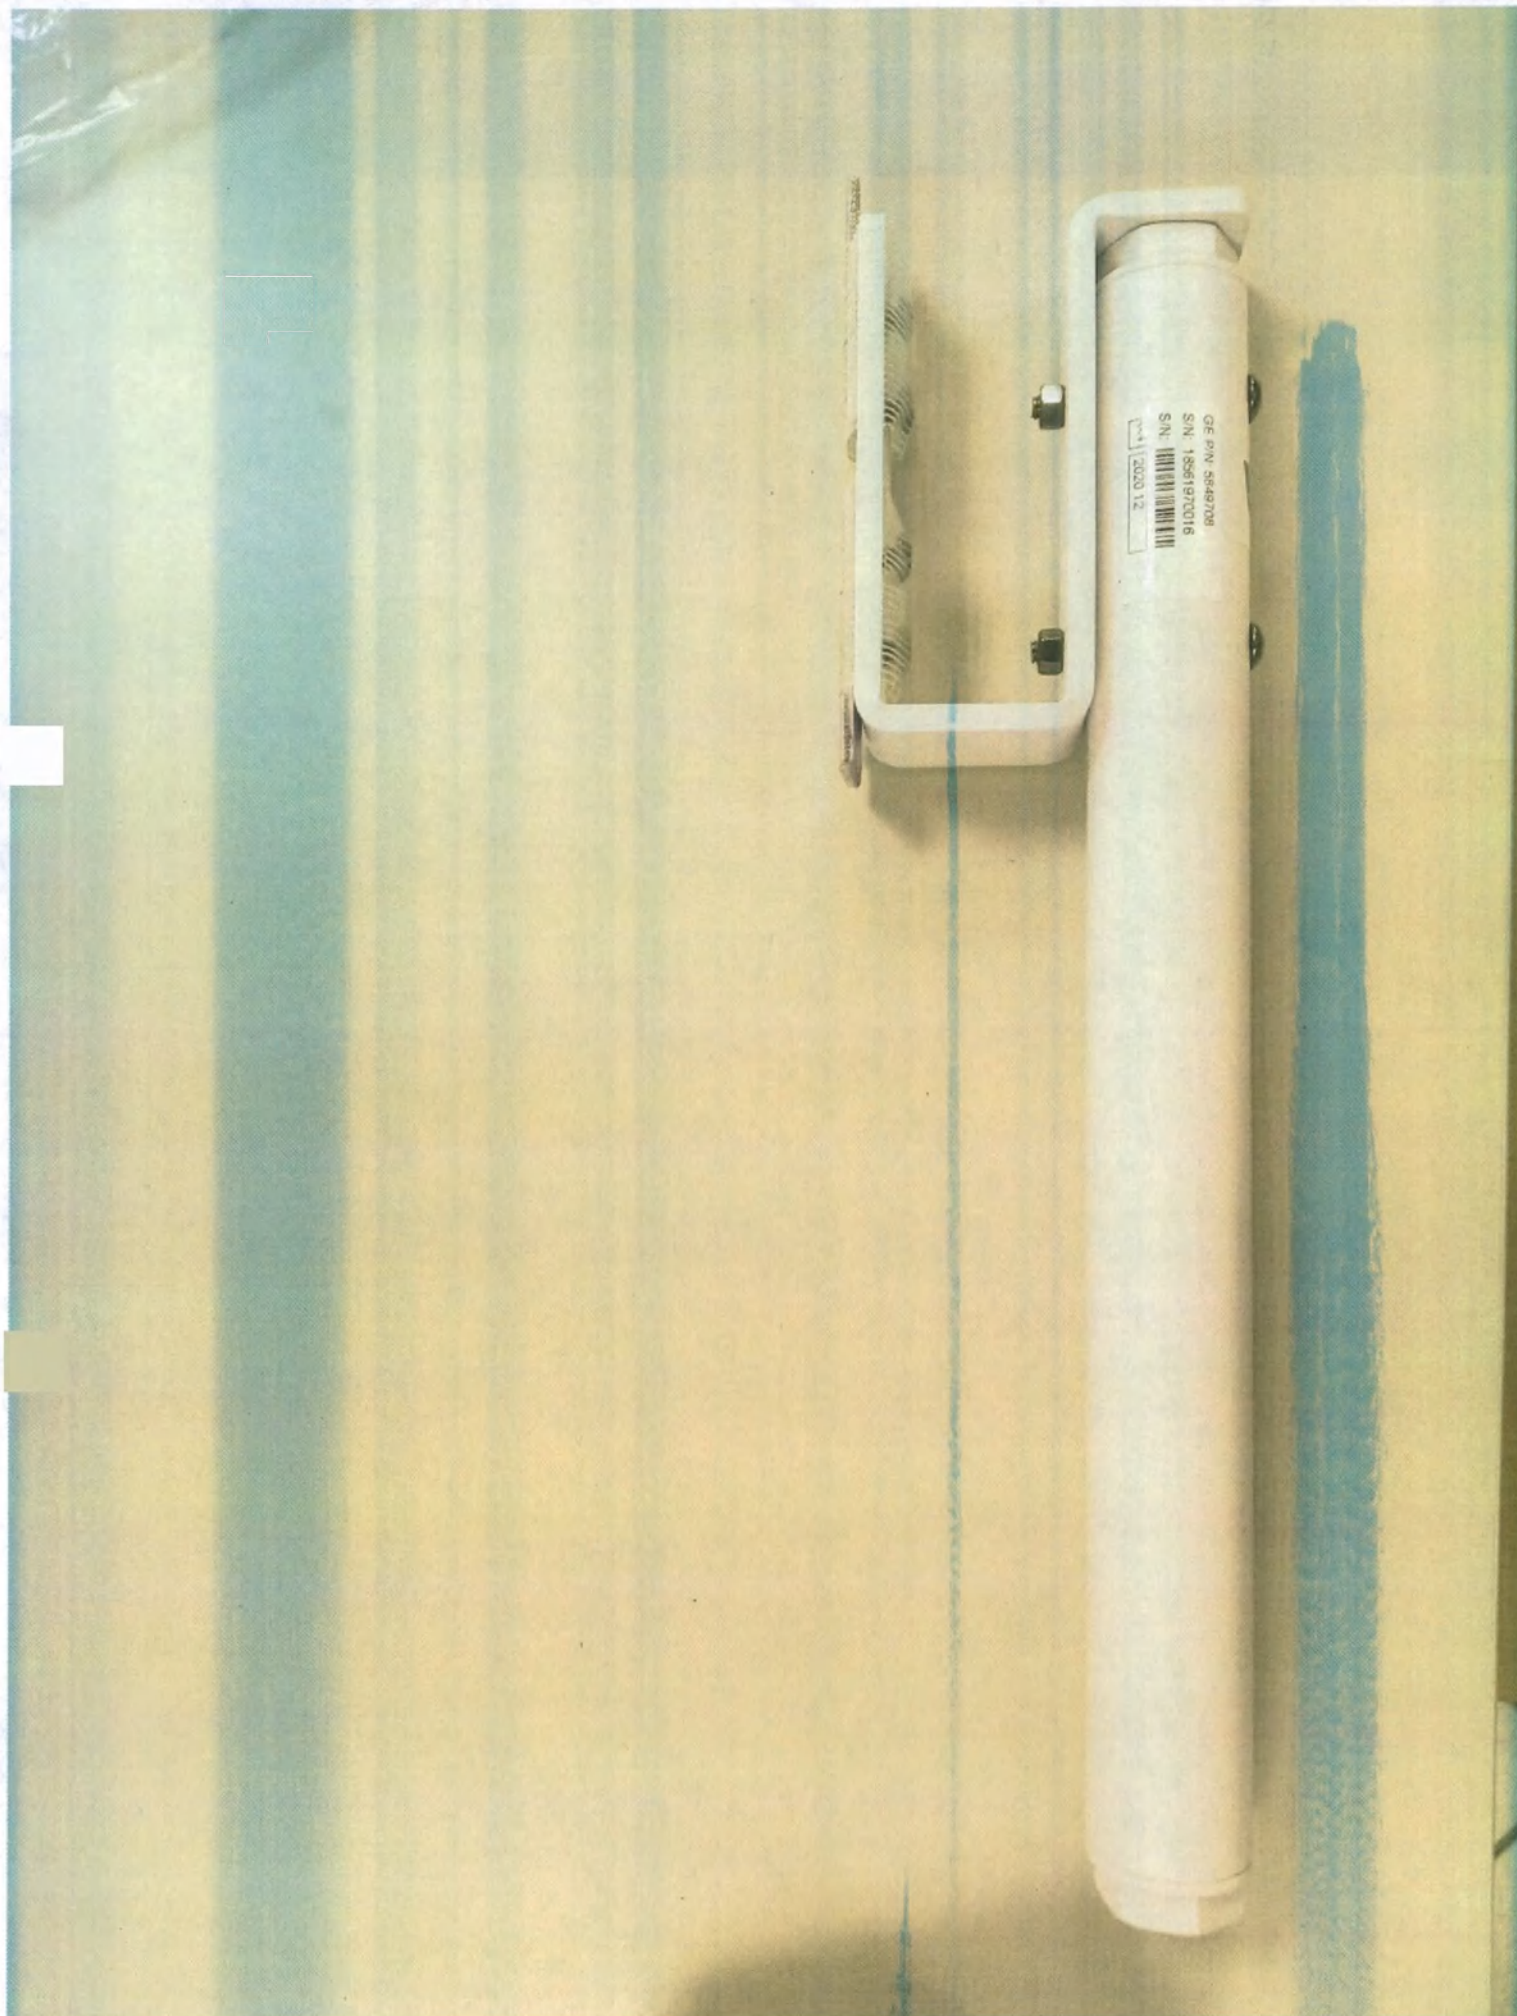


Фото 139.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft

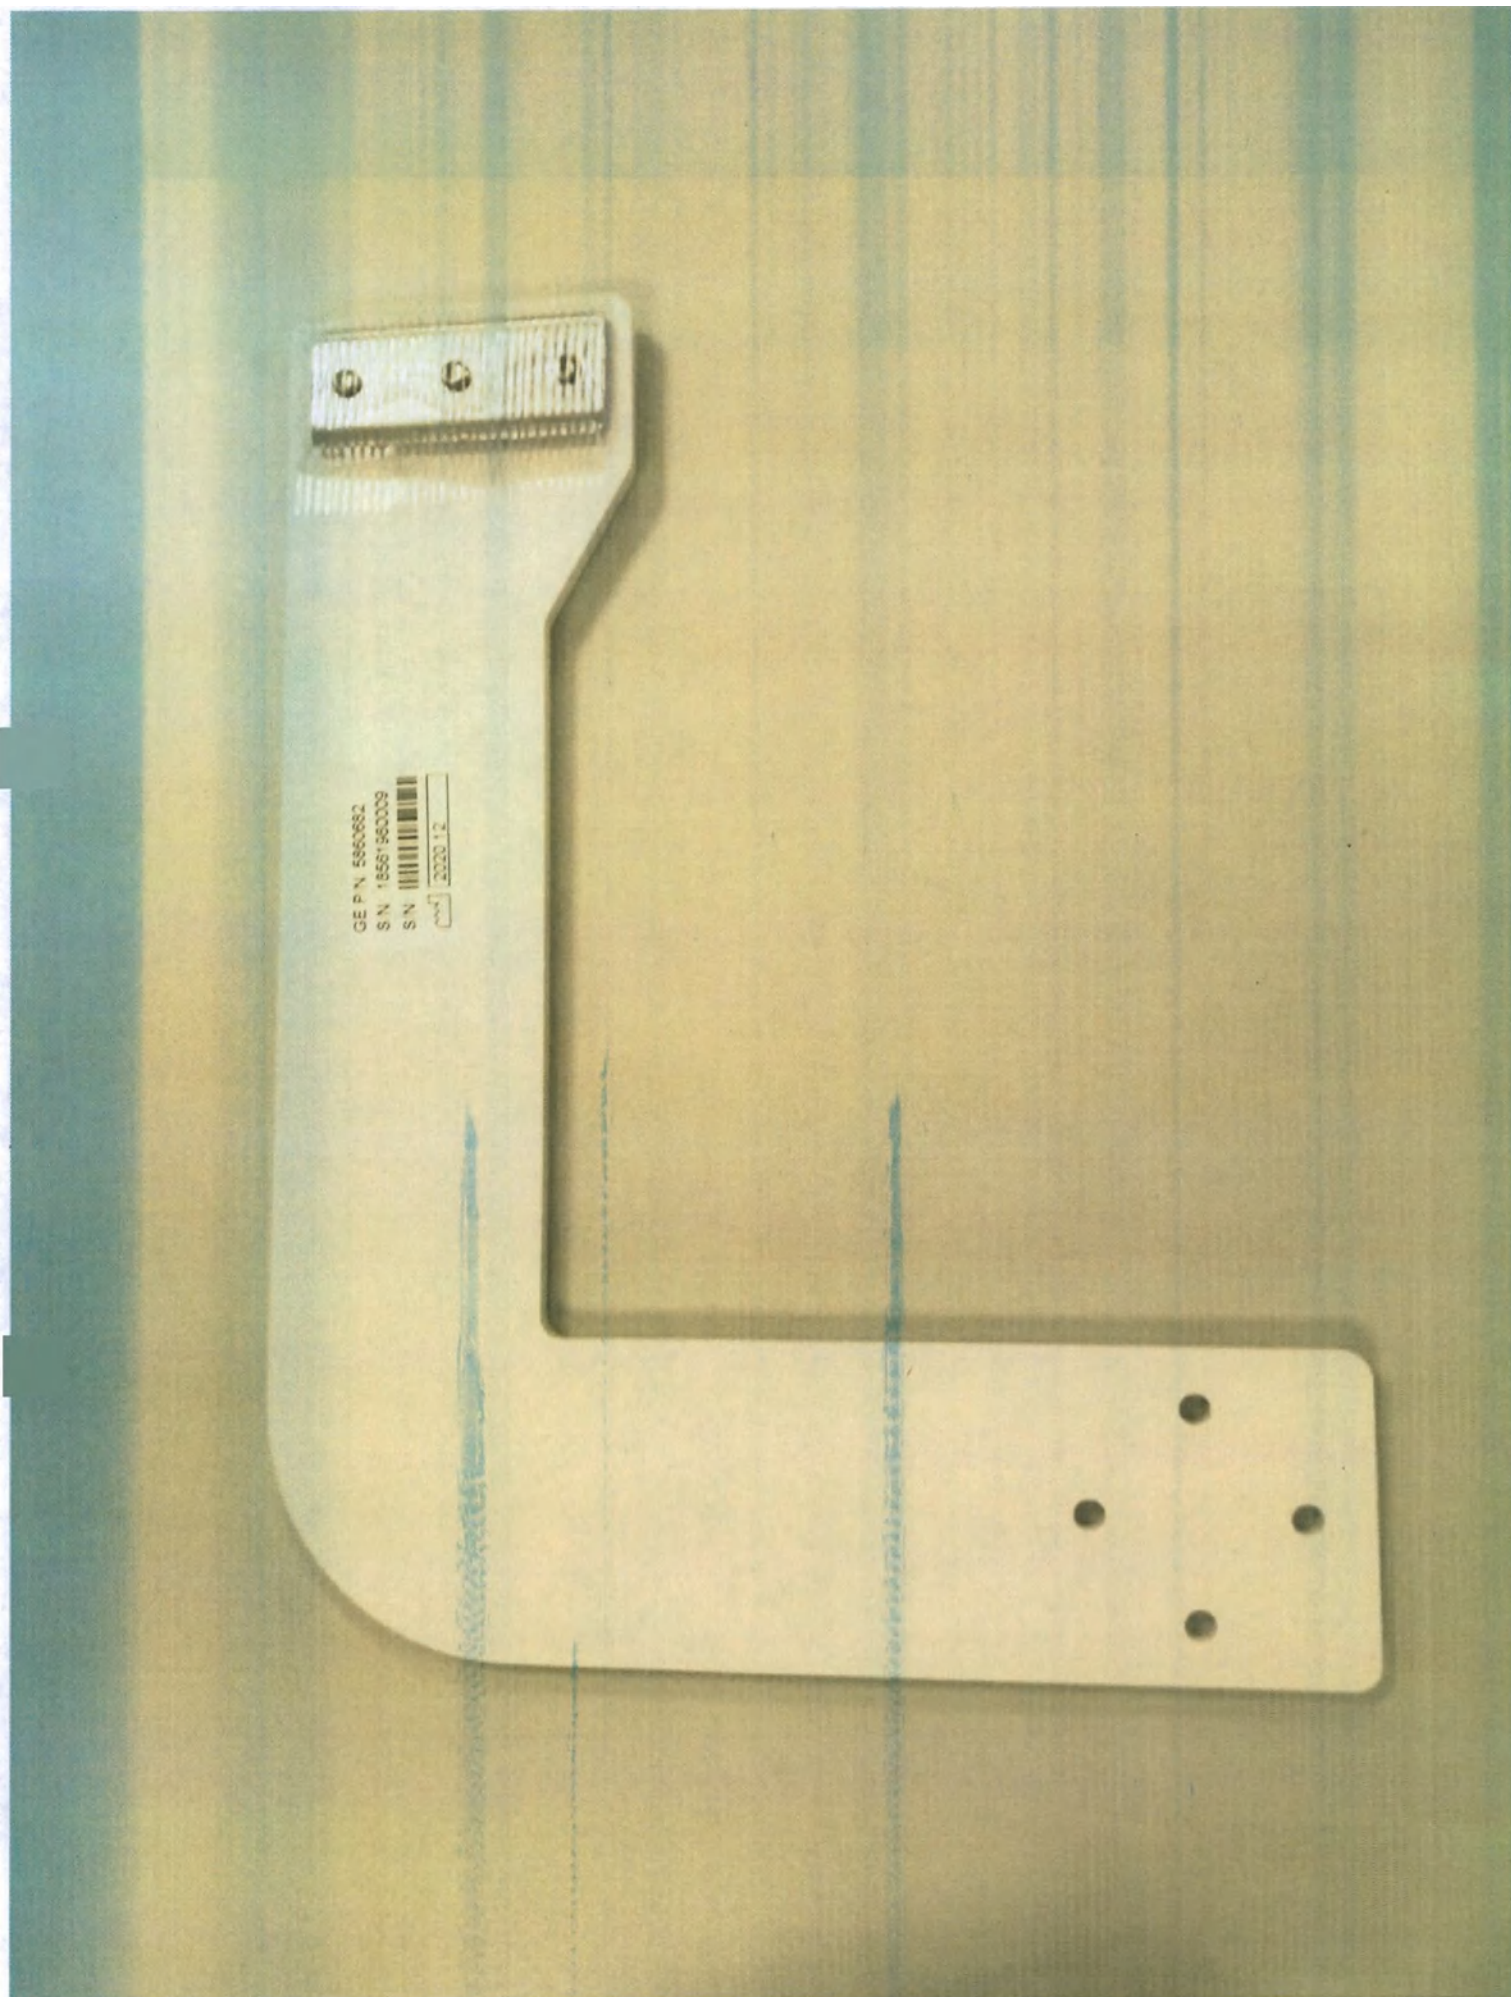


Фото 140

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft с принадлежностями: Принадлежности: 66. Держатель для Монитора артериального давления, SpO2 Tango M2.

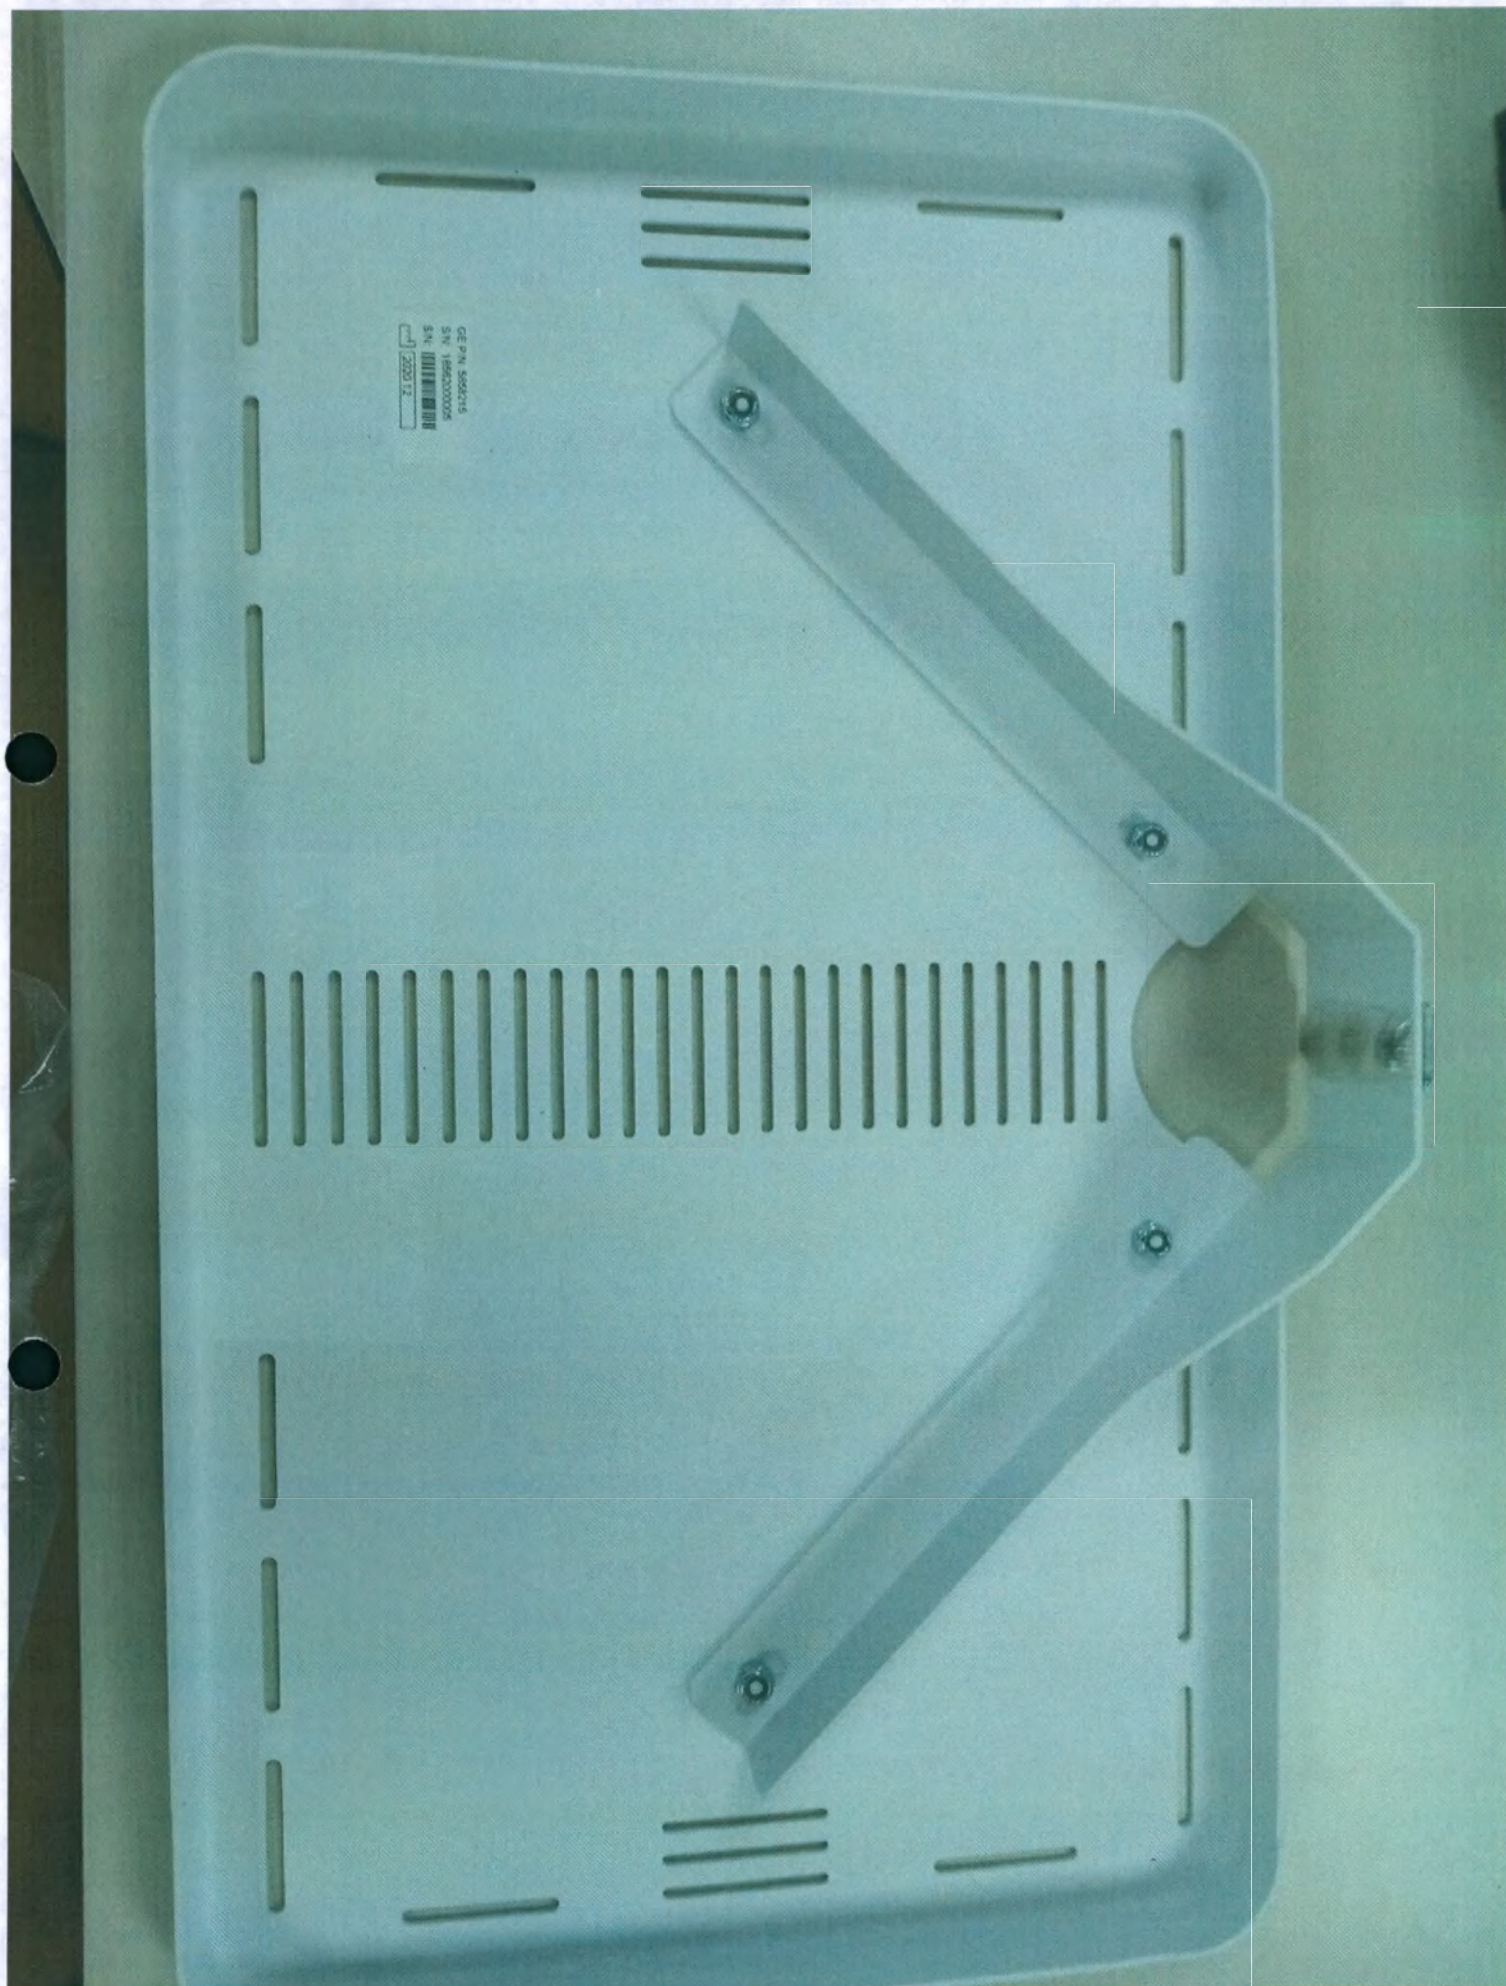


Фото 141.

Система функциональной диагностики, нагрузочных тестов и хранения данных CardioSoft
с принадлежностями: Принадлежности: 67. Полка консоли

ООО «Джий Хэлскеа»

Итого в настоящем документе

142 (сто сорок два) листа(-ов)

Лидер по регистрации

Дорофеева Ю.Н.

МП

