



Р-ФАРМ
Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина,
д. 19, корп. 1
+7 (495) 956 79 37
info@rpharm.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
медицинских изделий отдела регистрации
Медицинского департамента АО «Р-Фарм»

Е.И. Гелак

« 20 » 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениях
SU-1 -H-, SU-1 -S- с принадлежностями**

2023

I. Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1 -Н-

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1 -Н-

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FULFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм» 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Процессор ультразвуковой эндоскопический SU-1 -Н- (макет маркировки на русском языке)



Процессор ультразвуковой эндоскопический SU-1 -H-



Клавиатура для ультразвуковых процессоров, исполнения СР-1




Клавиатура для ультразвуковых процессоров, исполнения СР-1ТВ.




Тележка установочная РС-410




Видеомонитор жидкокристаллический эндоскопический CDL1909A

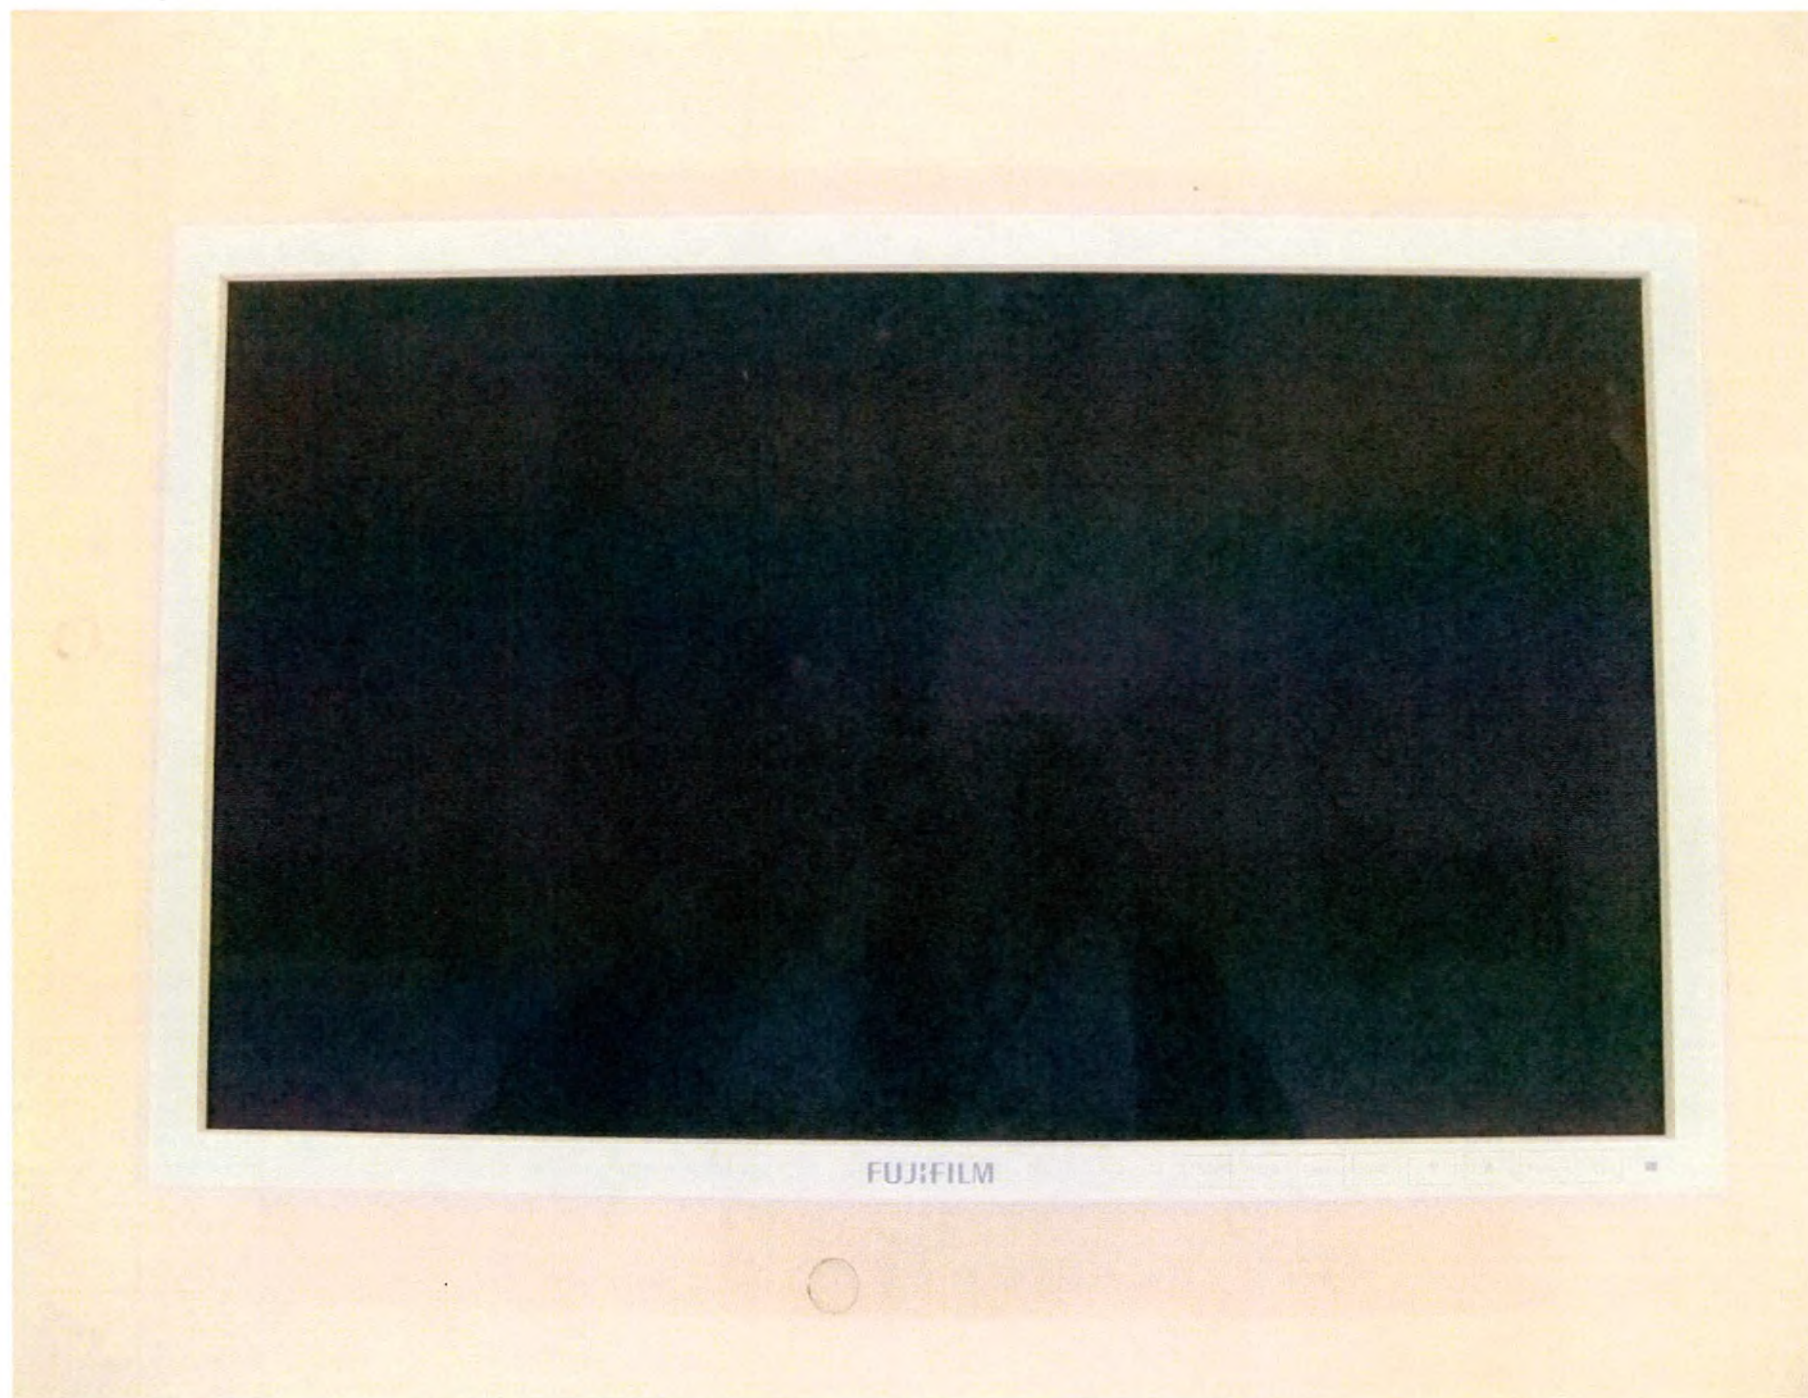


Видеомонитор жидкокристаллический эндоскопический CL-22

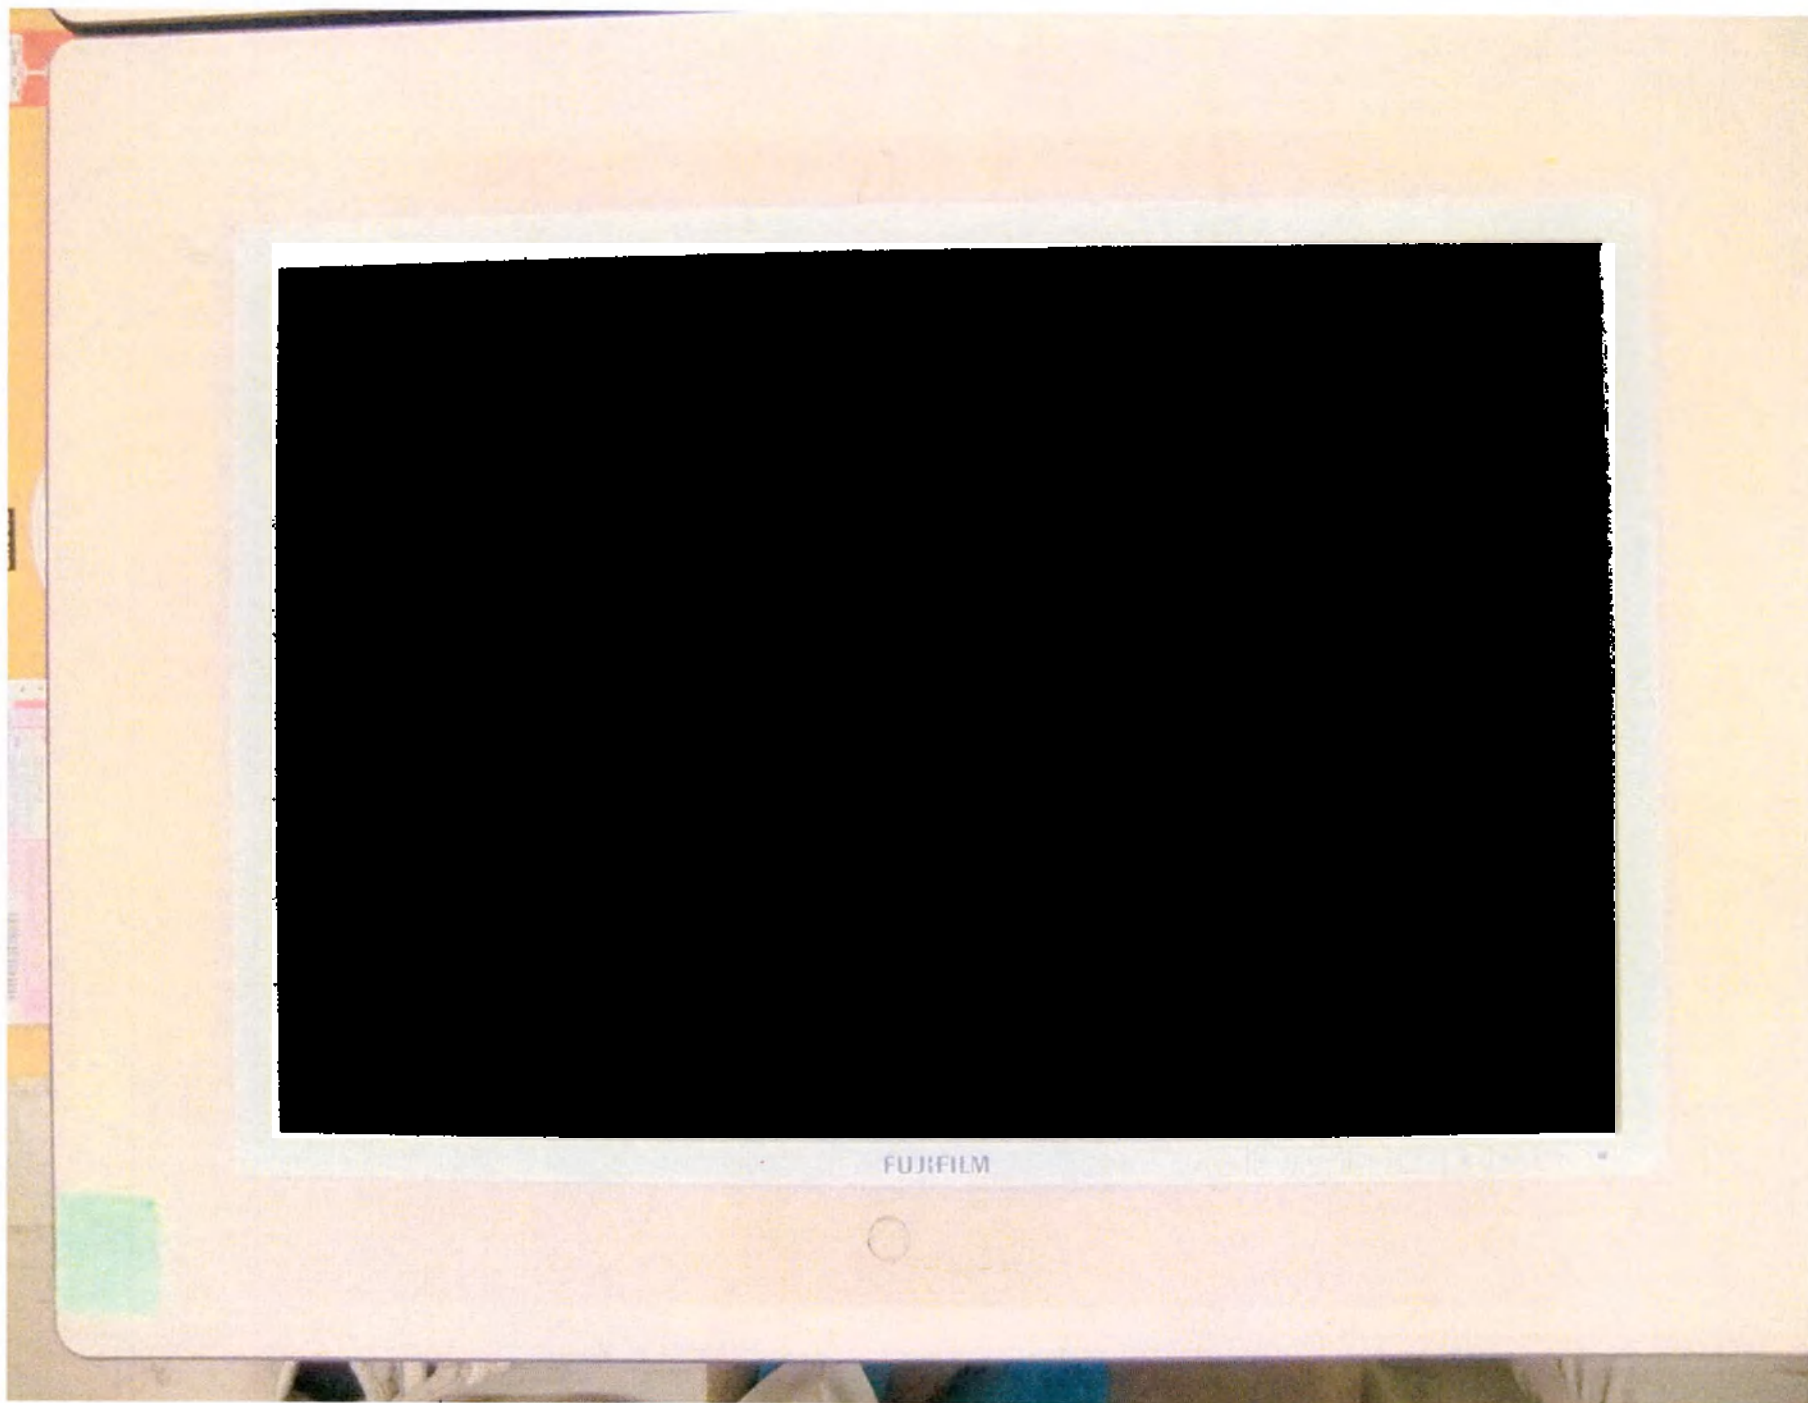

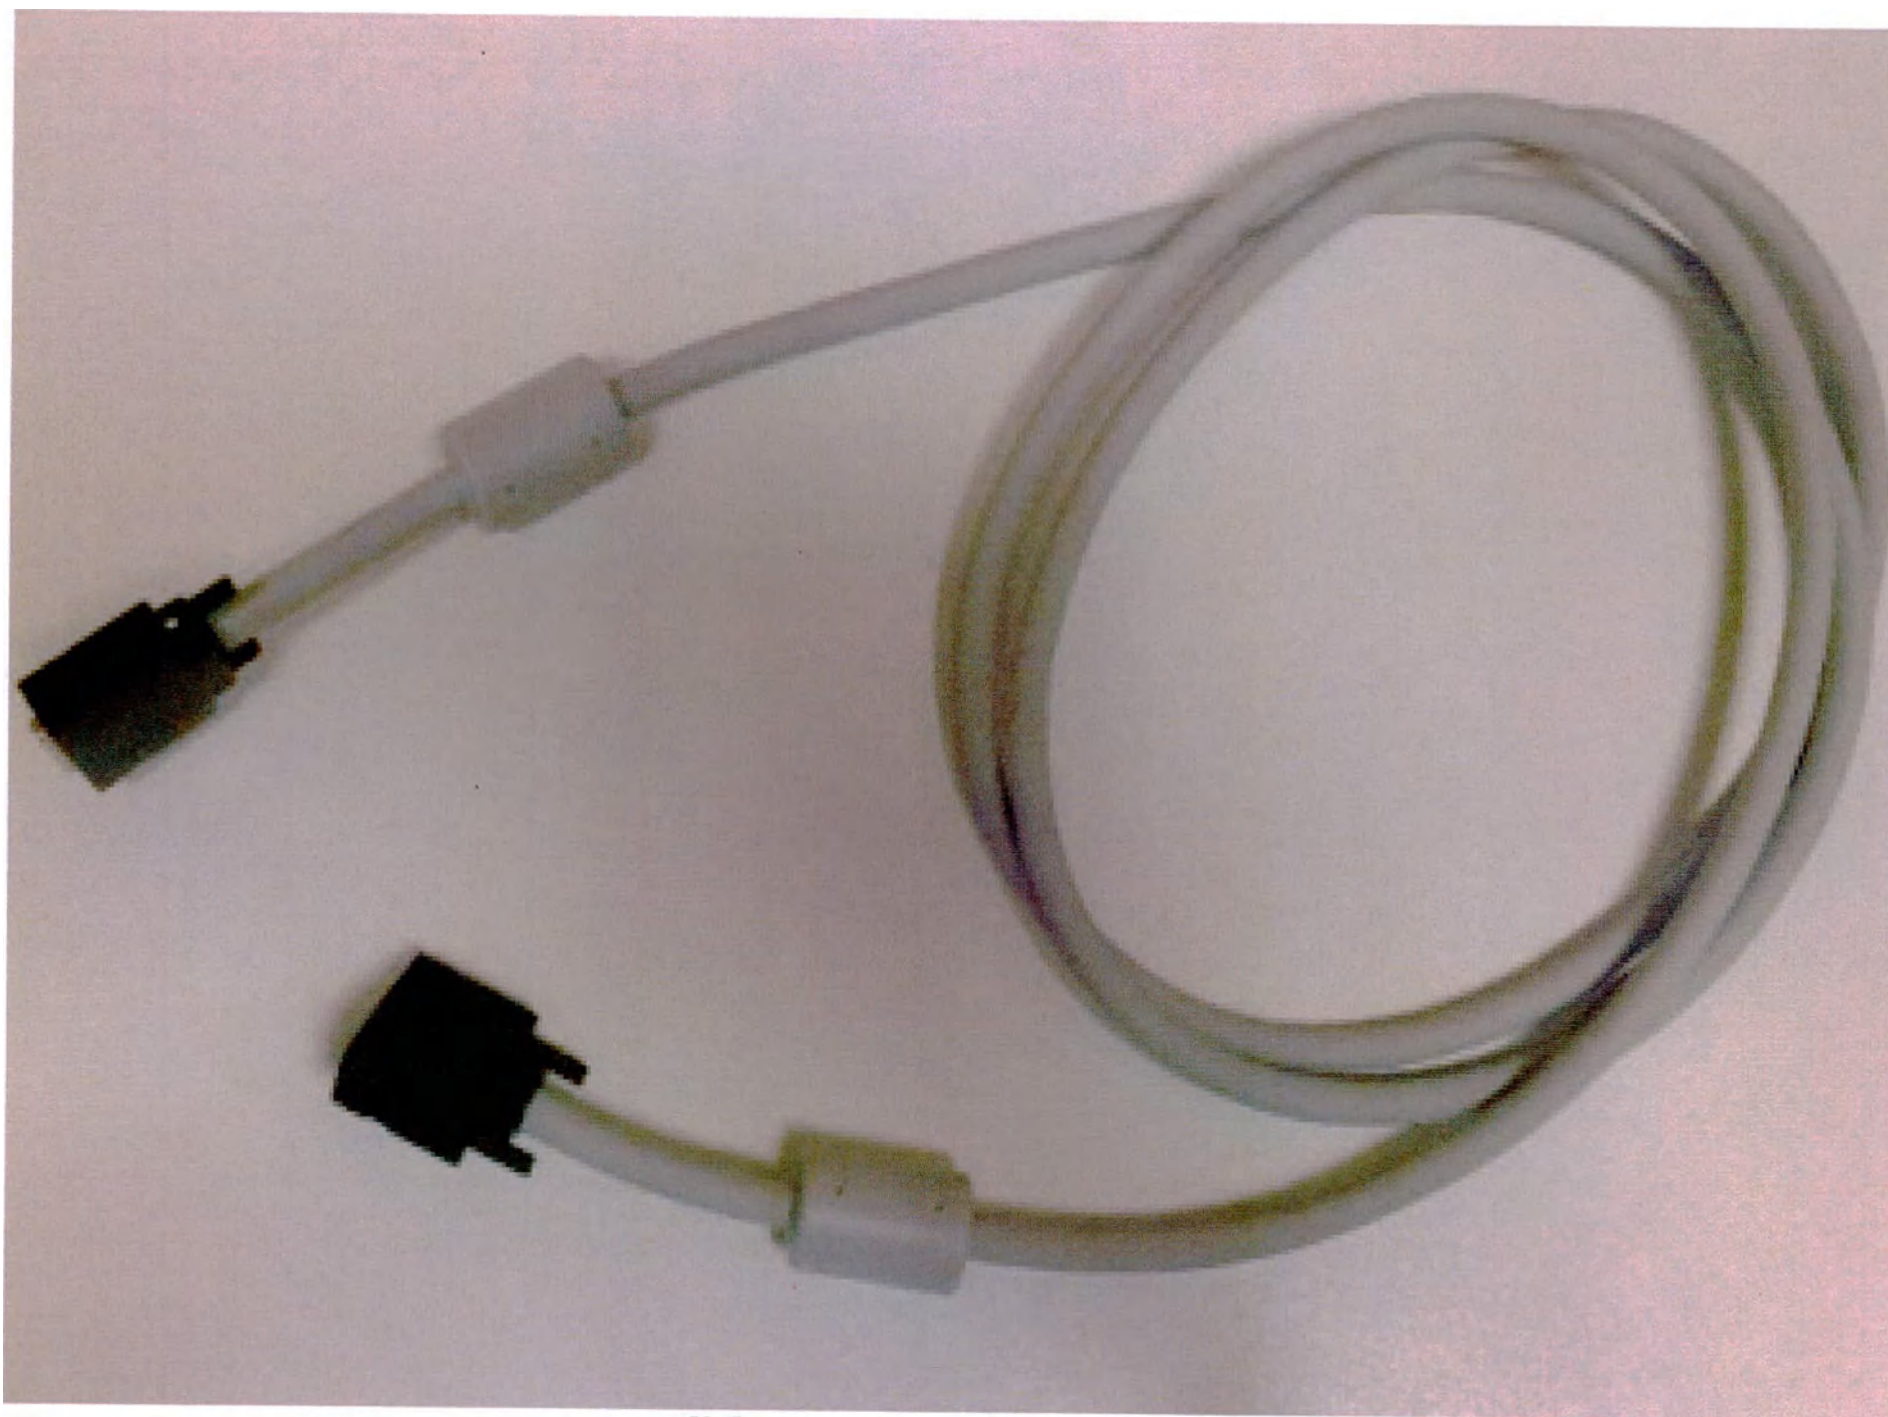

Кабель для подключения клавиатуры

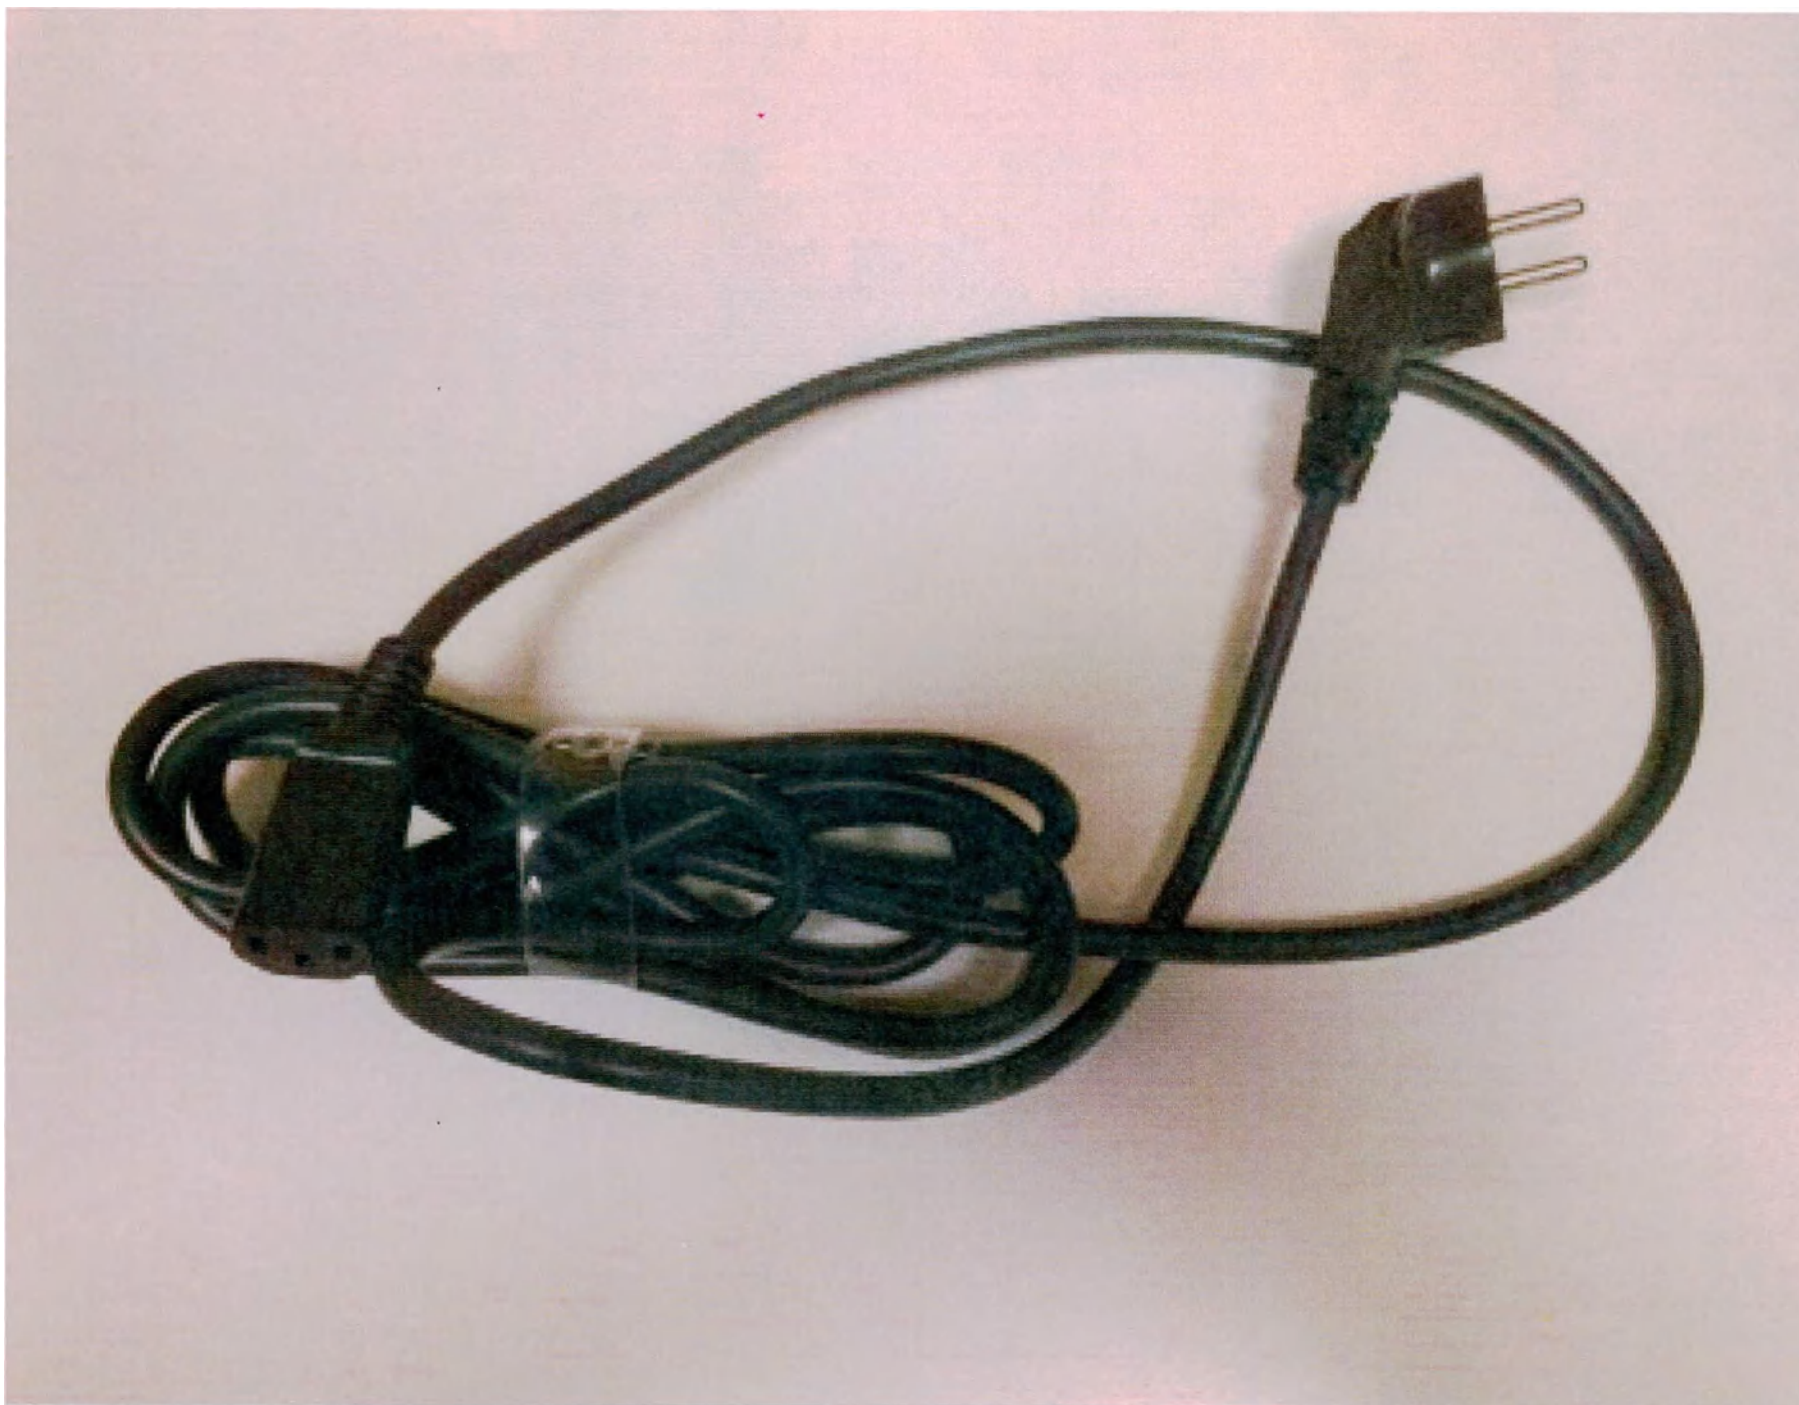

Кабель питания

FUJIFILM

Российск

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениях

SU-1 –H-, SU-1 –S-

с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(базовое)

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного устройства.



CE 0123

Руководство оператора, базовое

Русский

FUJIFILM

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениях
SU-1 -H-, SU-1 -S-
с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(справочное)

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного устройства.



CE 0123

Руководство оператора, справочное

FUJIFILM

Русский

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениях

SU-1 -H-, SU-1 -S-

с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного устройства.



CE 0123

Руководство по установке.

II. Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1 -S-


Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1 -S-

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FULFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна происхождения:	Япония	Japan

Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм» 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru
---	--

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

Процессор ультразвуковой эндоскопический SU-1 -S- (макет маркировки на русском языке)

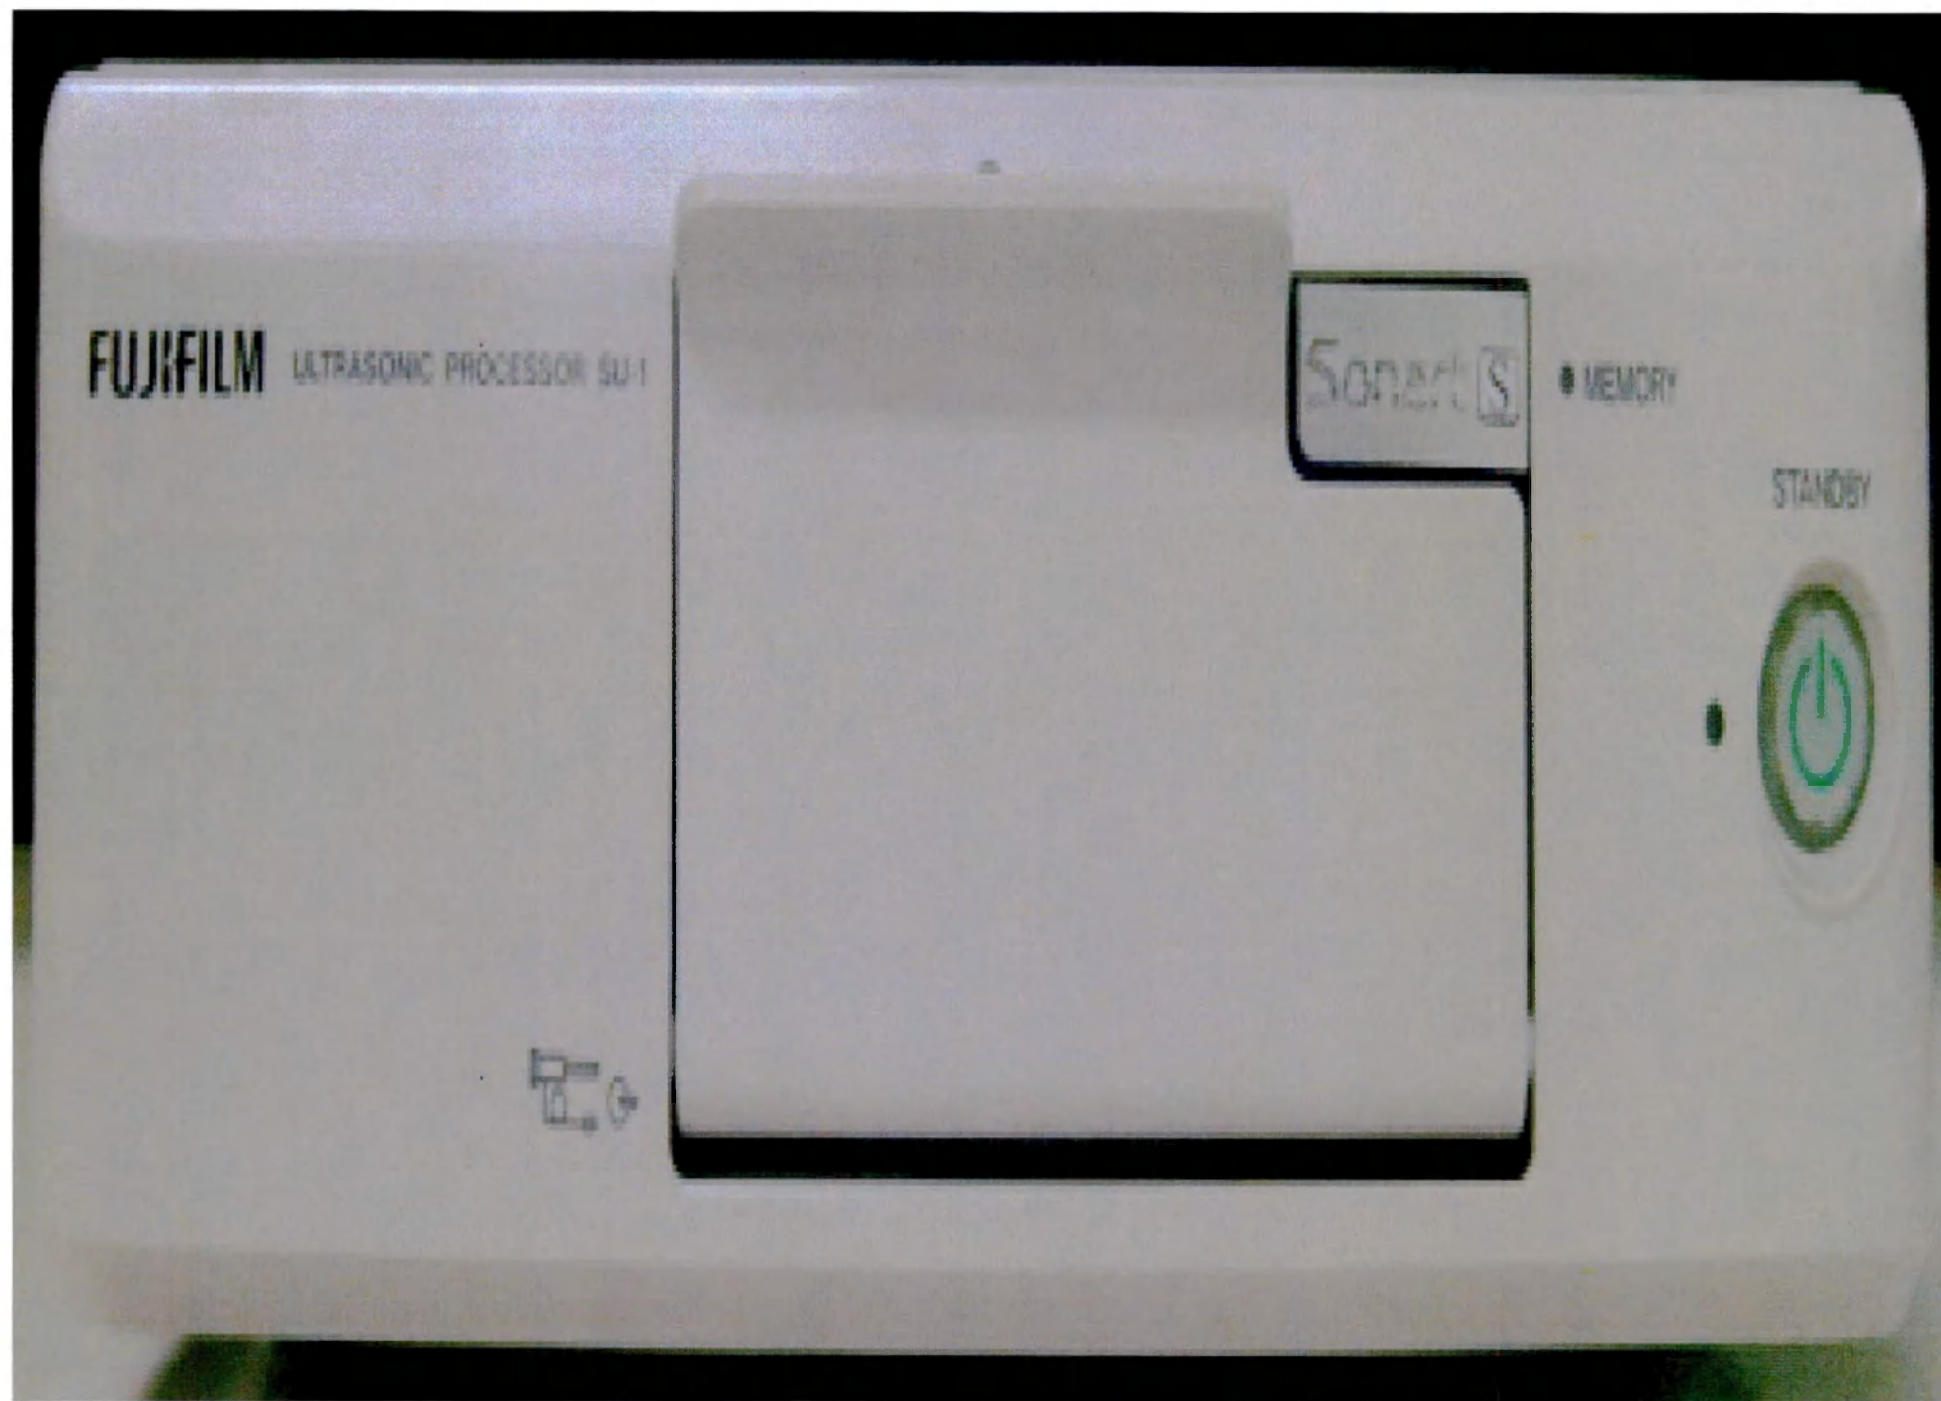



Клавиатура для ультразвуковых процессоров, исполнения СР-1




Клавиатура для ультразвуковых процессоров, исполнения CP-1TB




Тележка установочная РС-410




Видеомонитор жидкокристаллический эндоскопический CDL1909A

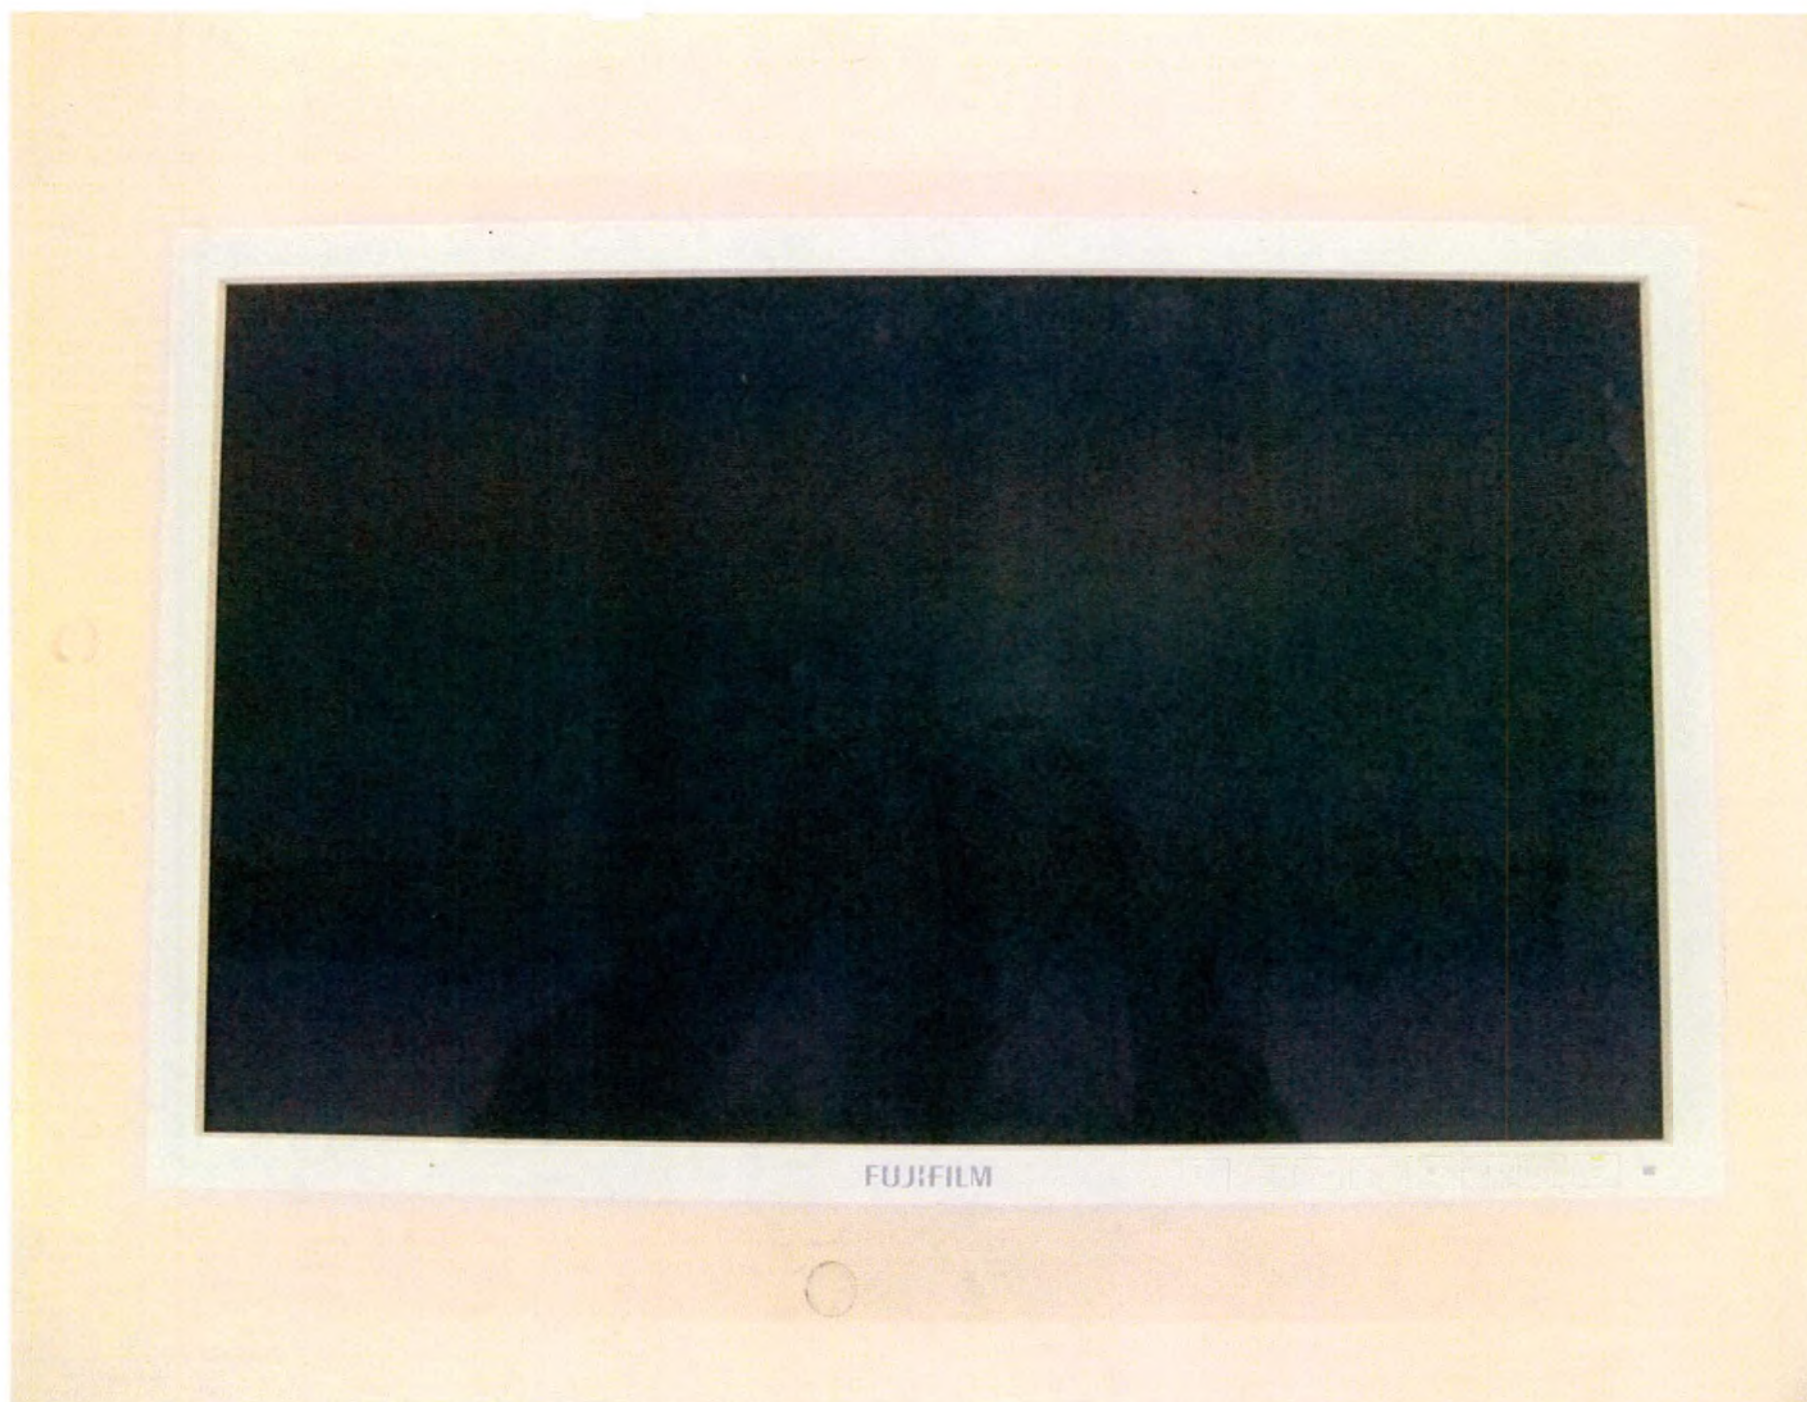


Видеомонитор жидкокристаллический эндоскопический CL-22

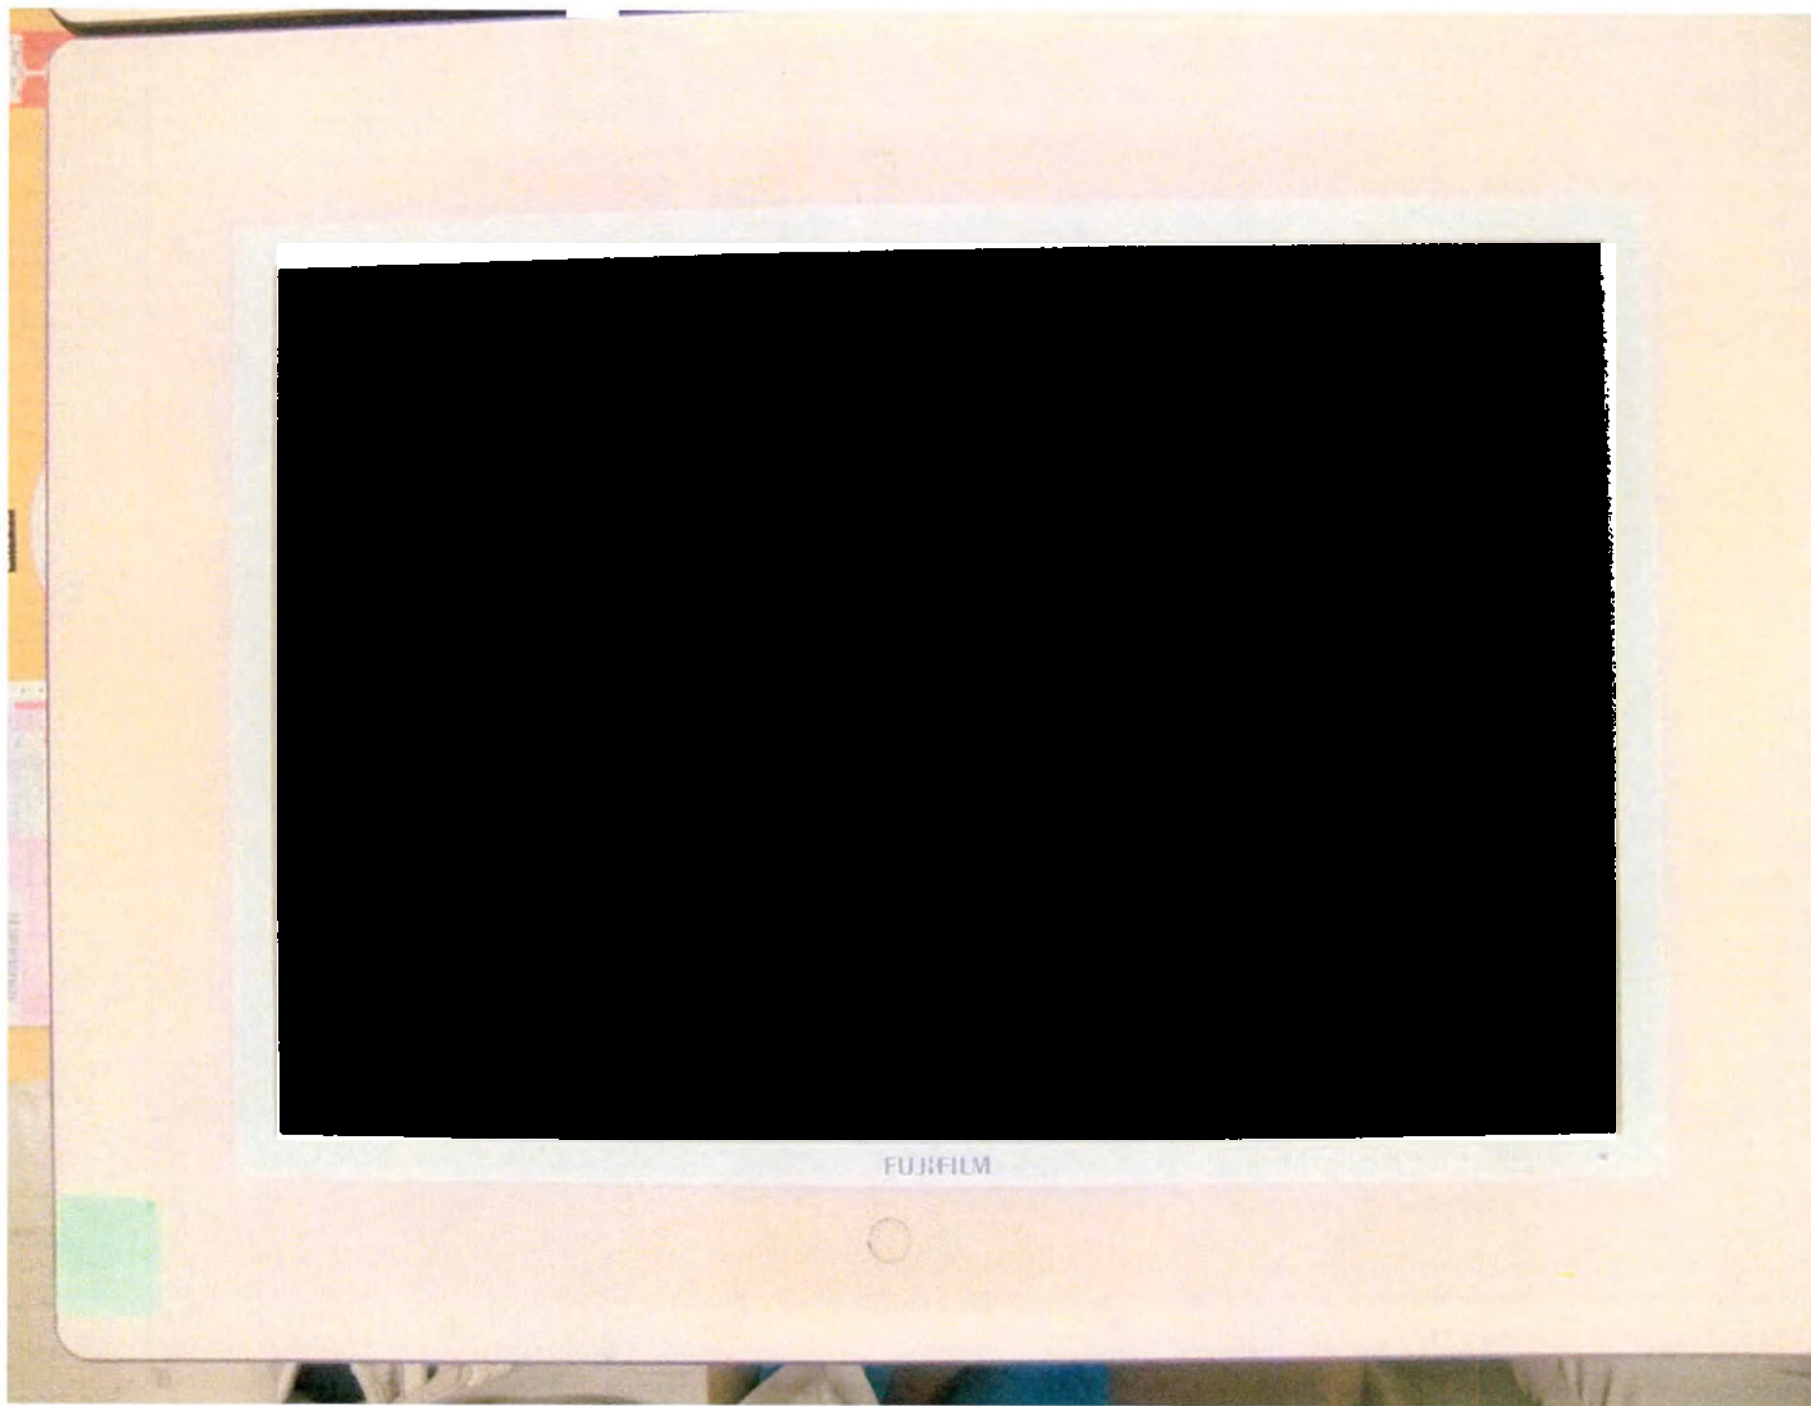

Видеомонитор жидкокристаллический эндоскопический CL-24

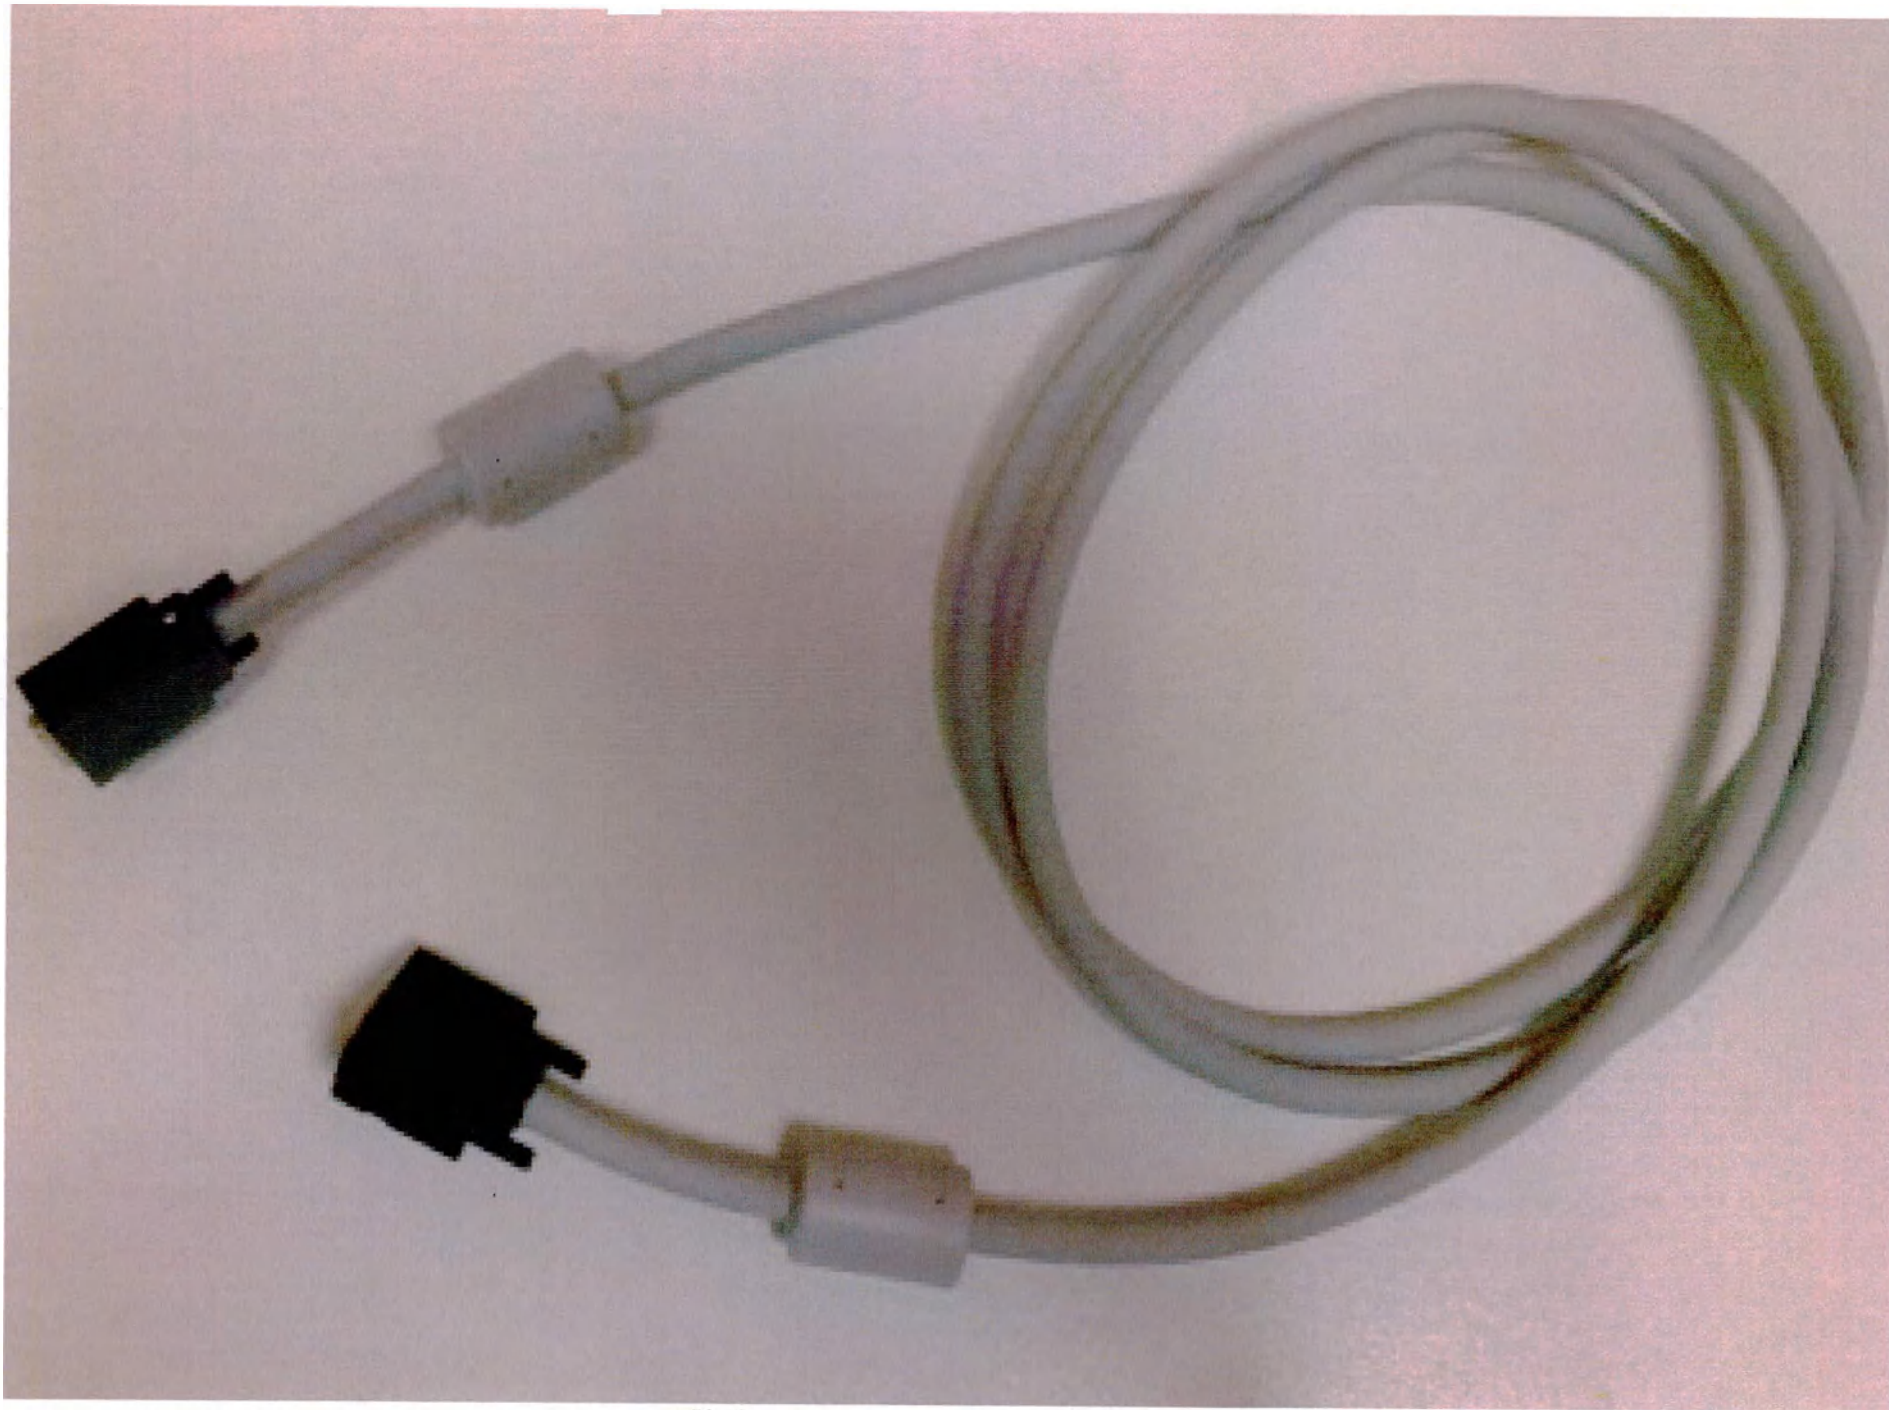

Кабель для подключения клавиатуры

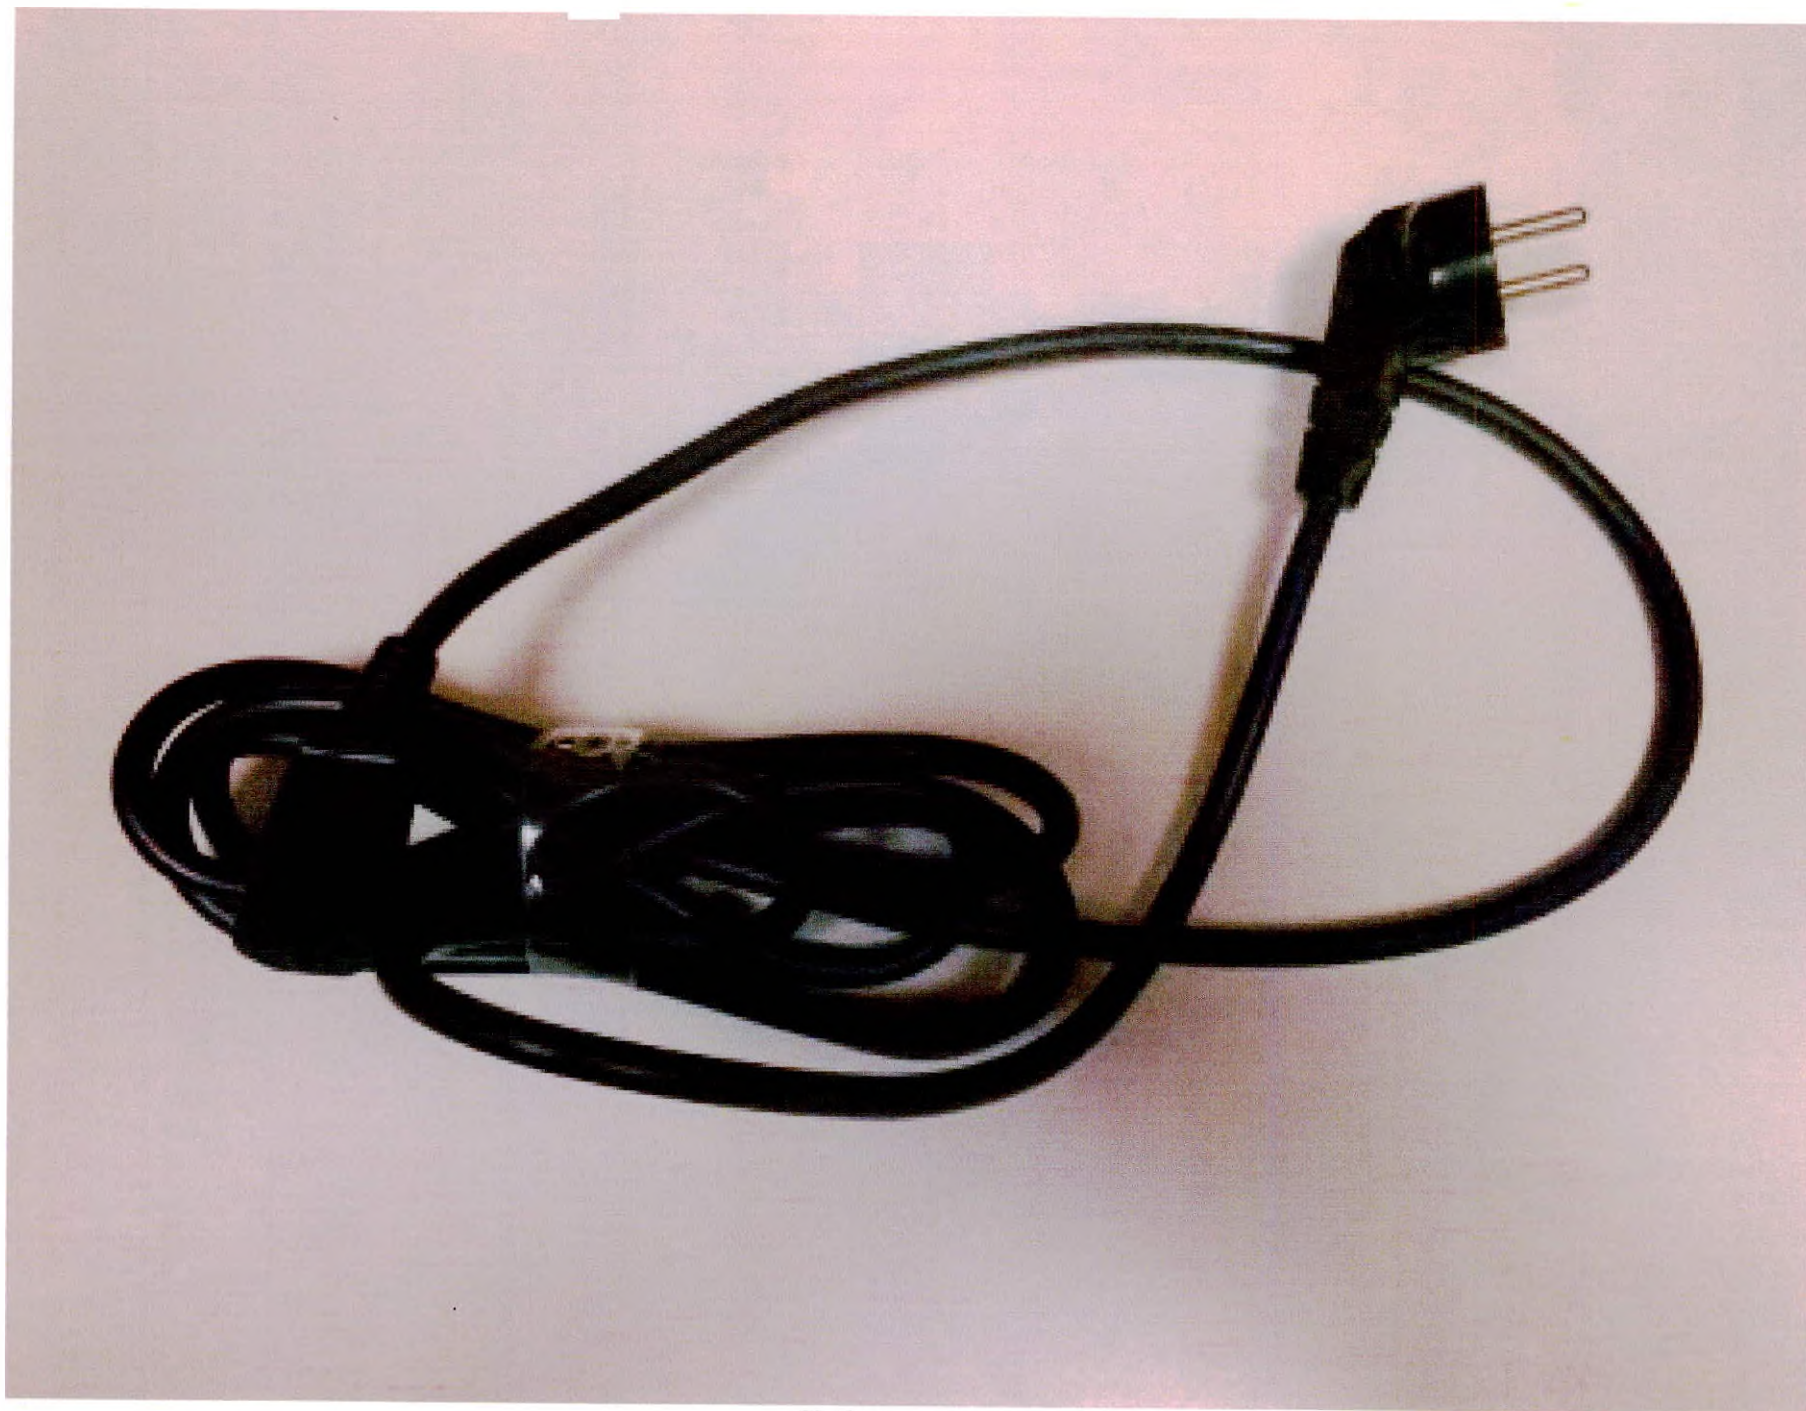

Кабель питания

FUJIFILM

Русский

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениих

SU-1 -H-, SU-1 -S-

с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(базовое)

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного устройства.



CE 0123

Руководство оператора, базовое

RUSSIAN
FUJIFILM

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениях
SU-1 -H-, SU-1 -S-
с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(справочное)

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного устройства.



CE 0123

Руководство оператора, справочное

FUJIFILM

Русский

Система ультразвуковой эндоскопической визуализации в исполнениях

SU-1 -H-, SU-1 -S-

с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство, чтобы избежать случайных ошибок и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами данного устройства.




CE 0123

Руководство по установке.



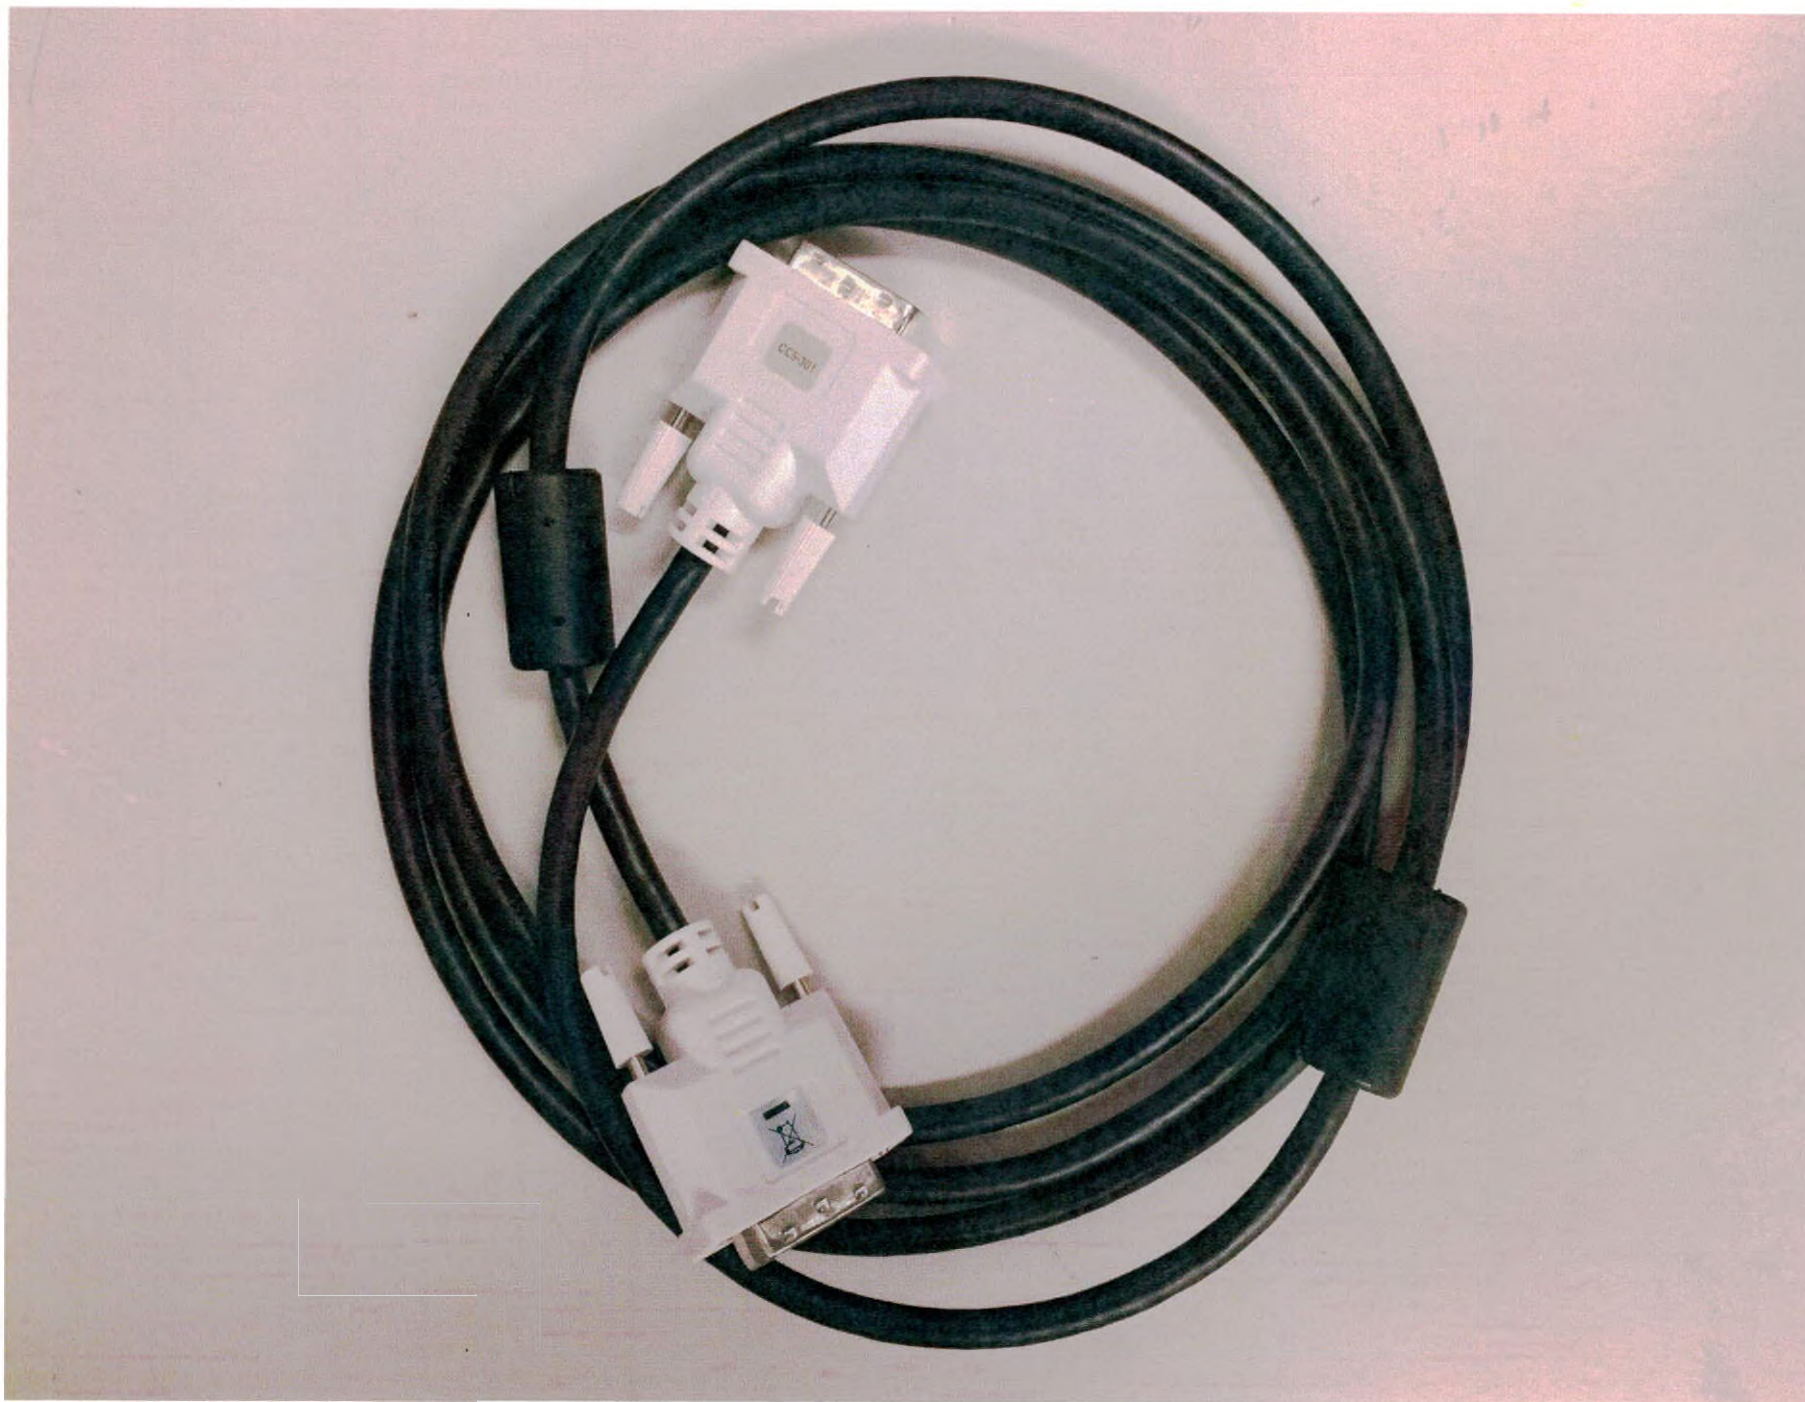

Кабель соединительный, в исполнении CC5-301

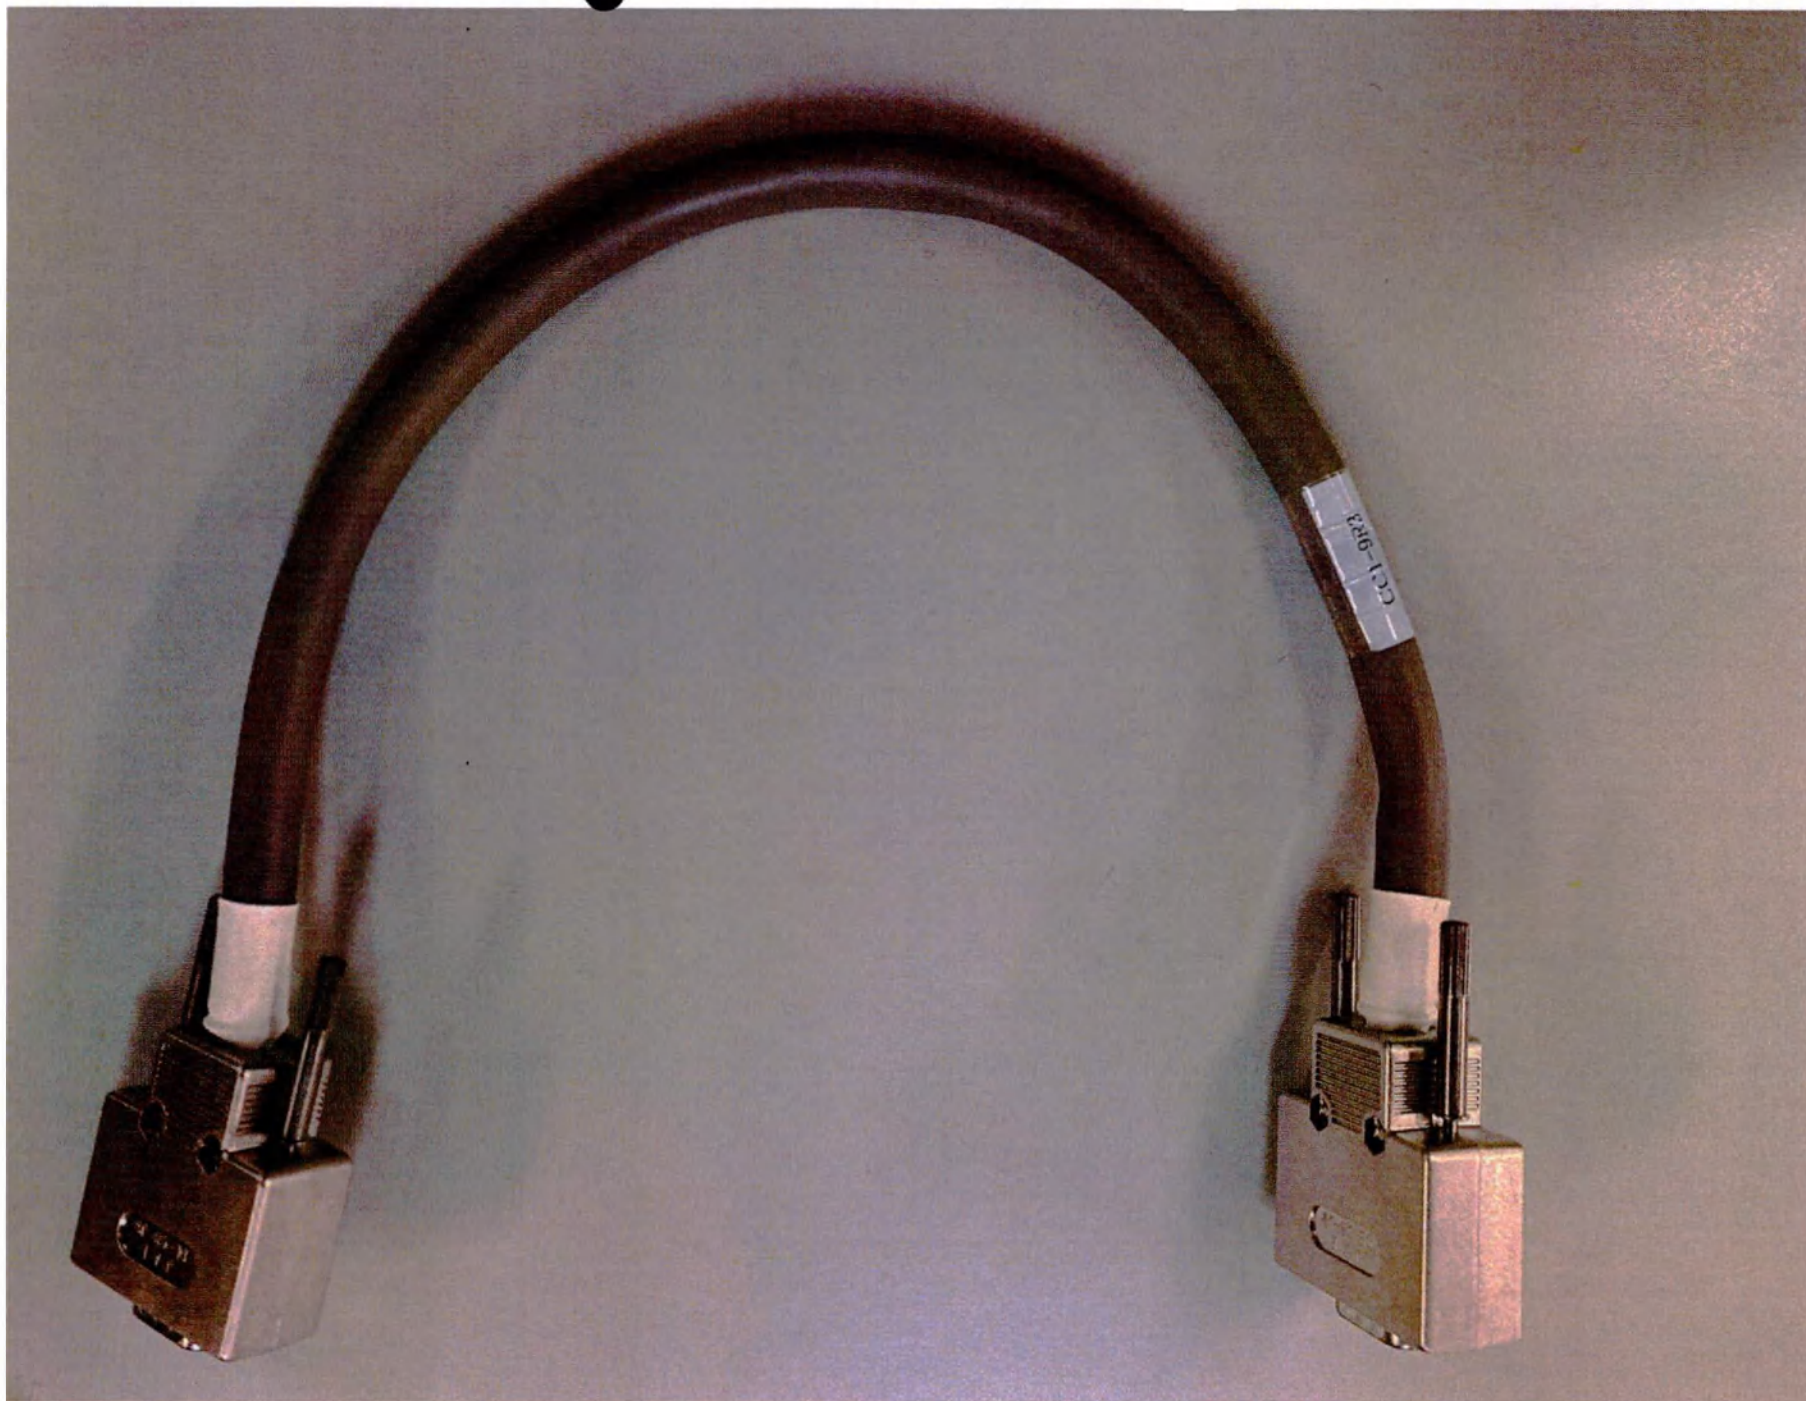

Кабель соединительный, в исполнении CC1-9R3



Кабель соединительный, в исполнении CC6-101

Принято и сфеновано
на 15.05.2019

