




Директор

ООО «Медика Продакт»


Михалева Е.М.

2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)»
производства «77 Электроника Кфт.», Венгрия
(«77 Elektronika Kft.», Fehérvári út 98, 1116 Budapest, Hungary; Тел.: +36 1
206 1480.
Факс: +36 1 206 1481, E-mail: sales@e77.hu).

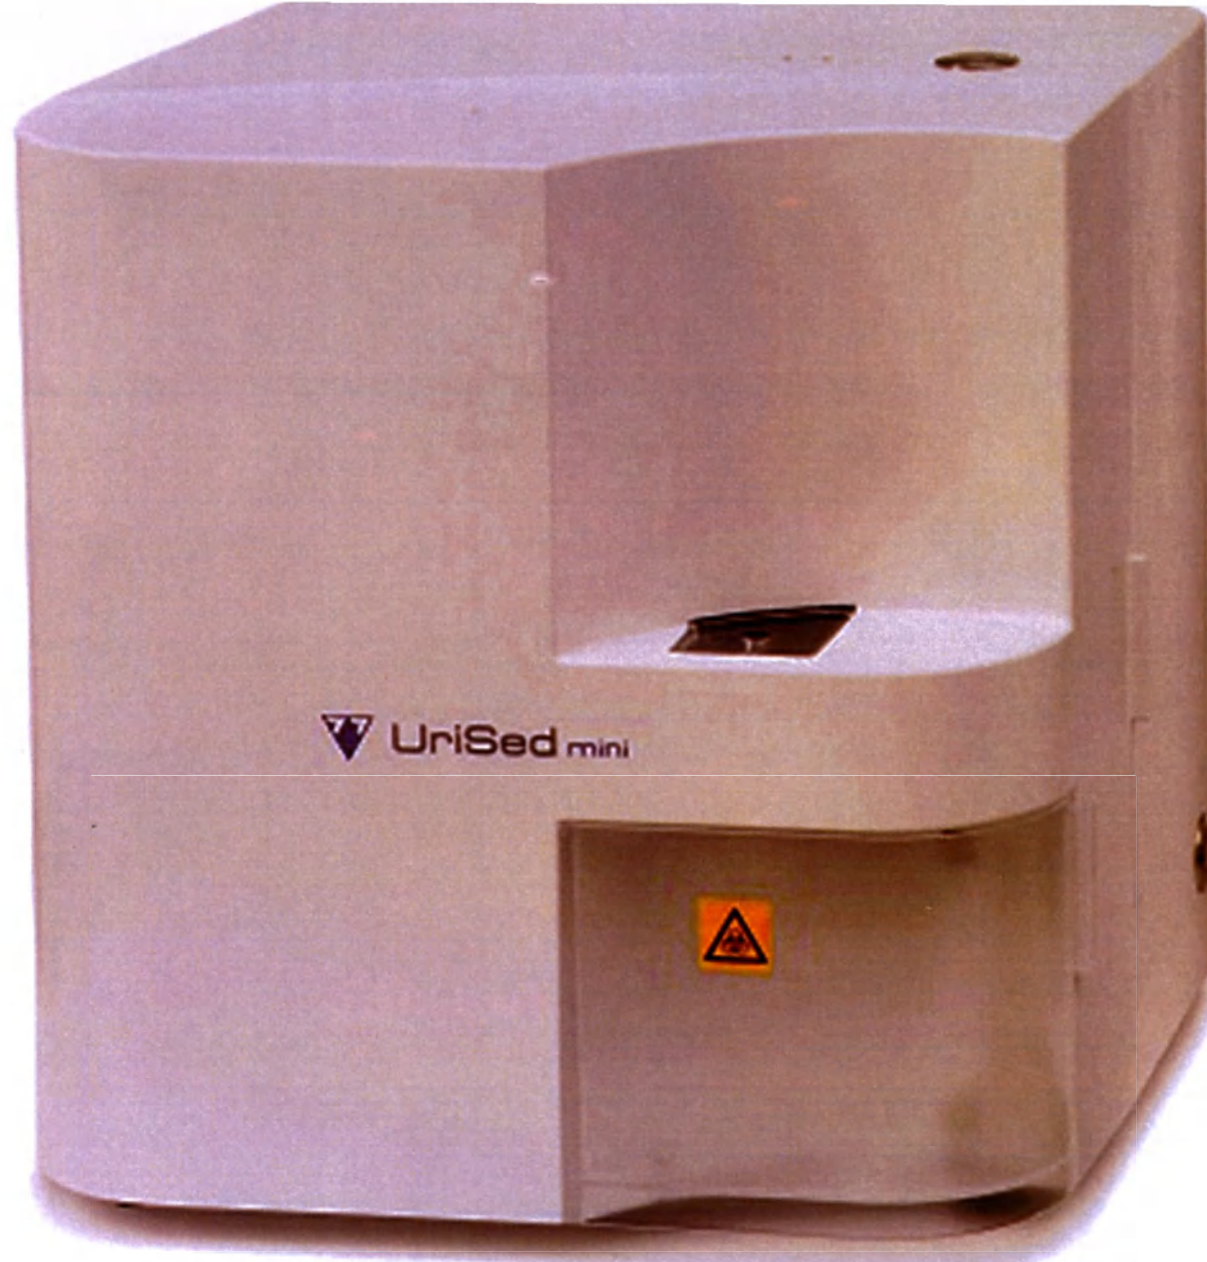

Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)

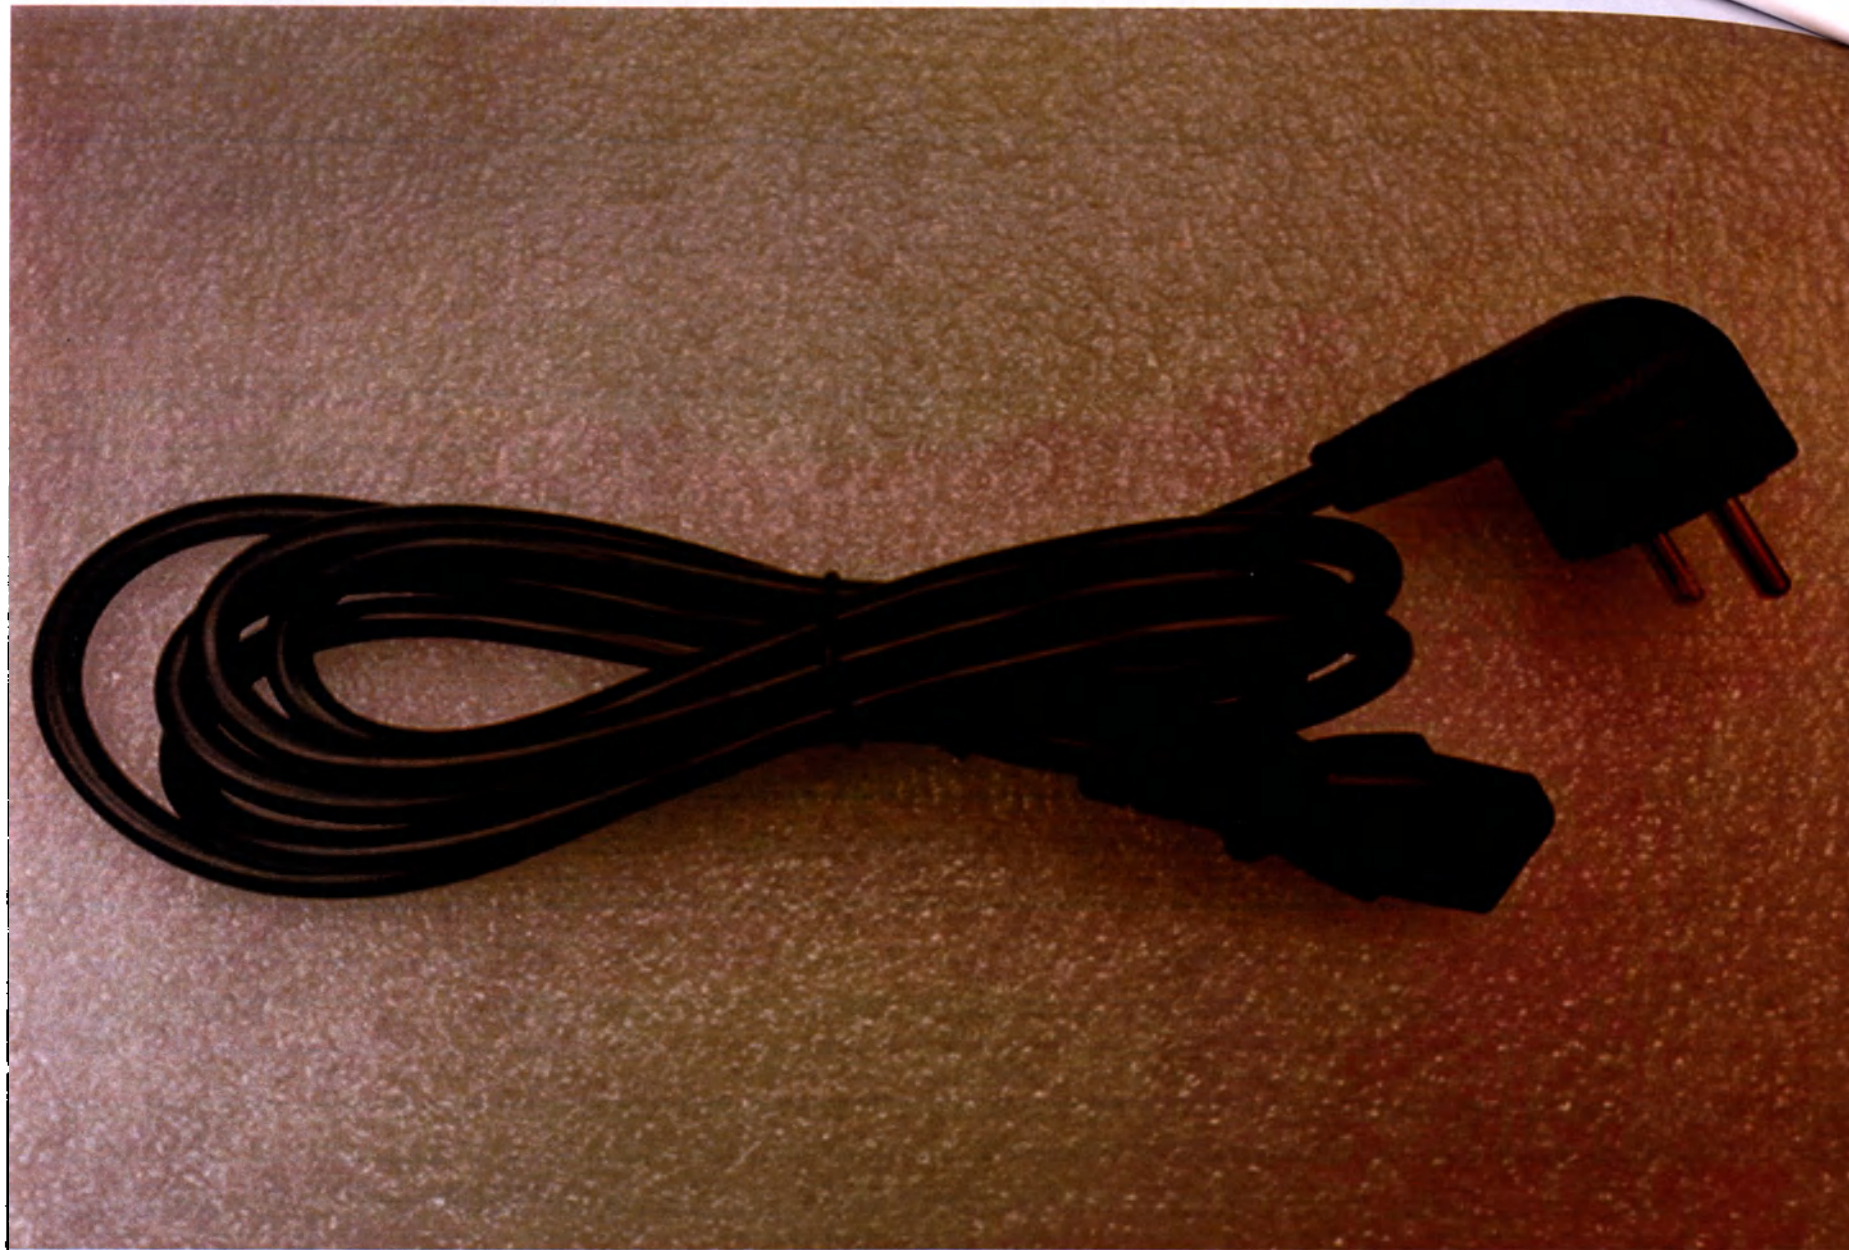

Кабель питания анализатора



Клавиатура




Мышь

5




ЖК - монитор


6

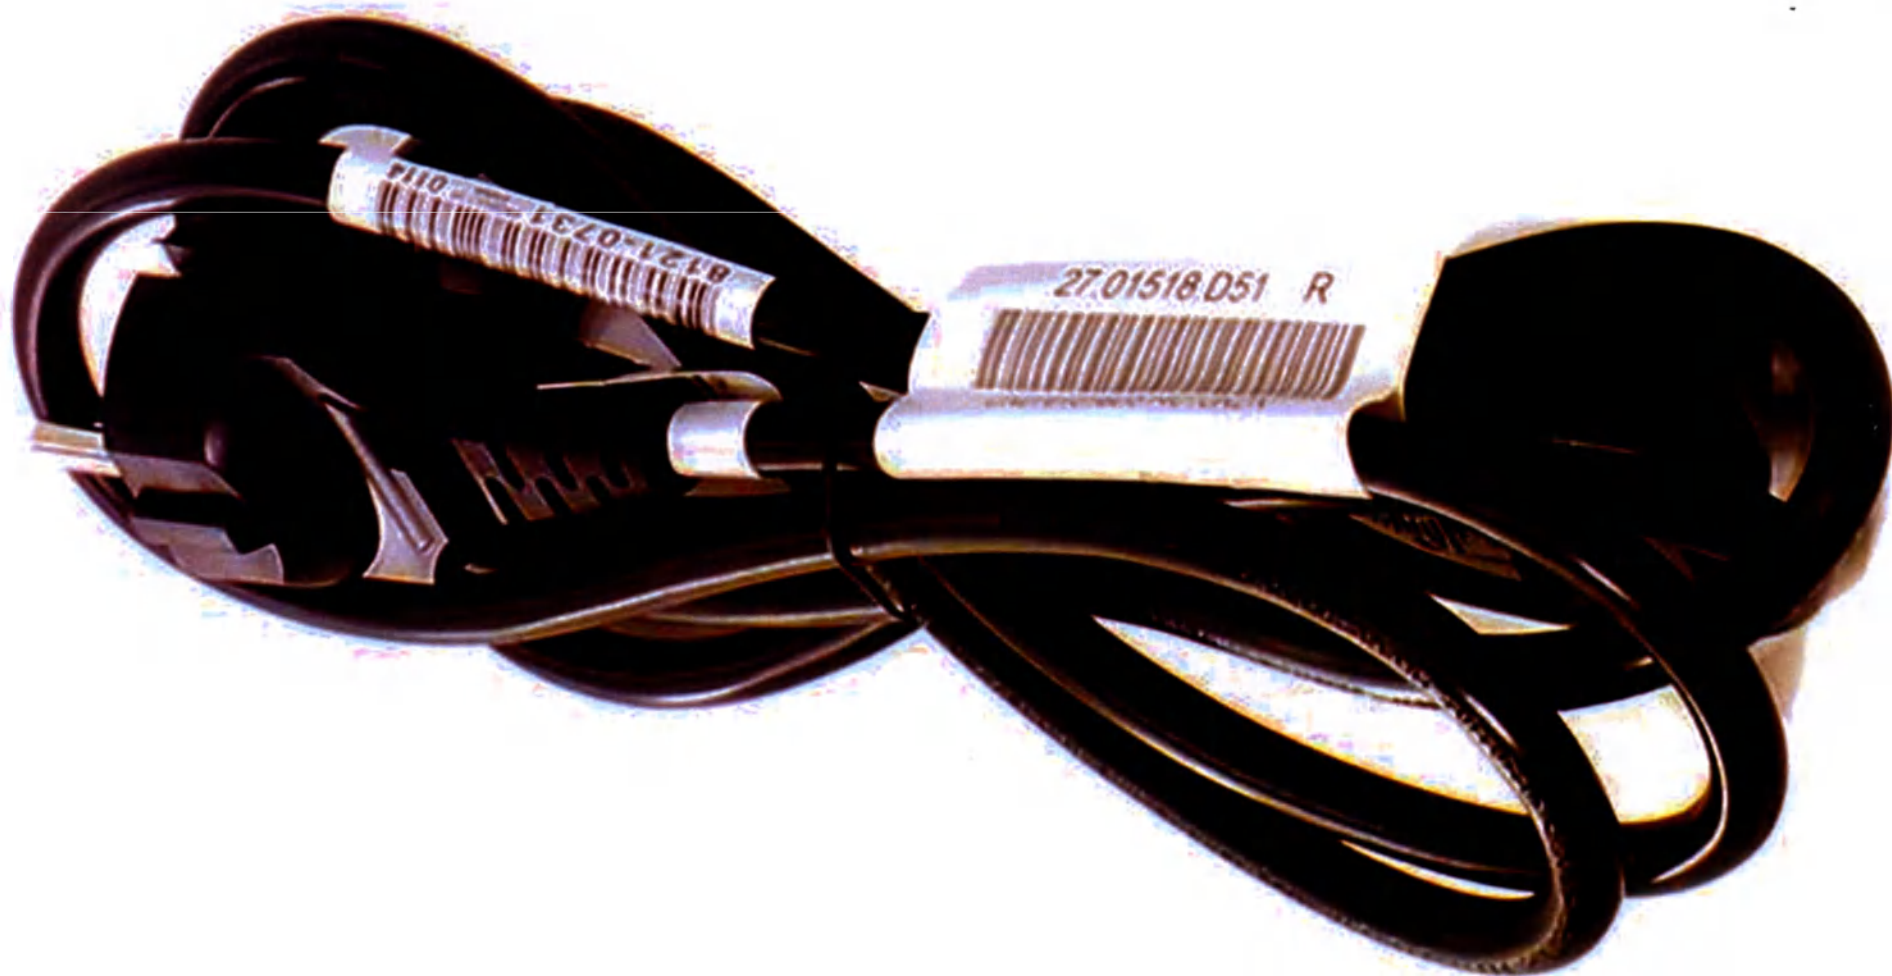


Кабель питания монитора

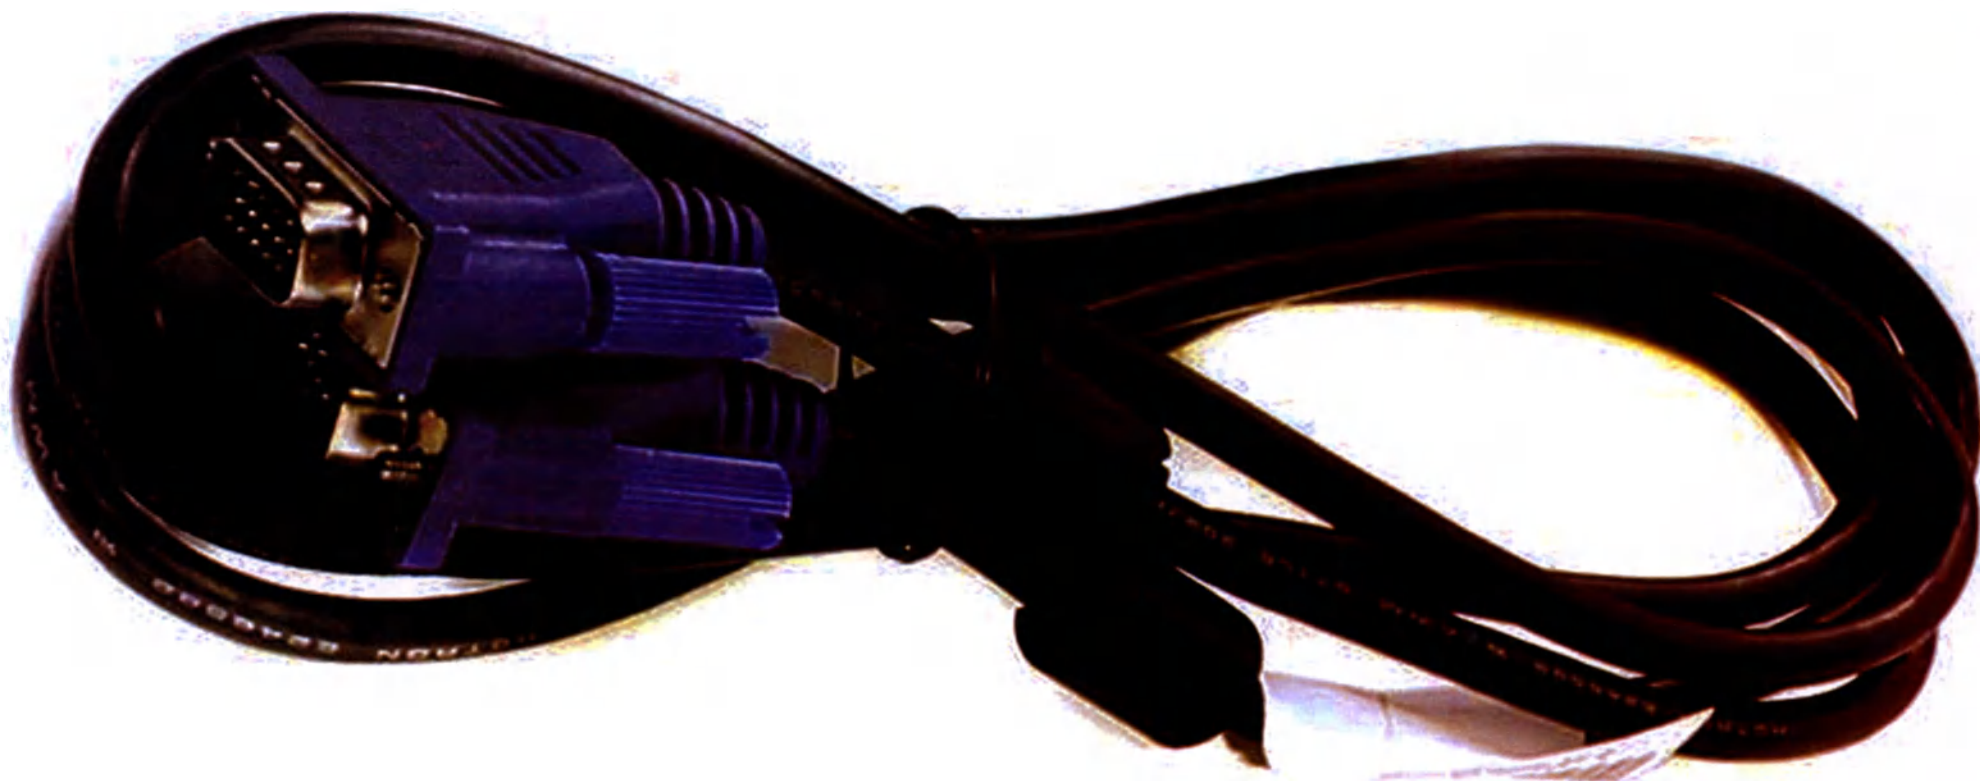


Кабель VGA

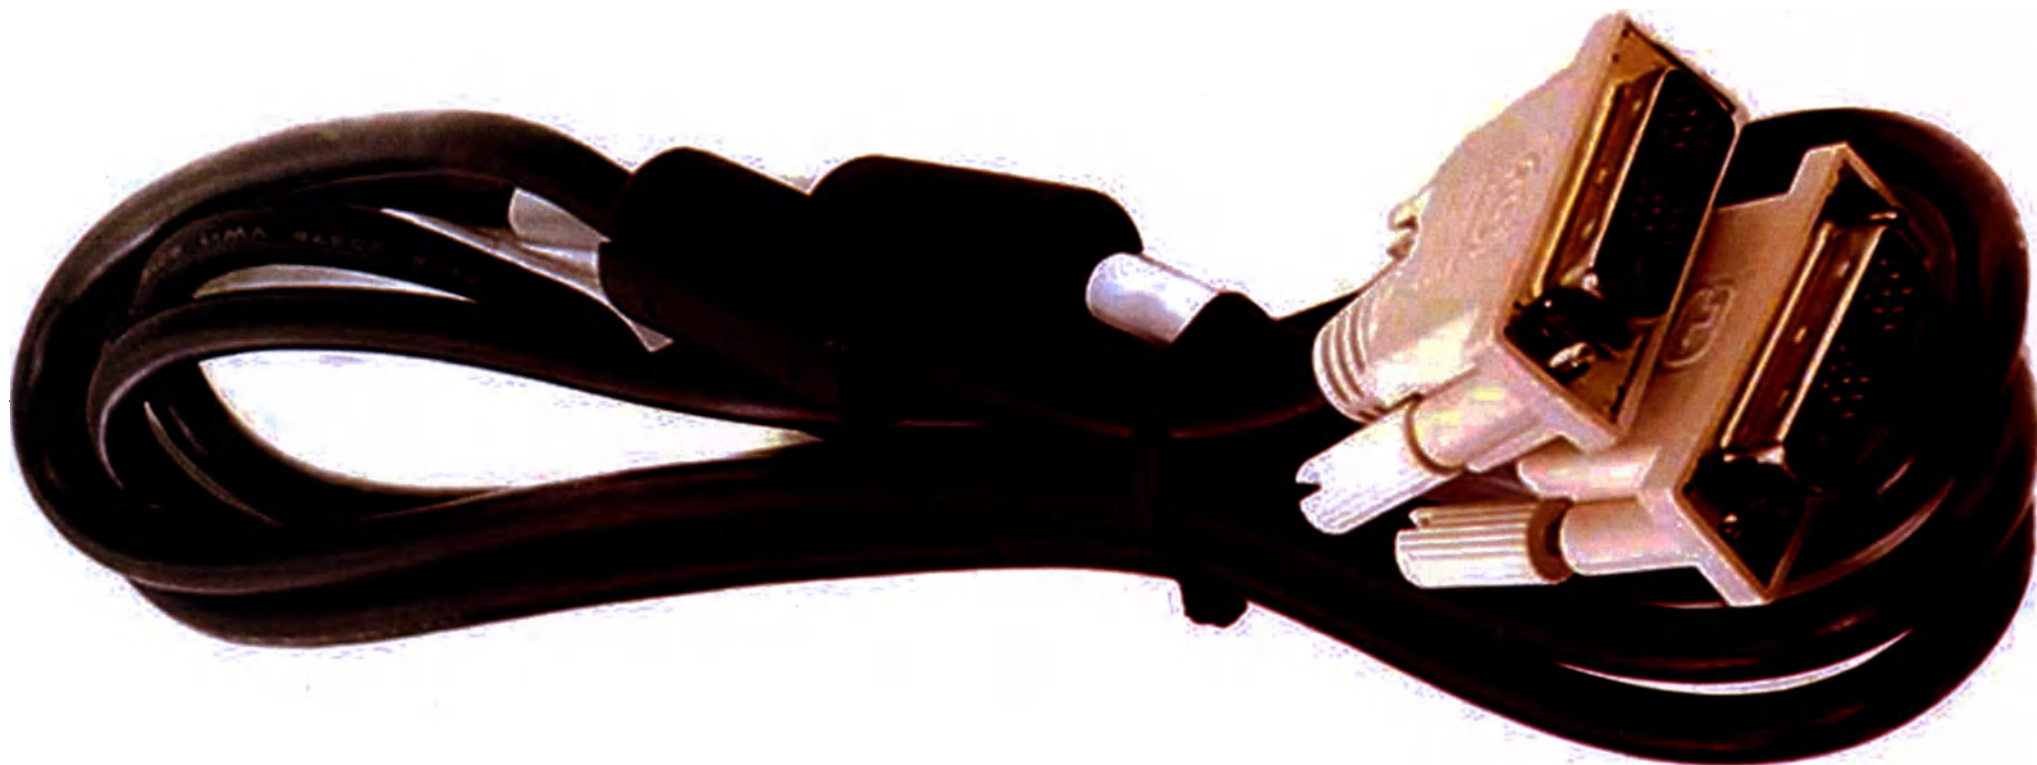

Кабель DVI

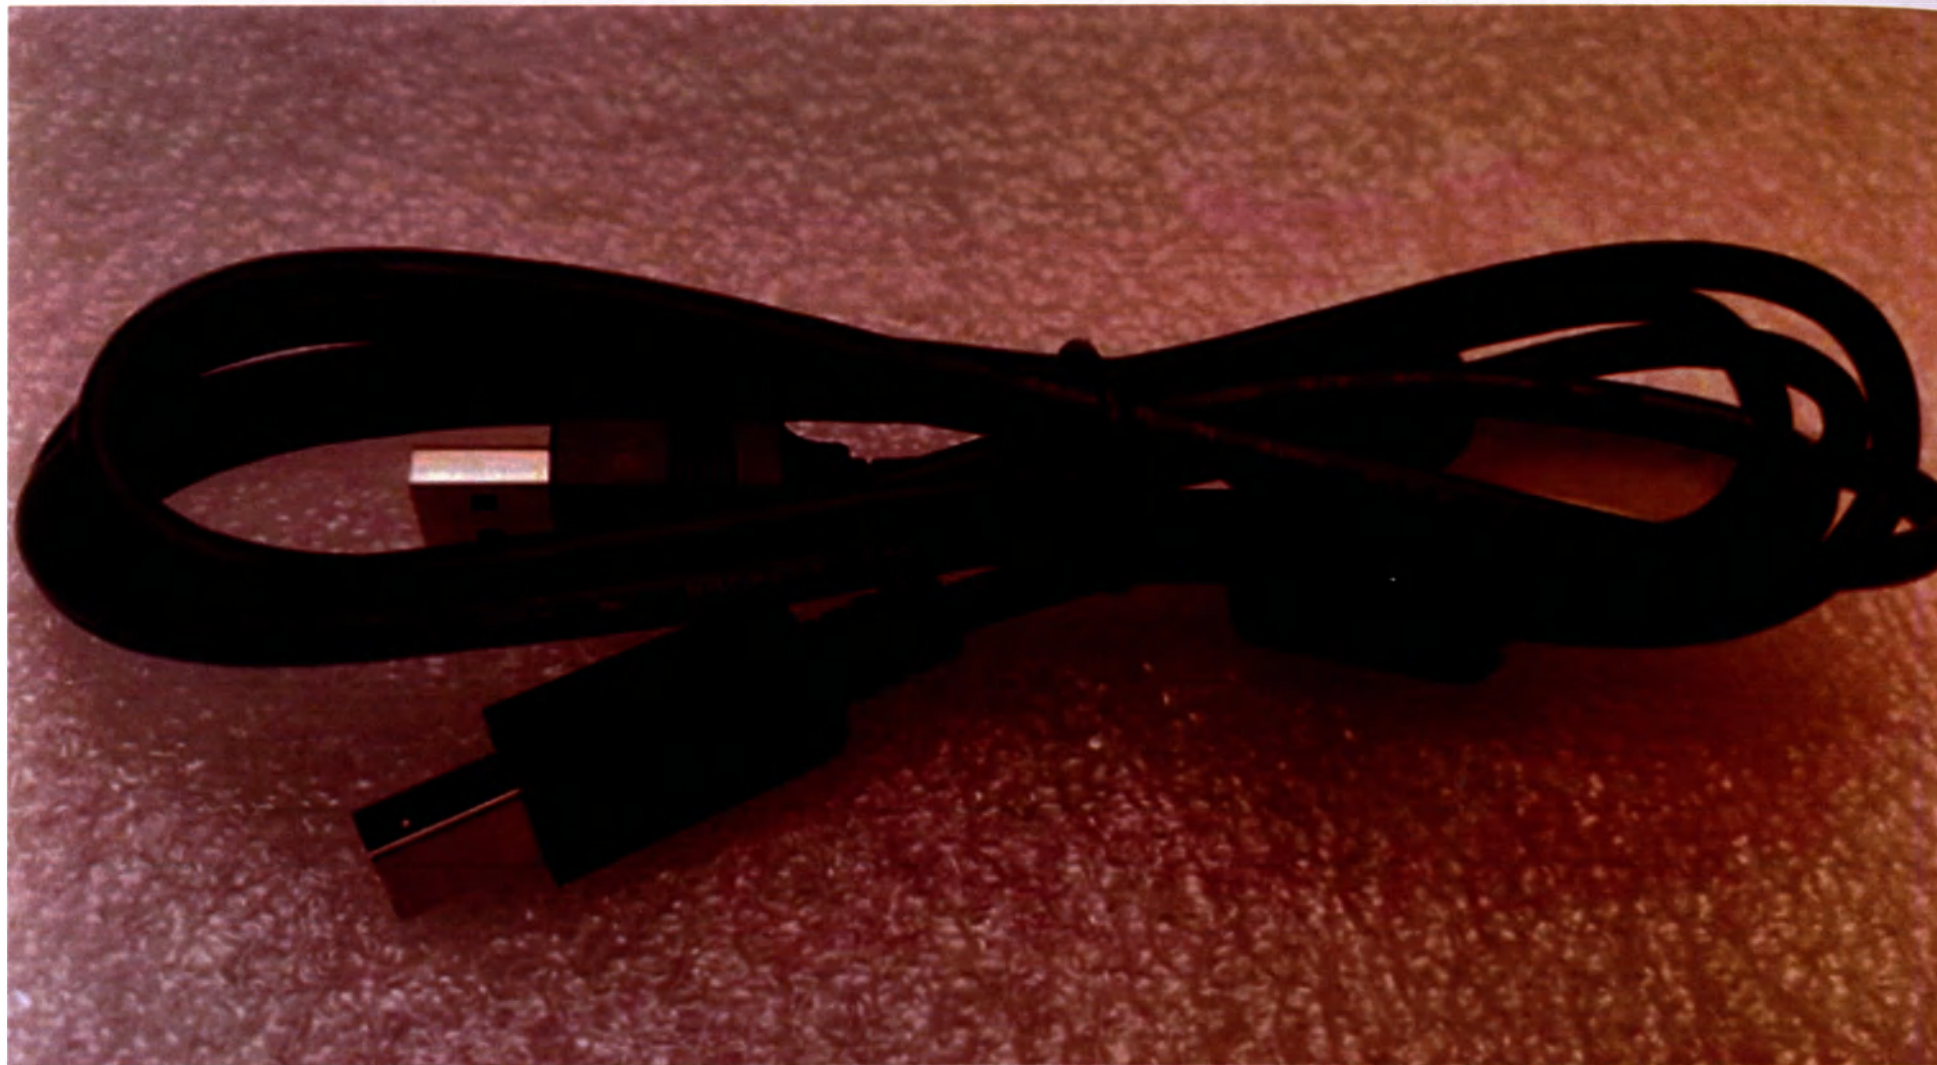

Кабель USB

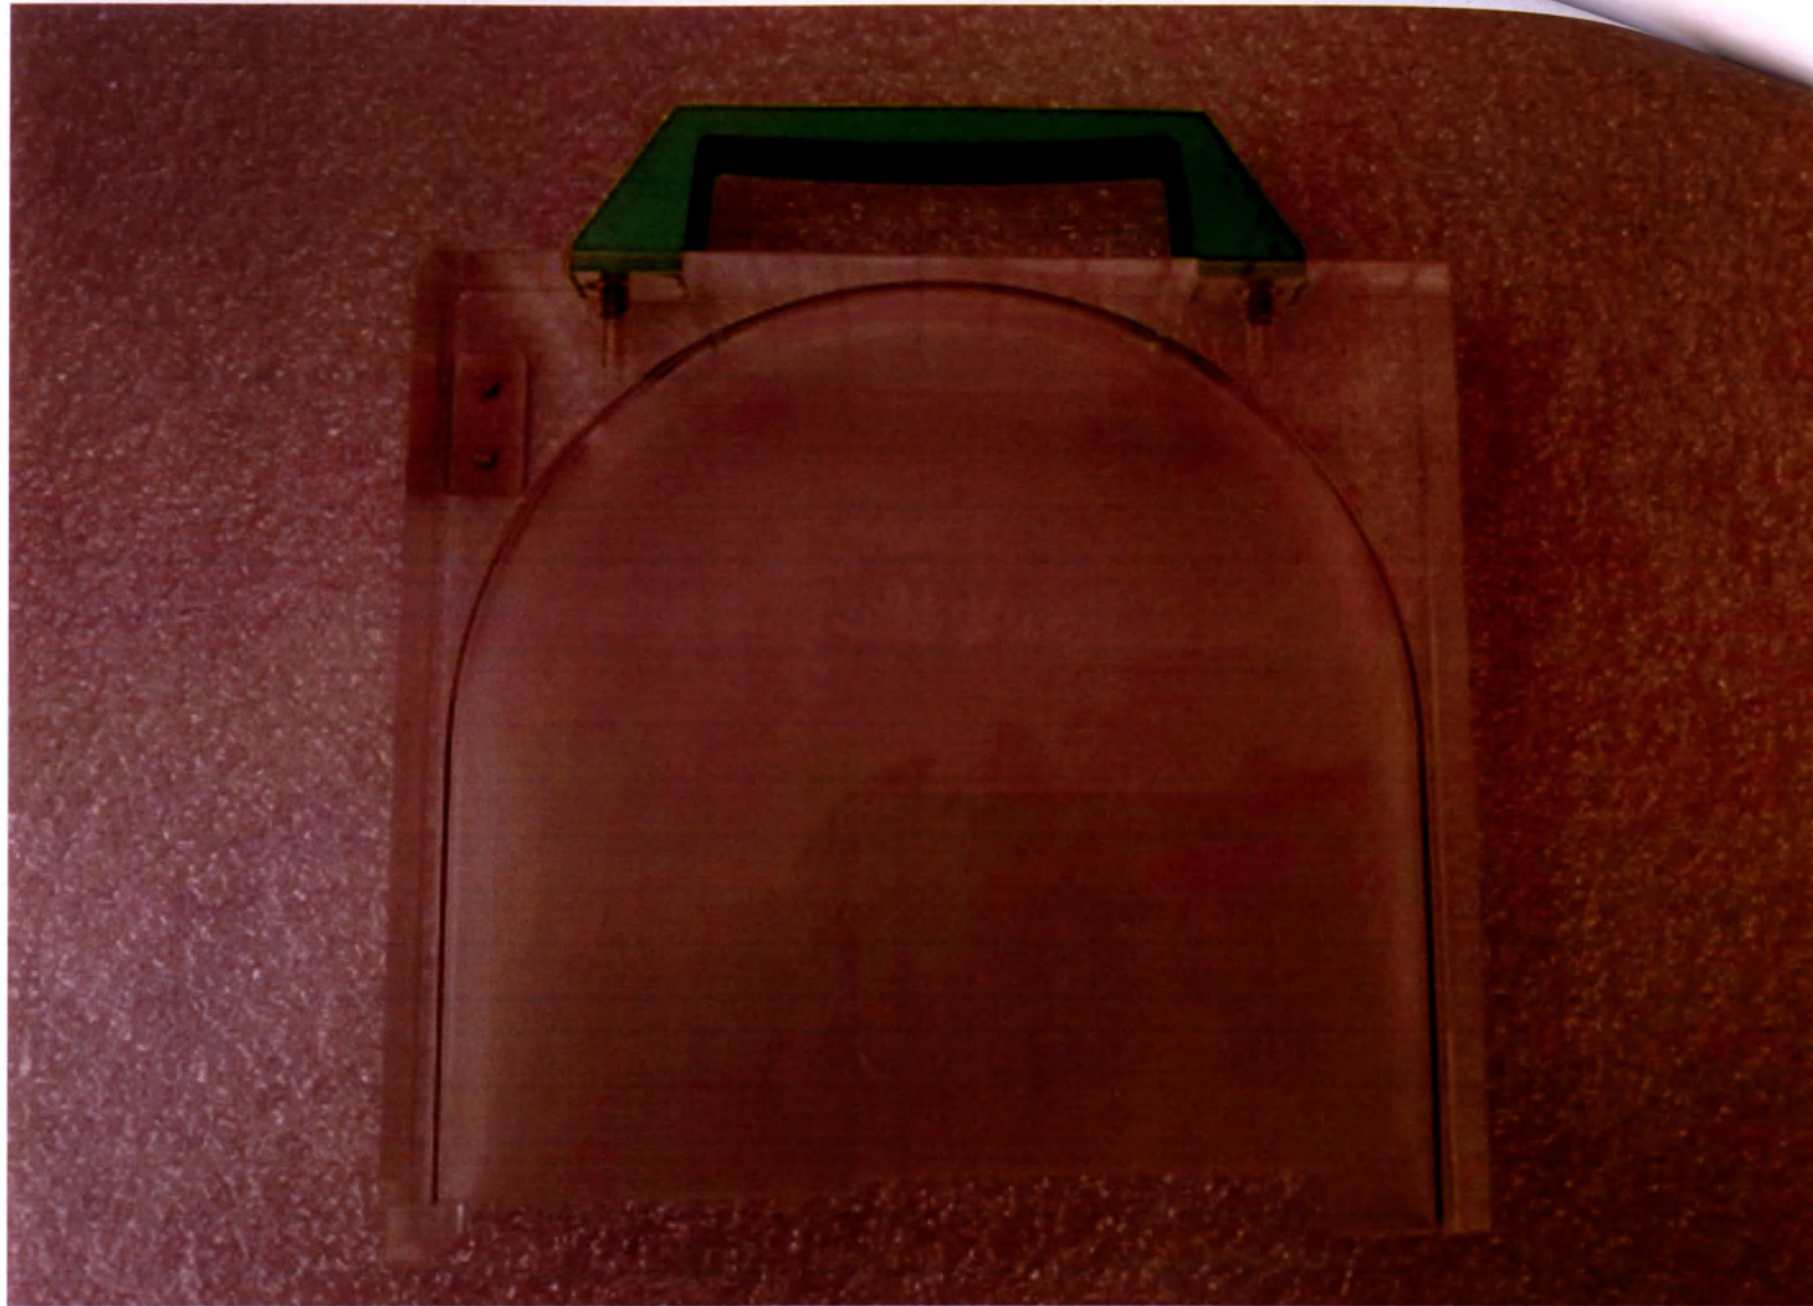

Крышка центрифуги



Отделение для отходов

12



77 Elektronika Kft.

УТВЕРЖДАЮ / APPROVE

77 Elektronika Kft.

OLIVER BABINSKI

QUALITY & ENVIRONM. DIR.

77 Elektronika Műszeripari Kft.

H-1116 Budapest,

Fehérvári út 98,

23.

(подпись/ signature)

М.П./Stamp

15. MAY 2019


Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)

Руководство пользователя




Руководство пользователя

13

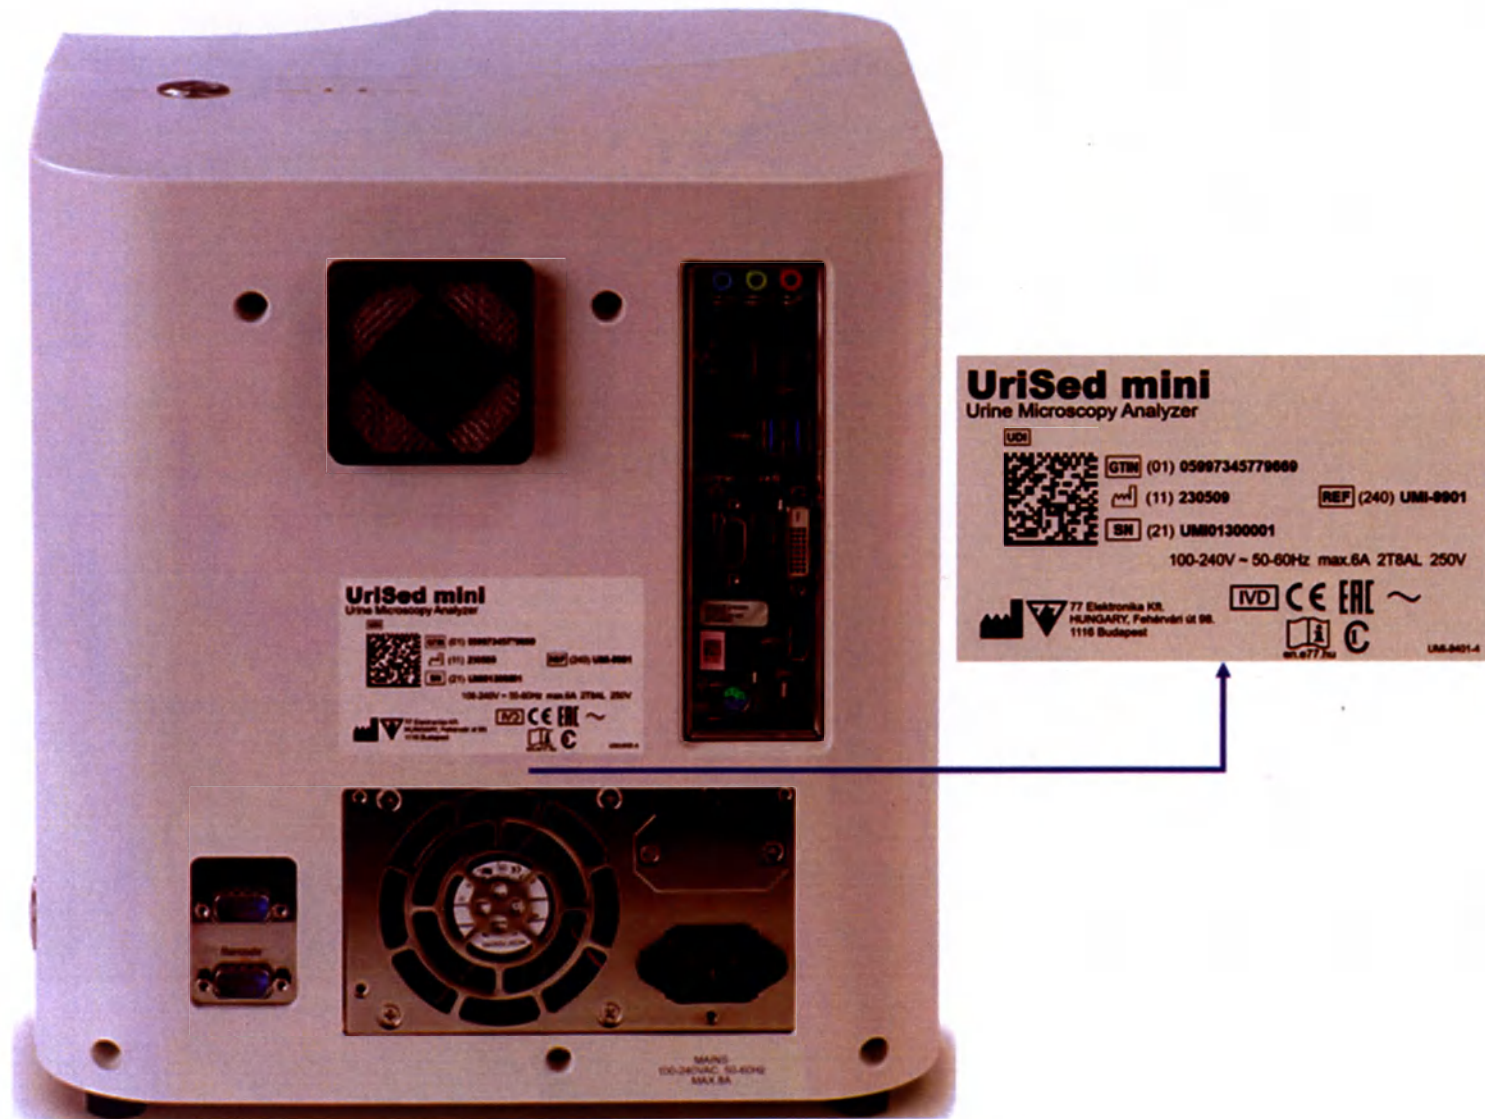


Анализатор UriSed mini с маркировкой на английском языке

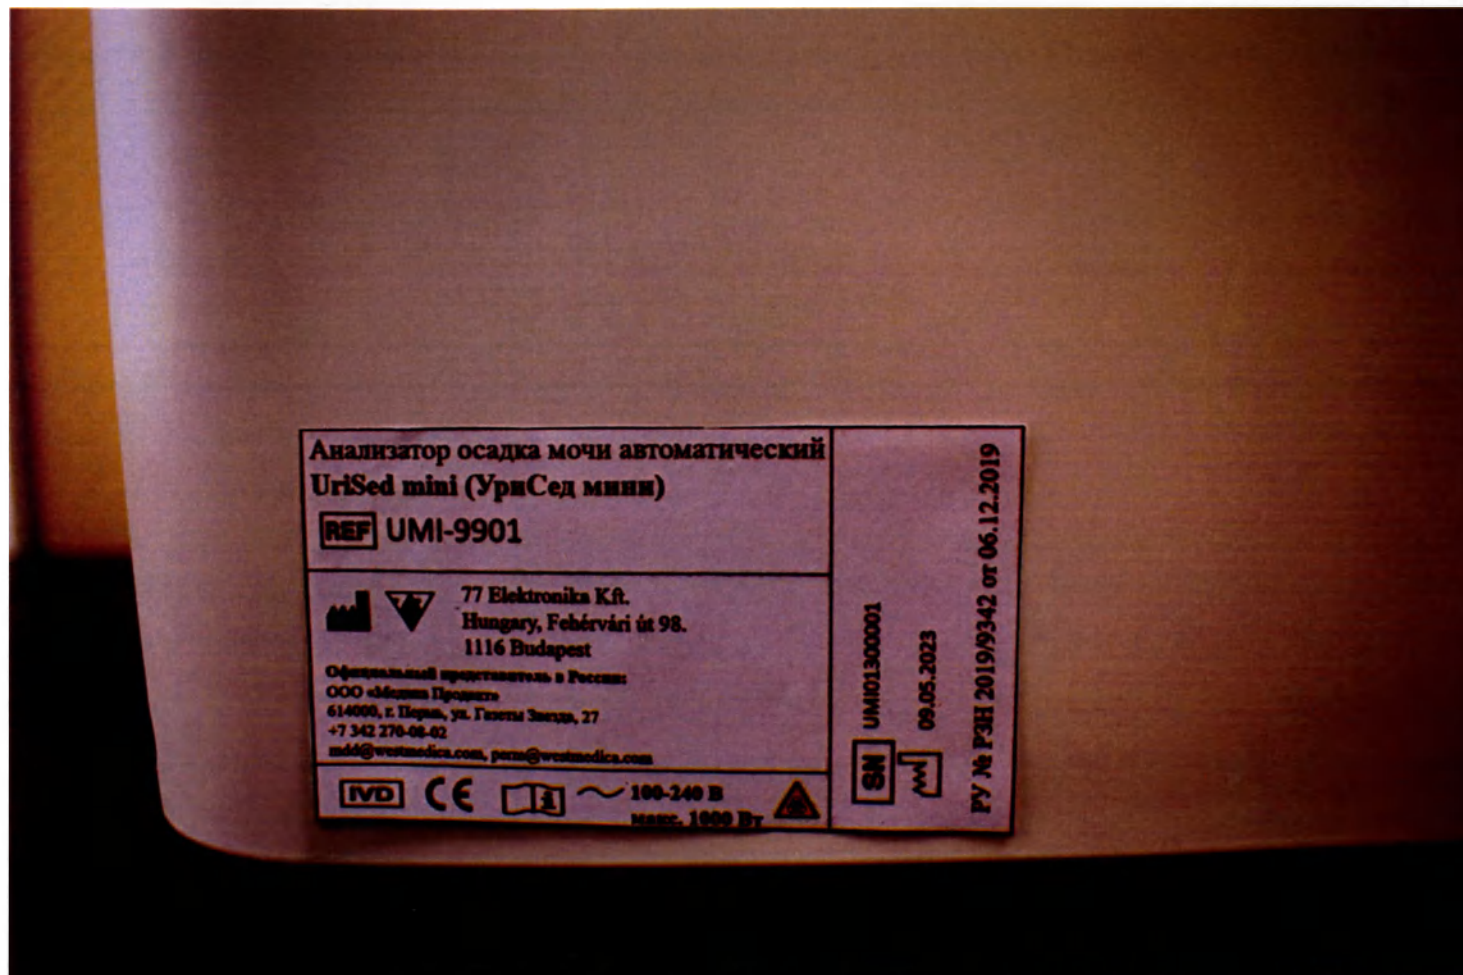

Анализатор UriSed mini с маркировкой на русском языке



Упаковка анализатора UriSed mini с маркировкой на английском и русском языках

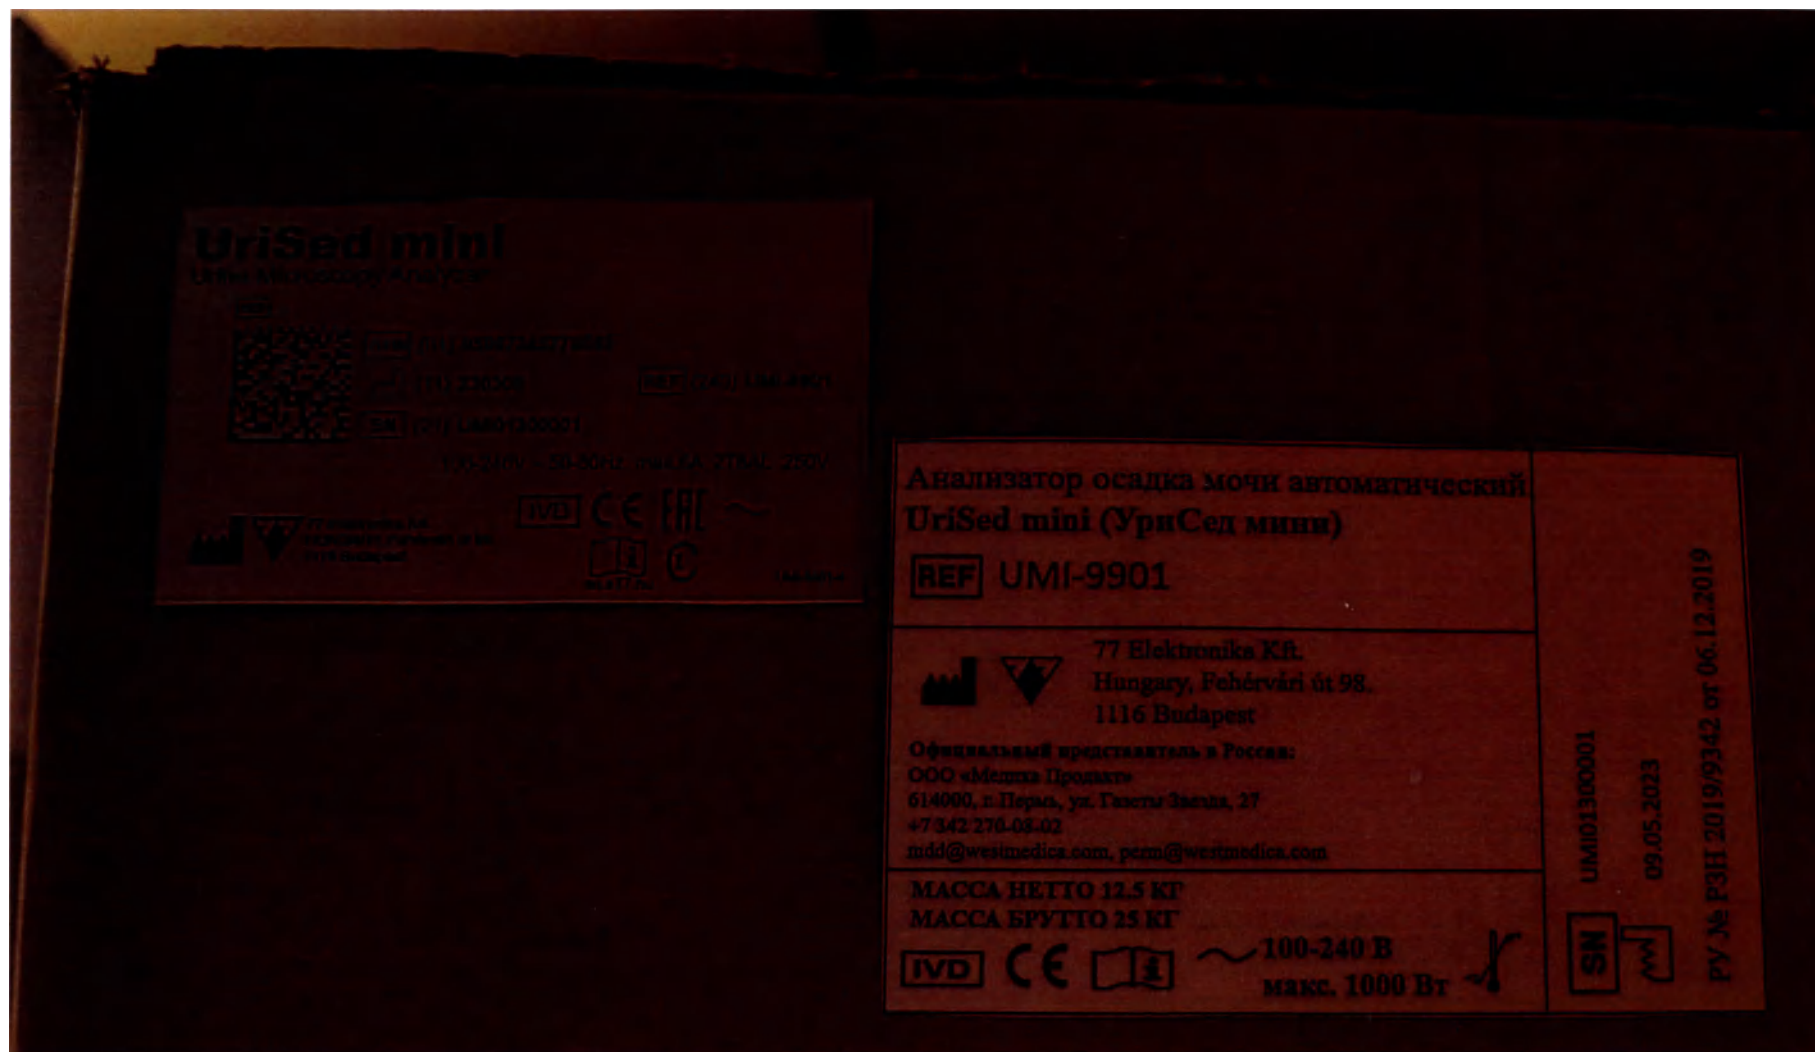

Упаковка анализатора UriSed mini с маркировкой на английском и русском языках (продолжение)

UriSed mini

Urine Microscopy Analyzer

UDI



GTIN (01)

~ (11)

SN (21)

REF (240) UMI-9901

100-240V ~ 50-60Hz max.6A 2T8AL 250V



77 Elektronika Kft.
HUNGARY, Fehérvári út 98.
1116 Budapest

IVD

CE EAC



en.e77.hu



UMI-9401-4

Макет маркировки анализатора UriSed mini на английском языке

Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини) REF UMI-9901		RU № PЗН 2019/9342 от 06.12.2019
 	77 Elektronika Kft. Hungary, Fehérvári út 98. 1116 Budapest Официальный представитель в России: ООО «Медика Продакт» 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02 mdd@westmedica.com, perm@westmedica.com	
IVD    100-240 В макс. 1000 Вт 	SN 	

Макет маркировки анализатора UriSed mini на русском языке

UriSed mini

Urine Microscopy Analyzer

UDI



GTIN (01)

(11)

SN (21)

REF (240) UMI-9901

100-240V ~ 50-60Hz max.6A 2T8AL 250V



77 Elektronika Kft.
HUNGARY, Fehérvári út 98,
1116 Budapest

IVD

CE EAC



en.e77.hu

1

UMI-9401-4

Макет маркировки упаковки анализатора UriSed mini на английском языке

Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини) REF UMI-9901	РУ № РЗН 2019/9342 от 06.12.2019 SN 	
  77 Elektronika Kft. Hungary, Fehérvári út 98. 1116 Budapest Официальный представитель в России: ООО «Медика Продакт» 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02 mdd@westmedica.com, perm@westmedica.com		
МАССА НЕТТО __ КГ МАССА БРУТТО __ КГ IVD CE  ~ 100-240 В макс. 1000 Вт 		

Макет маркировки упаковки анализатора UriSed mini на русском языке

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
_____ лист(-ах/-е) бумаги

Михалева Е. М., Директор

