

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «МО «Отдел медицинской техники»

А.Ю. Цикин

июля 2021 г.



ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

**КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ДЛЯ АППАРАТОВ ИВЛ, СРАР И КИСЛОРОДОТЕРАПИИ
по ТУ 32.50.21-002-55796184-2020**

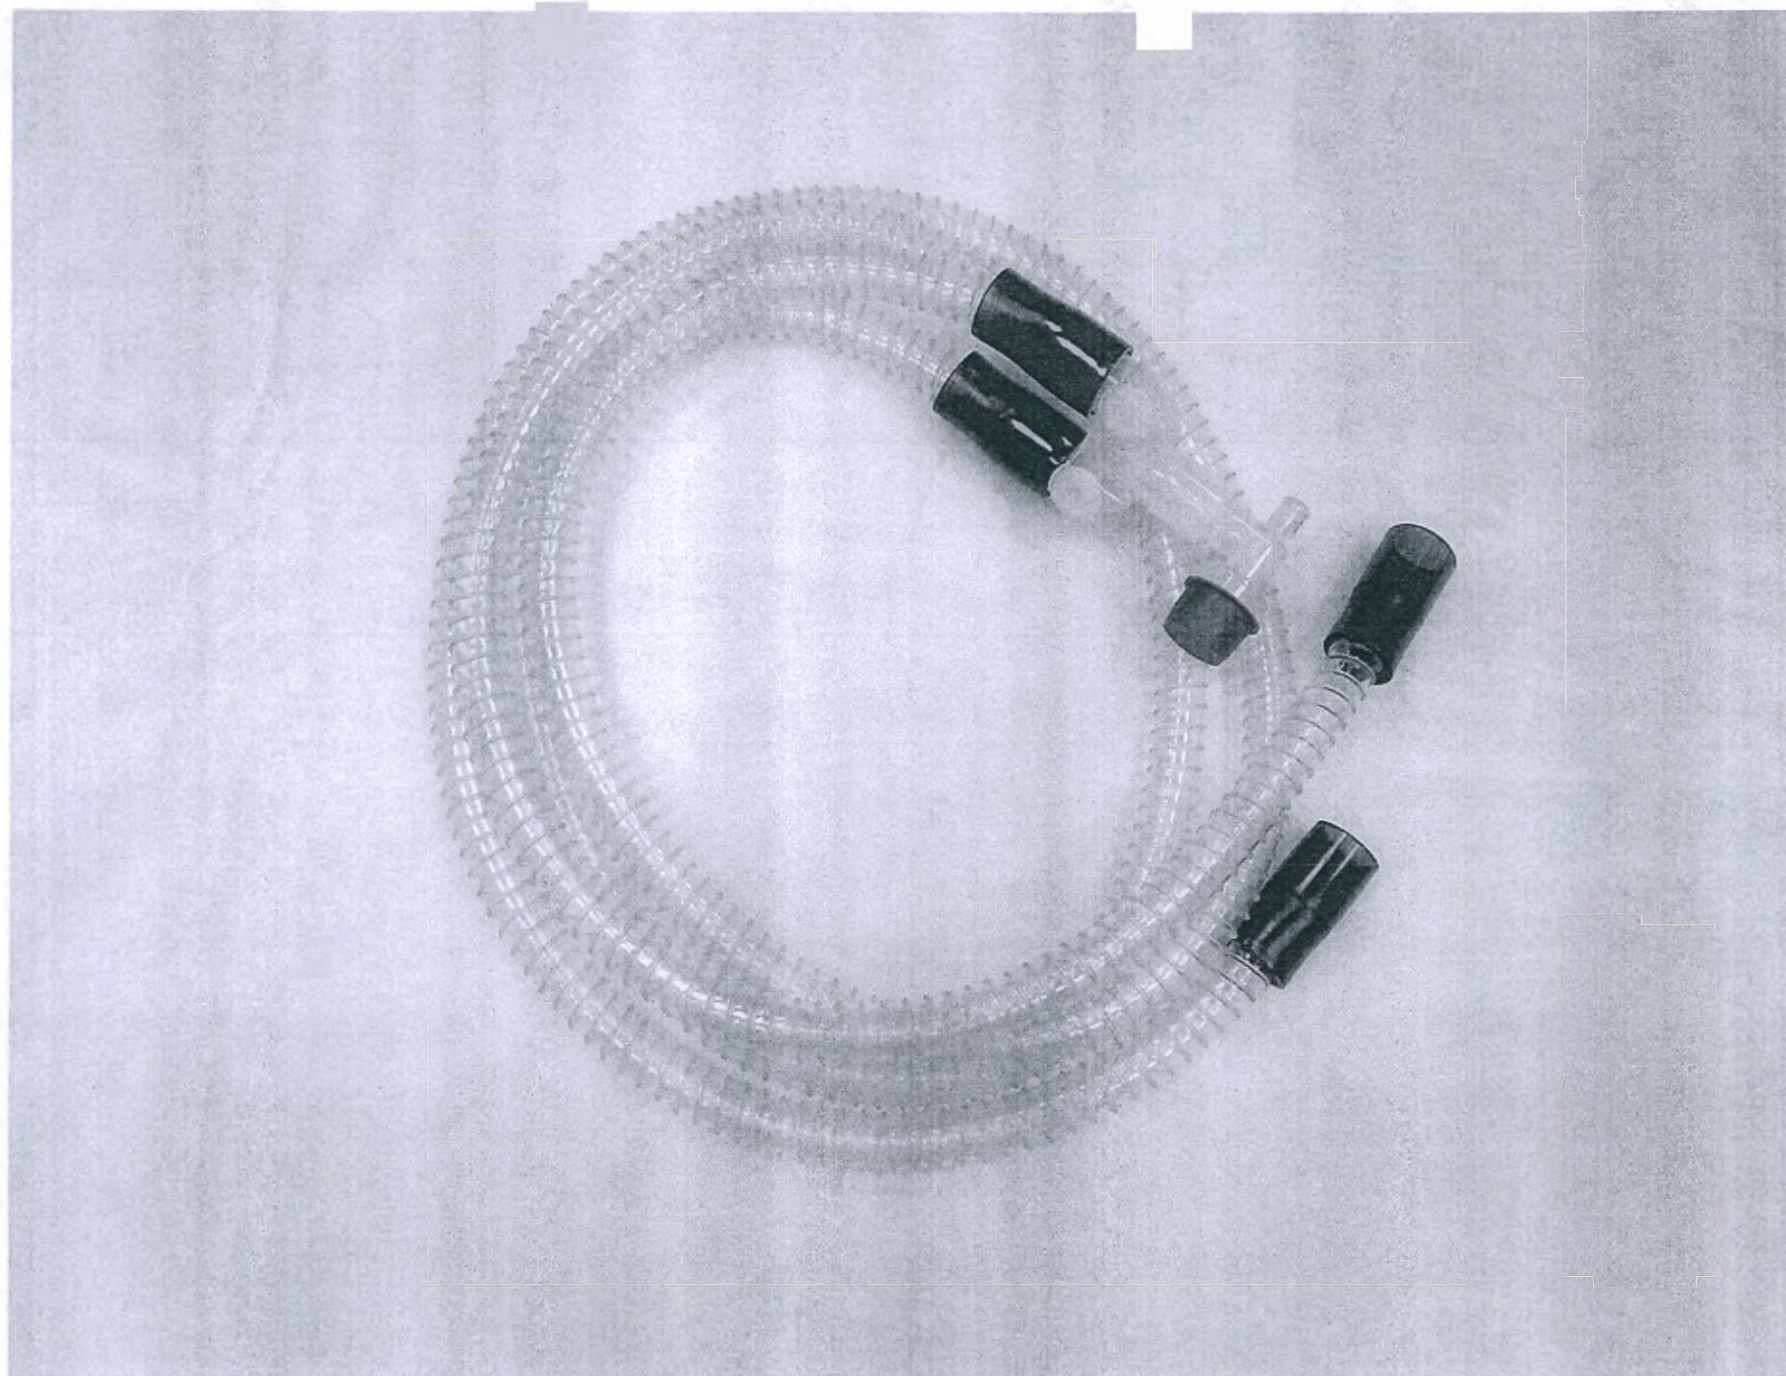


Рис. 1 Контур дыхательный детский (шланг дыхательный гладкоствольный)

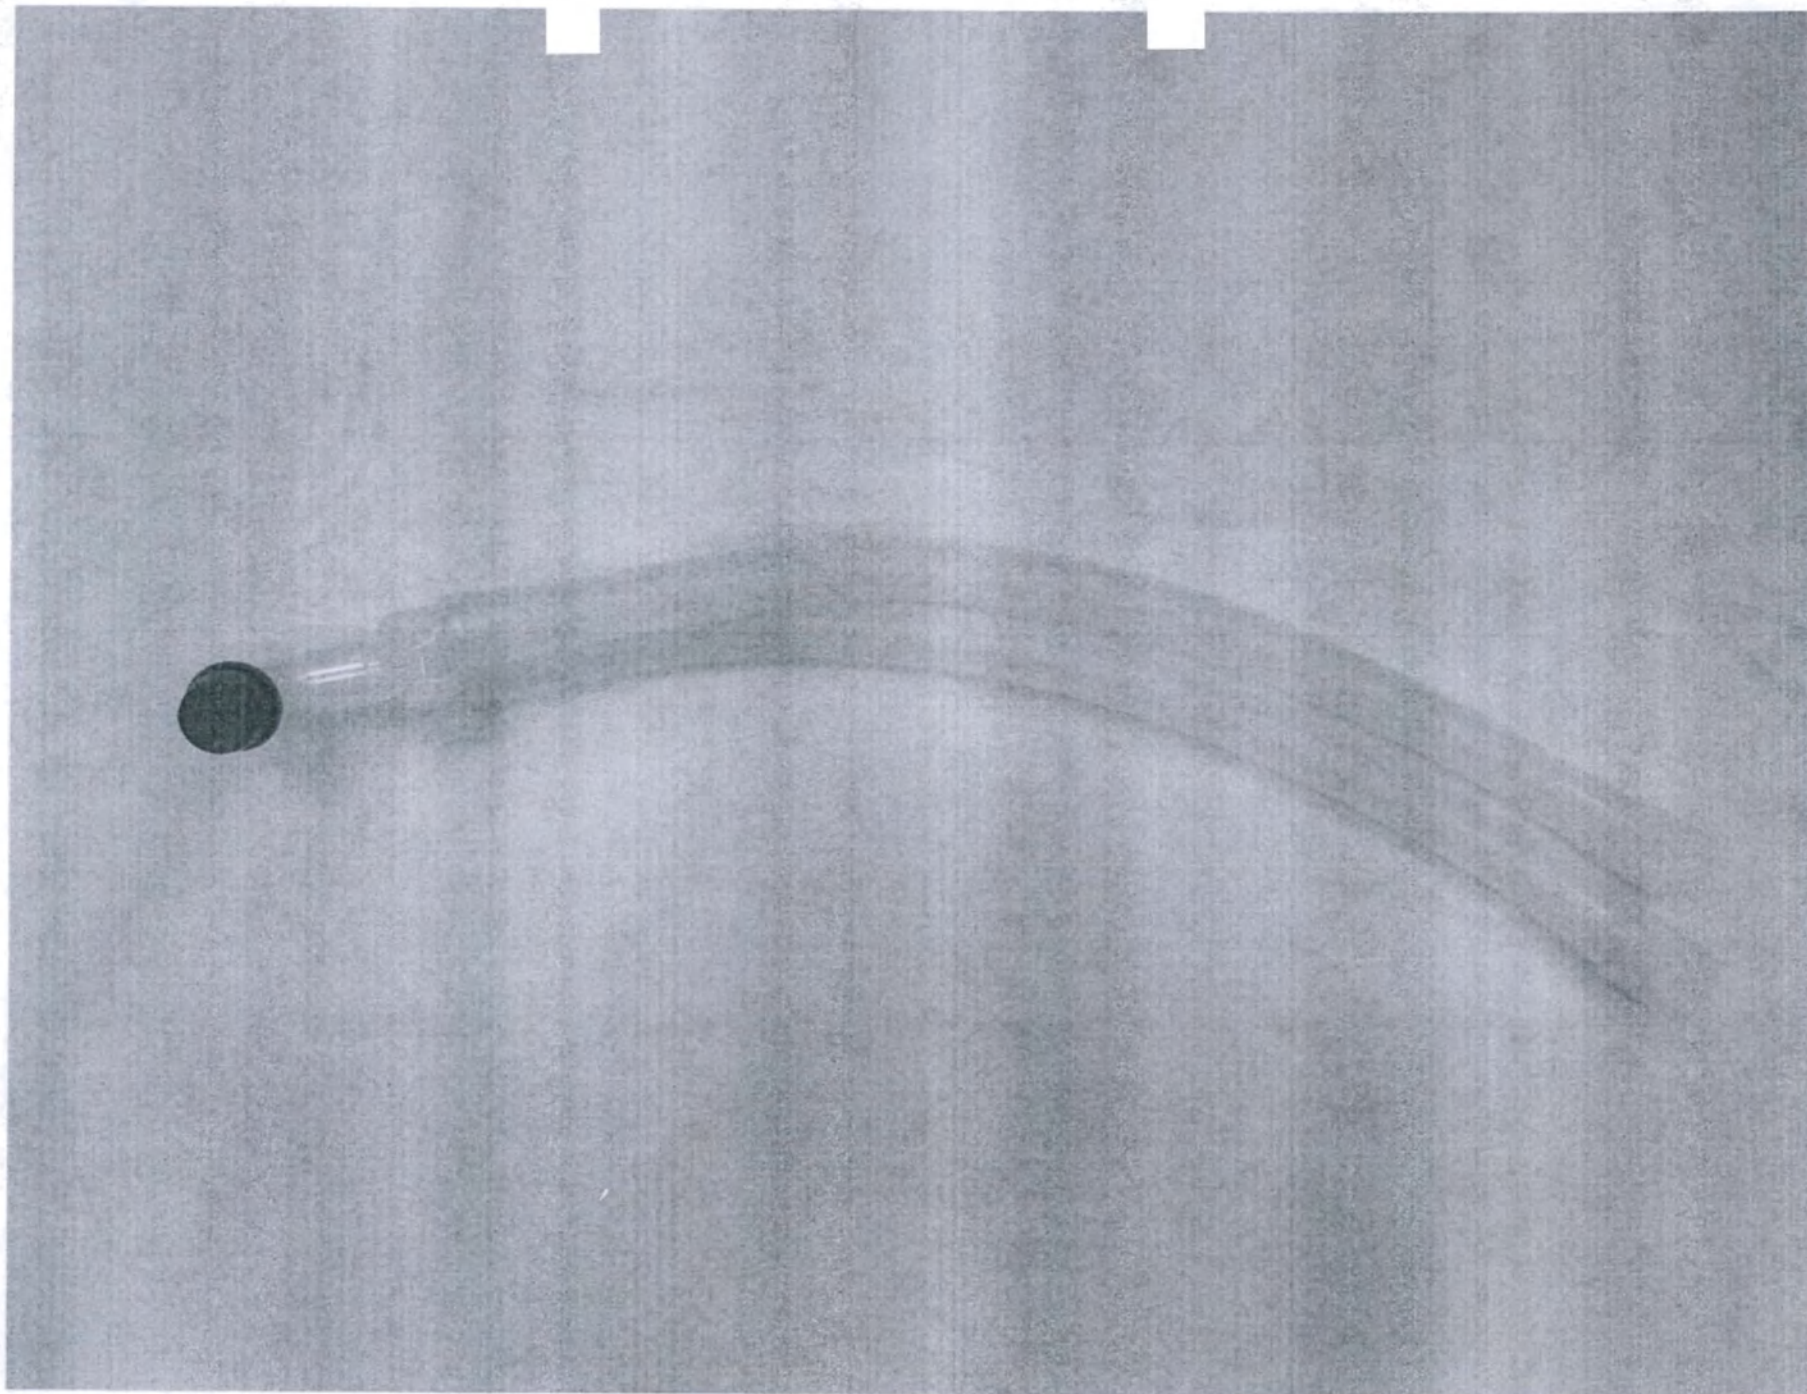


Рис. 2 Контур дыхательный детский (шланг дыхательный конфигурируемый)

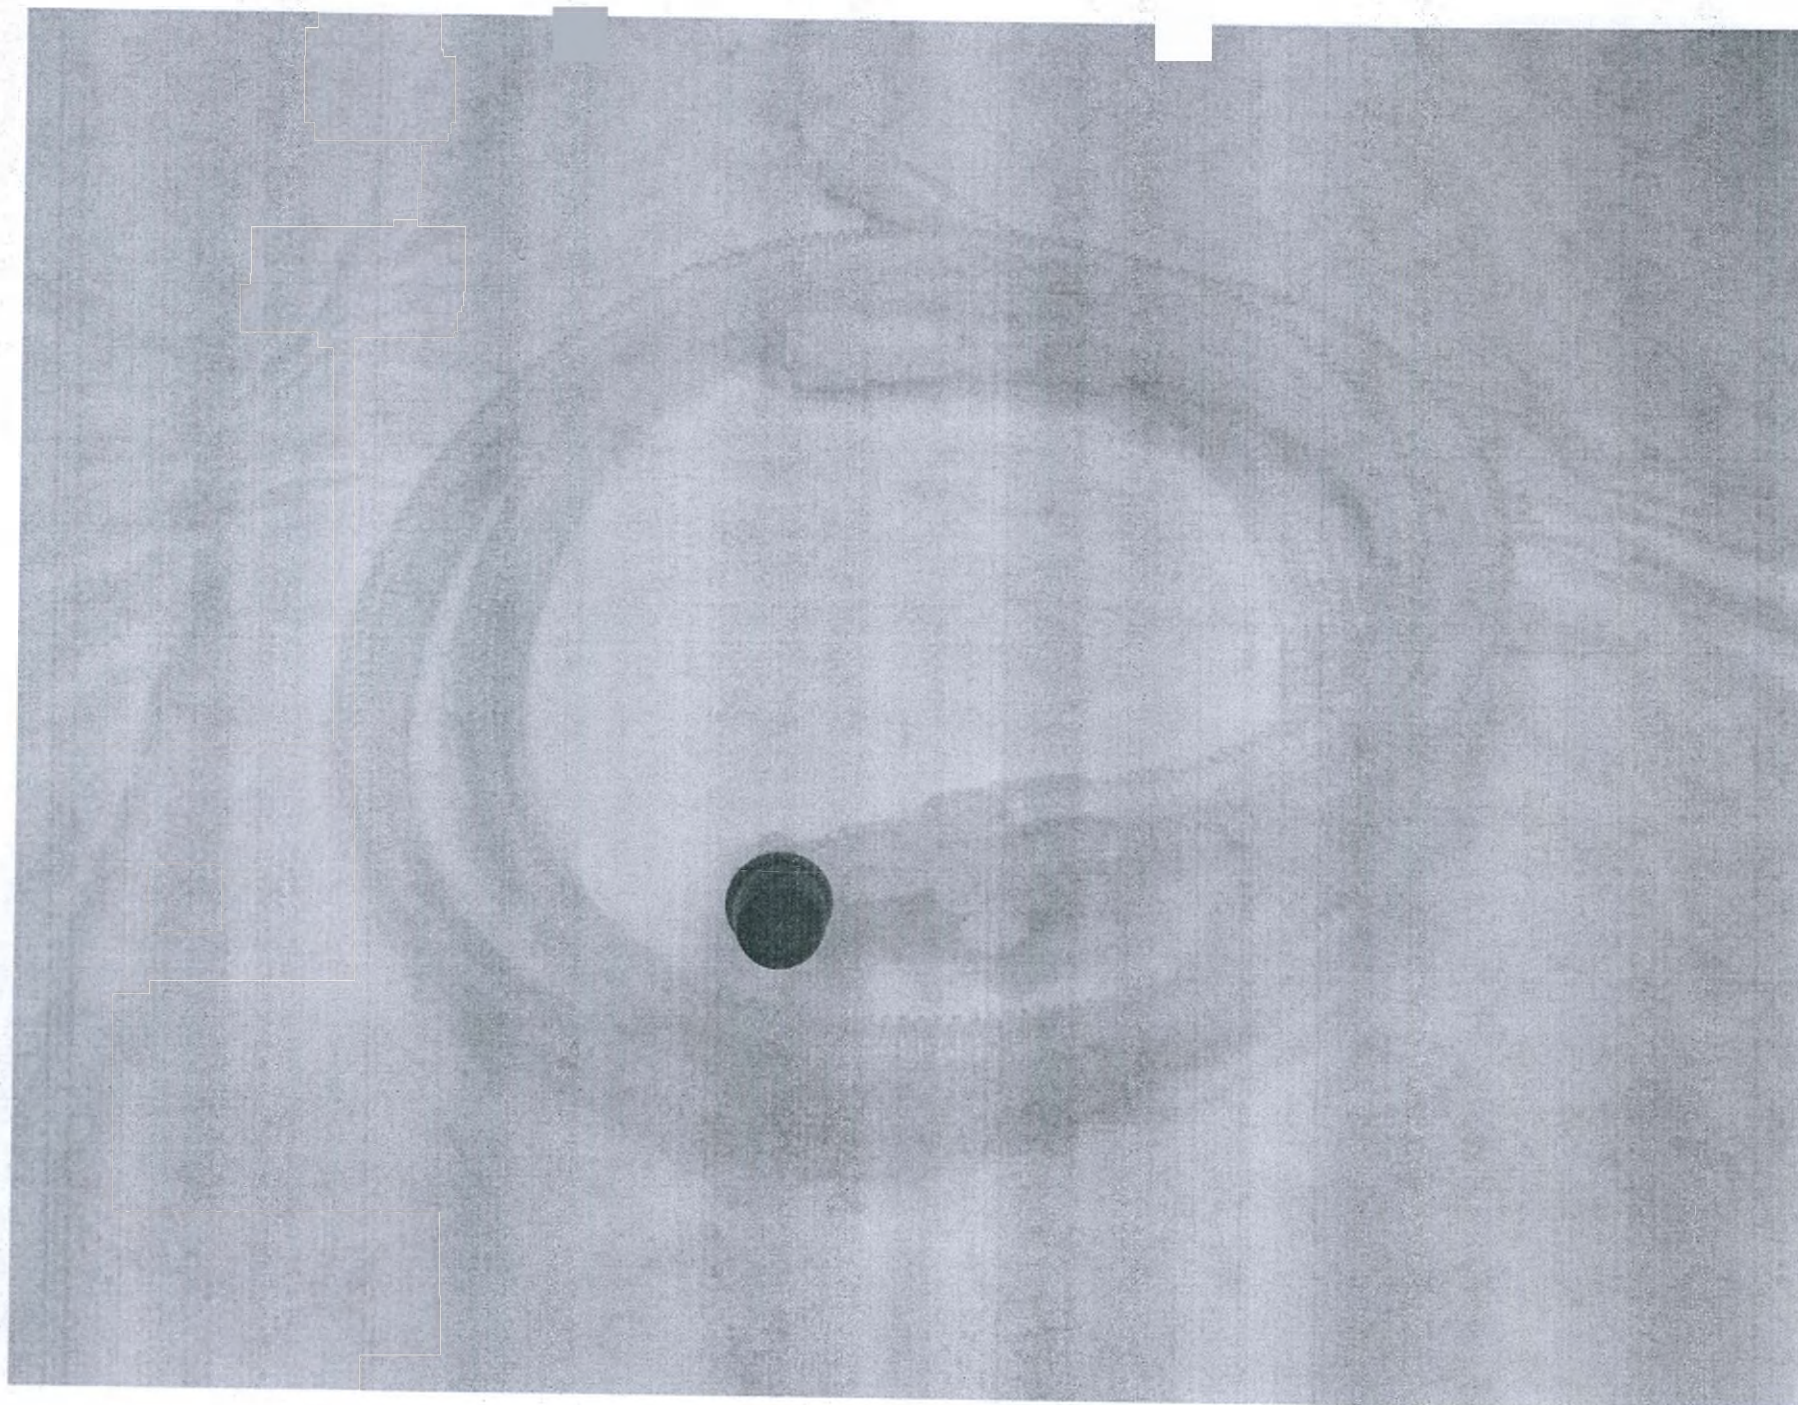


Рис. 3 Контур дыхательный детский (шланг дыхательный гофрированный)

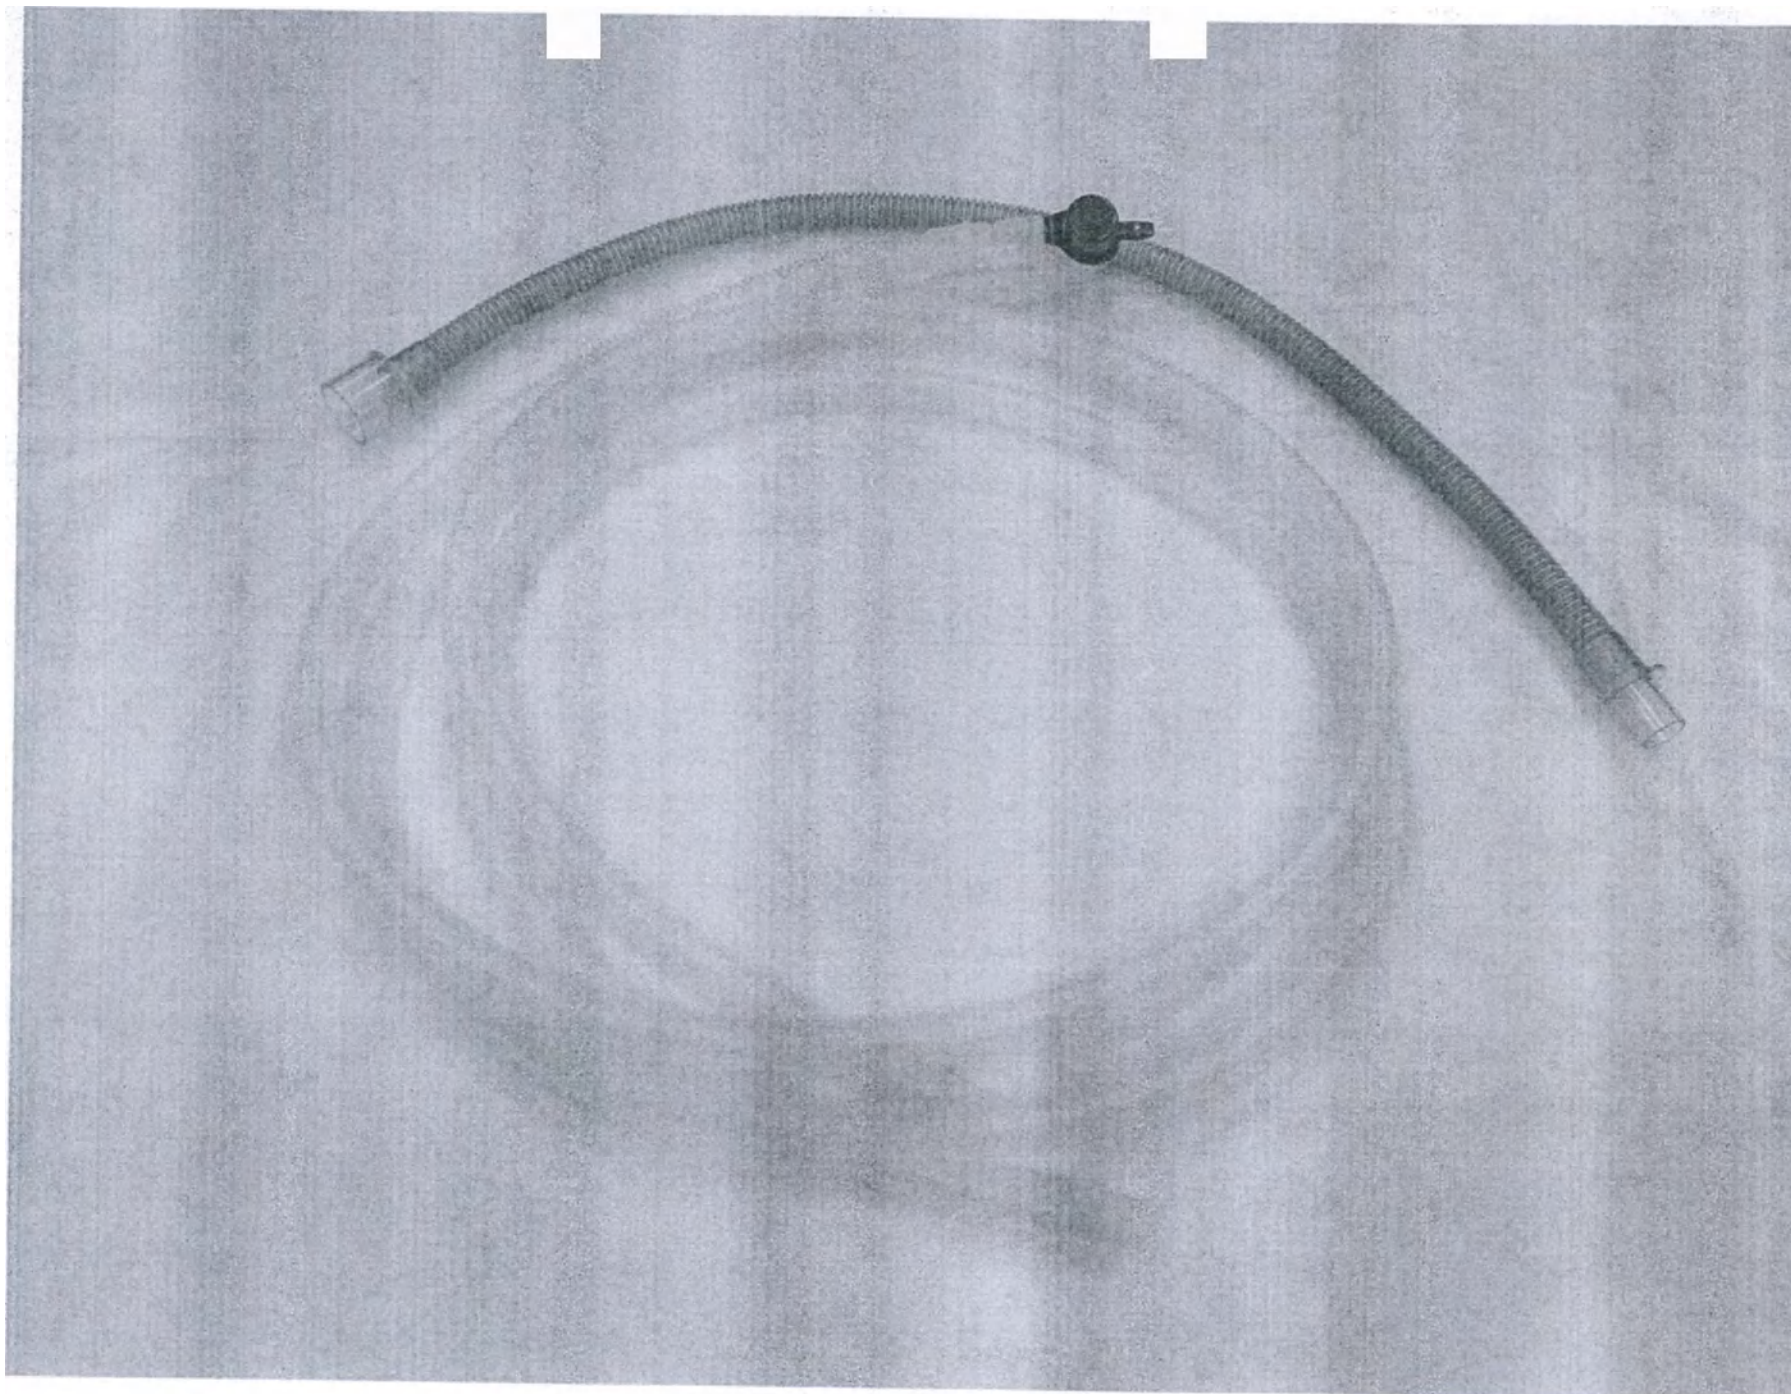


Рис. 4 Контур дыхательный неонатальный (Шланг дыхательный гофрированный)

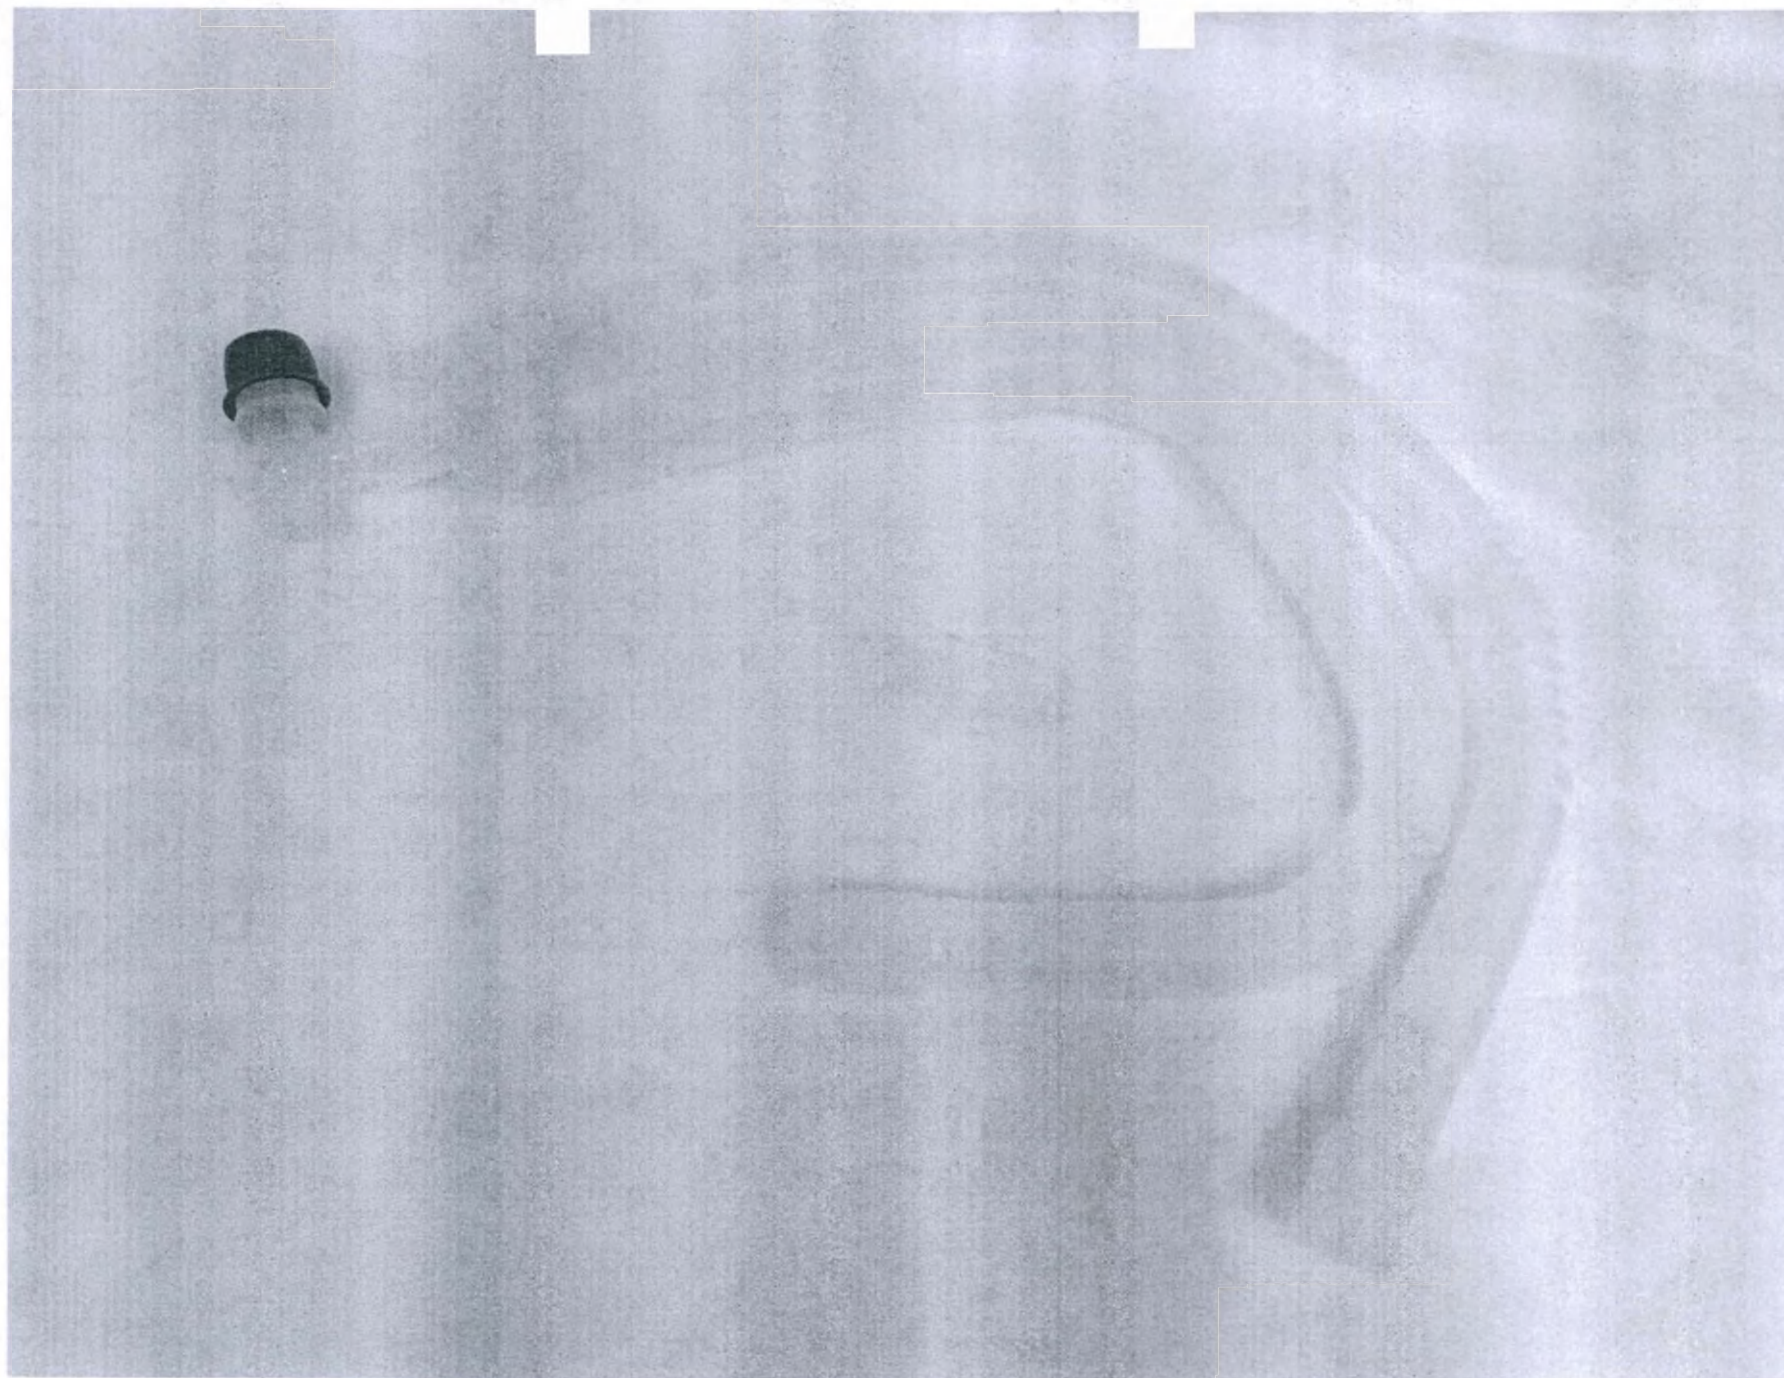


Рис. 5 Контур дыхательный взрослый (Шланг дыхательный конфигурируемый)

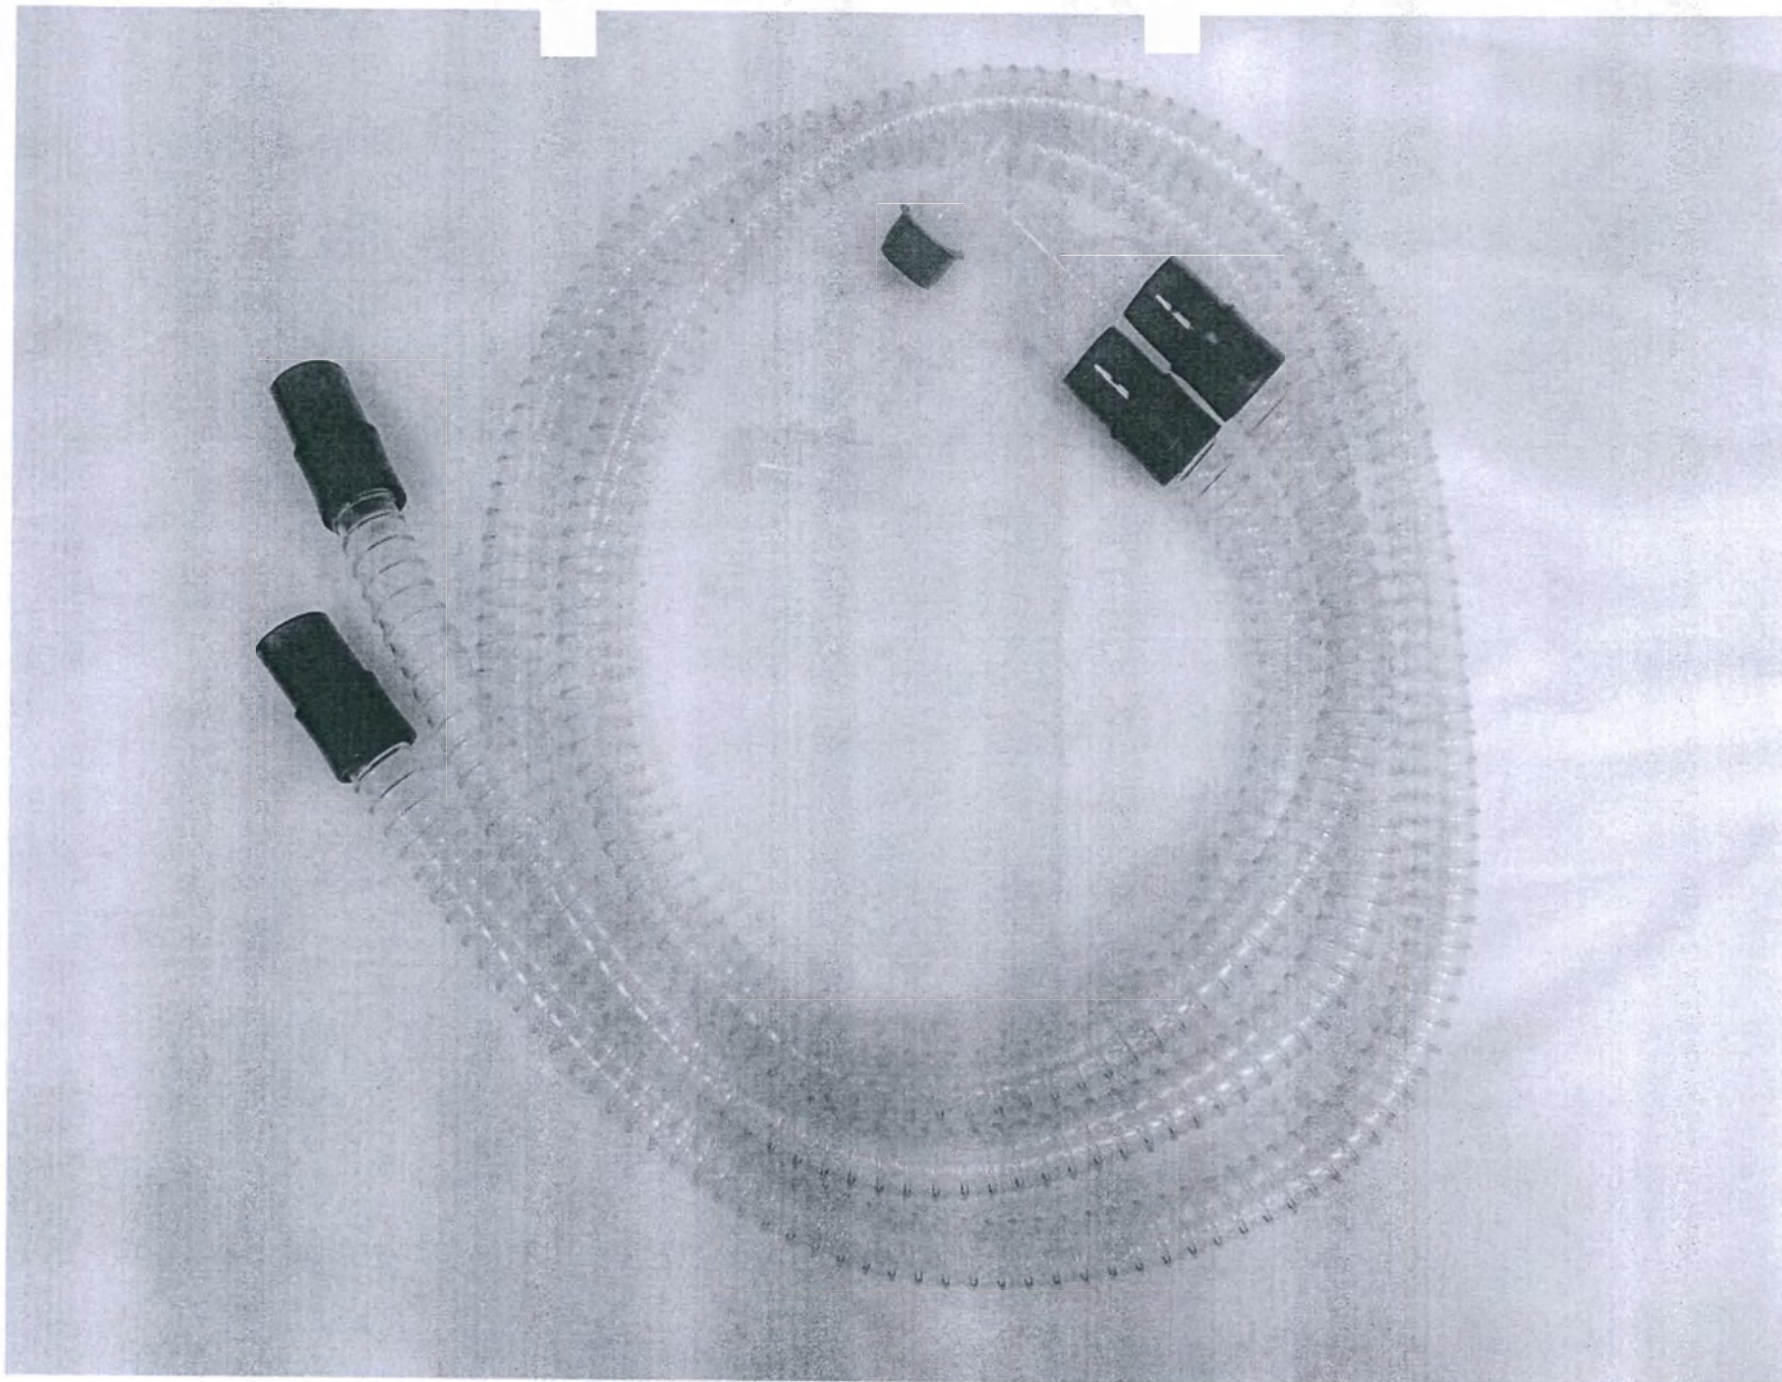


Рис. 6 Контур дыхательный взрослый (Шланг дыхательный гладкоствольный)

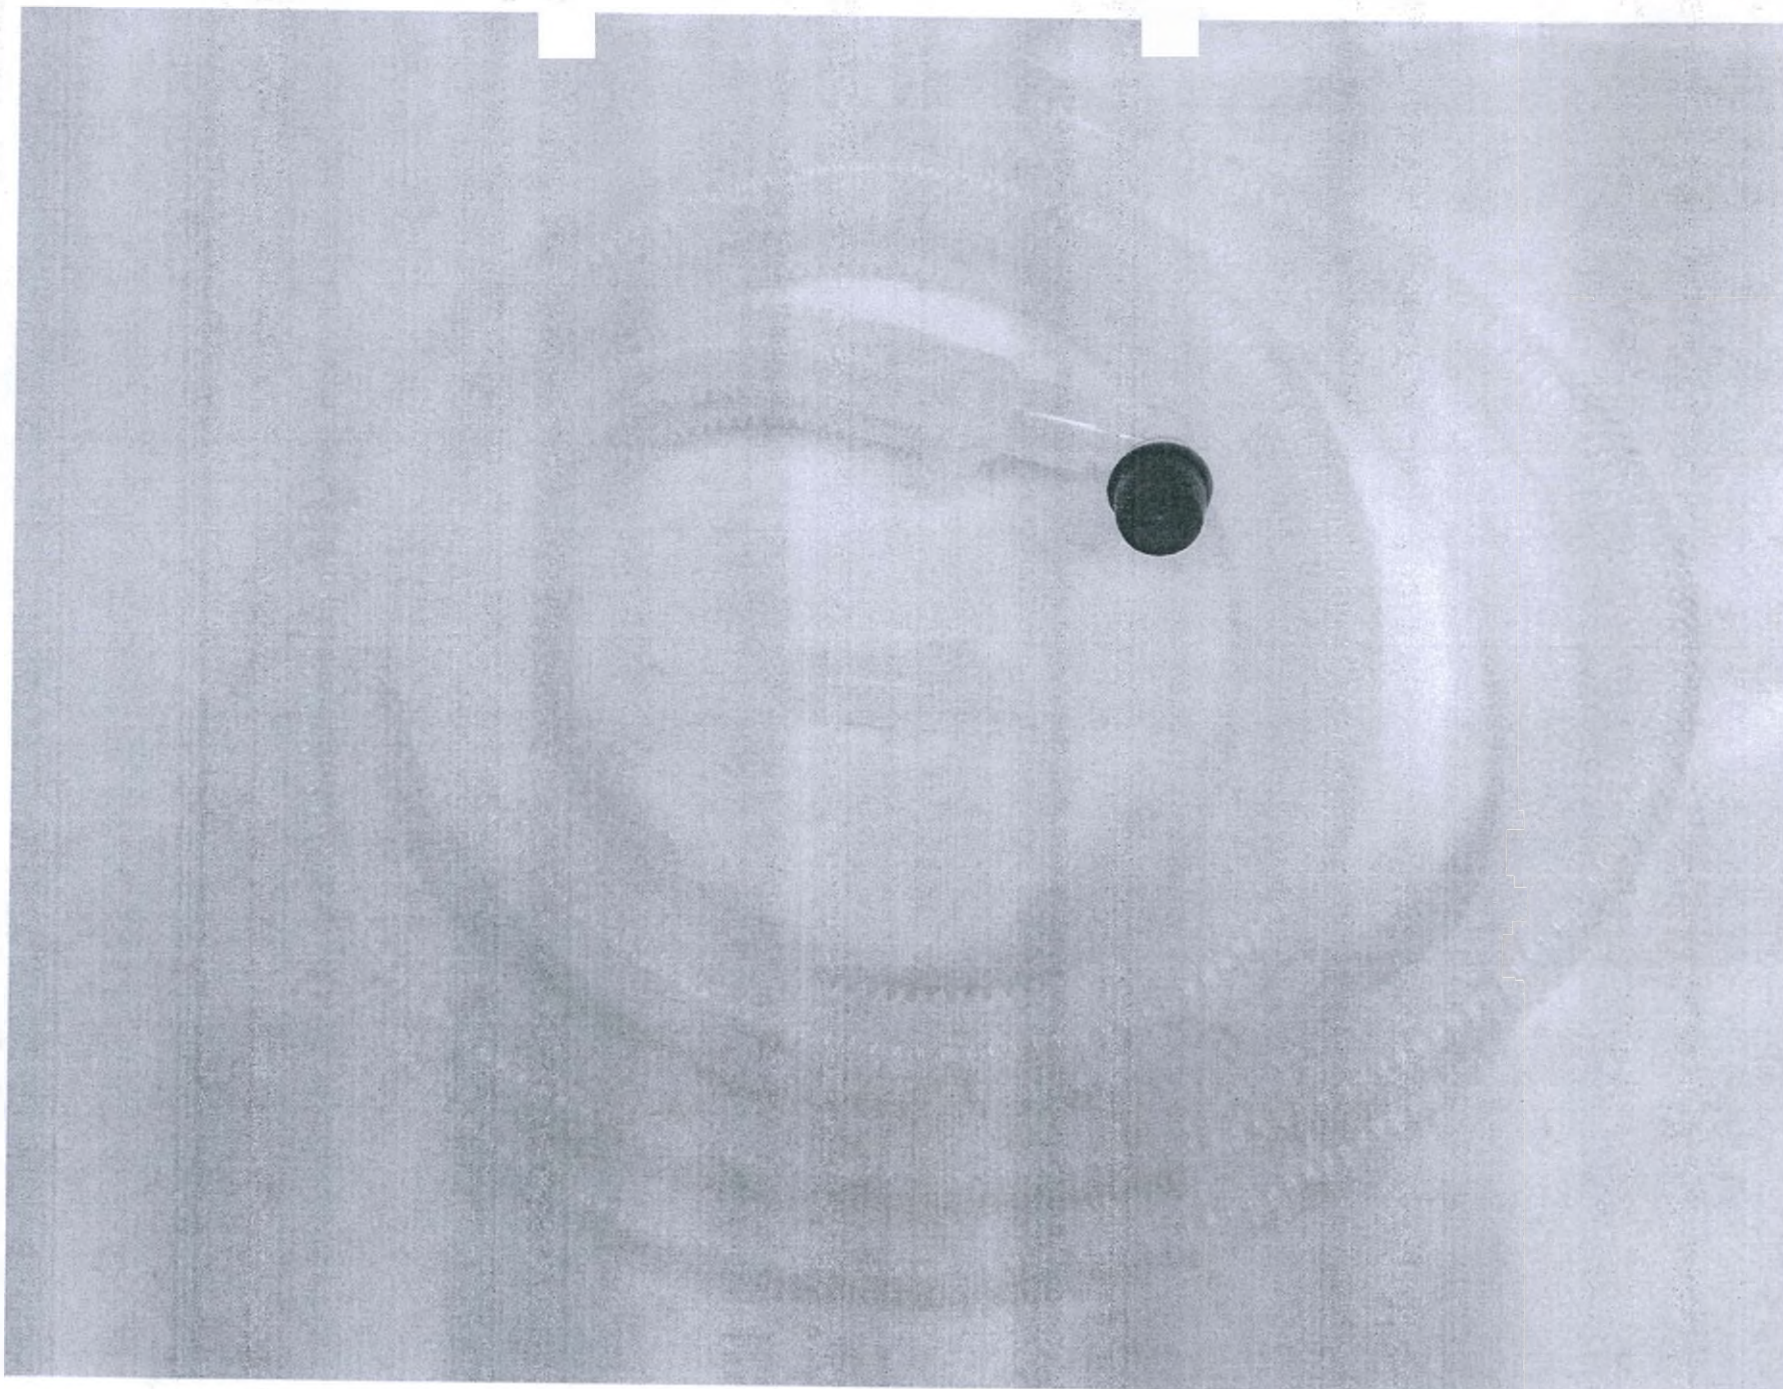


Рис. 7 Контур дыхательный взрослый (Шланг дыхательный гофрированный)

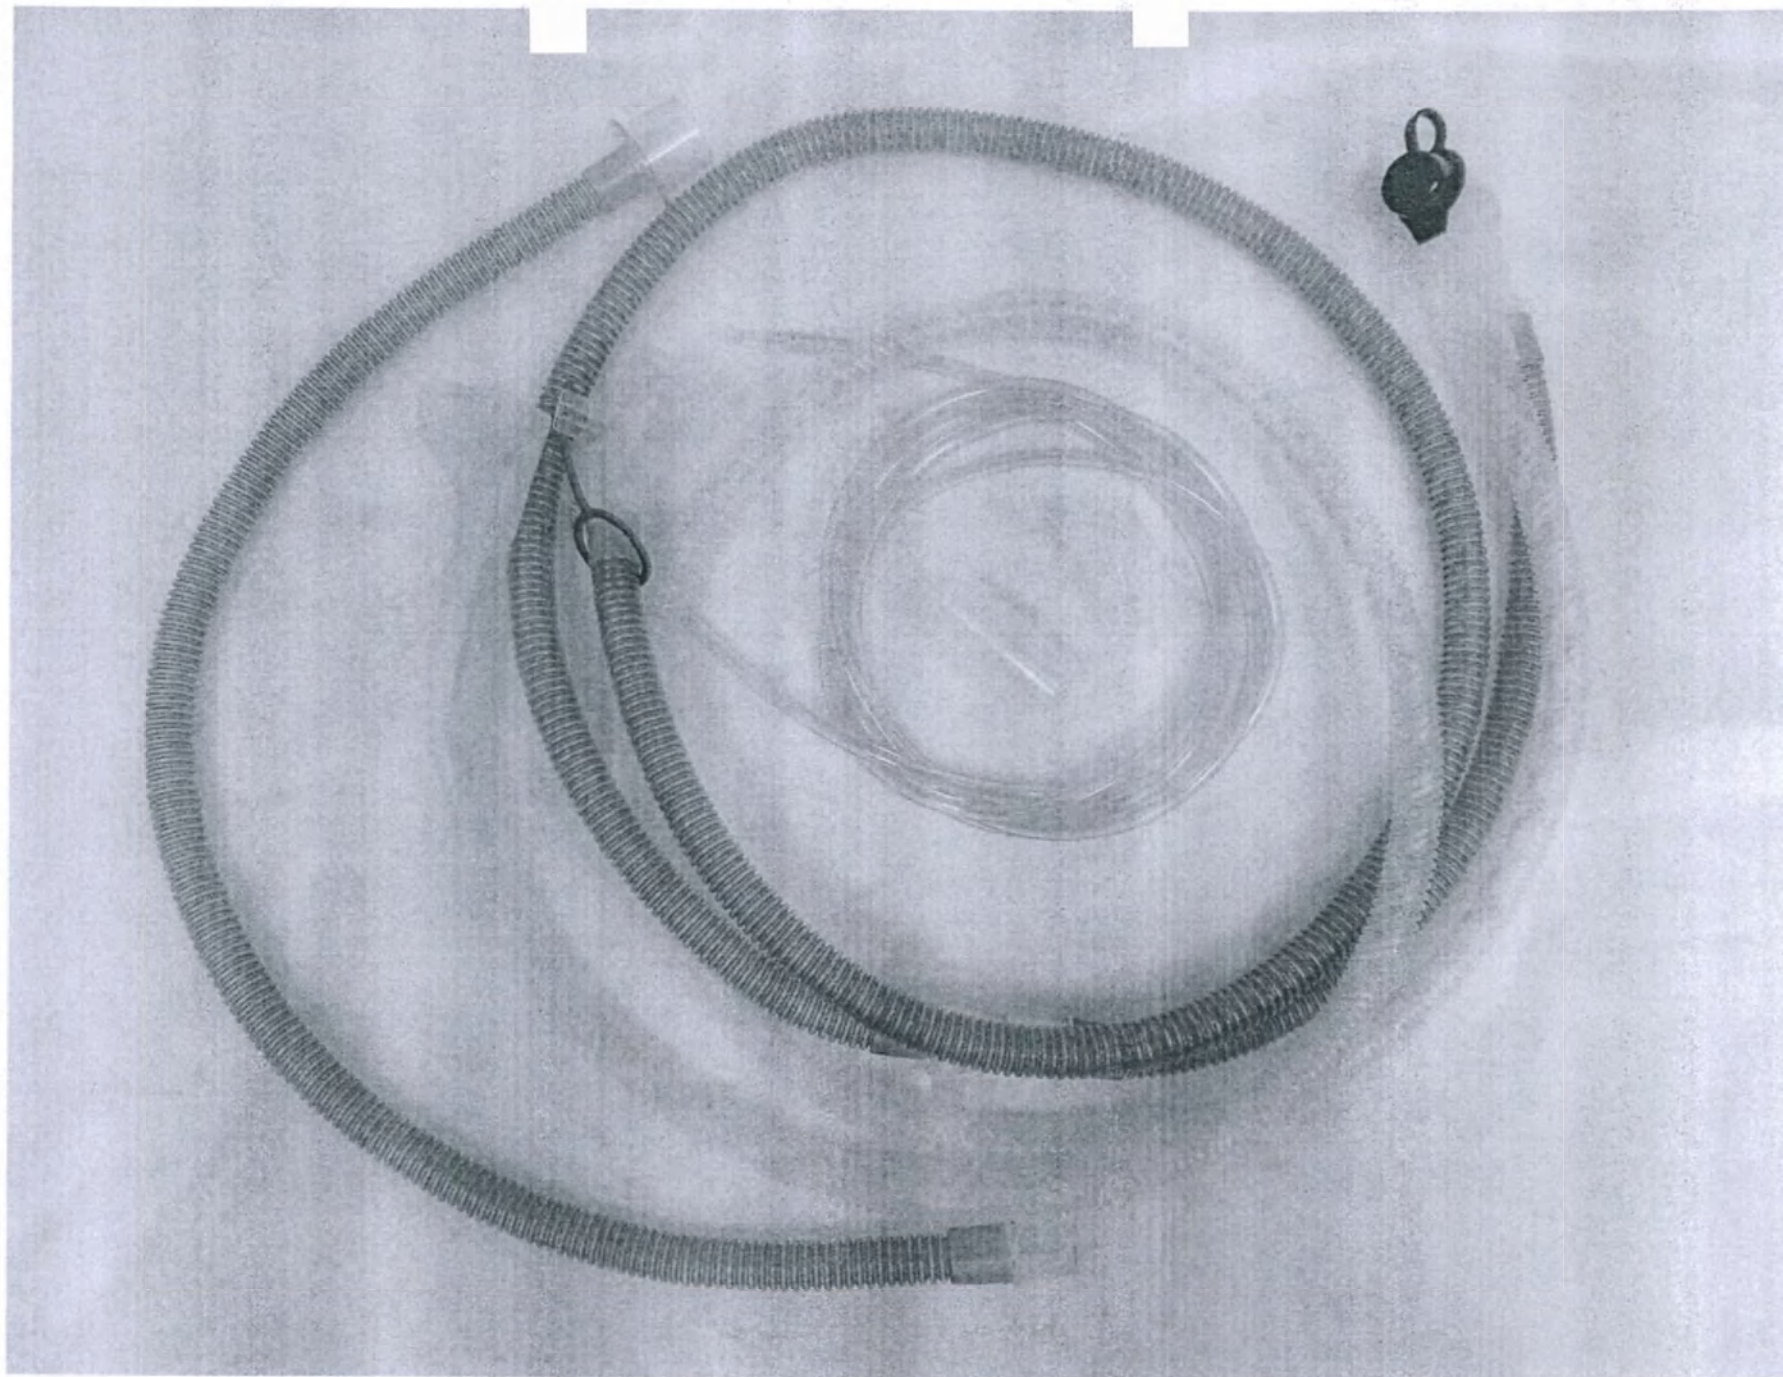


Рис. 8 Контур дыхательный неонатальный с двумя линиями обогрева

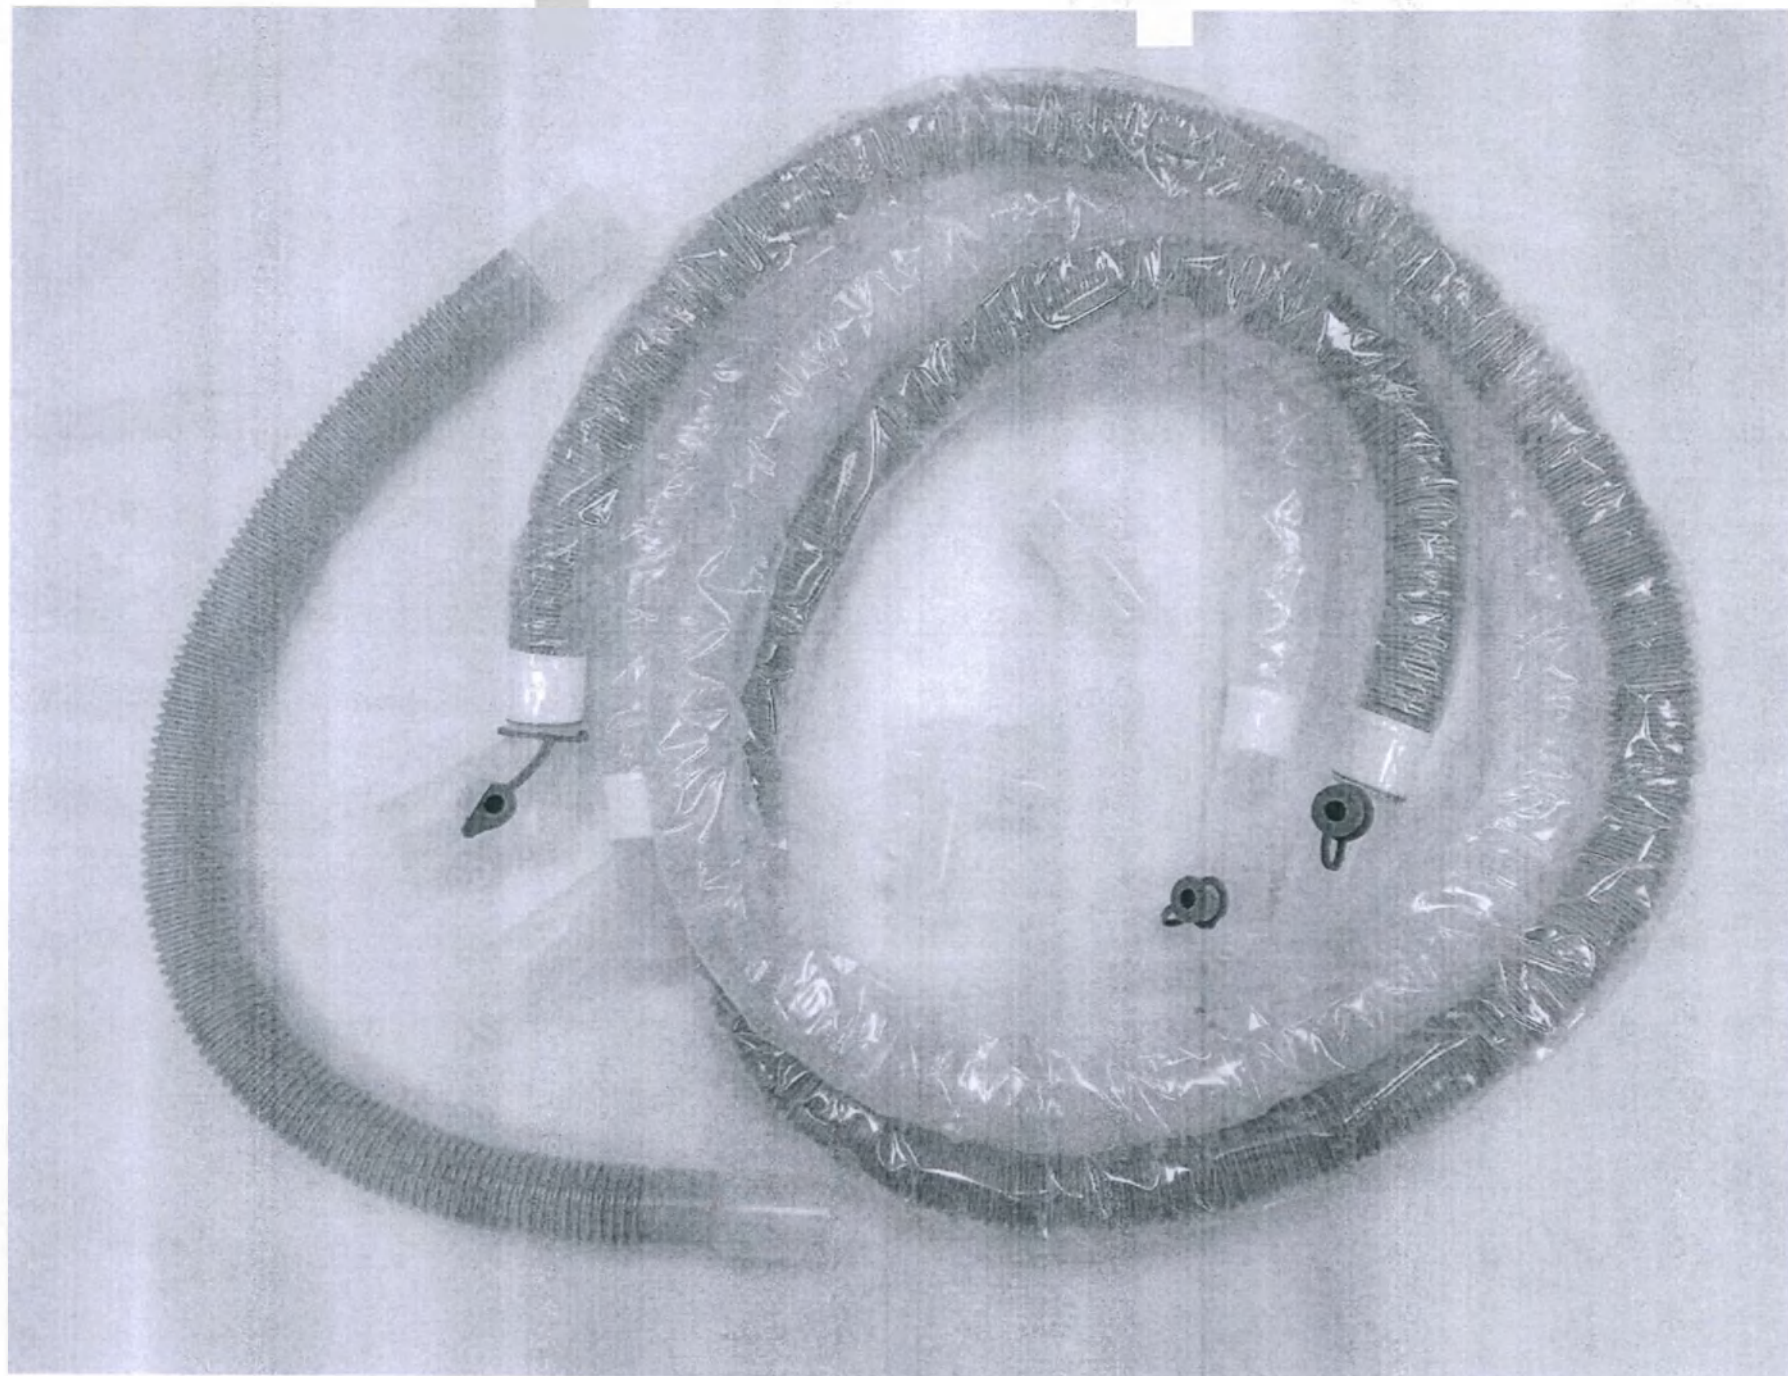


Рис. 9 Контур дыхательный взрослый с двумя линиями обогрева

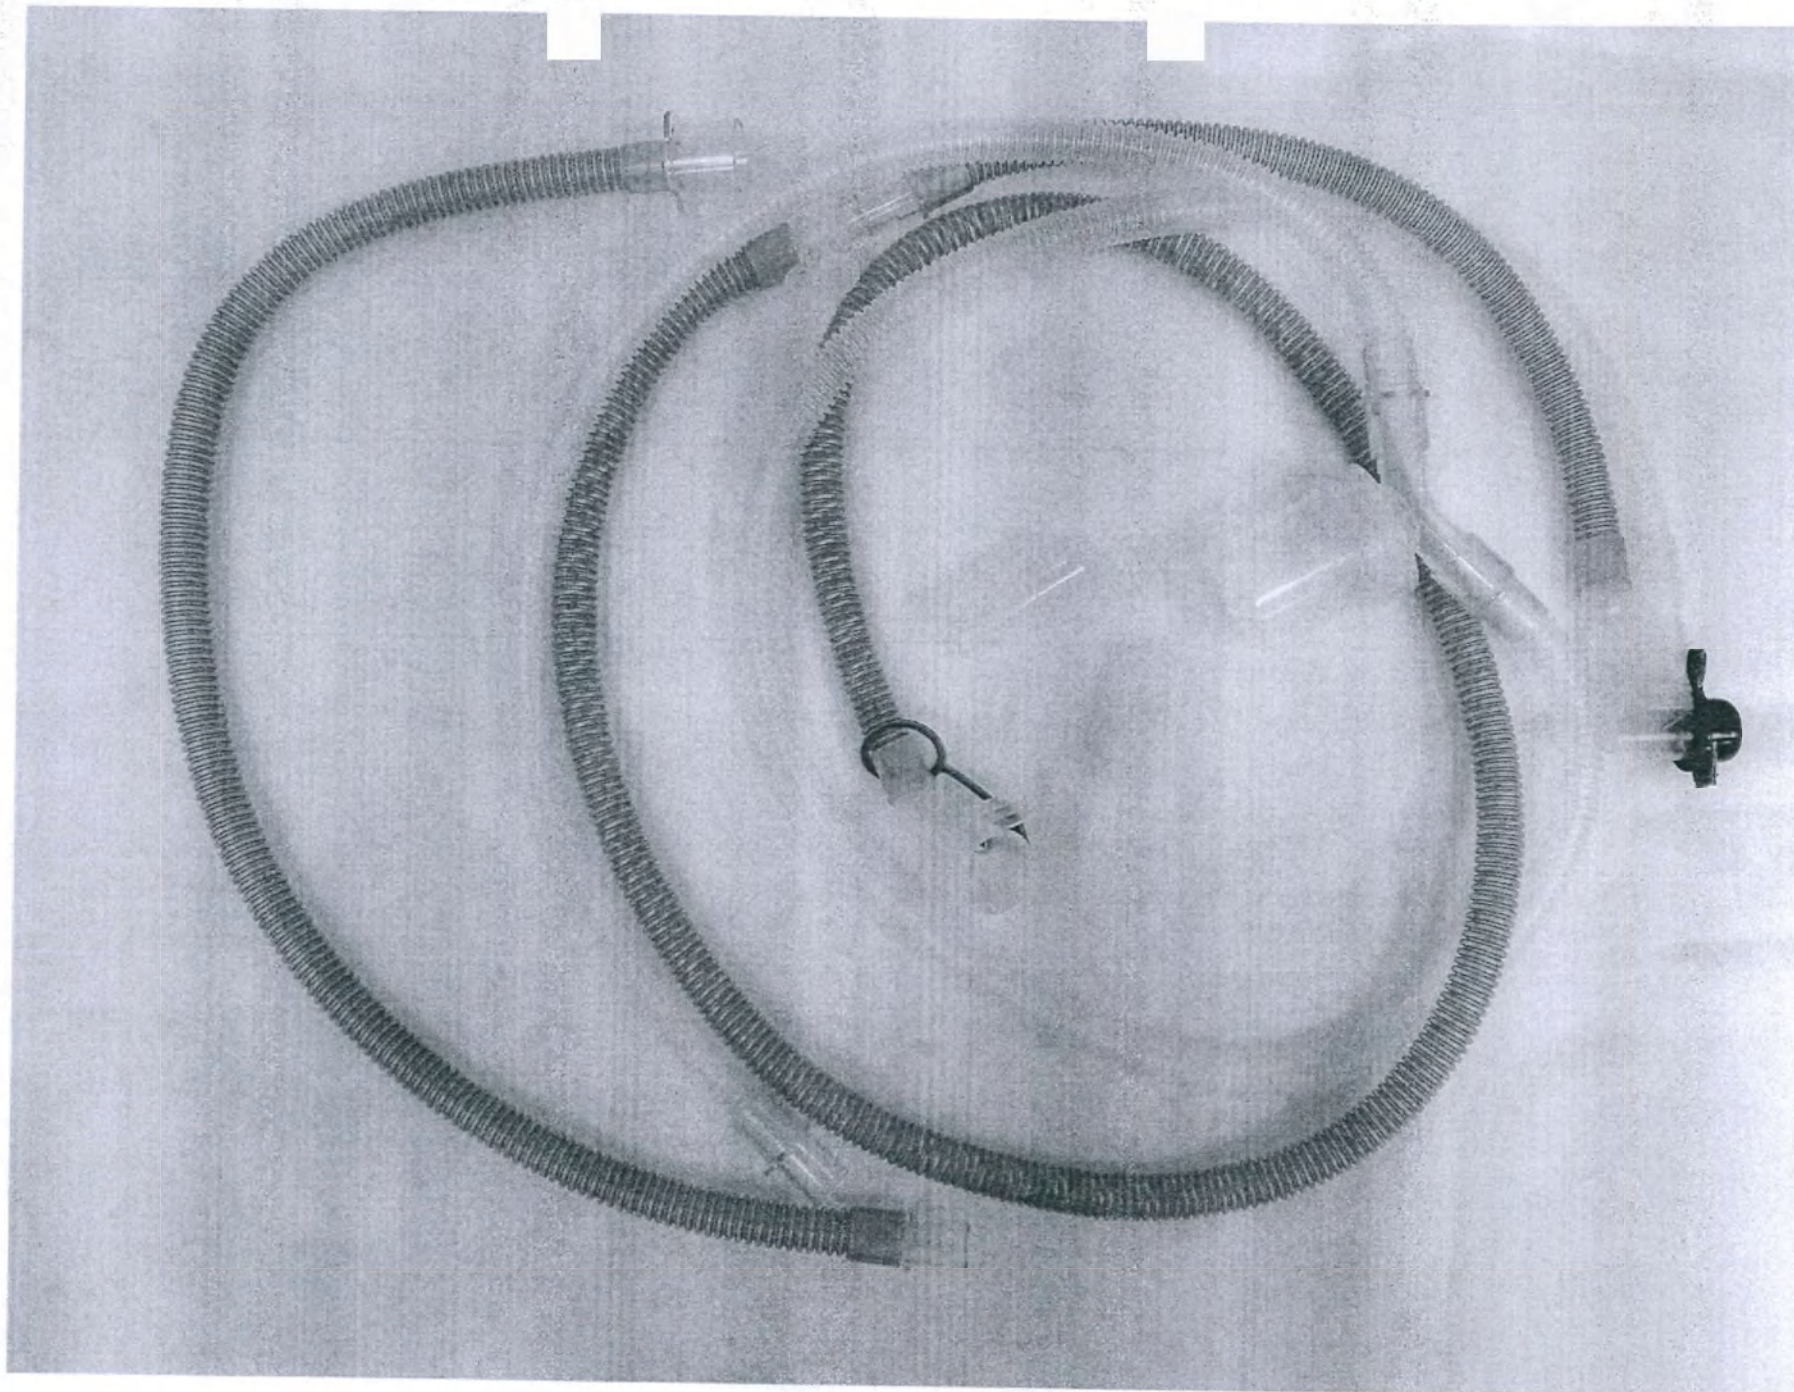


Рис. 10 Контур дыхательный неонатальный с одной линией обогрева и влагосборником

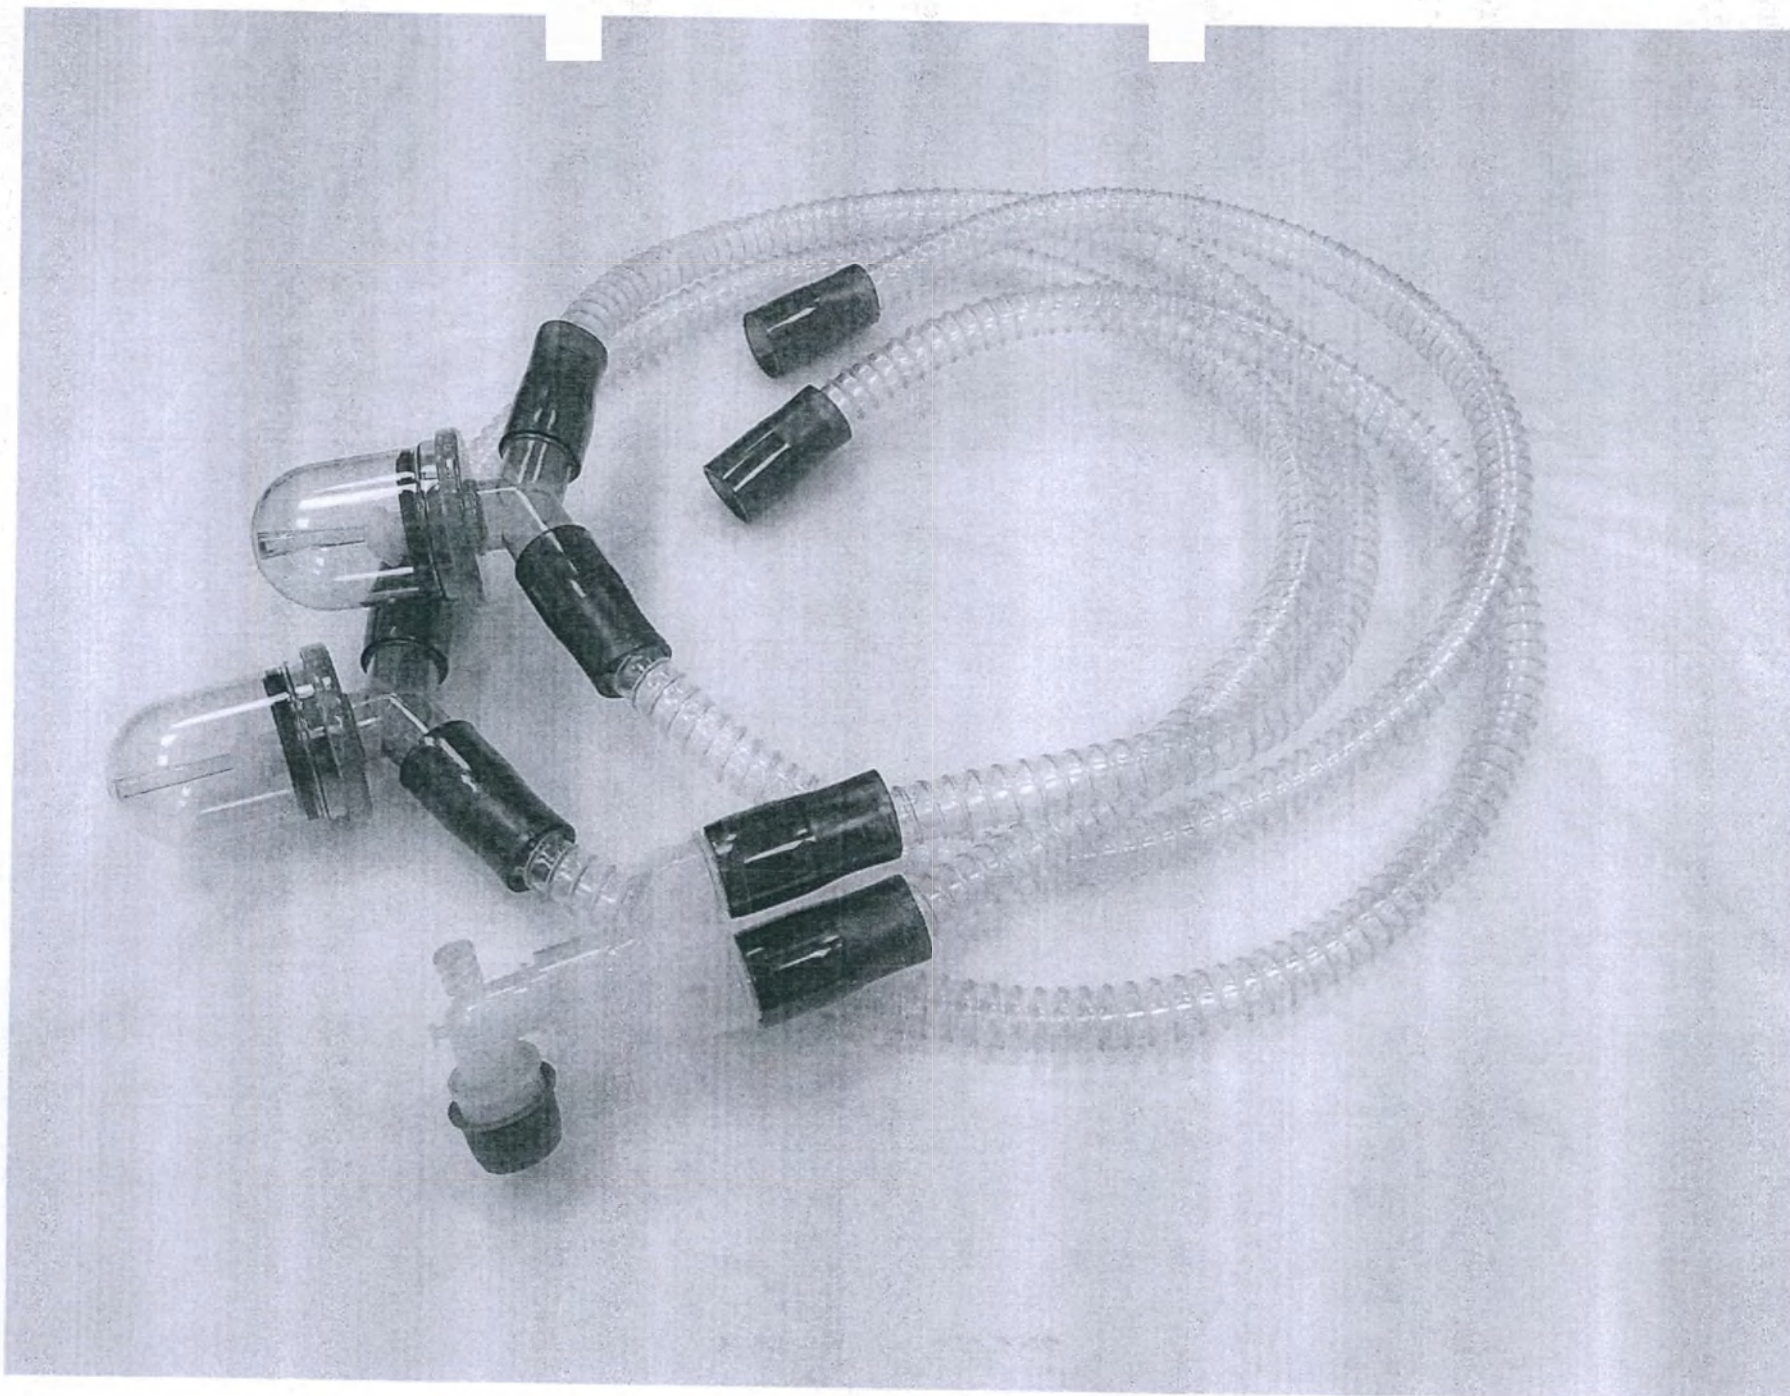


Рис.11 Контур дыхательный детский с двумя влагосборниками (шланг дыхательный гладкоствольный)

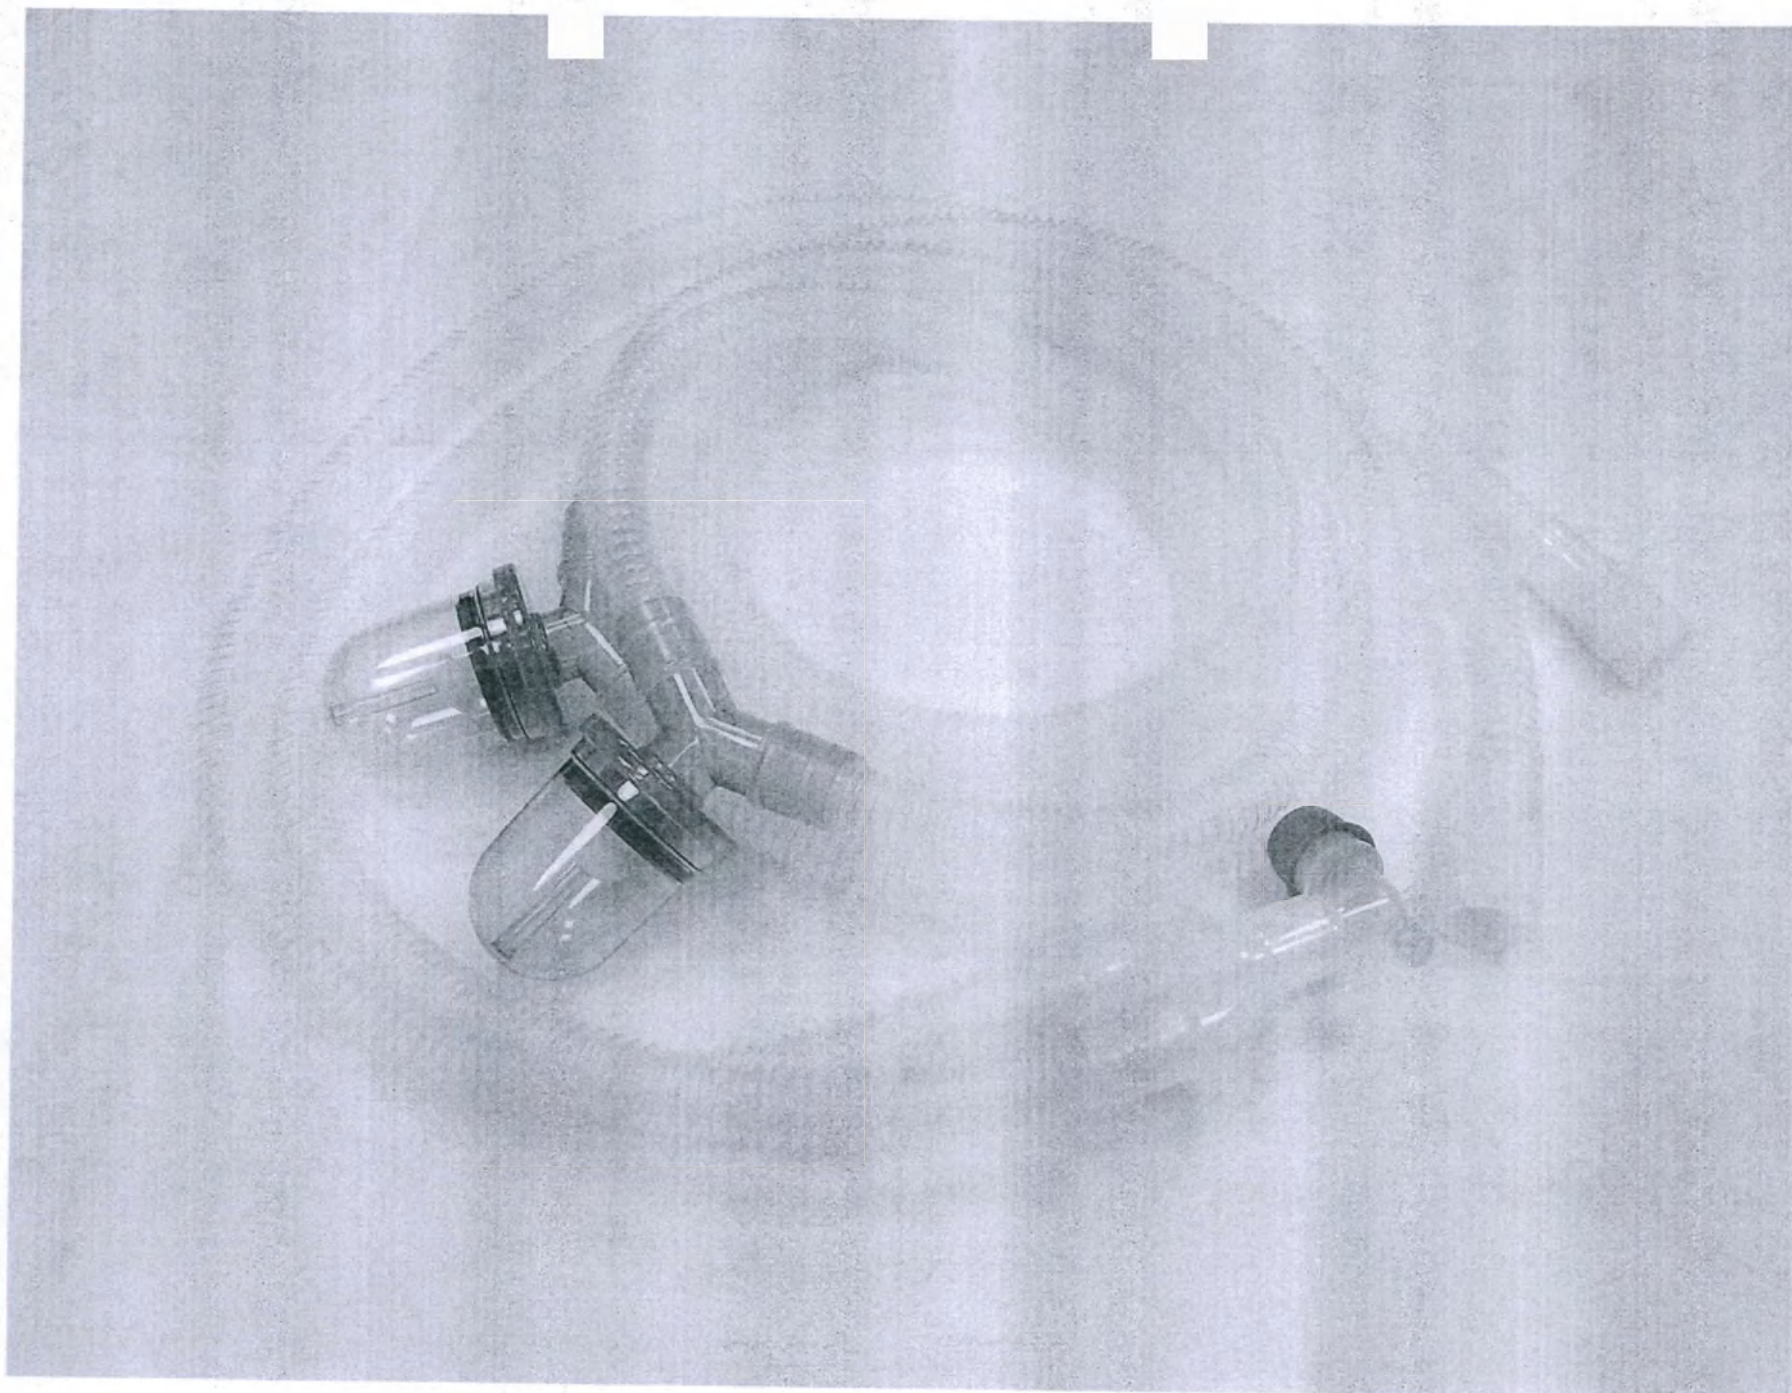


Рис.12 Контур дыхательный детский с двумя влагосборниками (шланг дыхательный гофрированный)

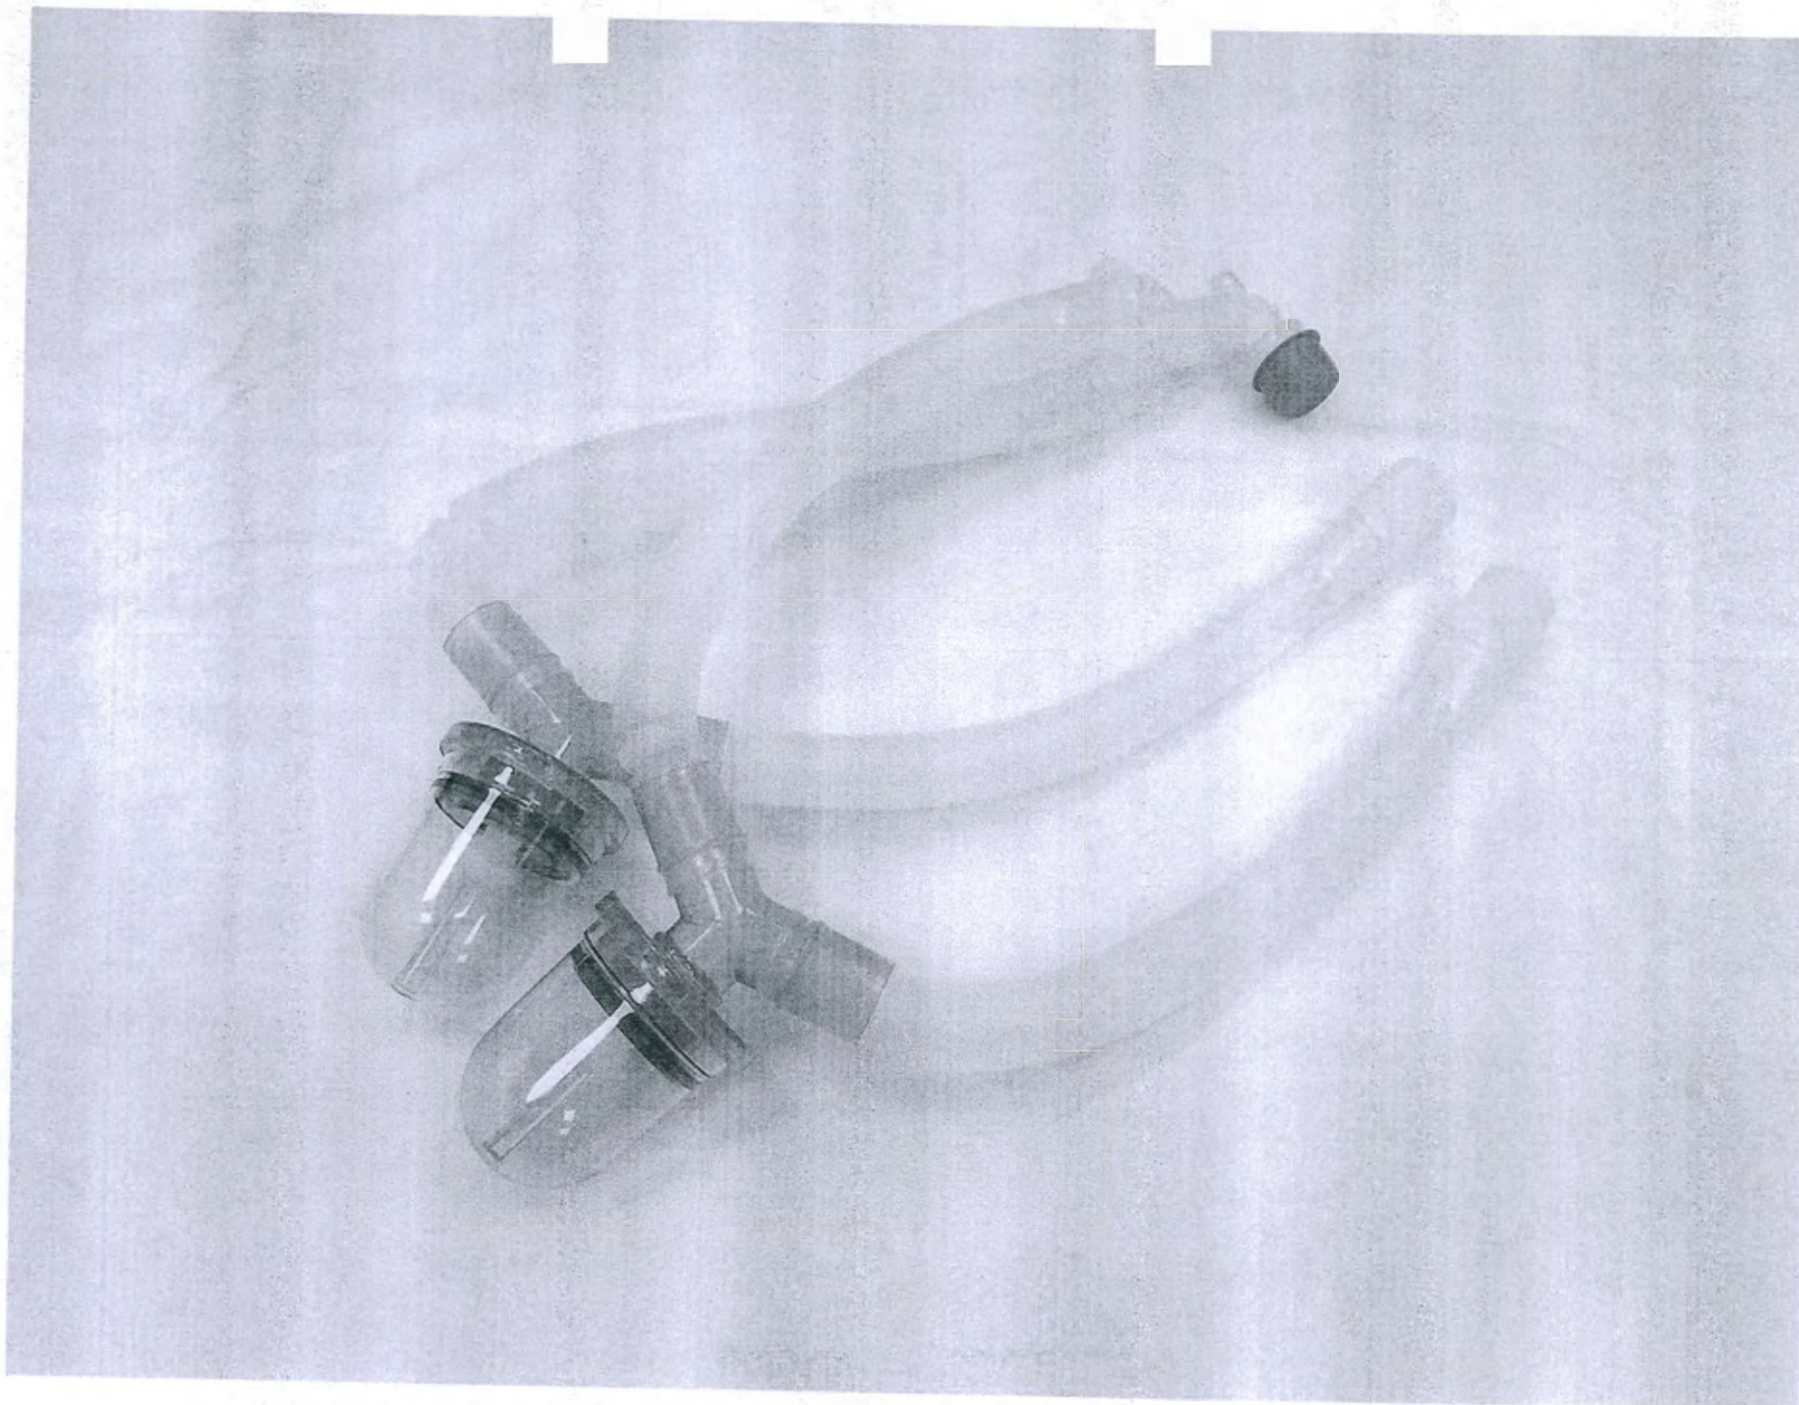


Рис.13 Контур дыхательный детский с двумя влагосборниками (шланг дыхательный конфигурируемый)

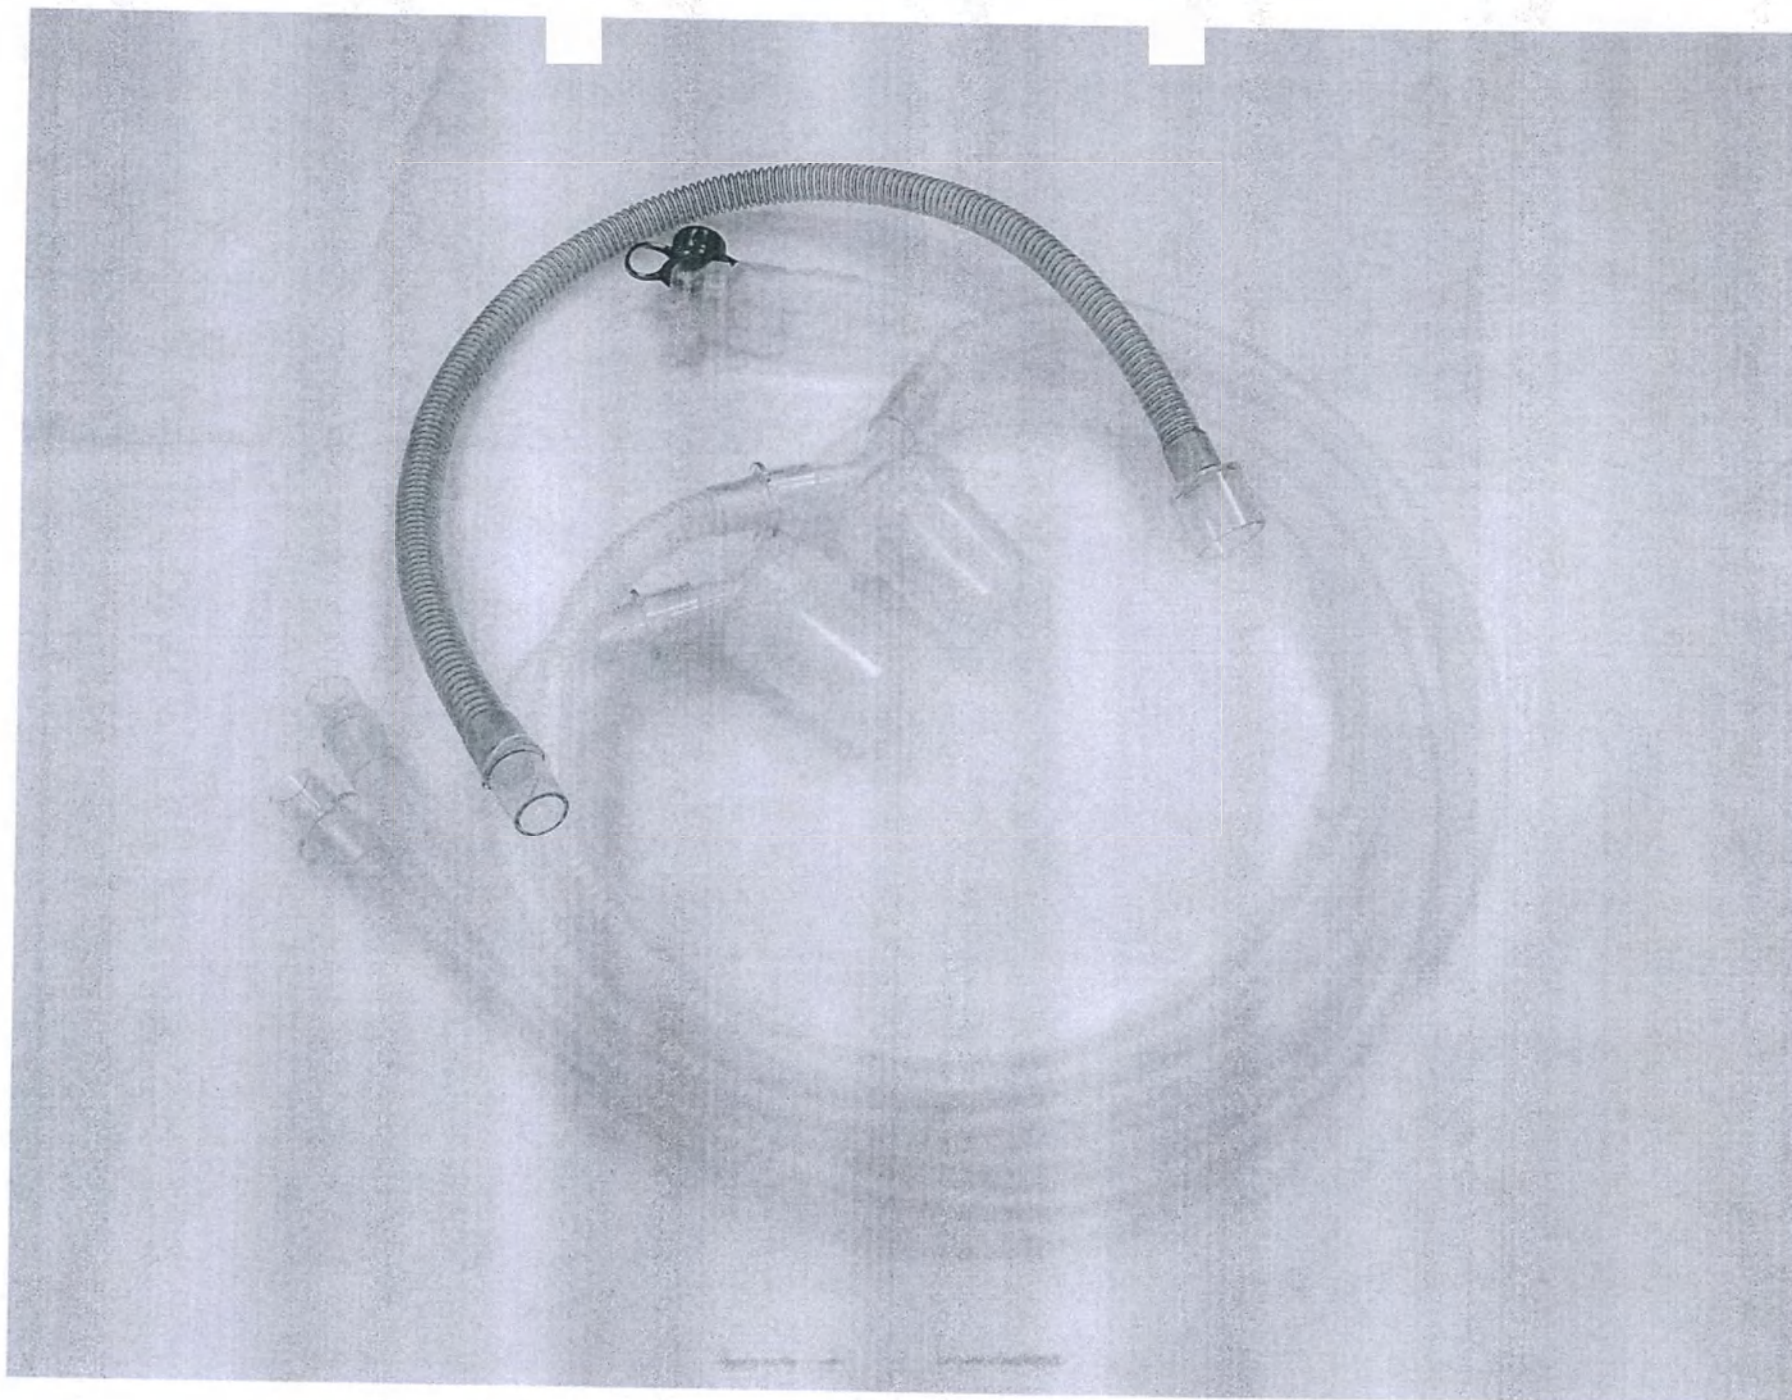


Рис. 16 Контур дыхательный неонатальный с двумя влагосборниками

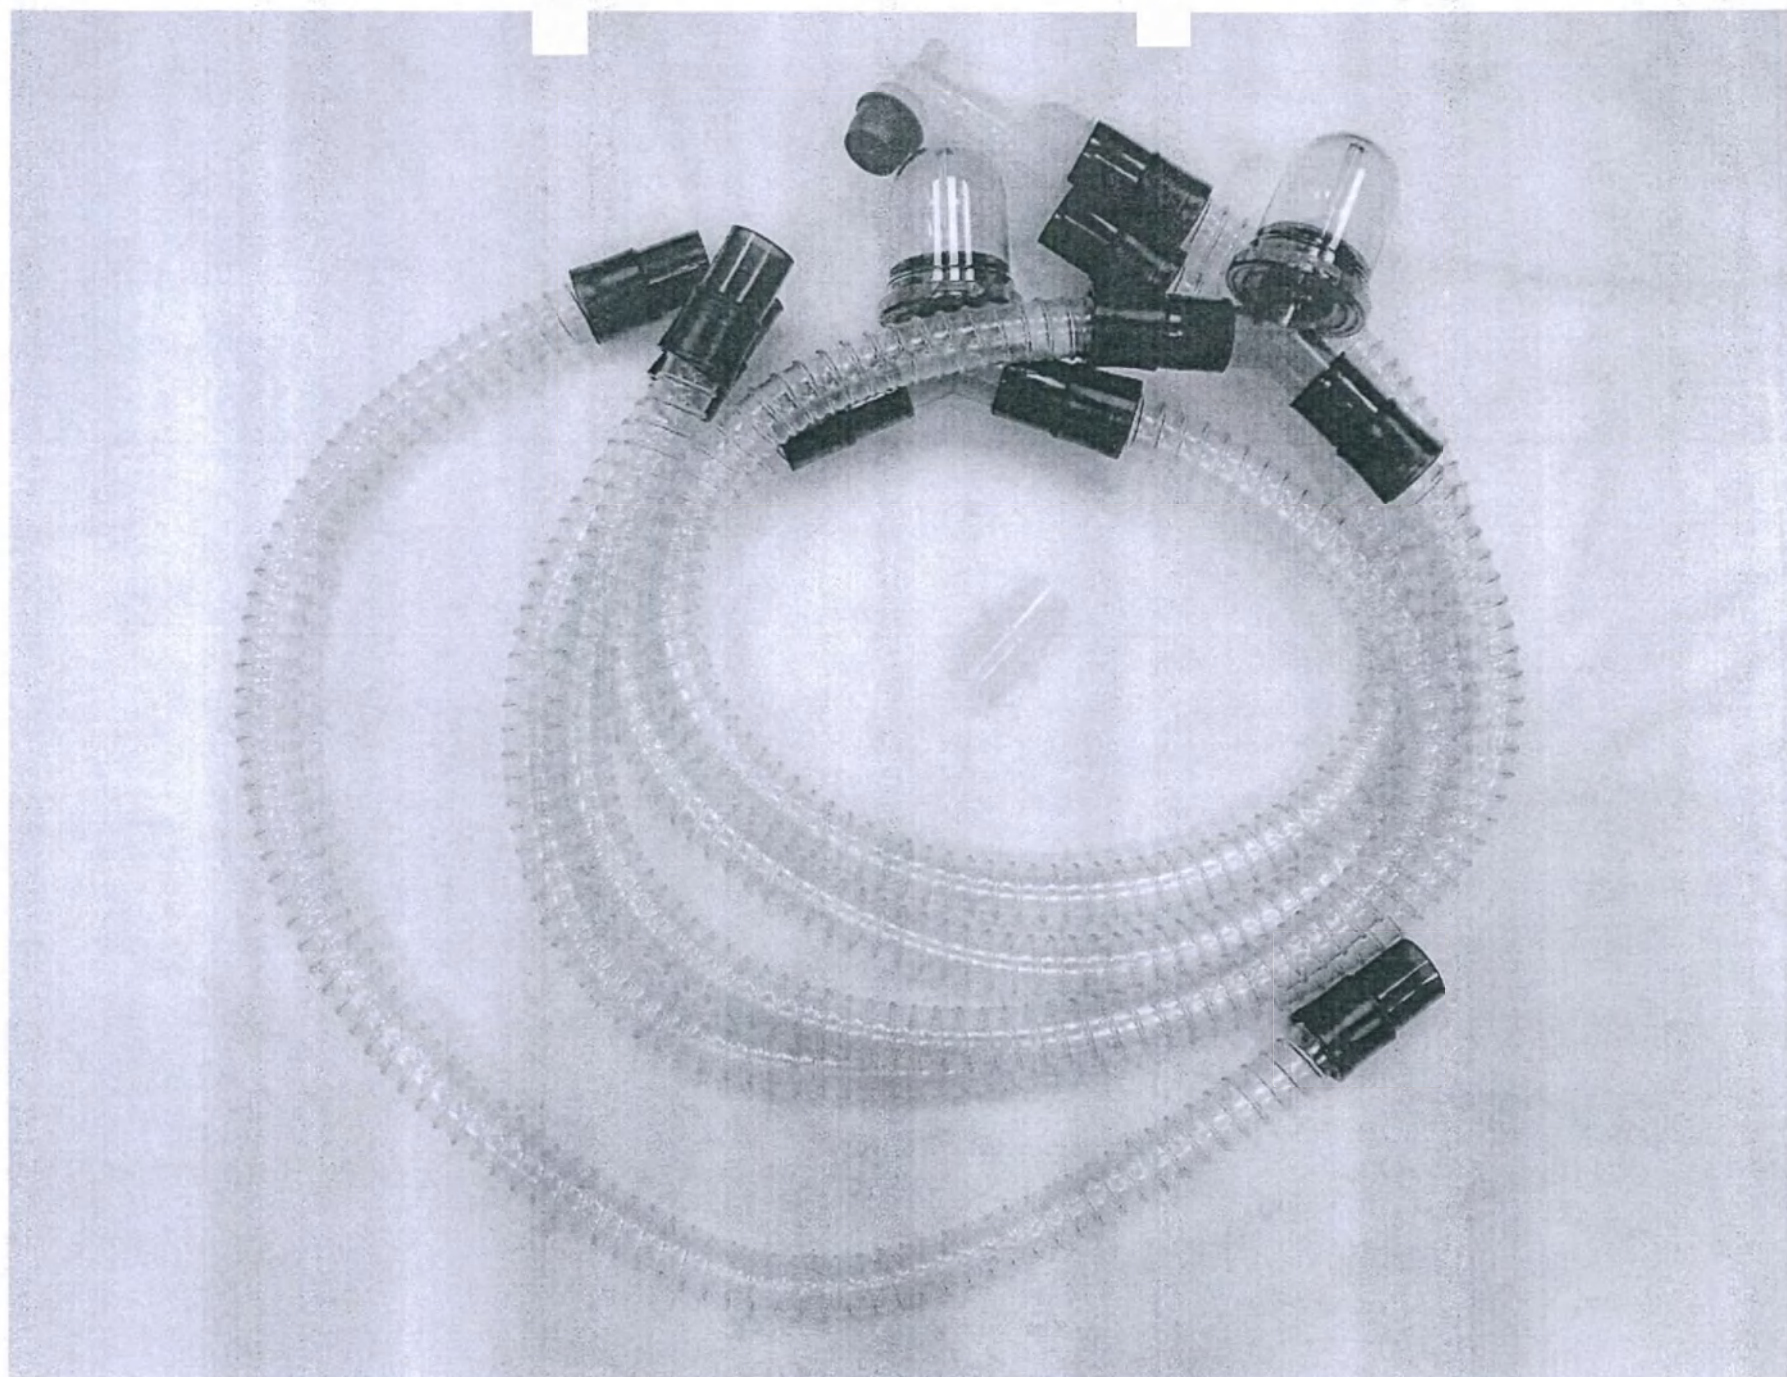


Рис. 17 Контур дыхательный взрослый с двумя влагосборниками (шланг дыхательный гладкоствольный)

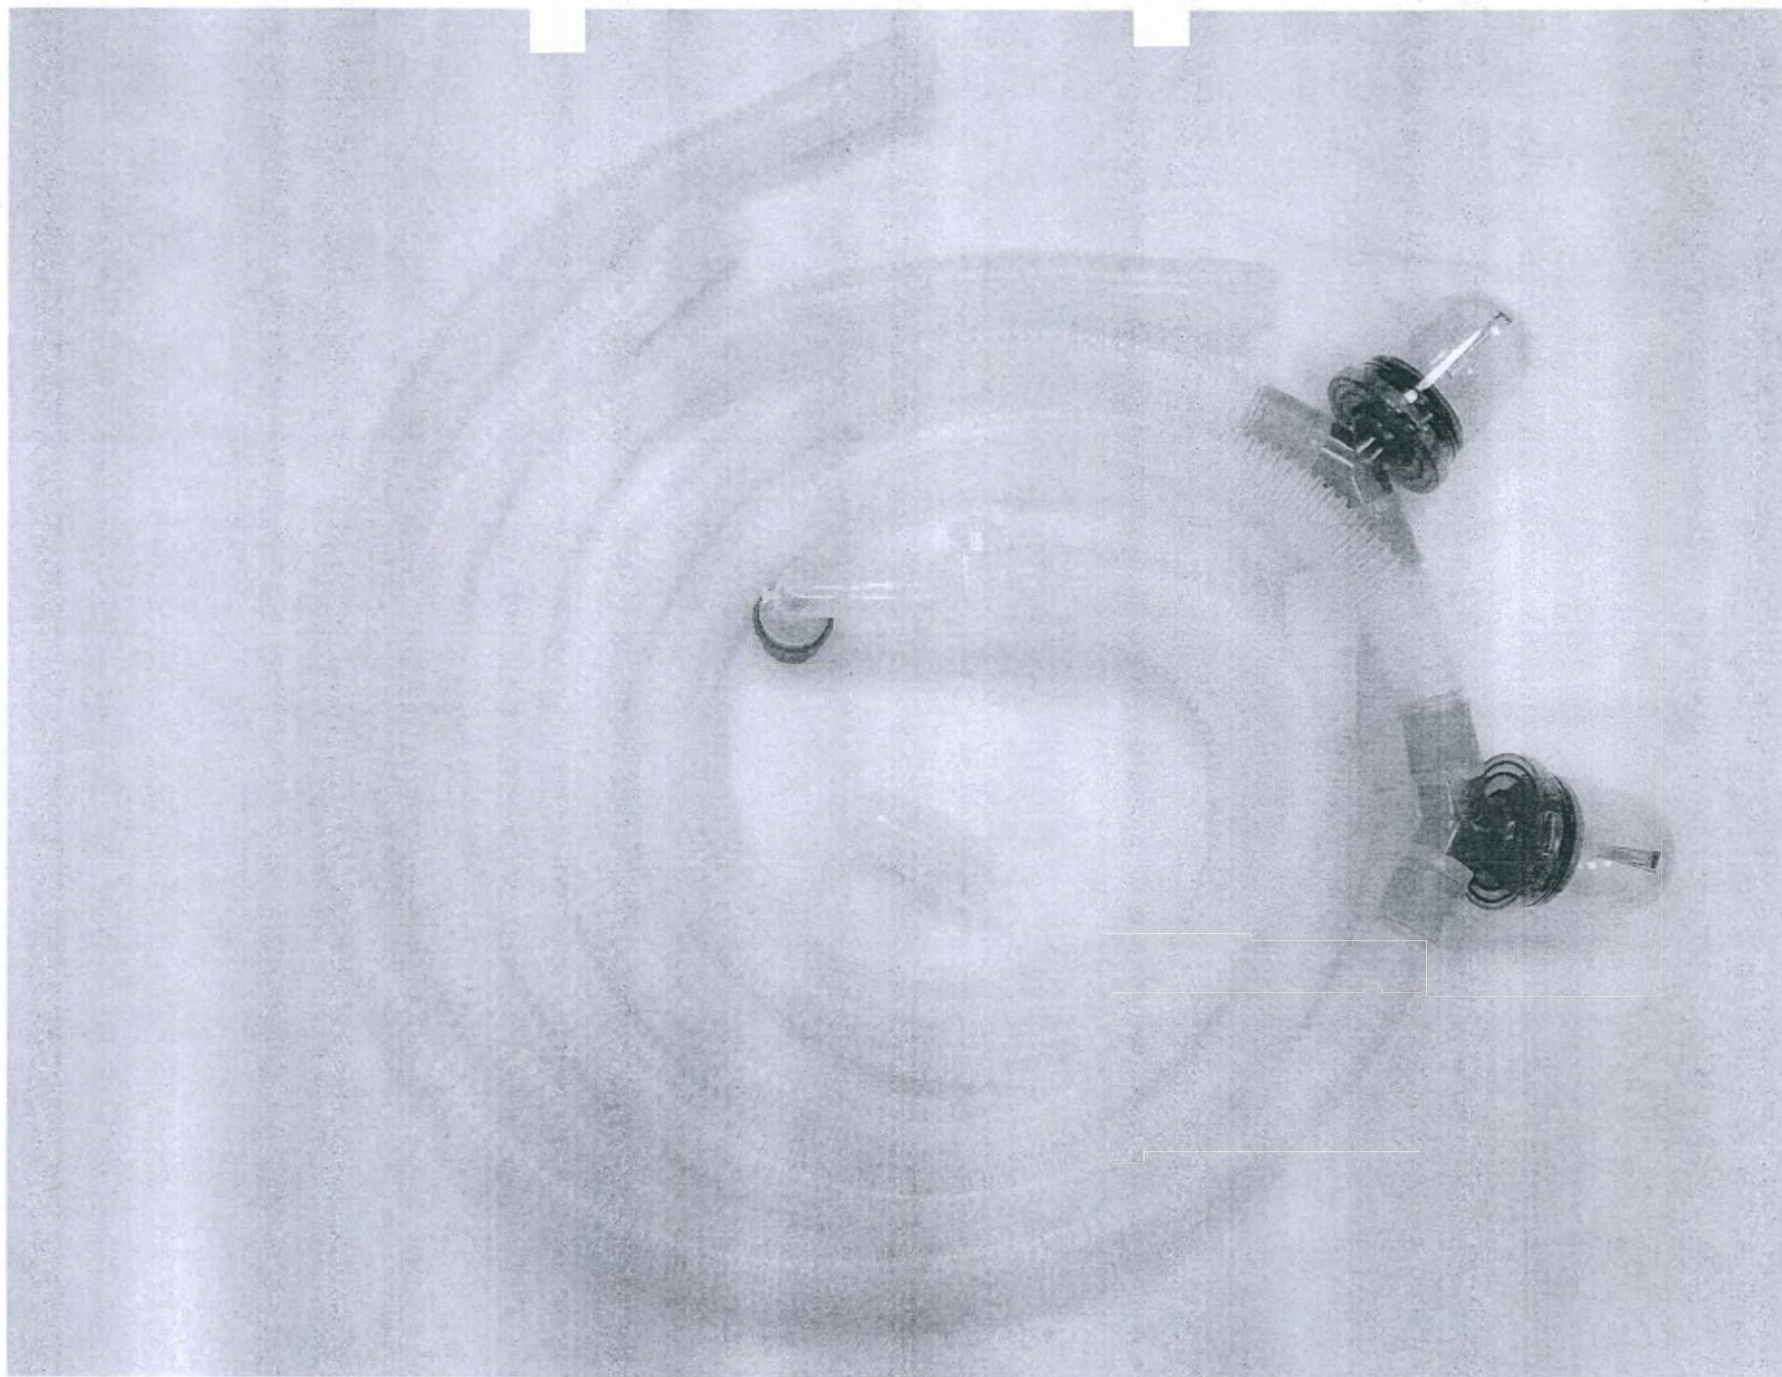


Рис. 18 Контур дыхательный взрослый с двумя влагосборниками (шланг дыхательный гофрированный)

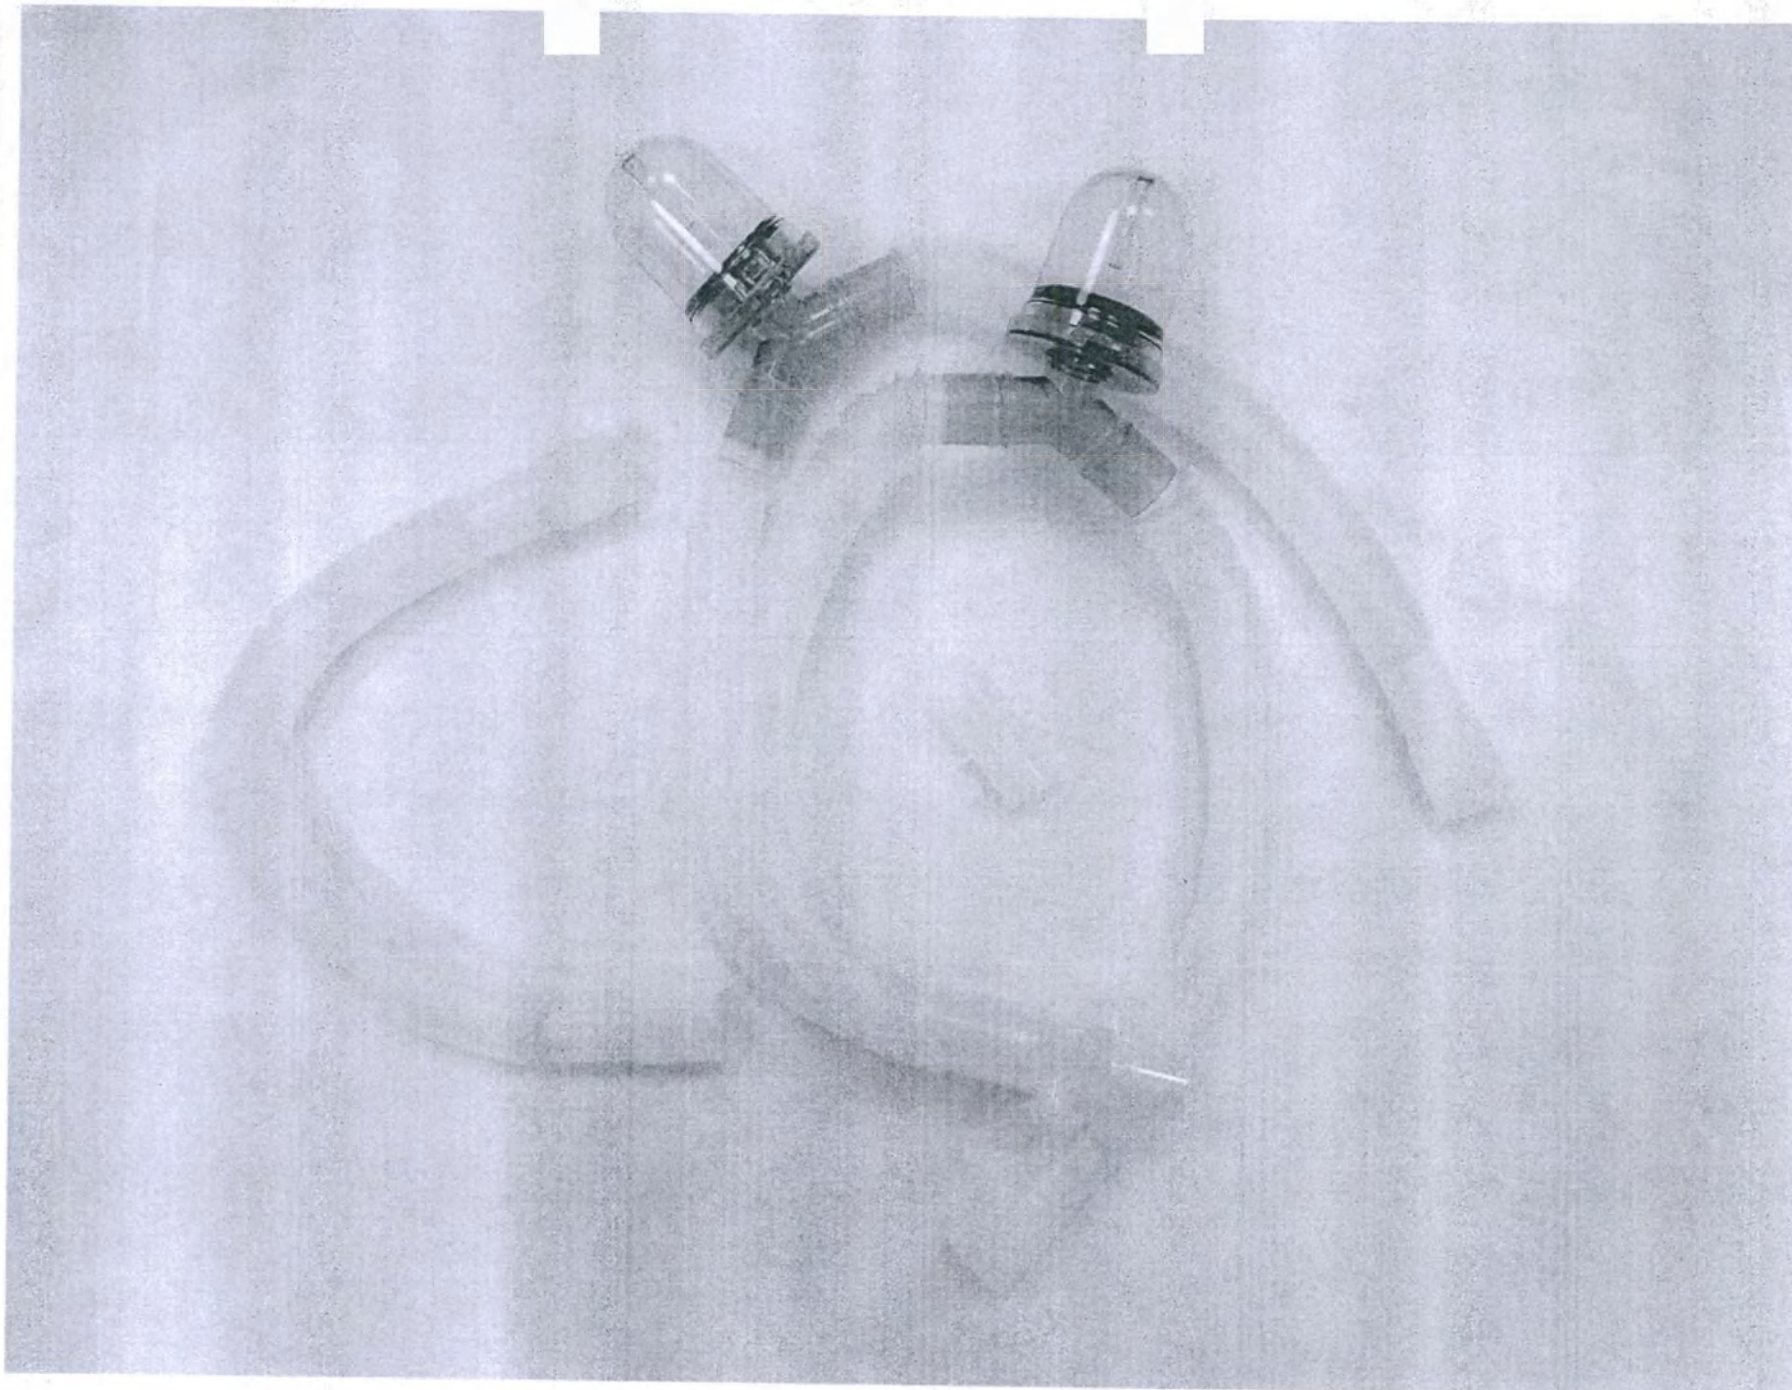


Рис. 19 Контур дыхательный взрослый с двумя влагосборниками (шланг дыхательный конфигурируемый)

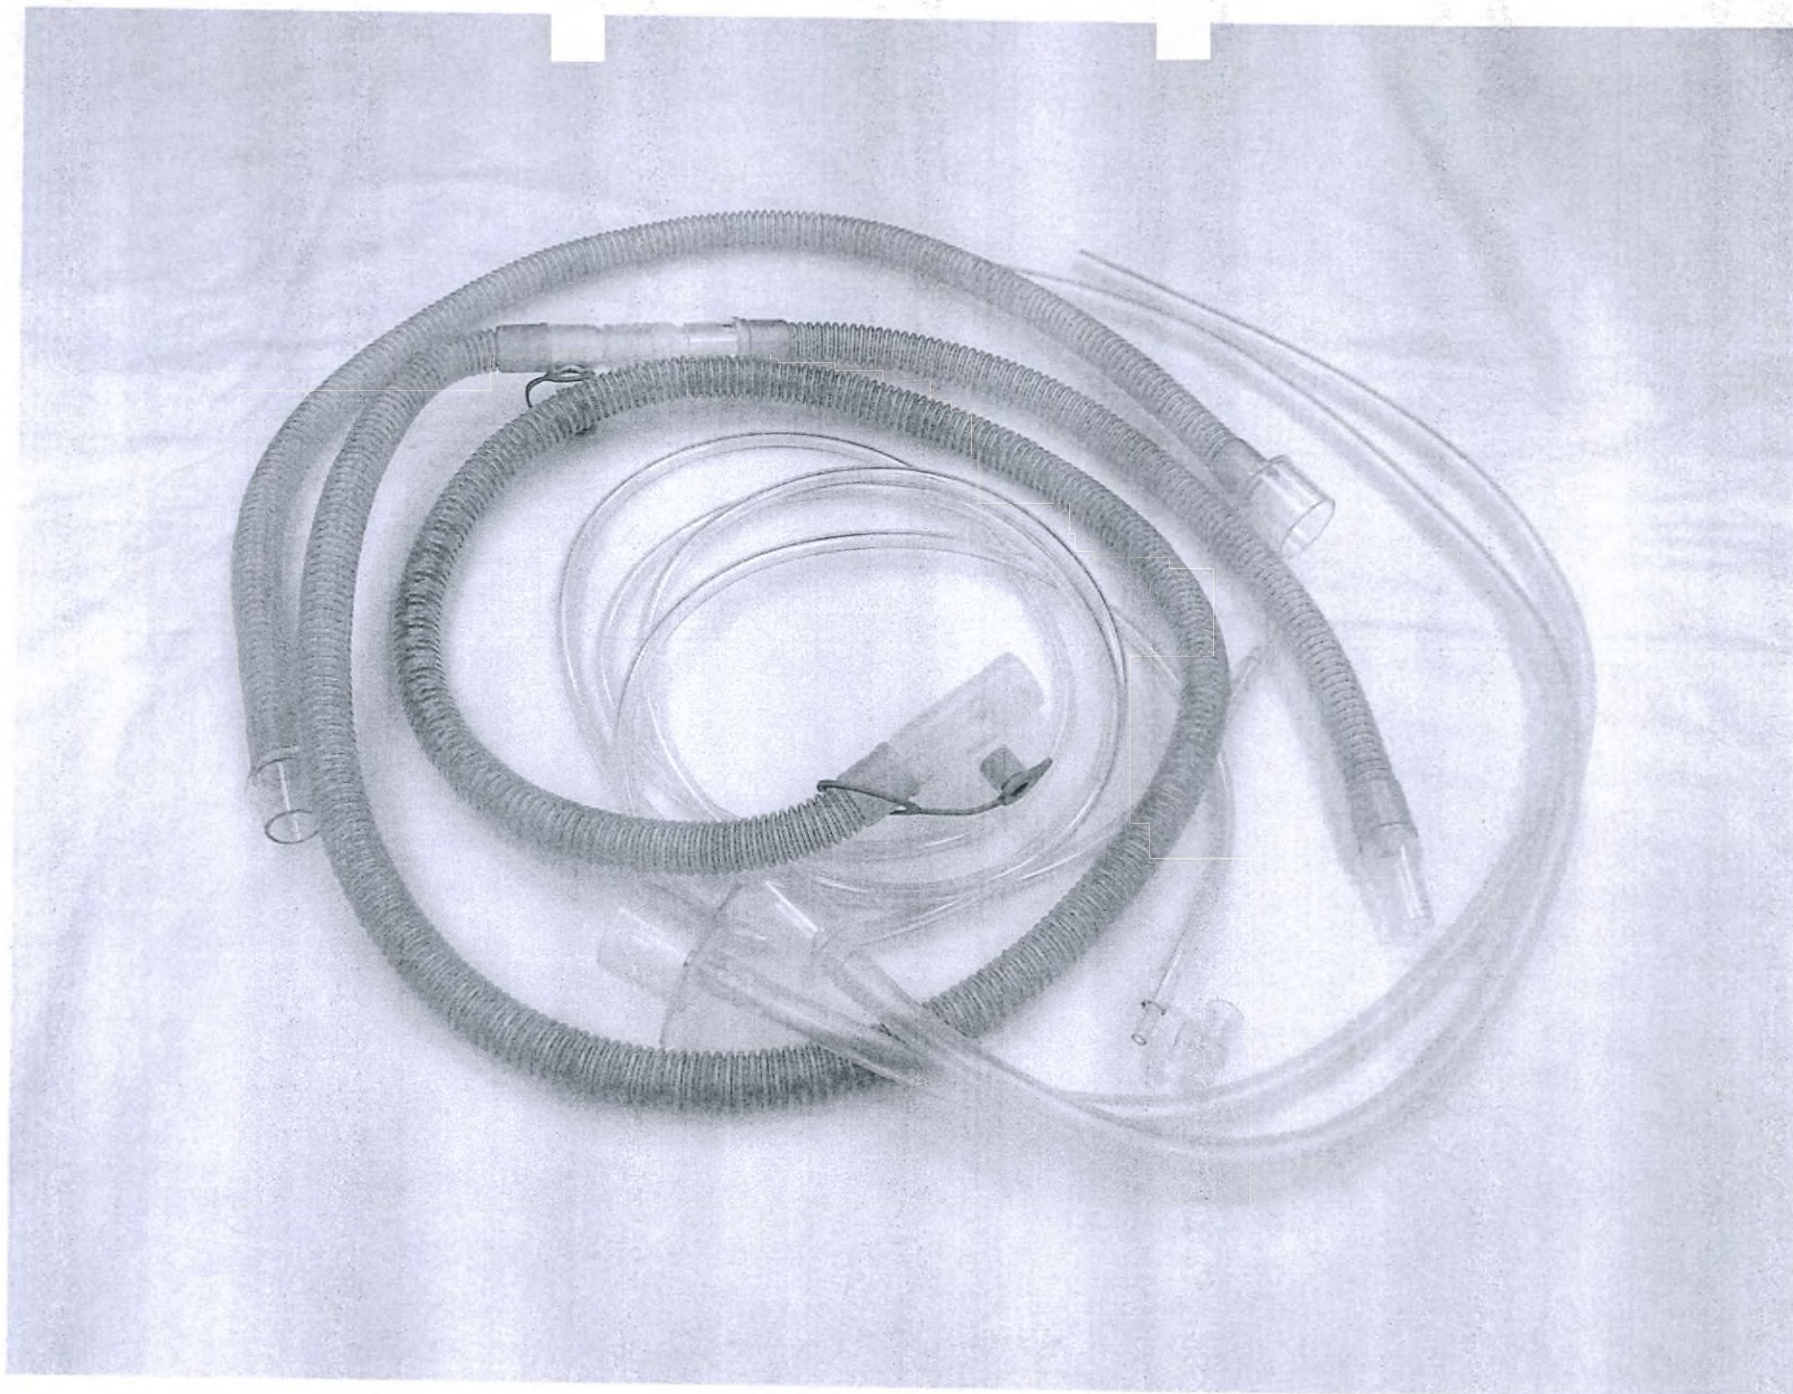
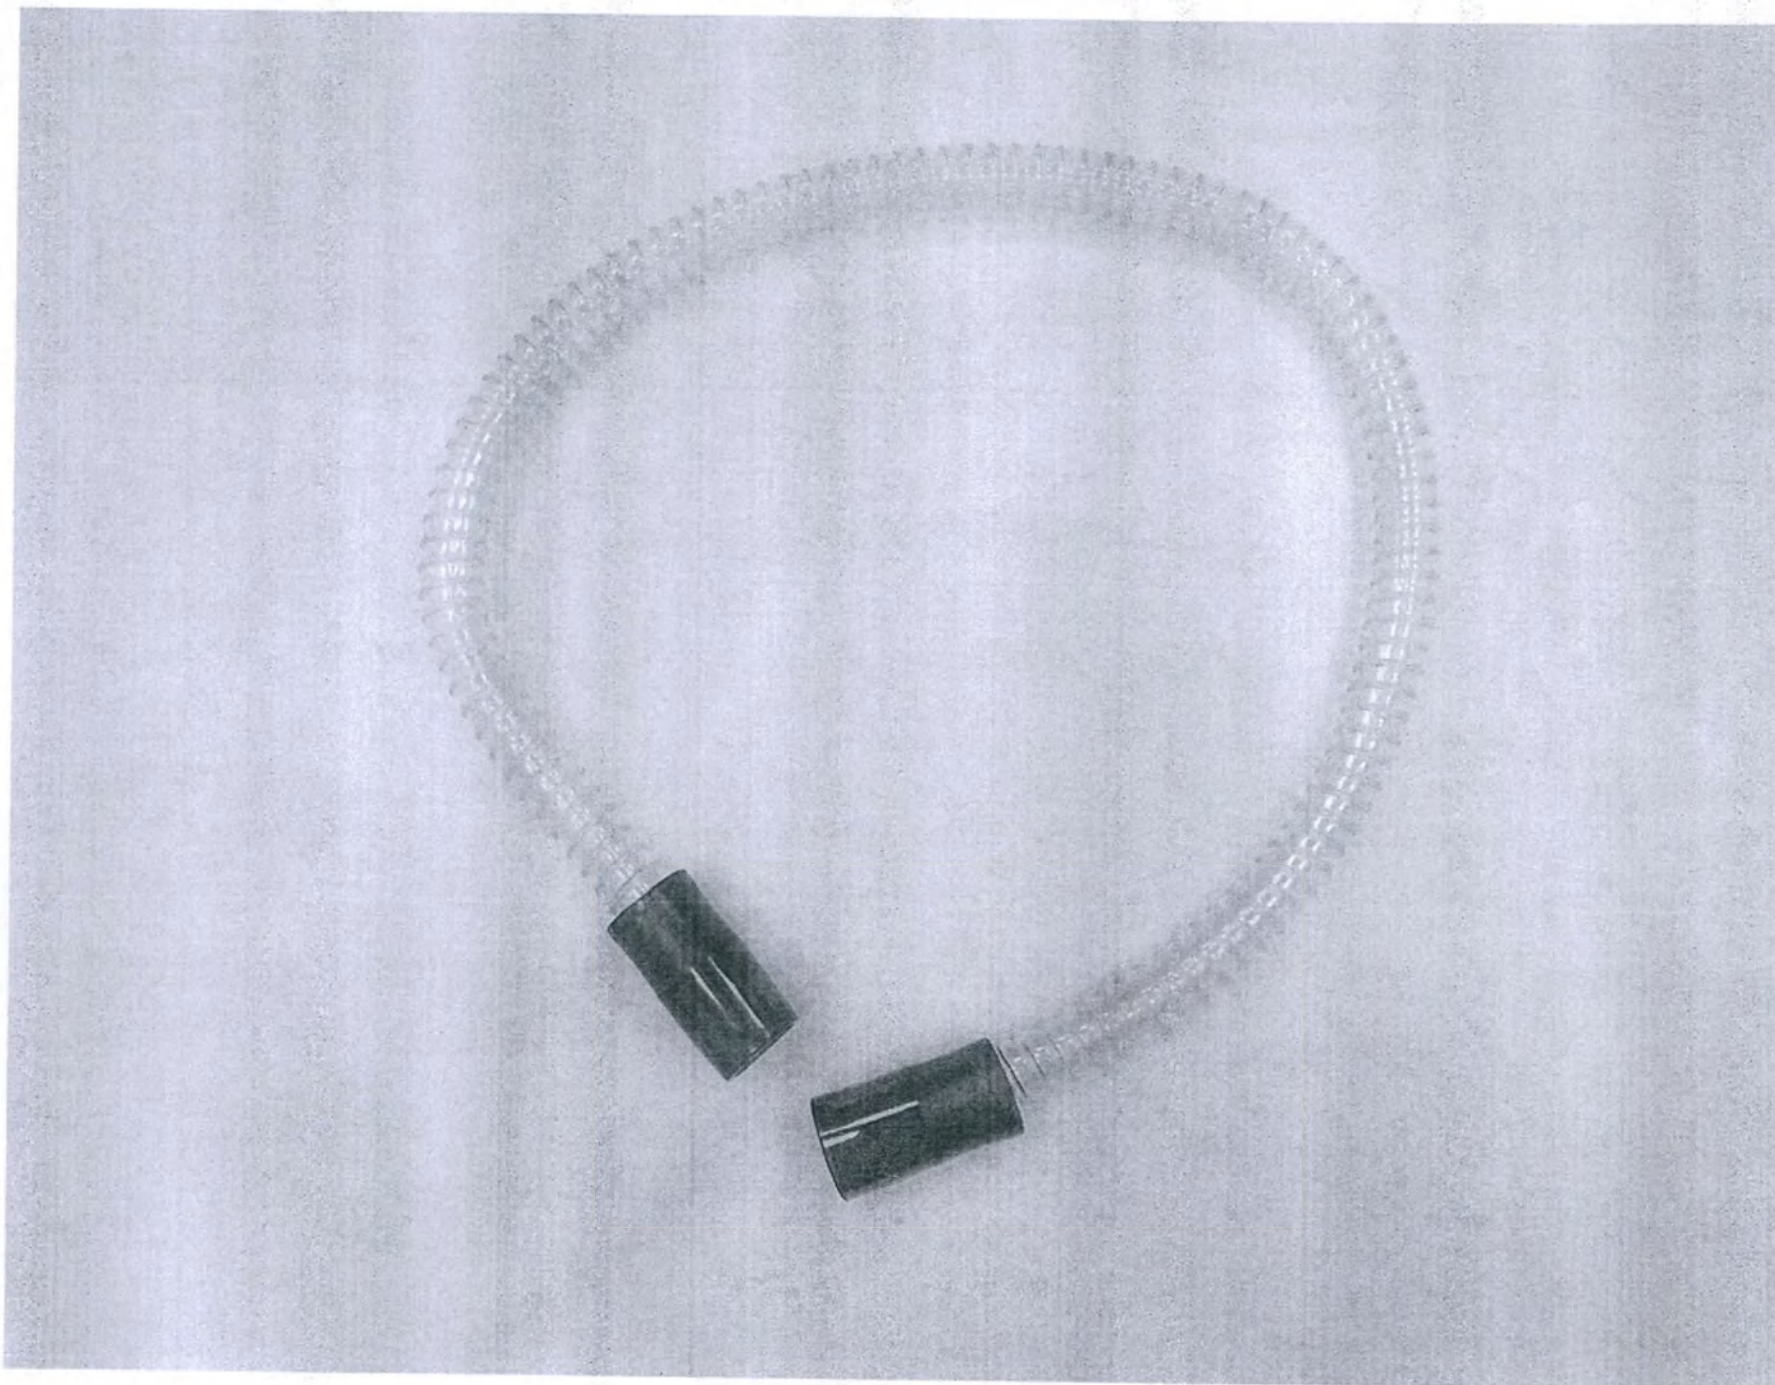


Рис. 20 Контур дыхательный неонатальный для СРАР-терапии



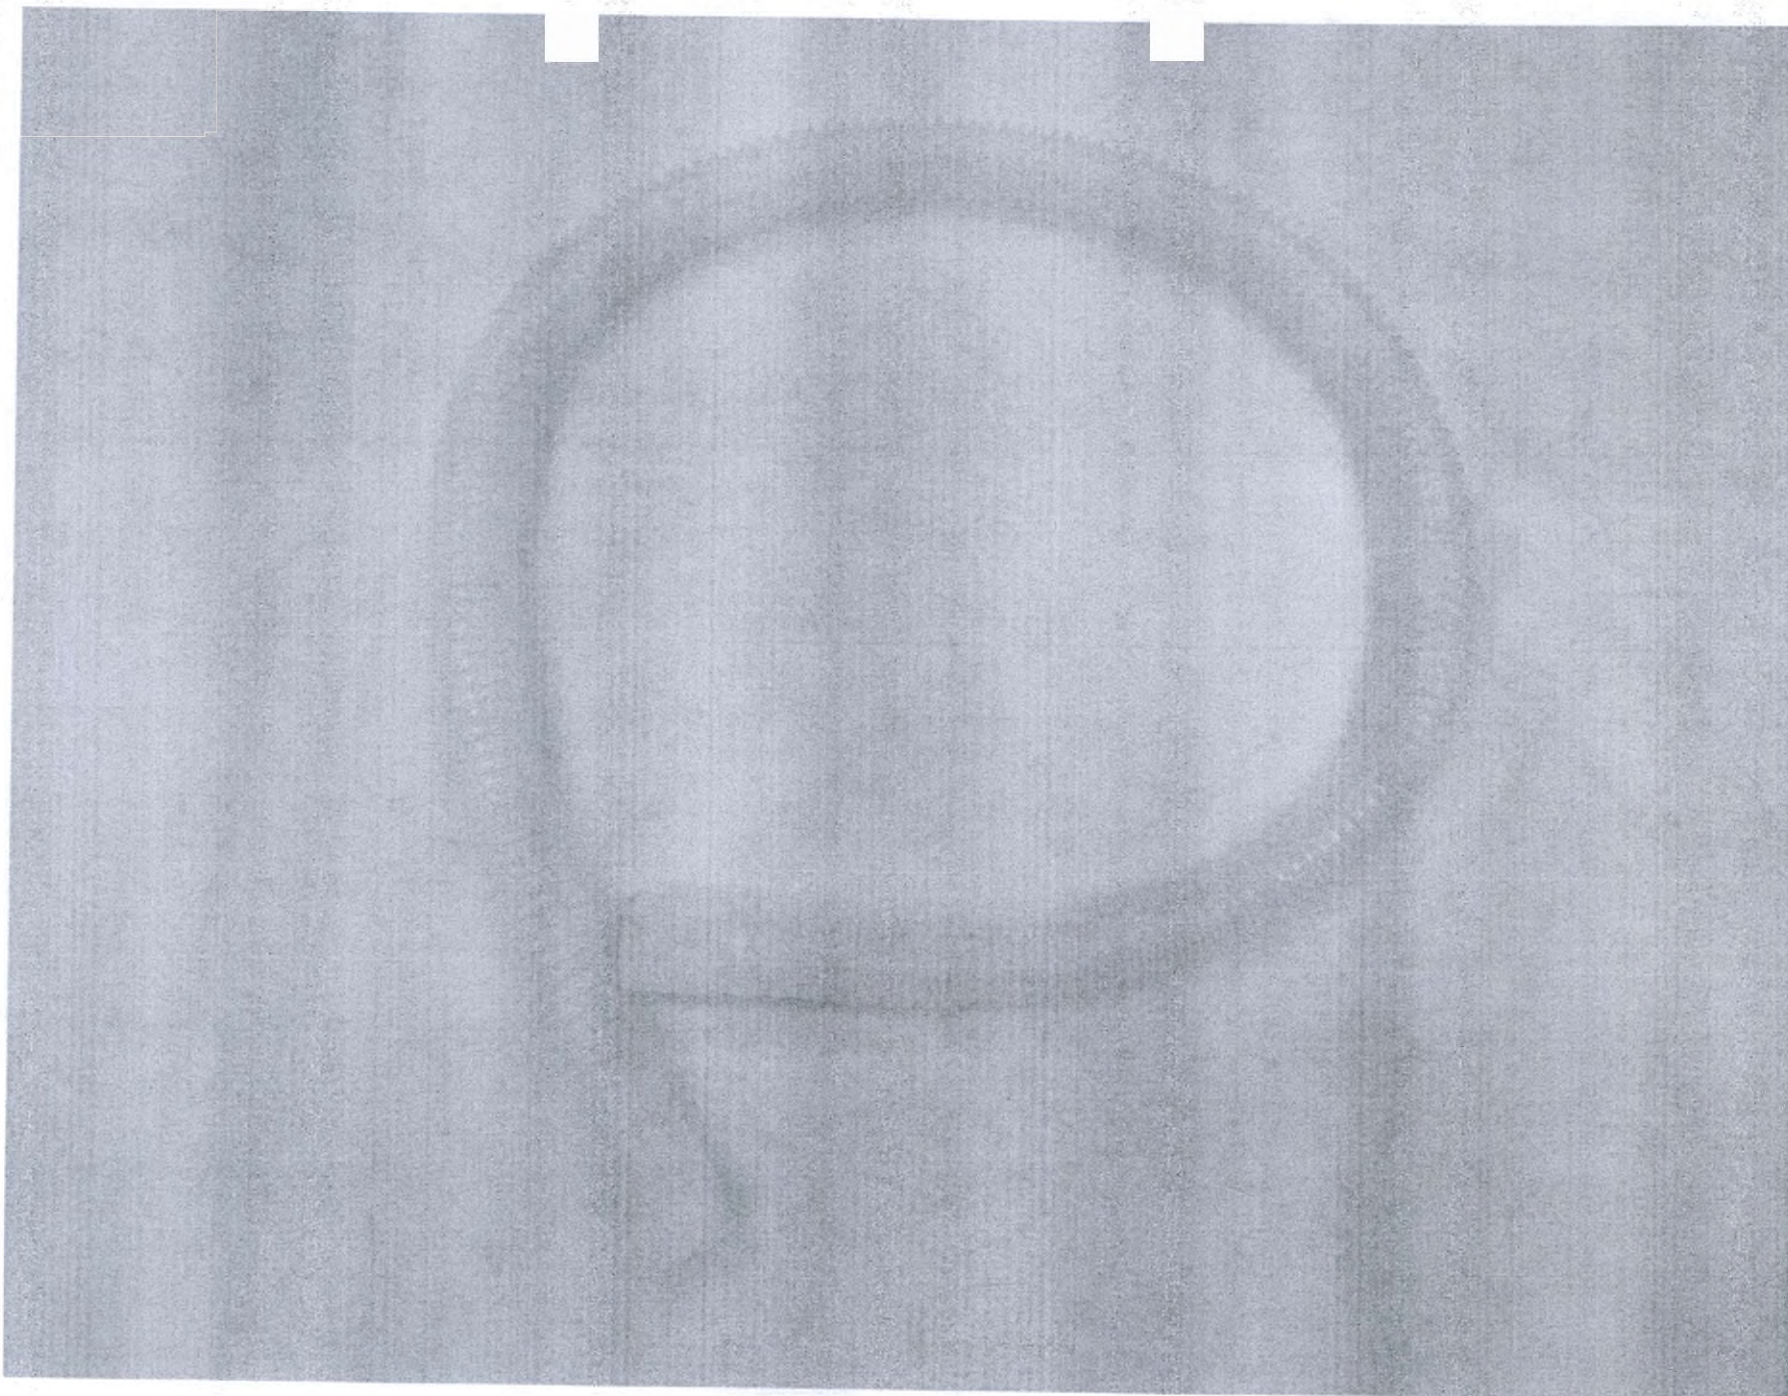


Рис.22 Лимб гофрированный

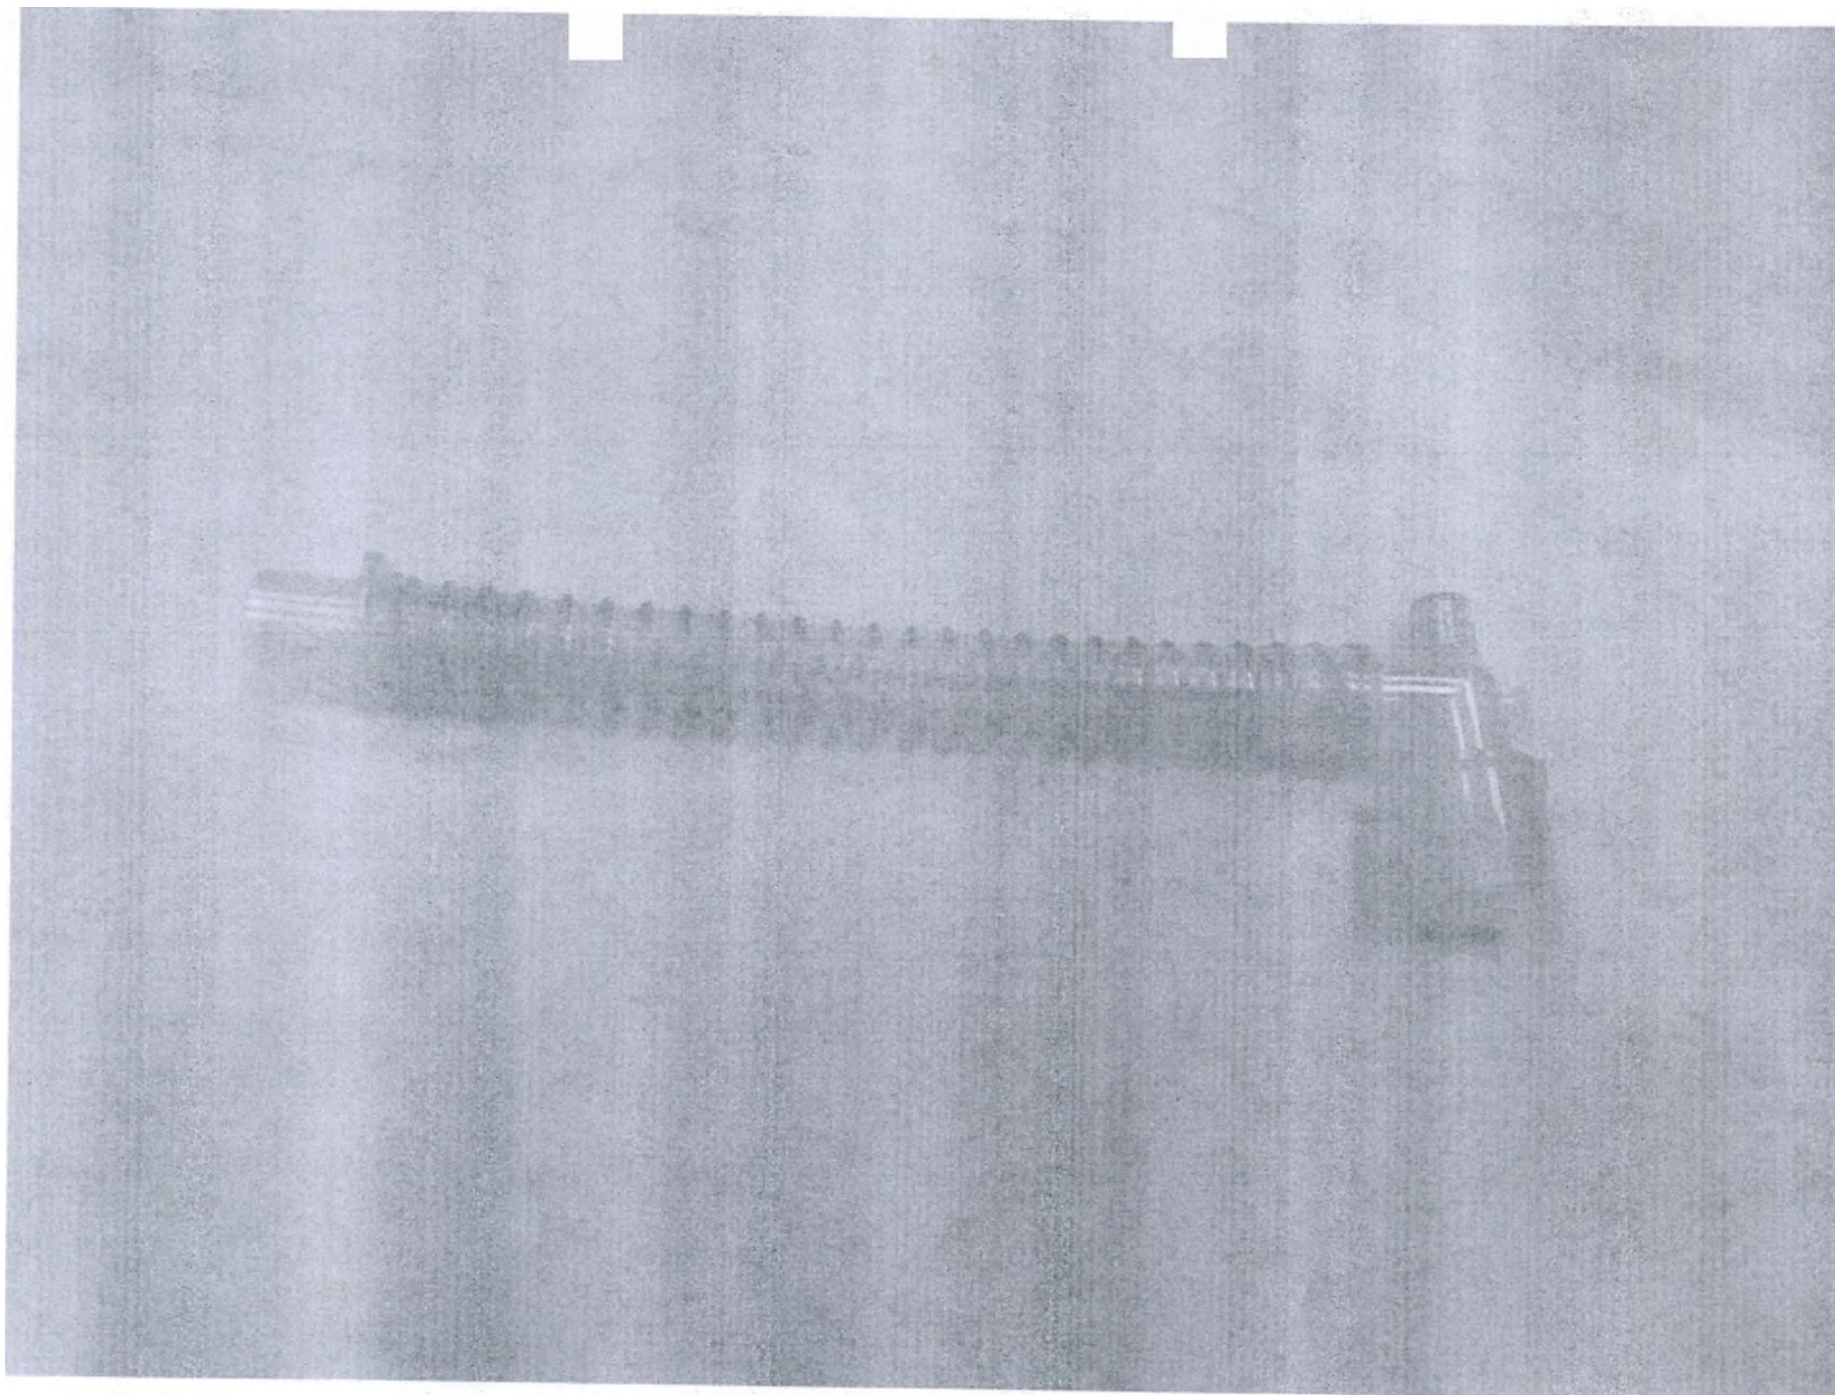


Рис. 23 Соединитель

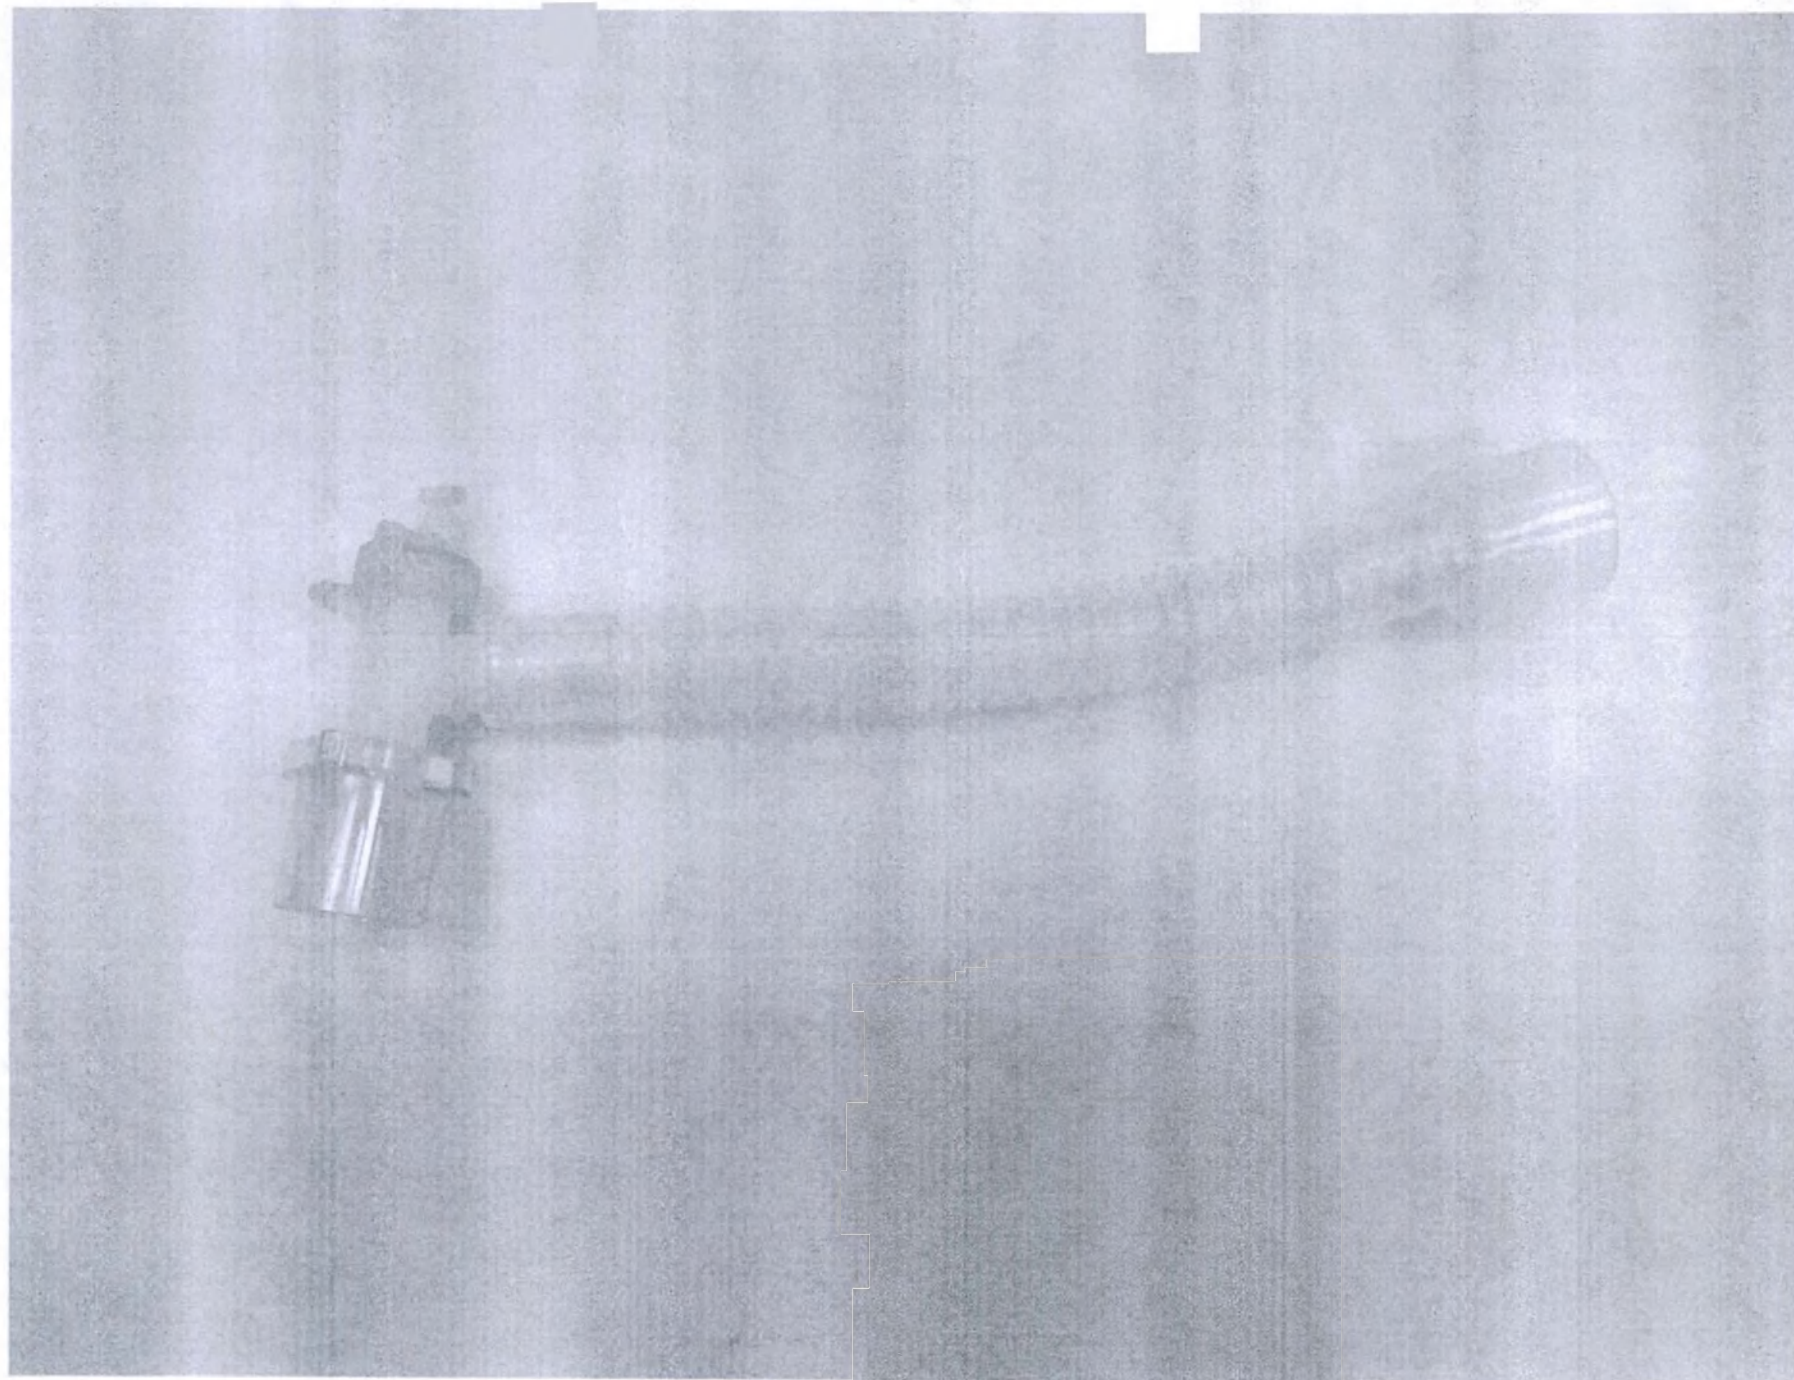


Рис.24 Соединитель с дополнительными портами гофрированный

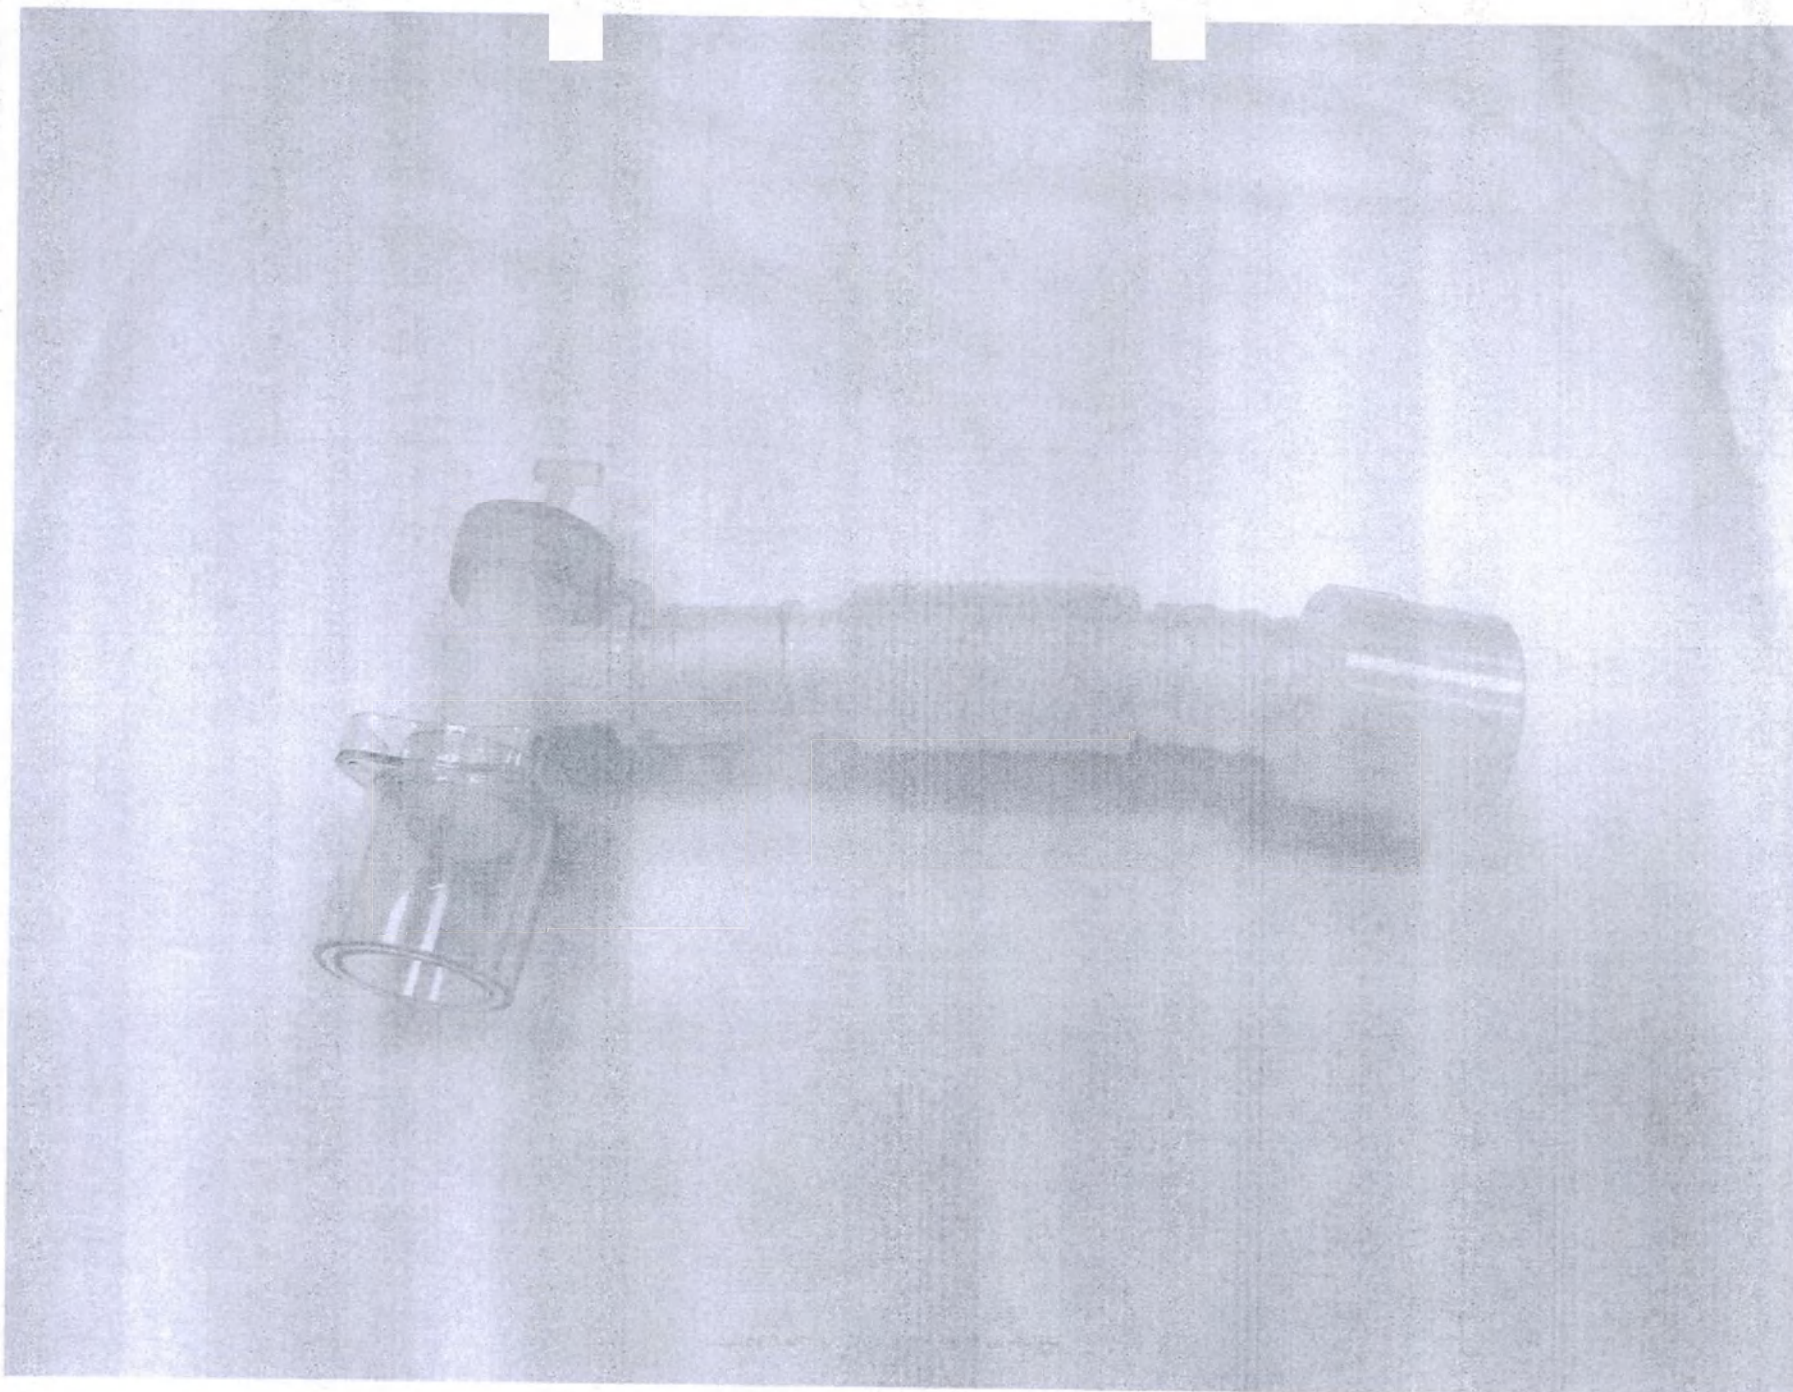


Рис. 25 Соединитель с дополнительными портами конфигурируемый

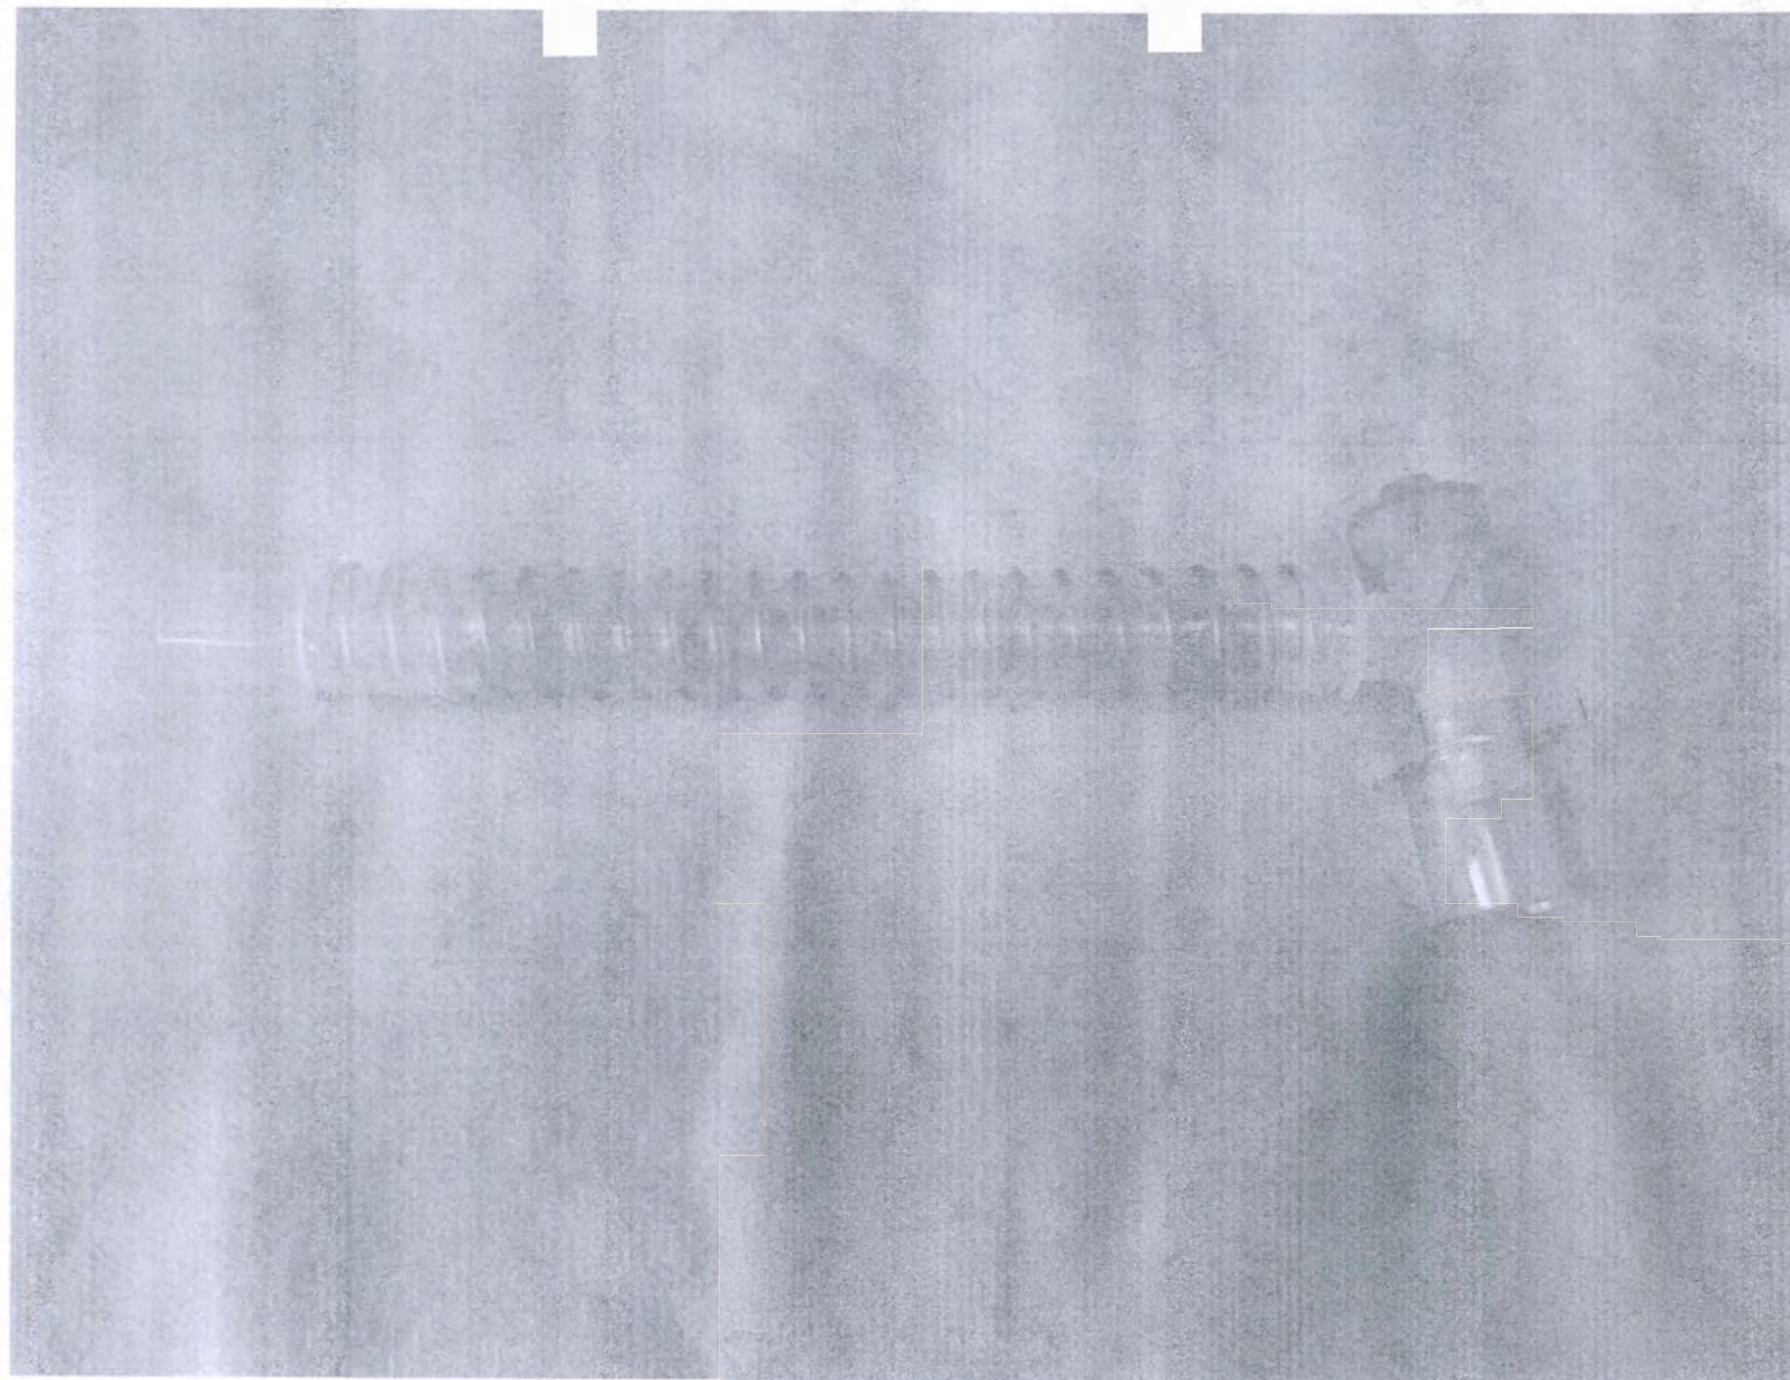


Рис. 26 Соединитель с дополнительными портами гладкоствольный

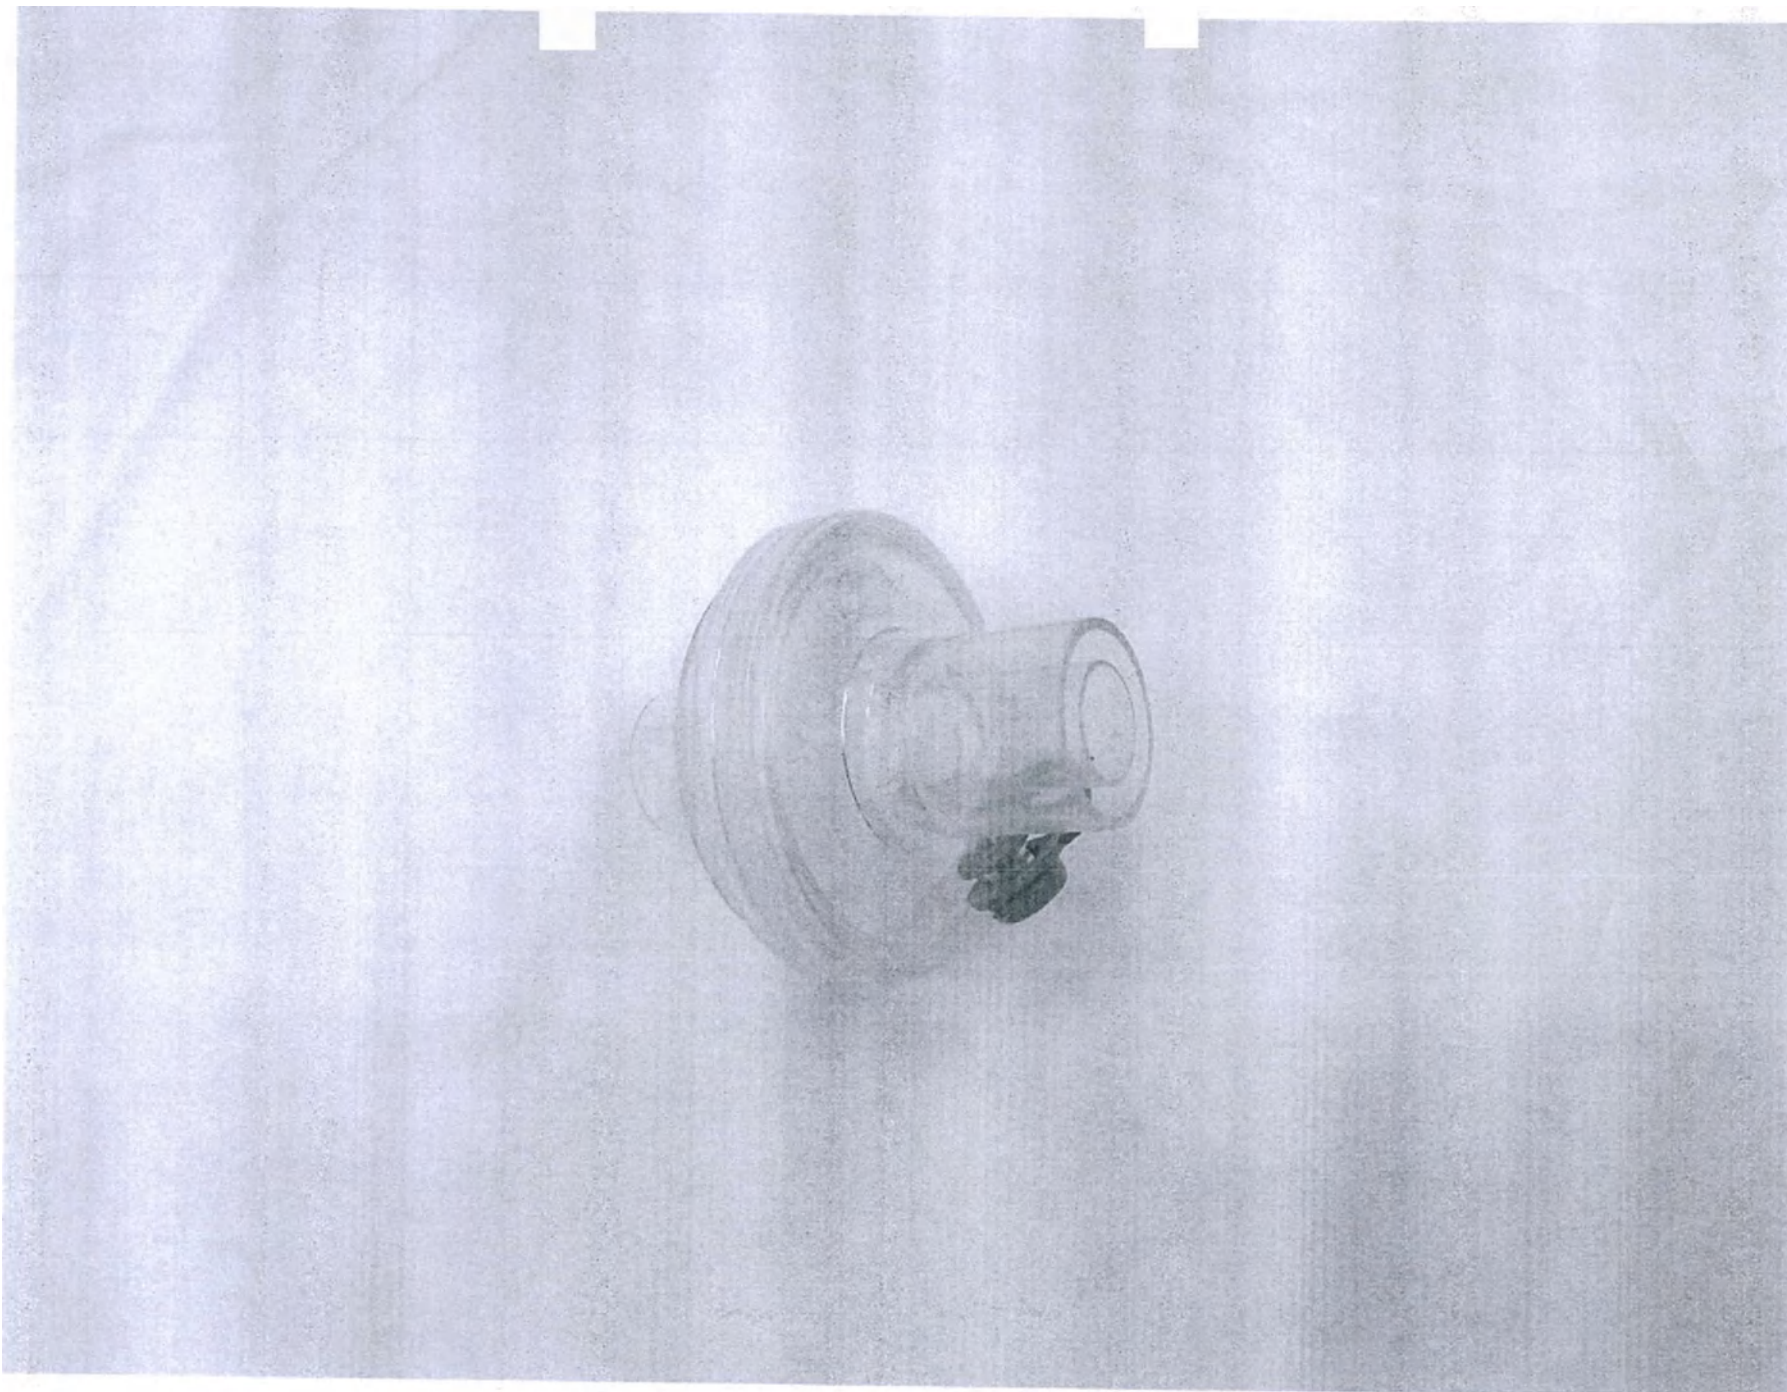


Рис.27 Фильтр дыхательный

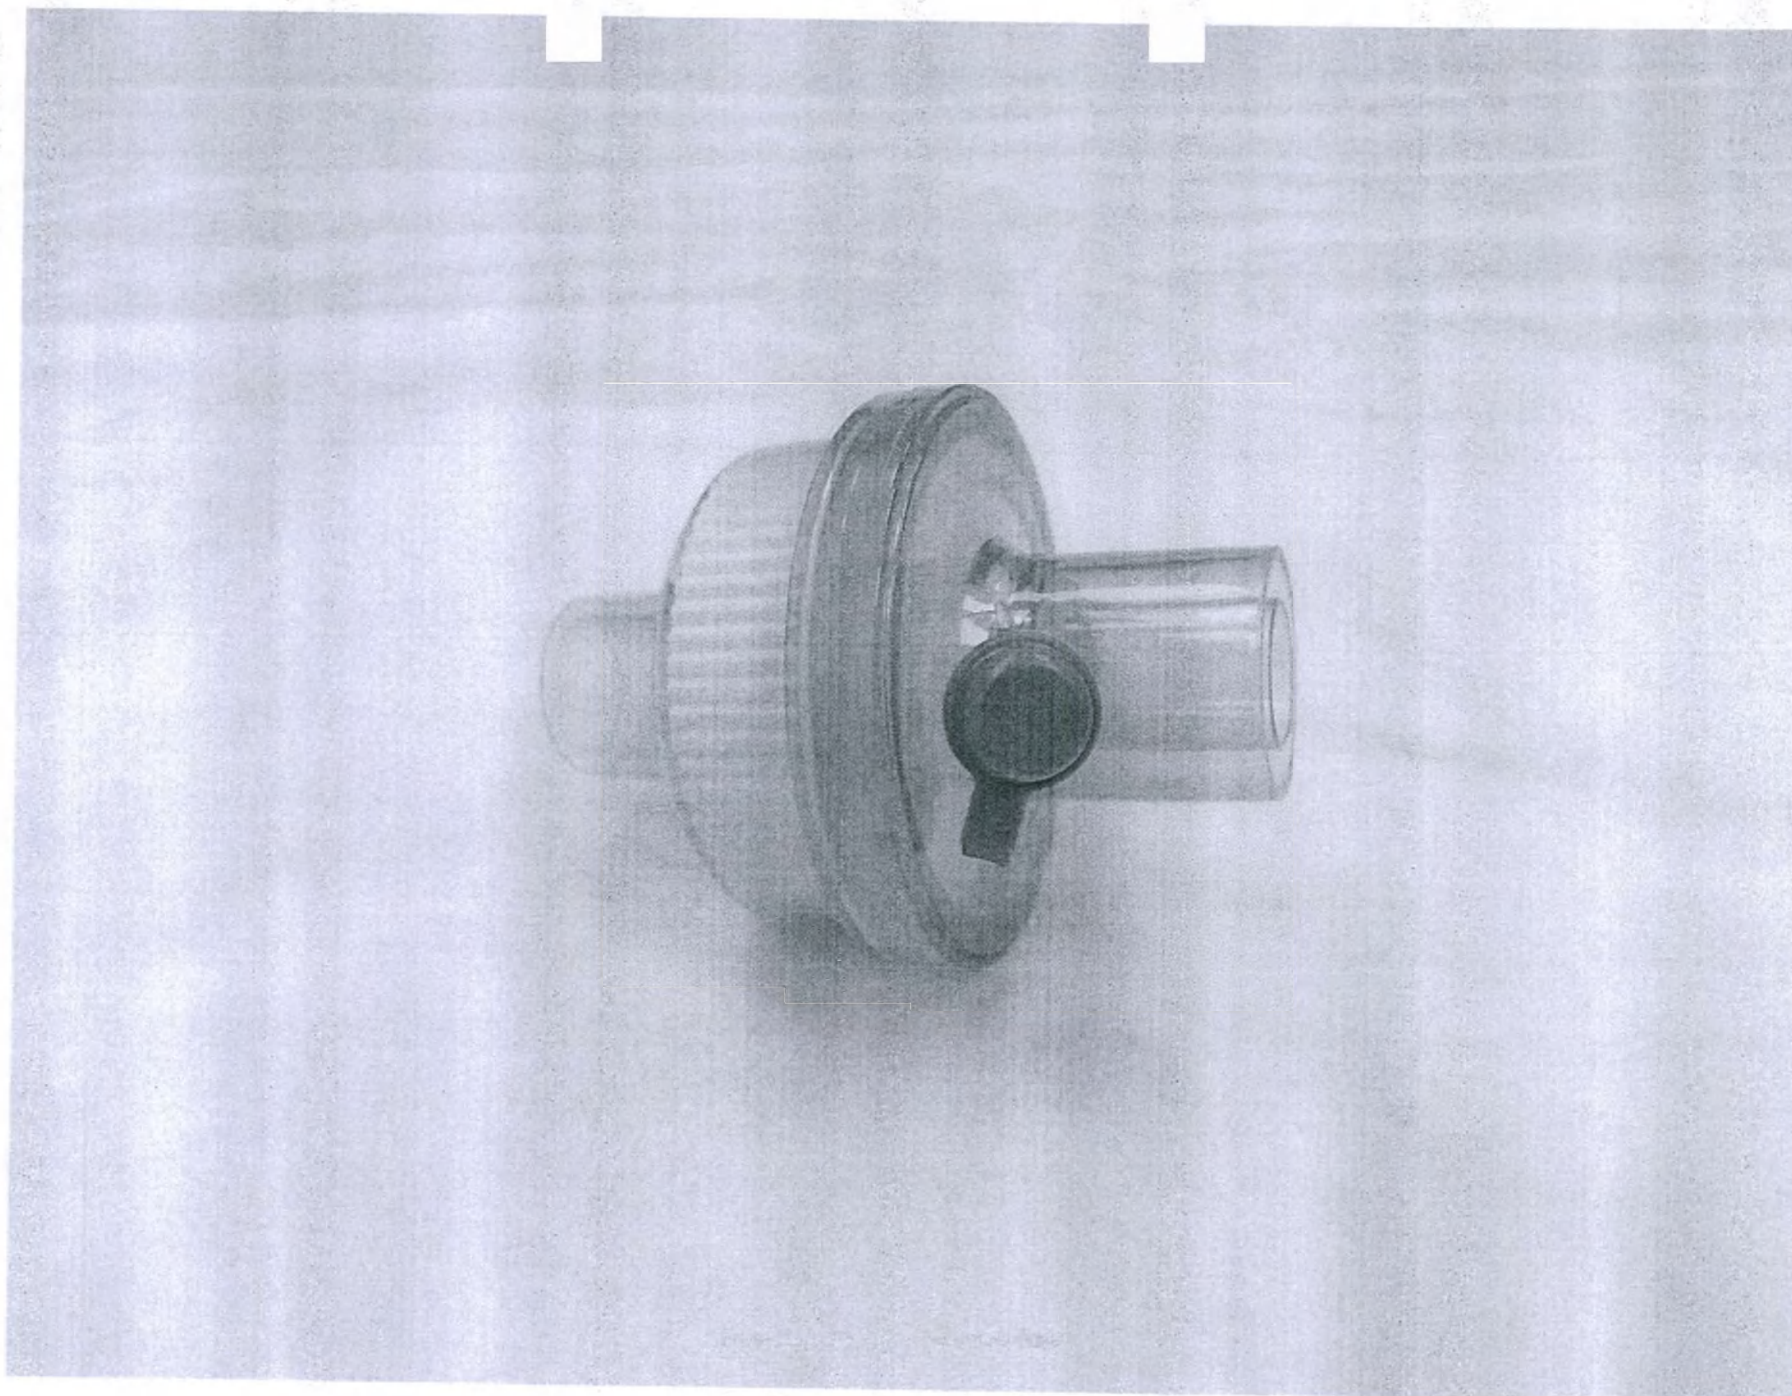


Рис. 28 Тепловлагообменник дыхательный

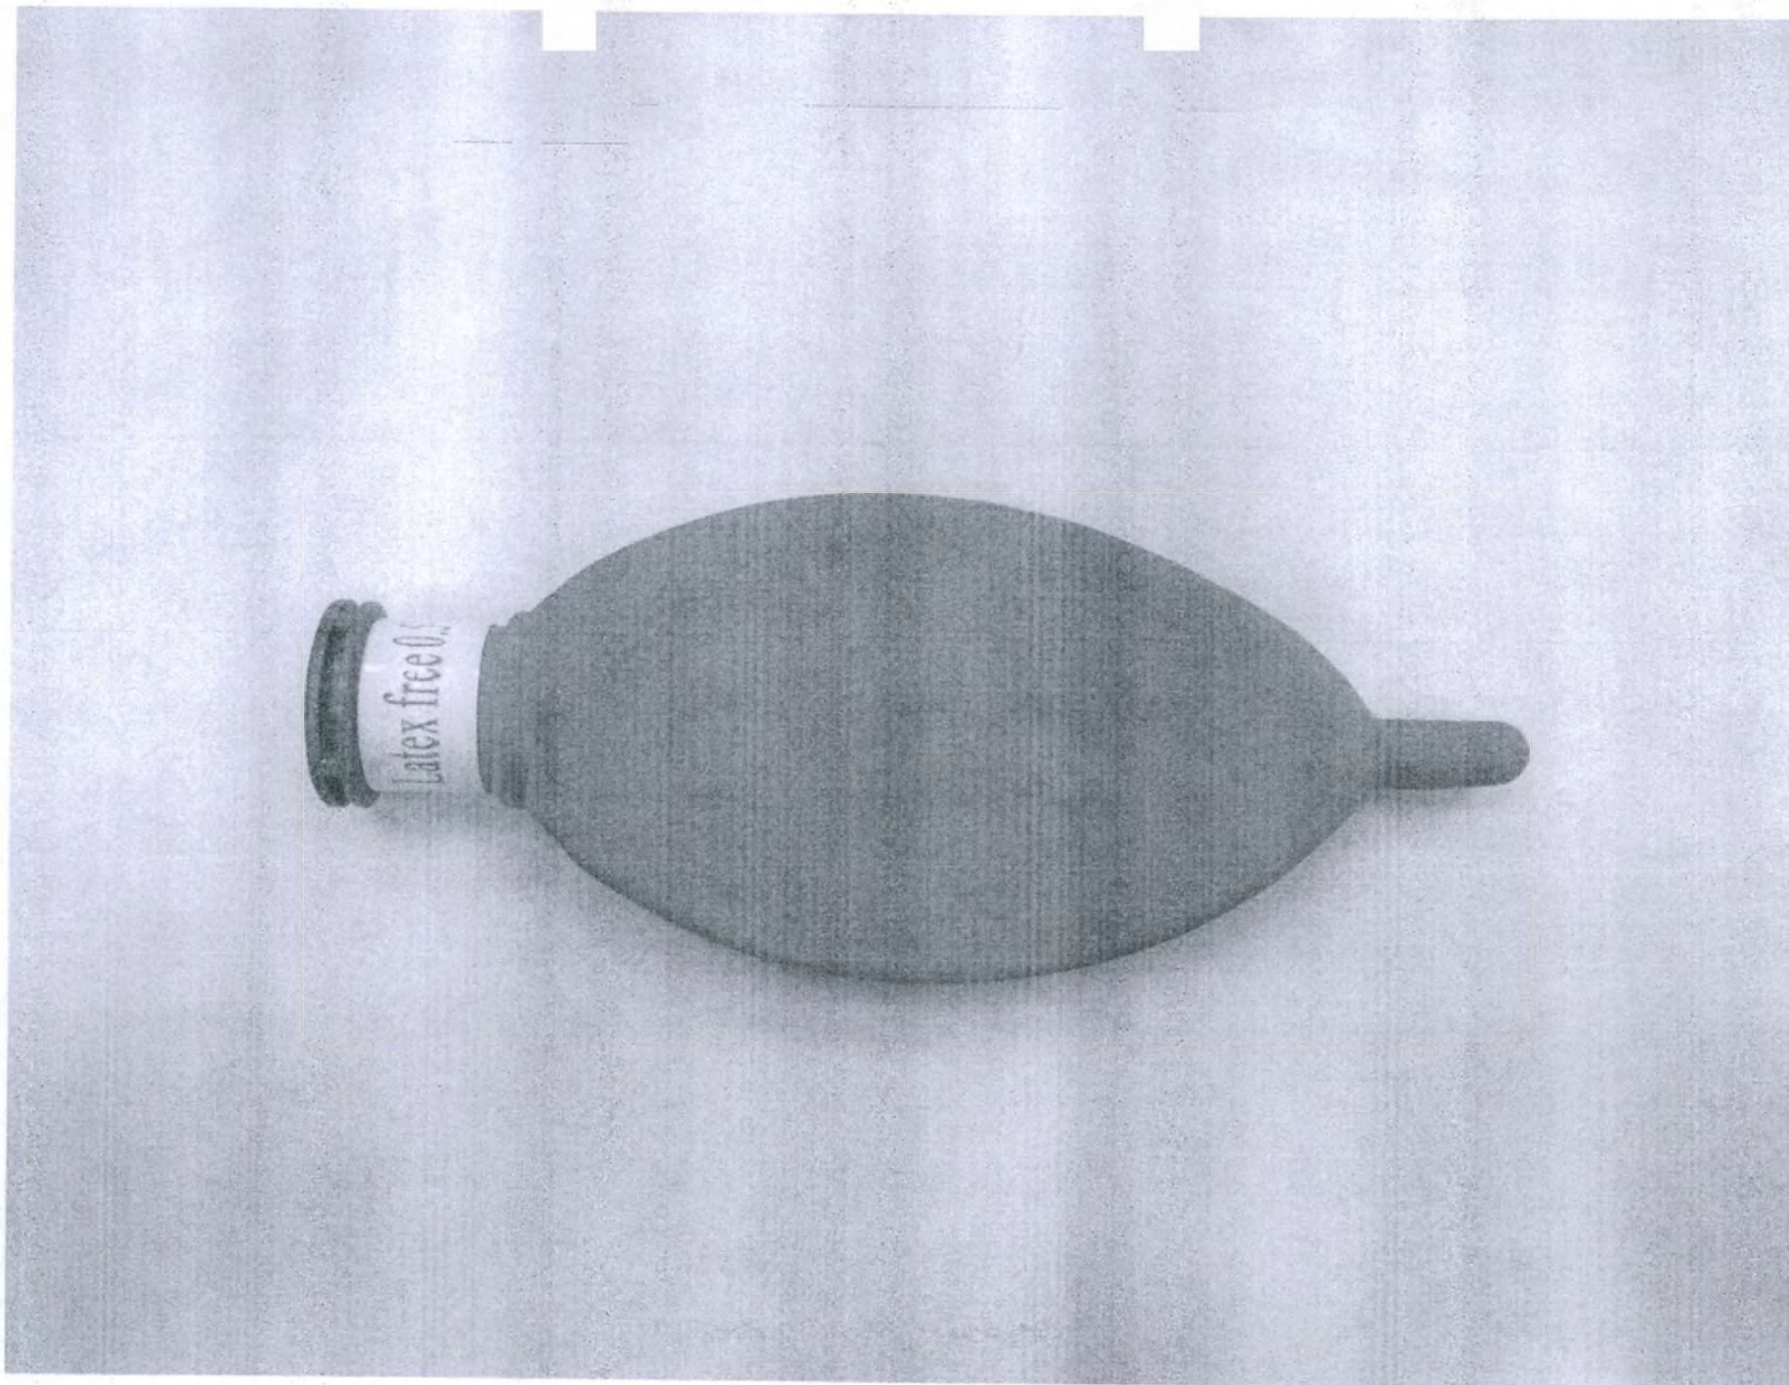


Рис. 29 Мешок дыхательный безлатексный, 0,5 л



Рис. 30 Мешок дыхательный безлатексный, 1 л

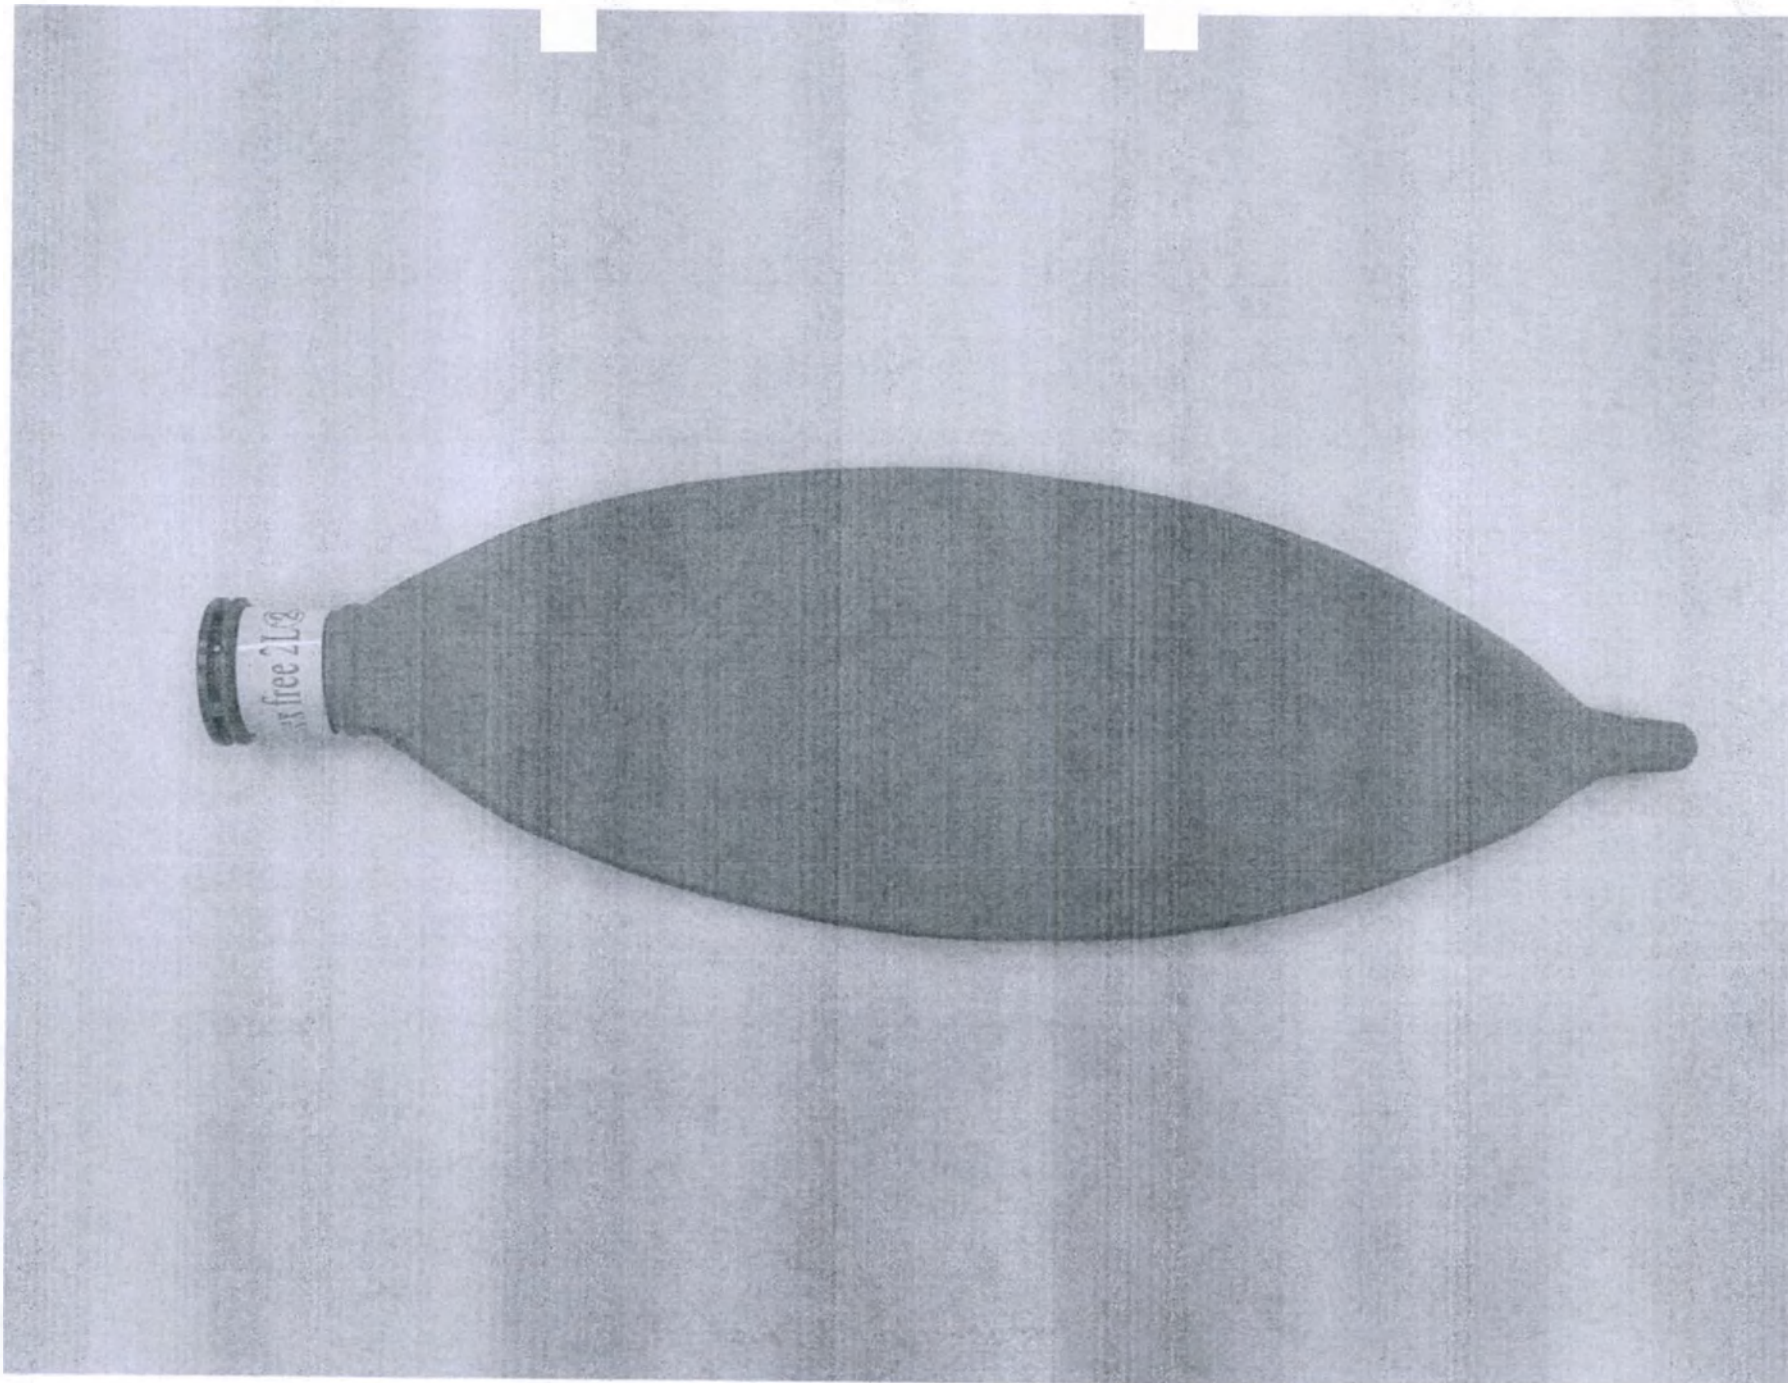


Рис. 31 Мешок дыхательный безлатексный, 2 л

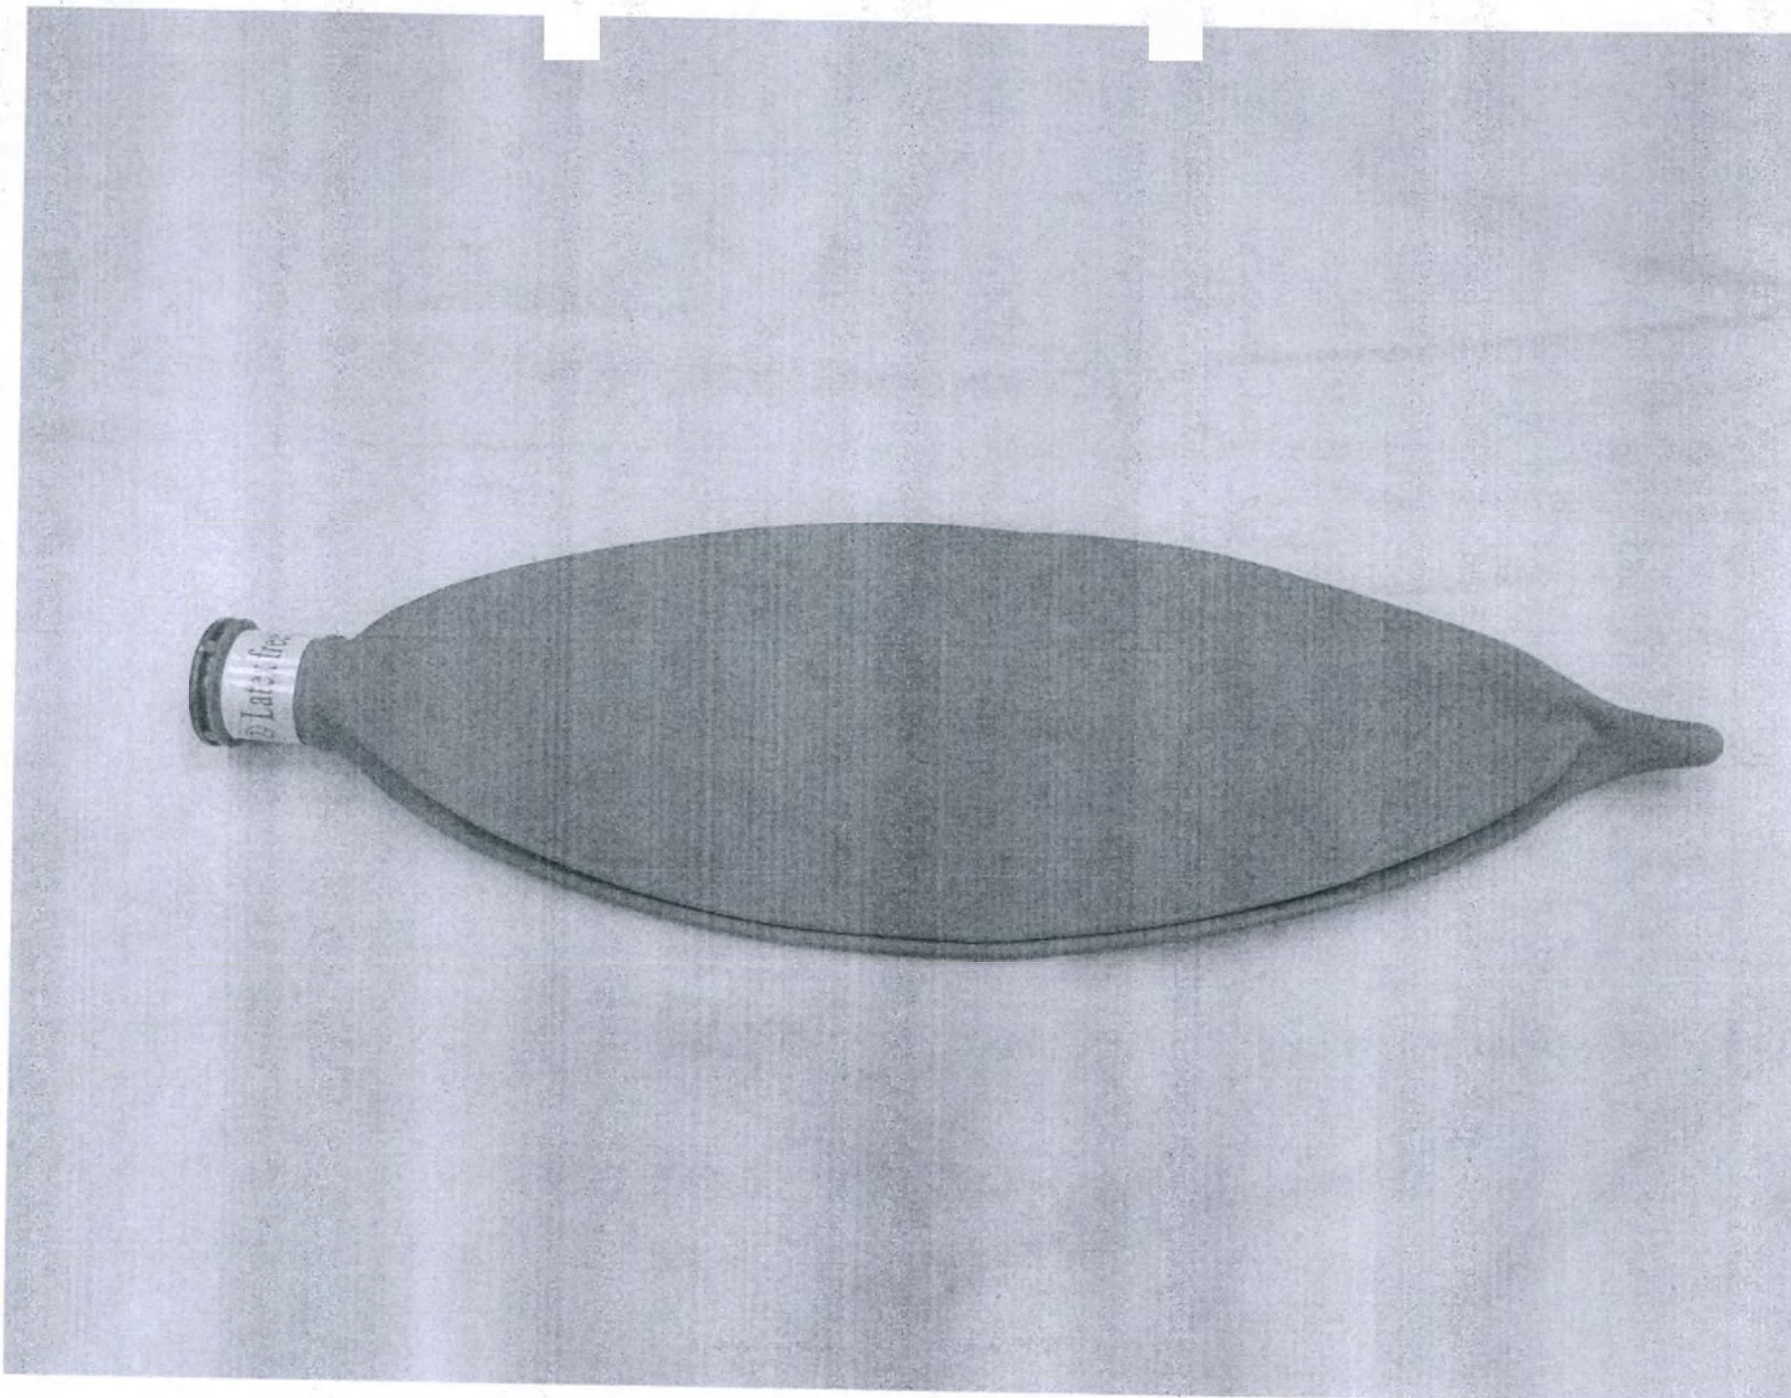


Рис. 32 Мешок дыхательный безлатексный, 3 л

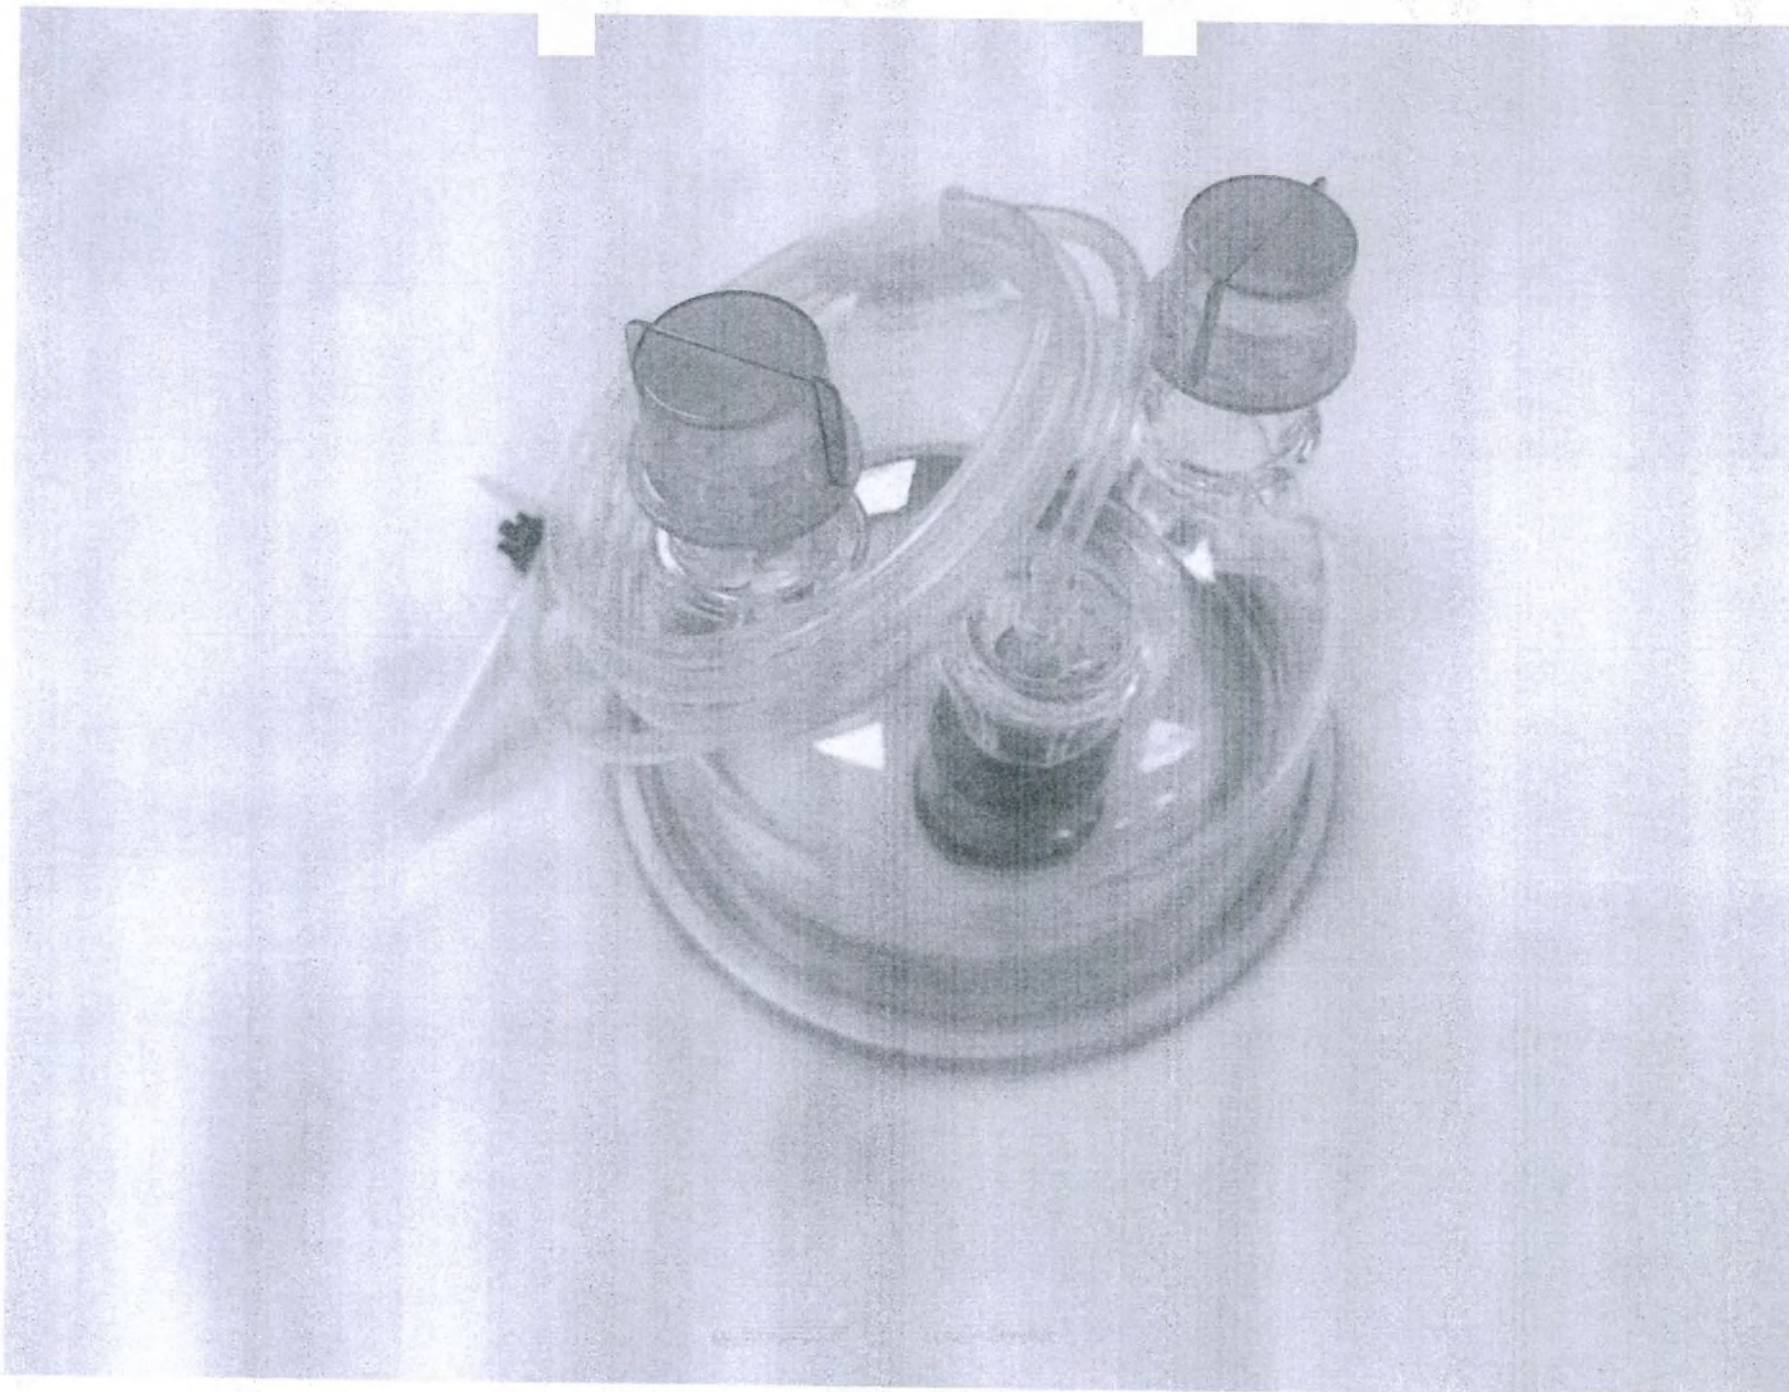


Рис. 33 Камера увлажнителя автозаполняемая универсальная

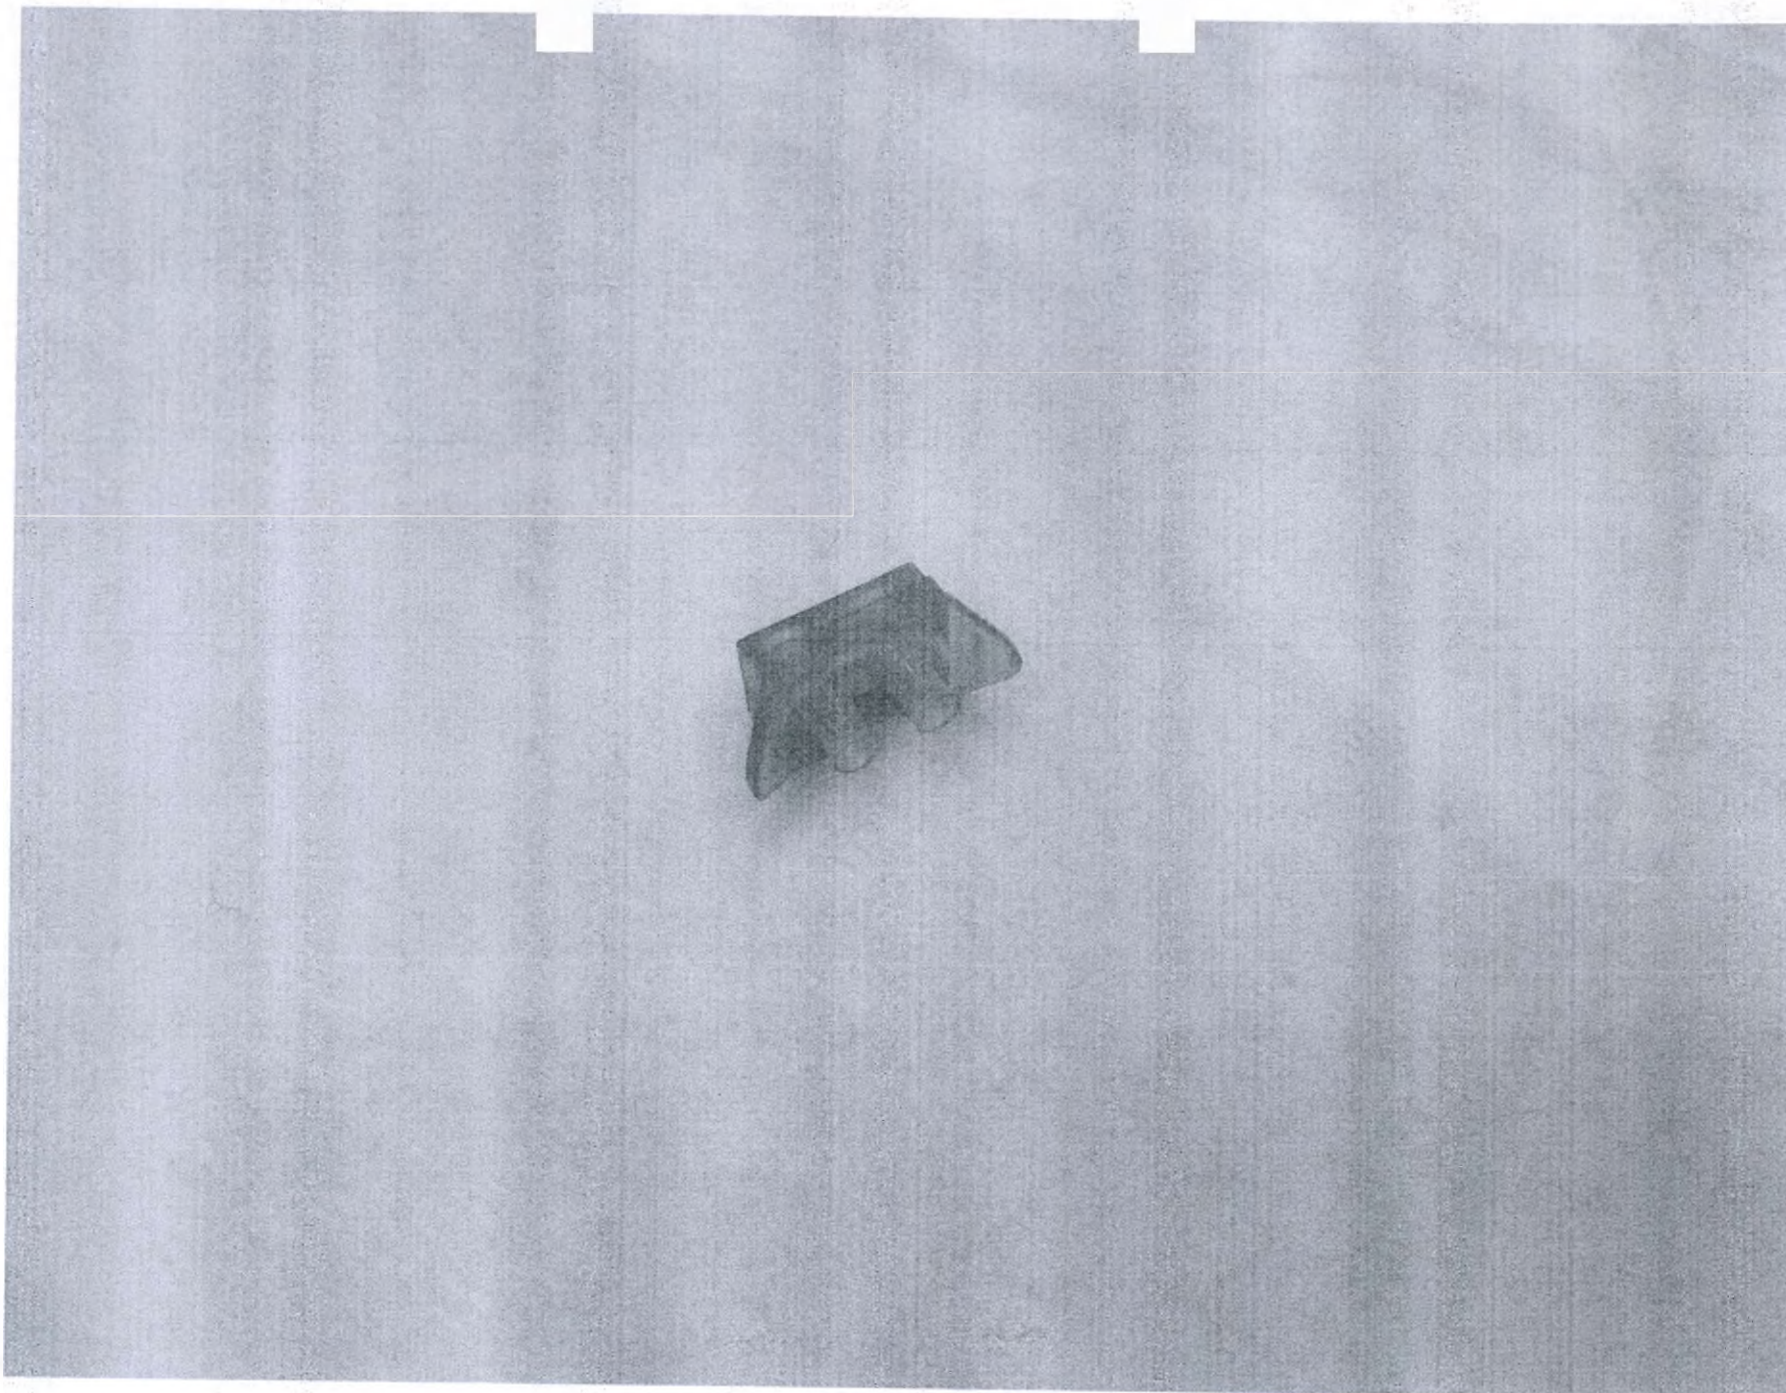


Рис. 34 Канюля назальная детская (неонатальная) для nCPAP-терапии, размер М

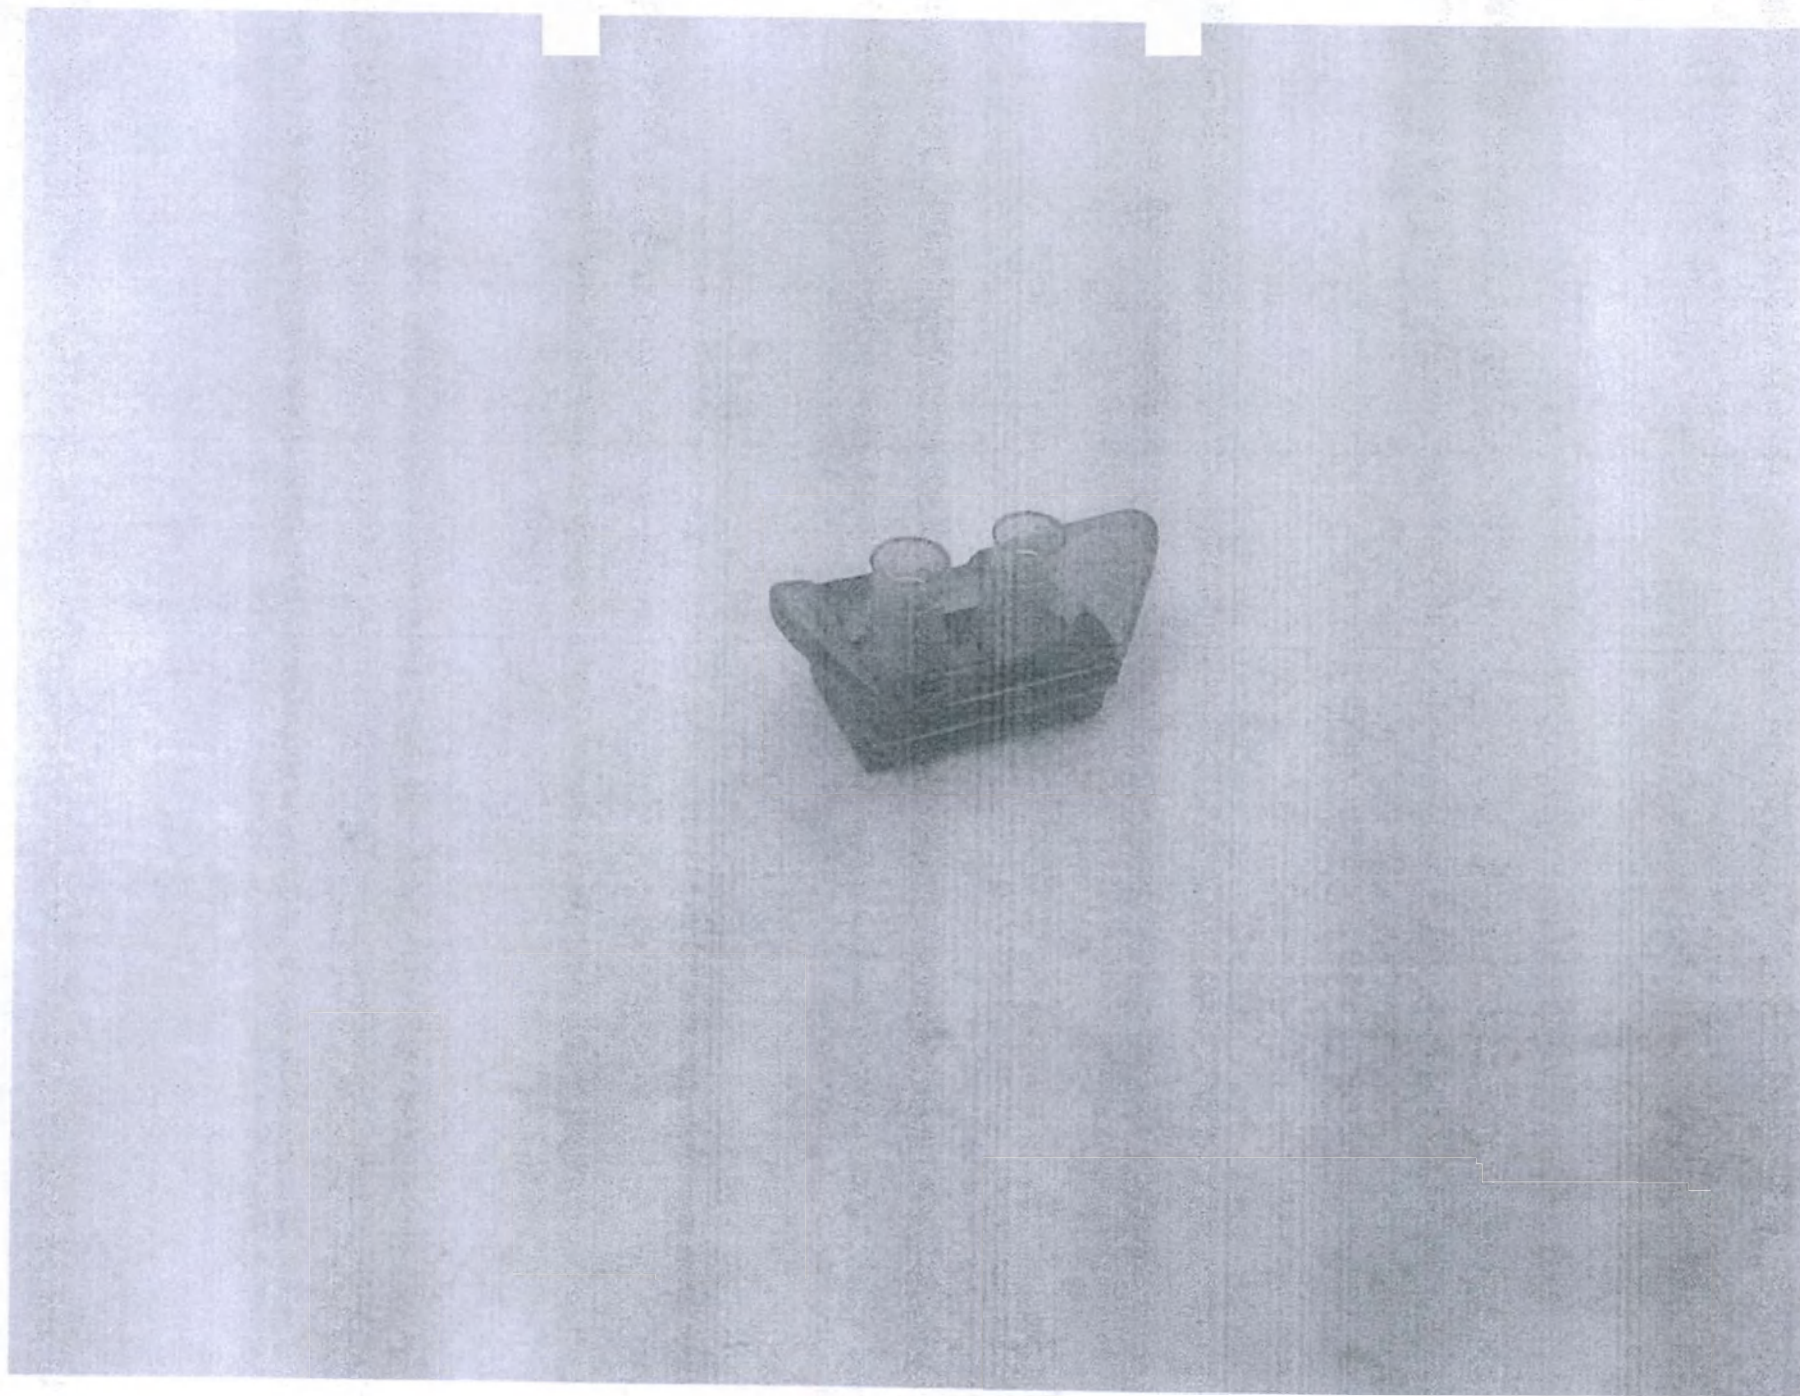


Рис. 35 Канюля назальная детская (неонатальная) для nCPAP-терапии, размер L

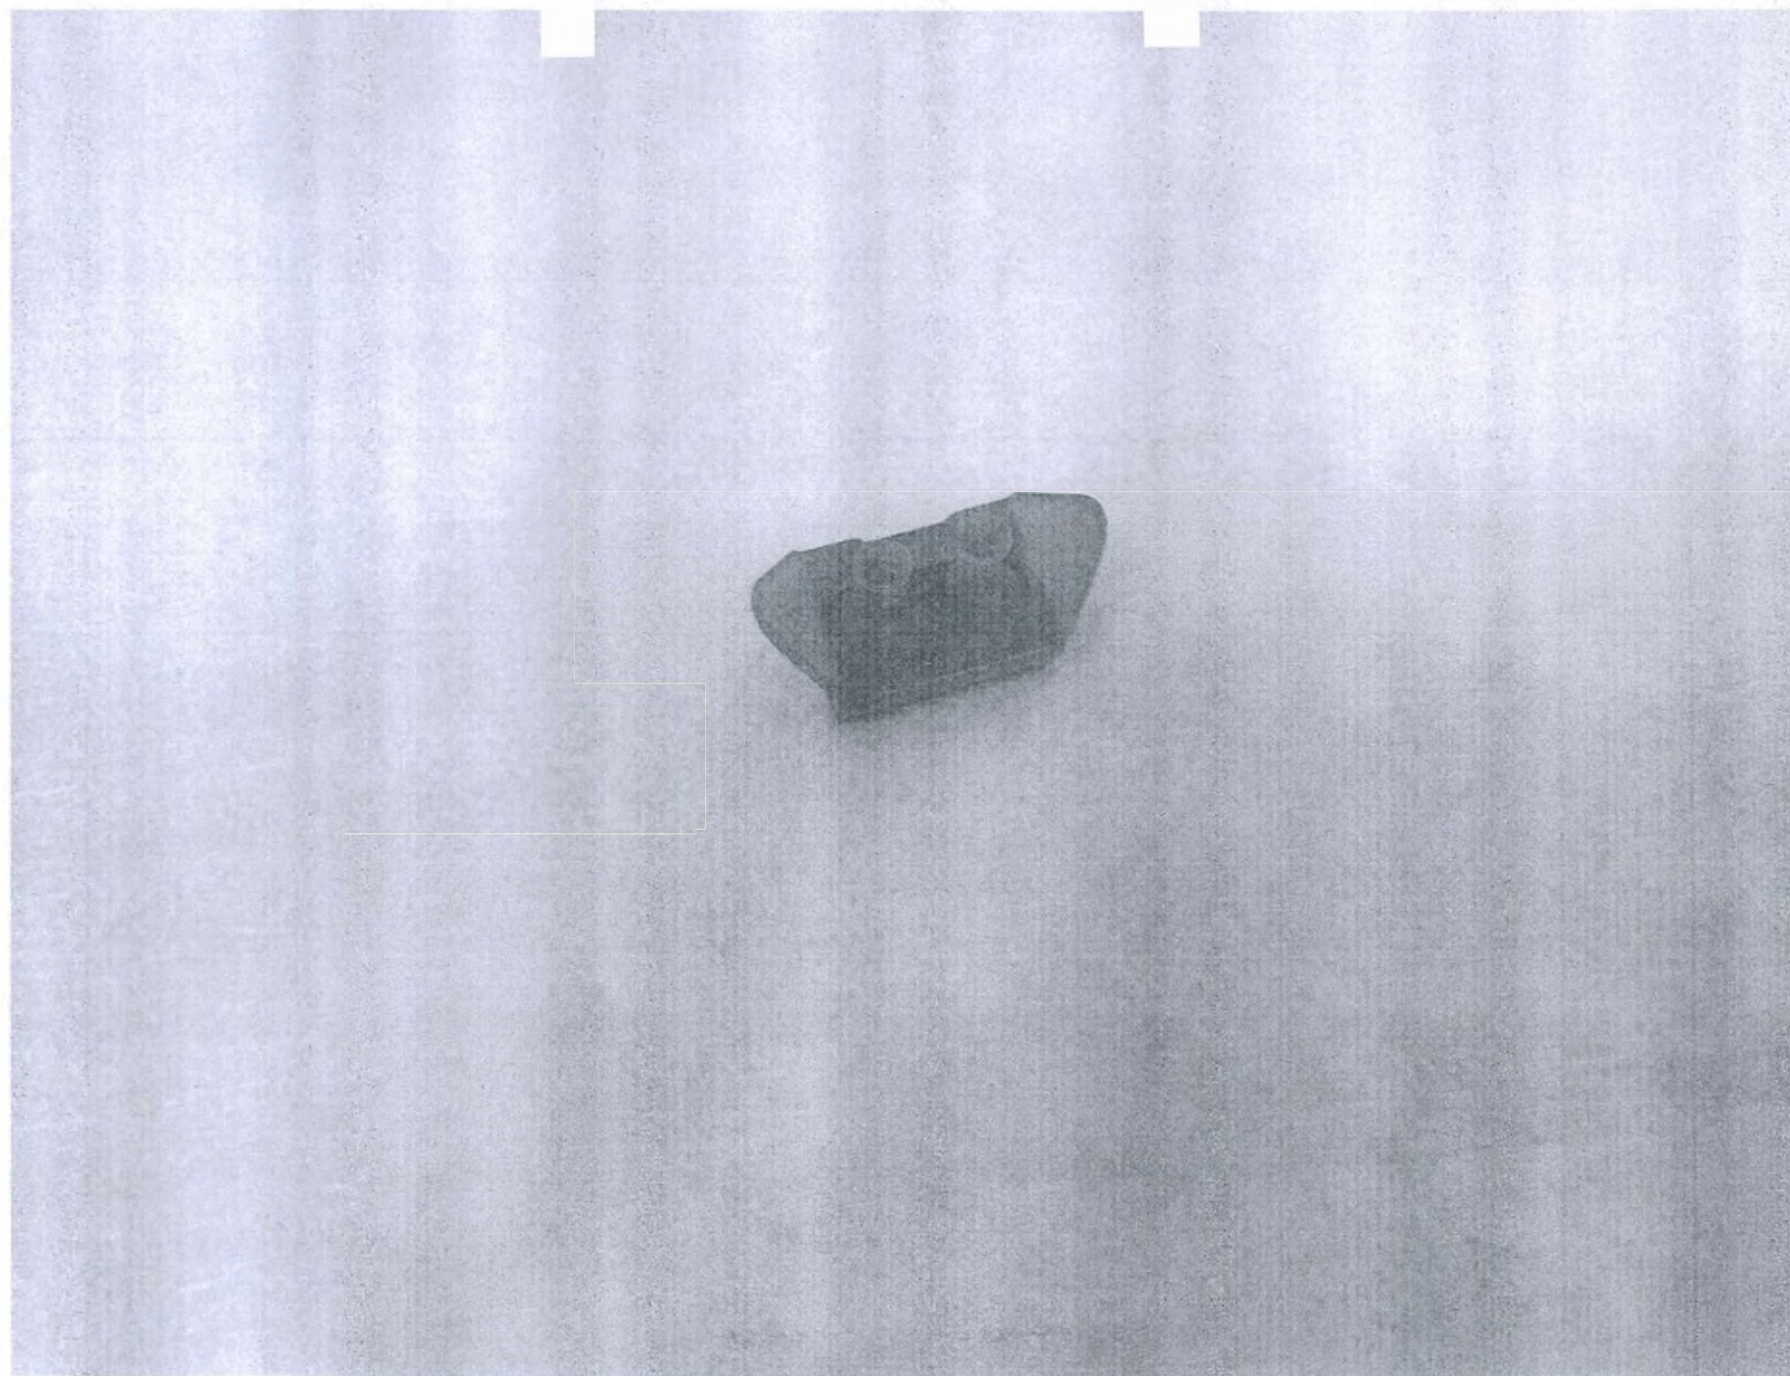


Рис. 36 Канюля назальная детская (неонатальная) для nCPAP-терапии, размер S

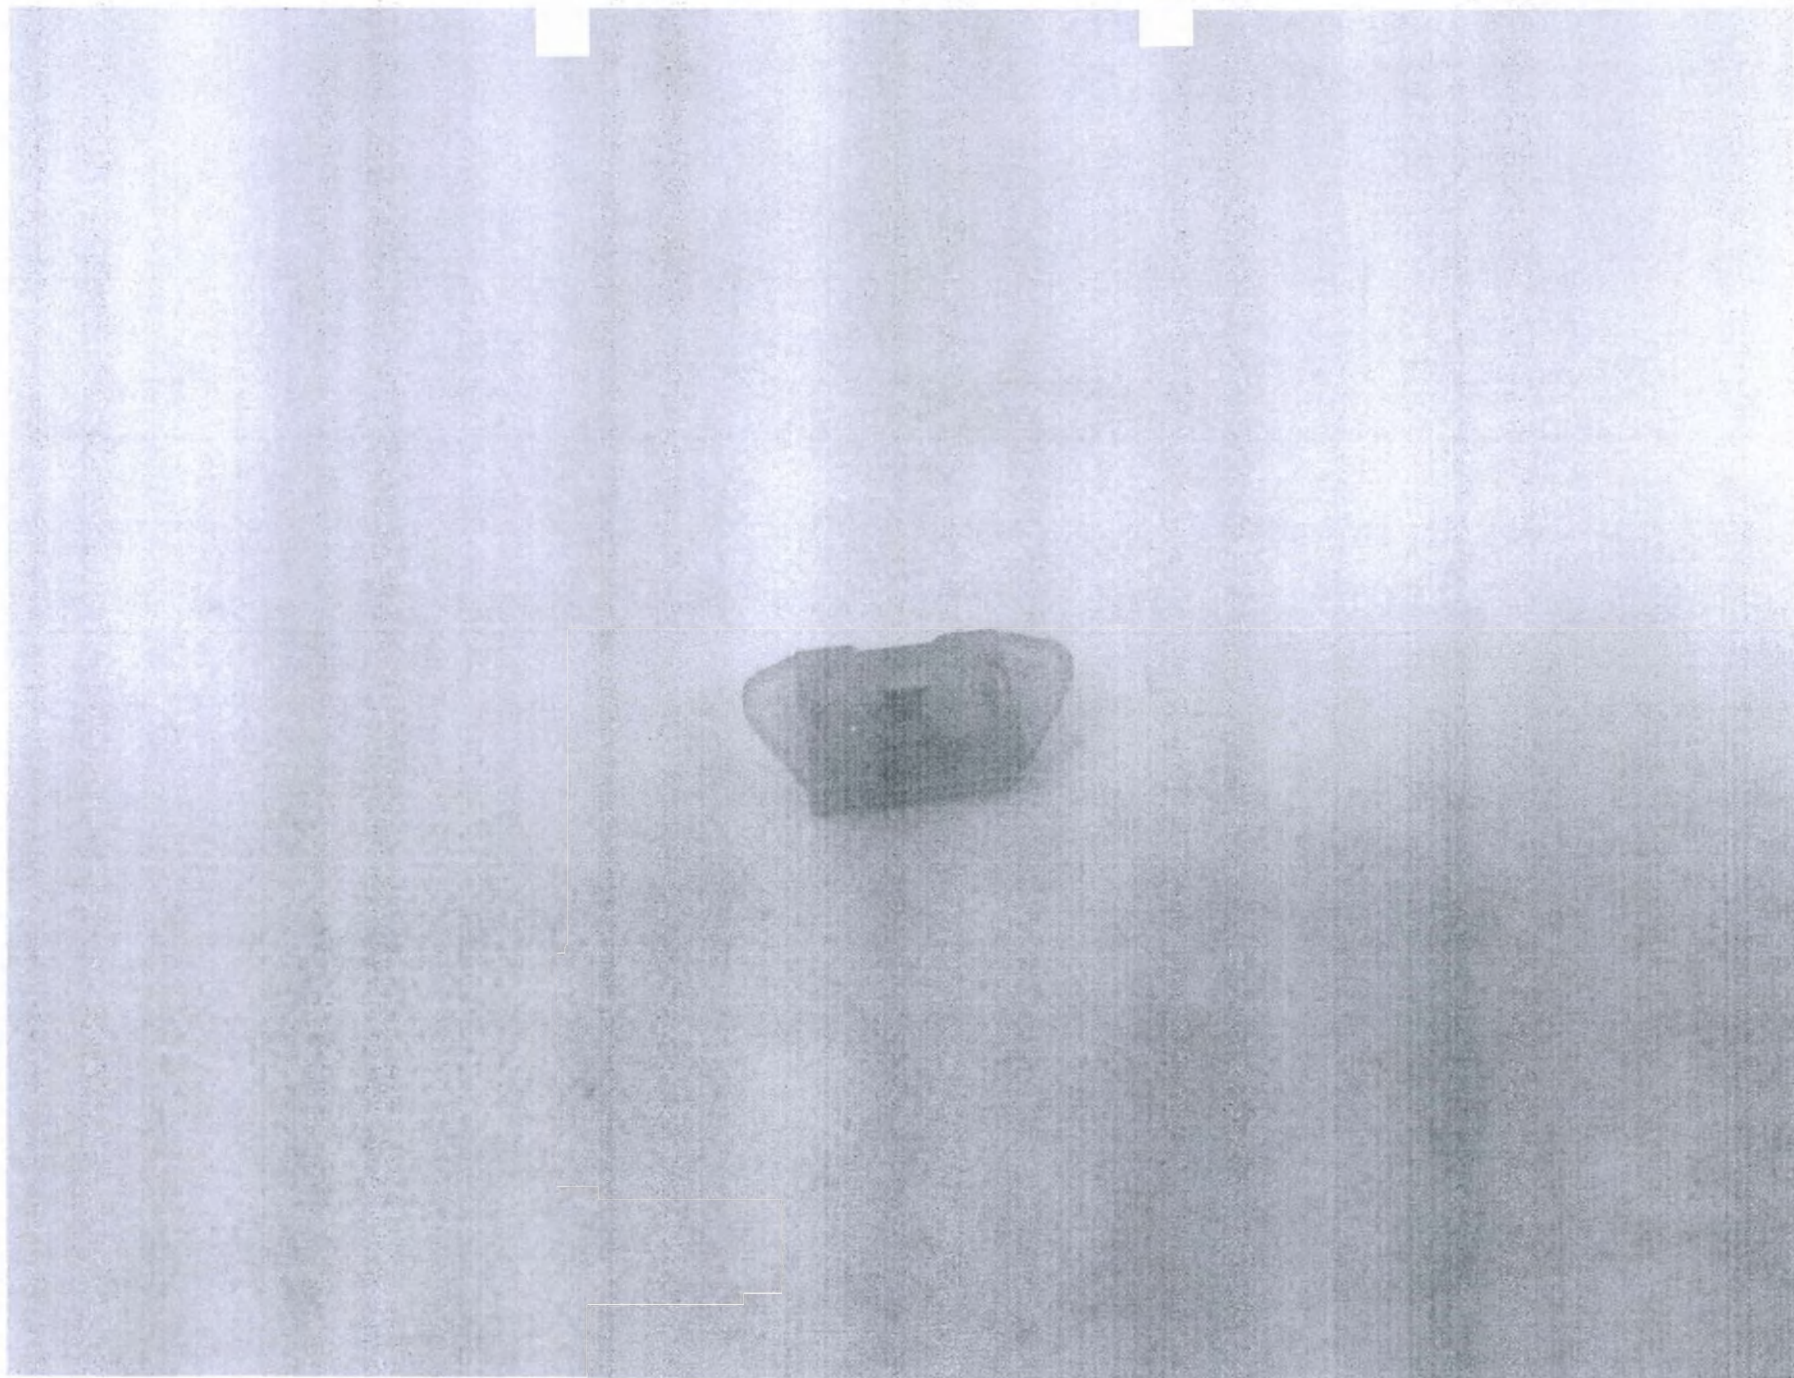


Рис. 37 Канюля назальная детская (неонатальная) для nCPAP-терапии, размер XS

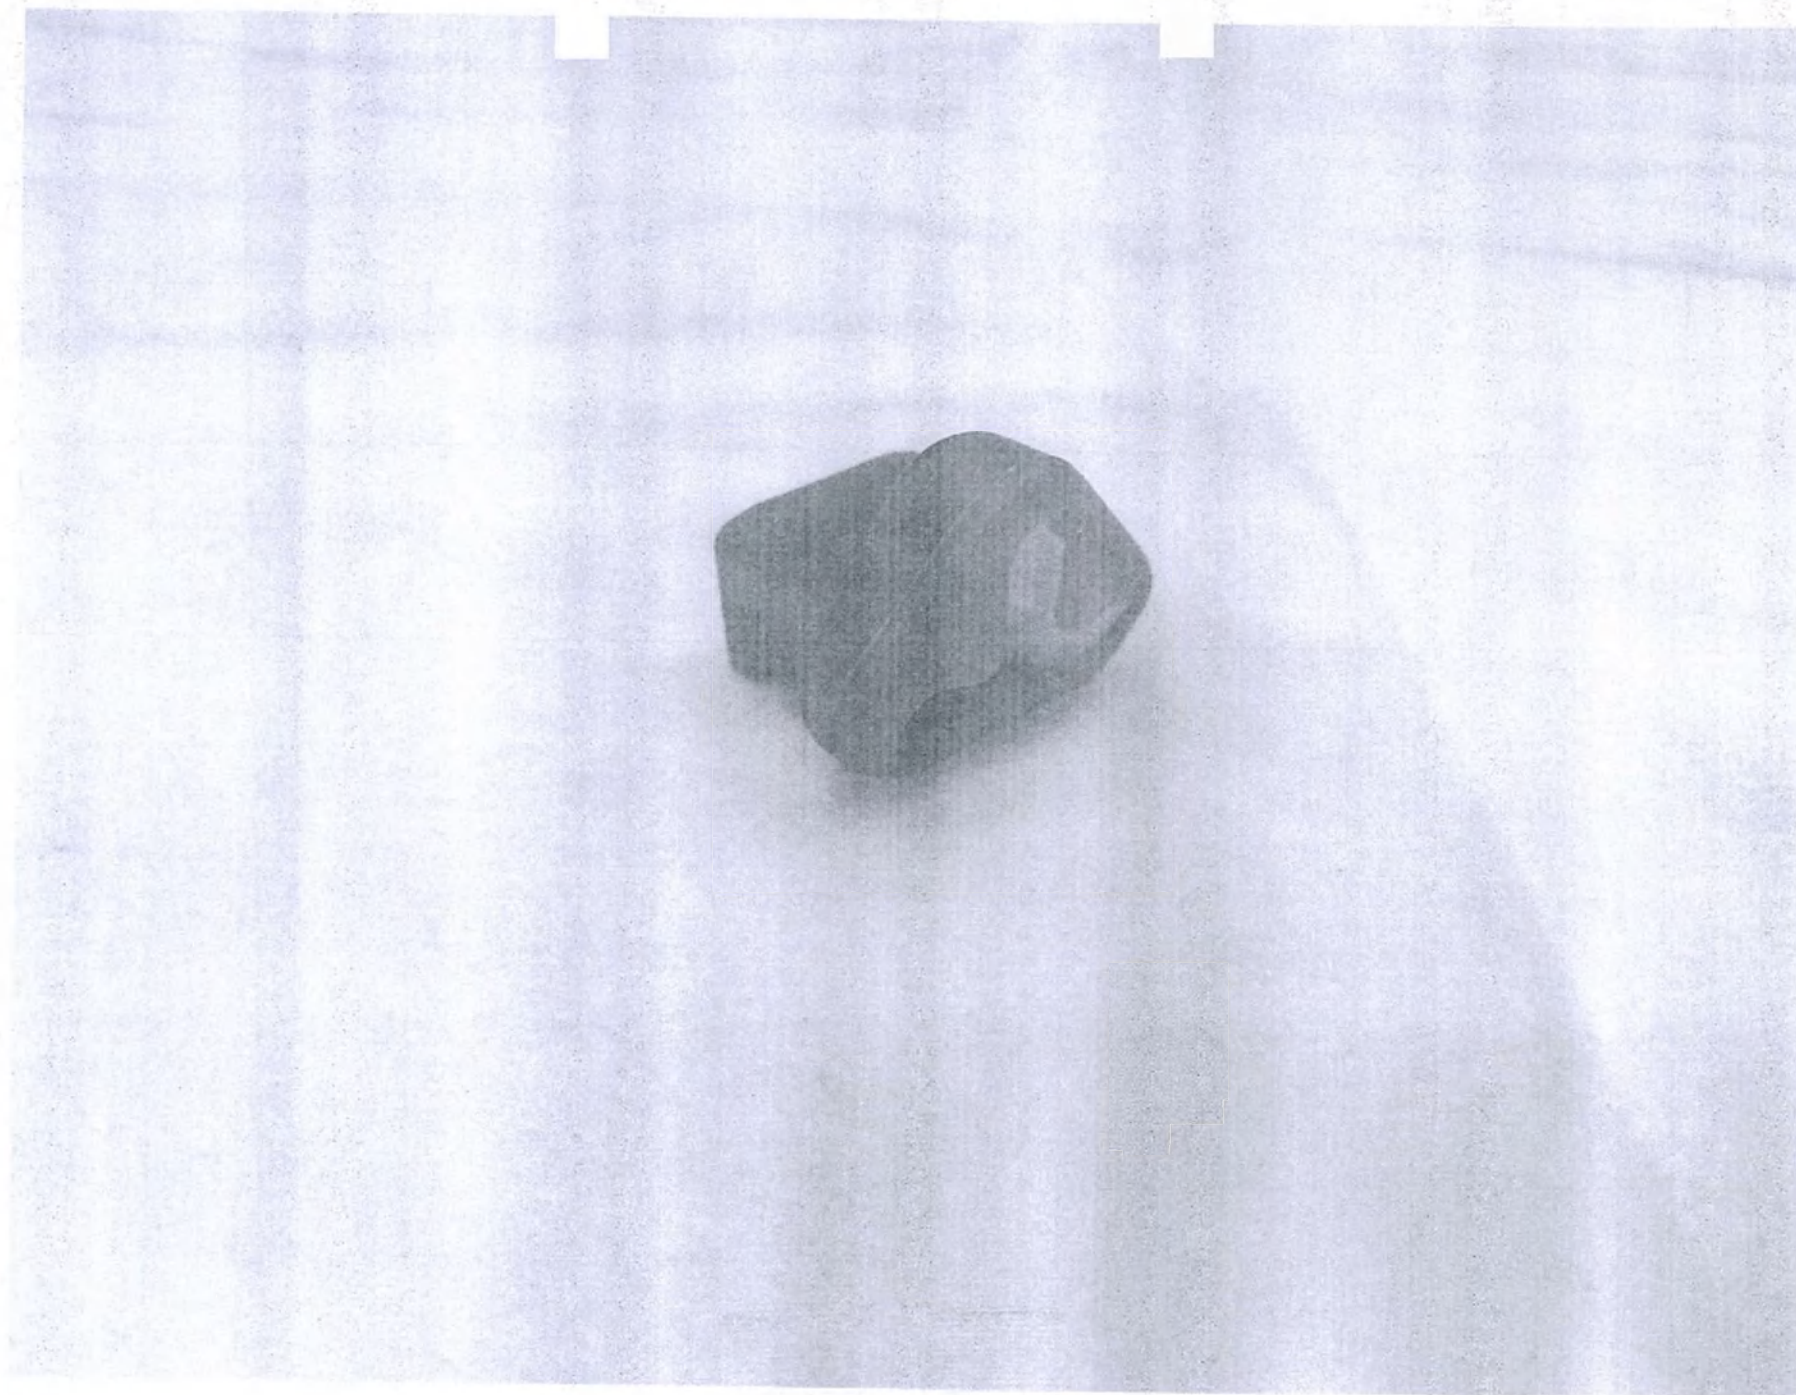


Рис. 38 Маска дыхательная для nCPAP-терапии, размер S

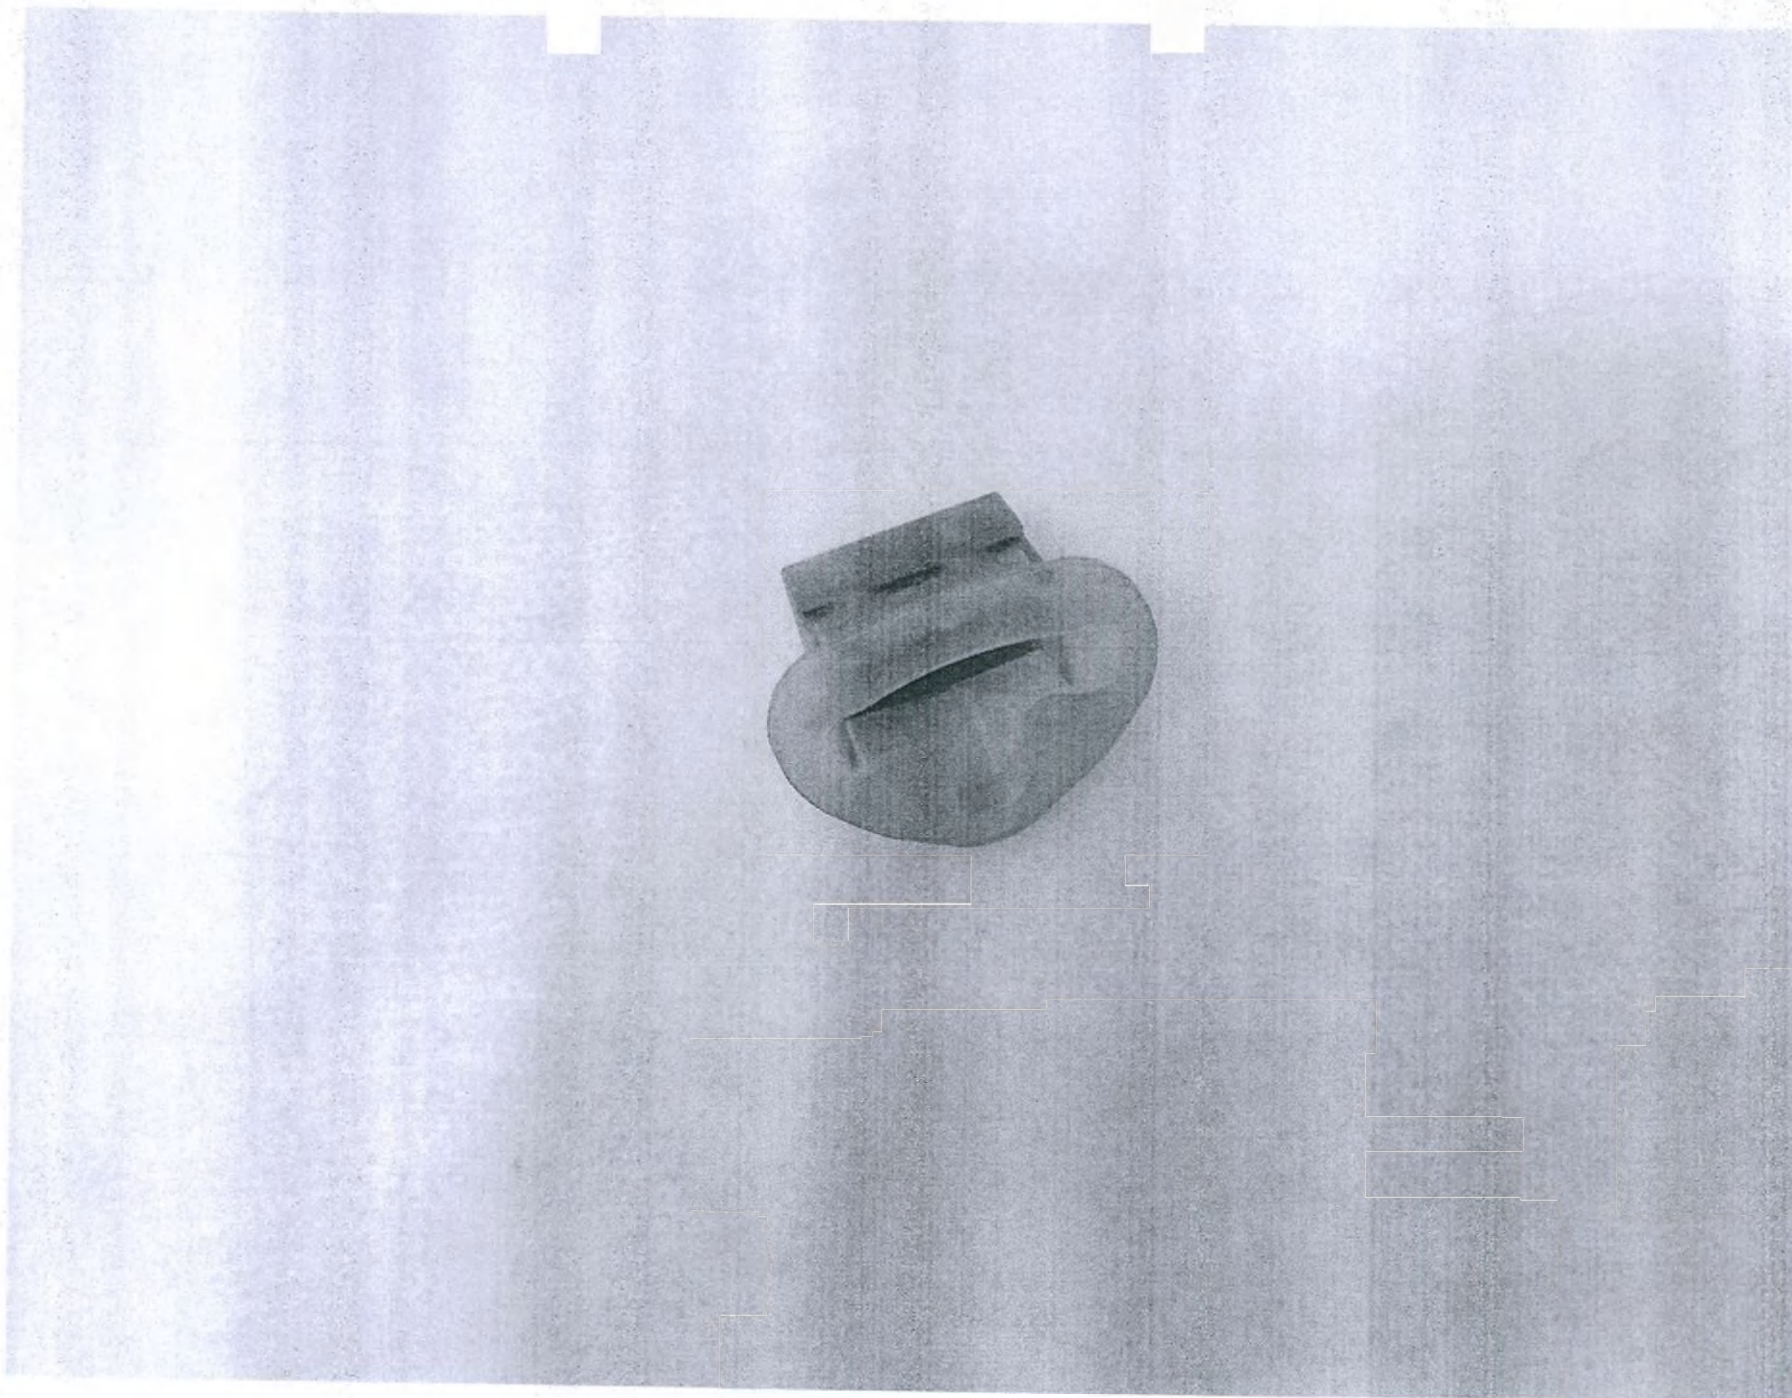


Рис. 39 Маска дыхательная для nCPAP-терапии, размер М

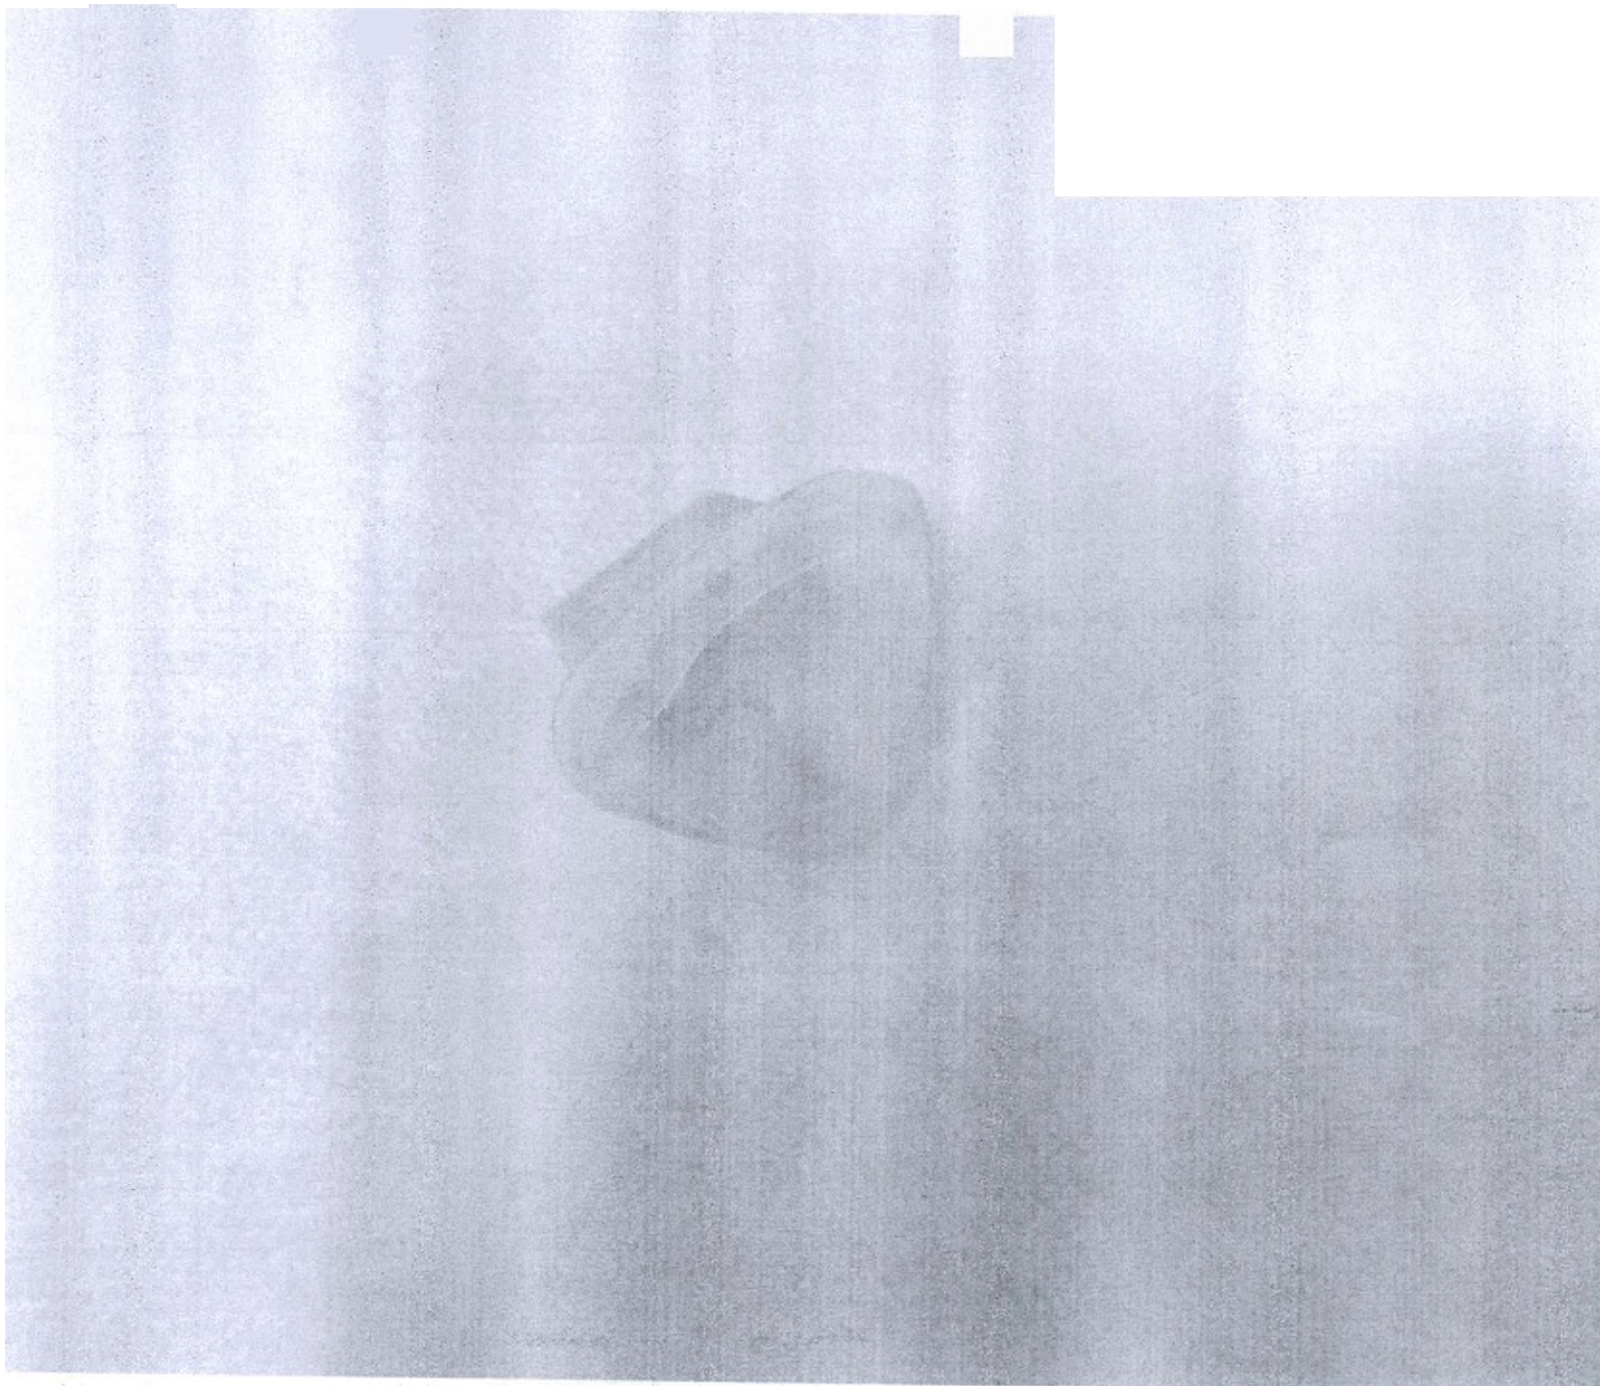


Рис. 40 Маска дыхательная для пСРАР-терапии, размер L

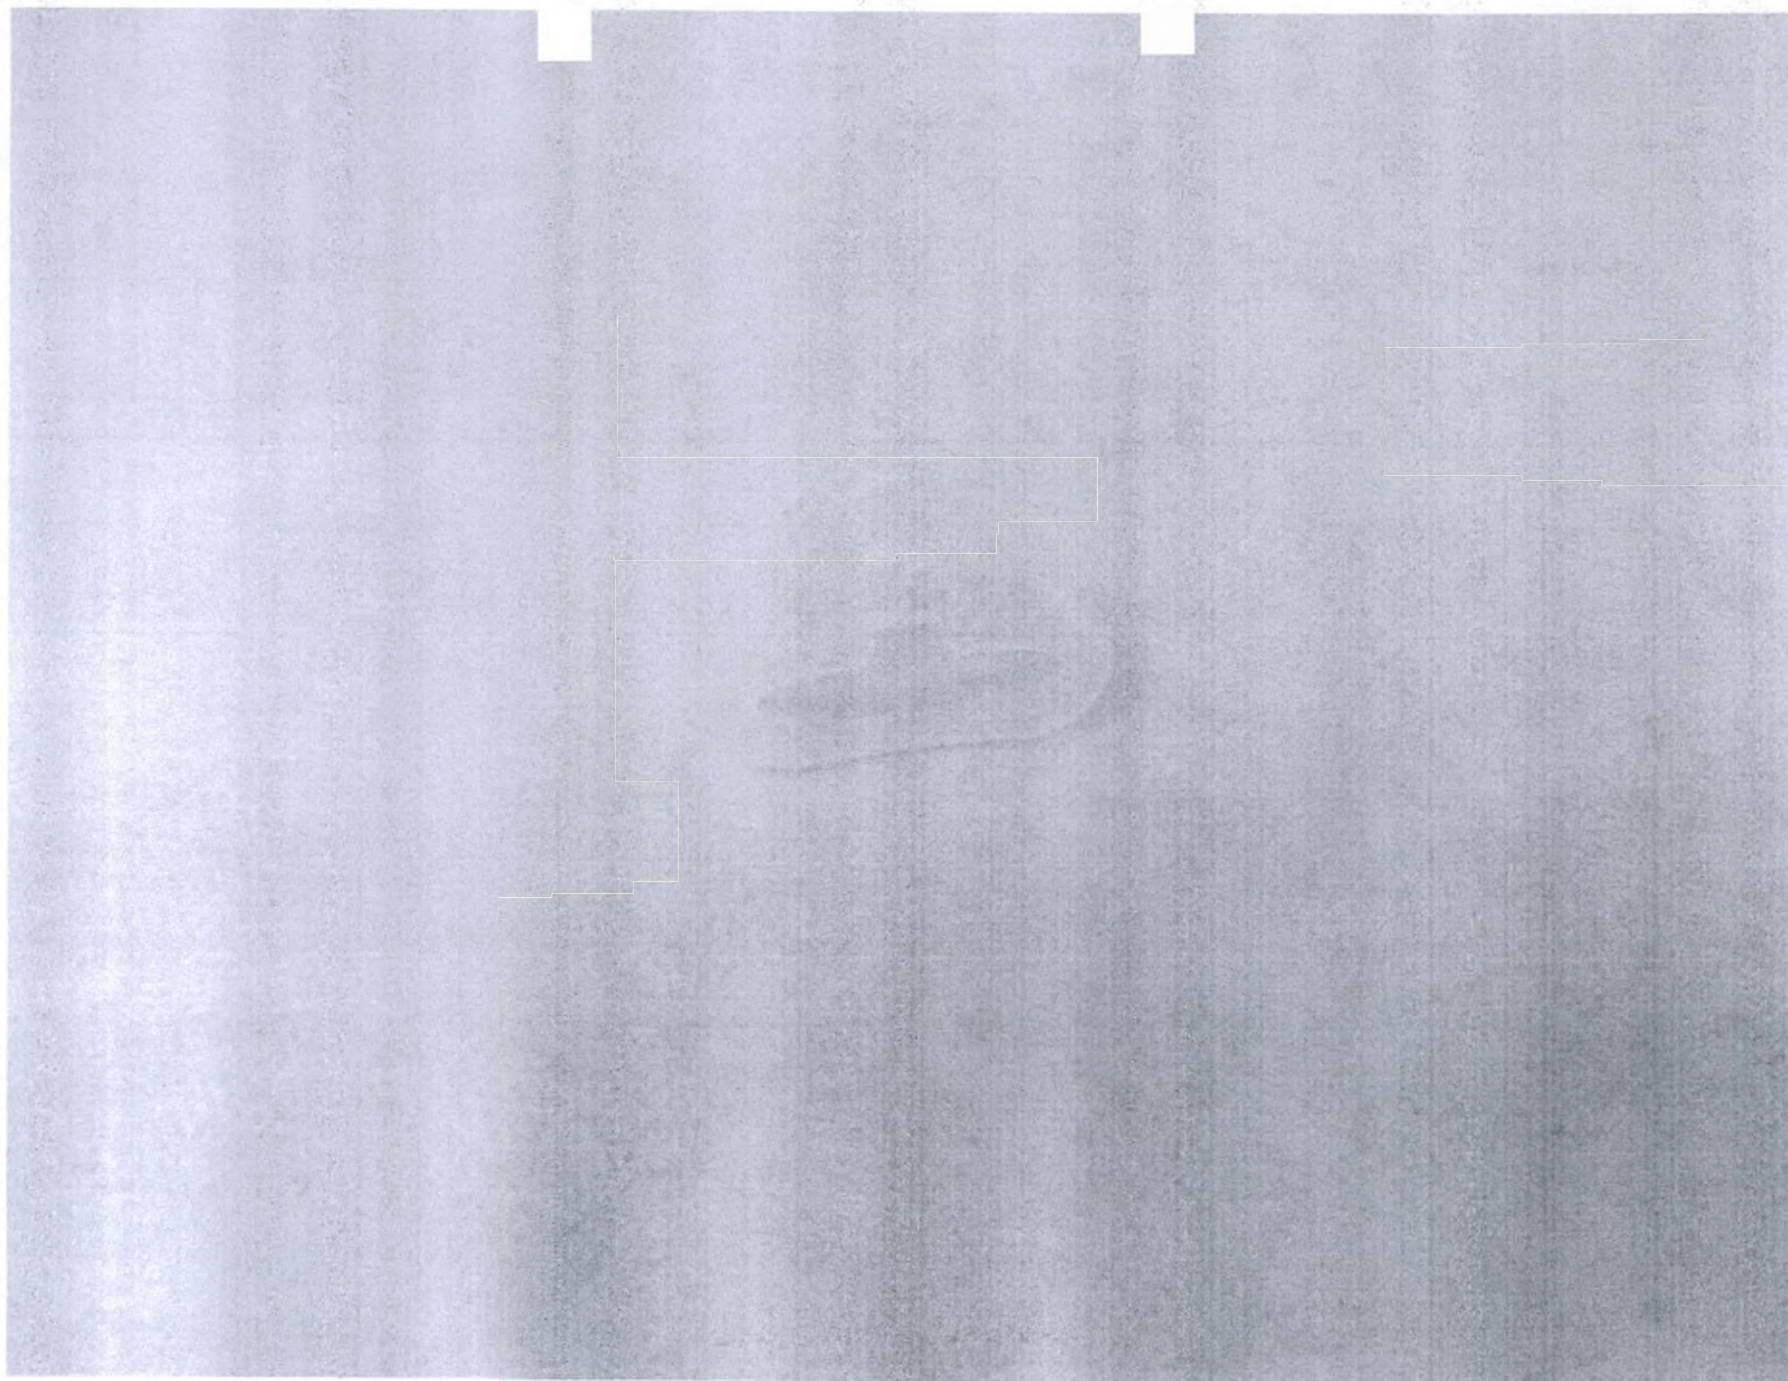


Рис. 41 Маска дыхательная для nCPAP-терапии, размер XL

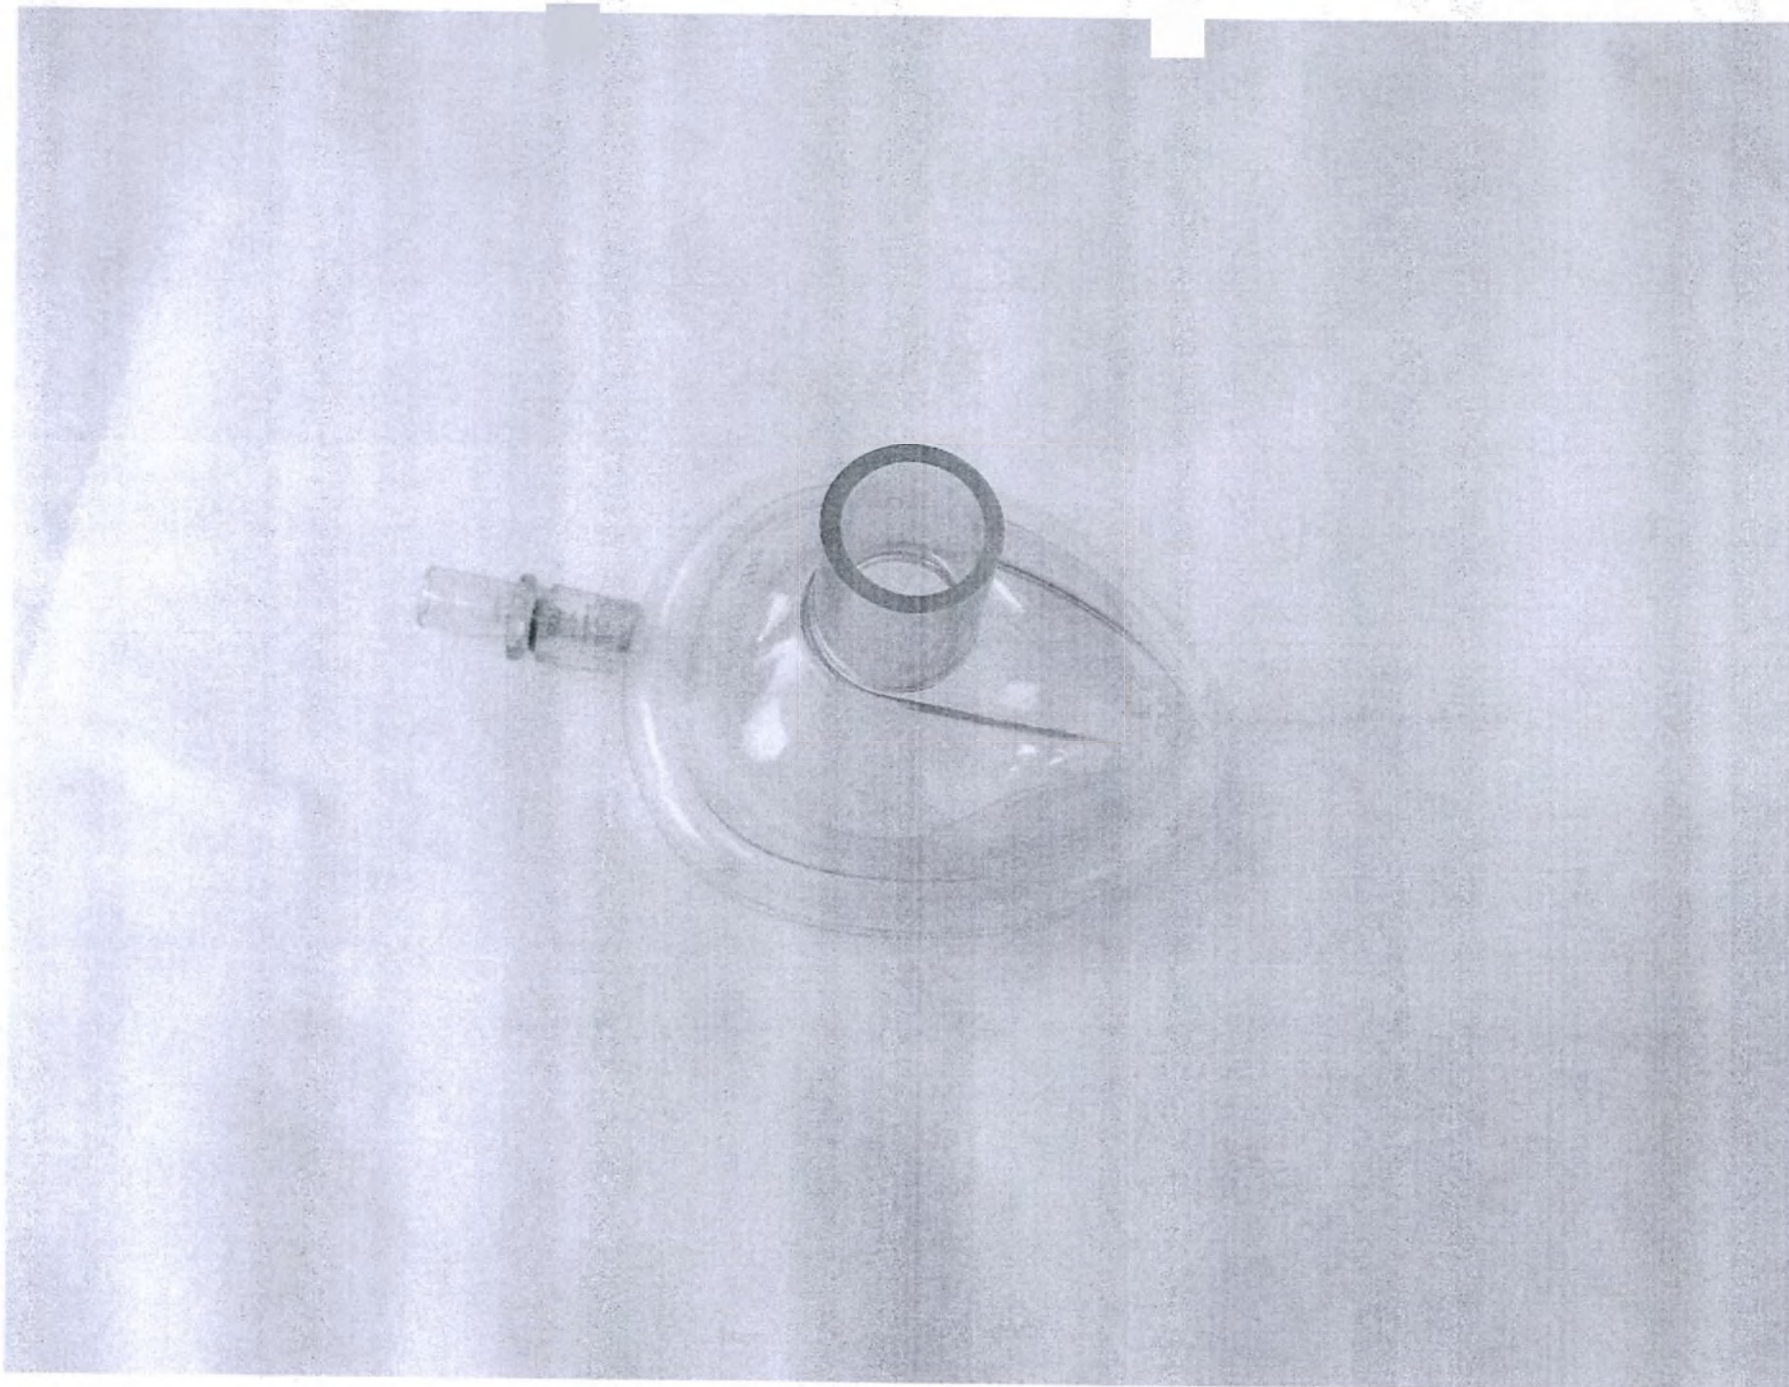


Рис. 42 Маска дыхательная наркозная, размер 0

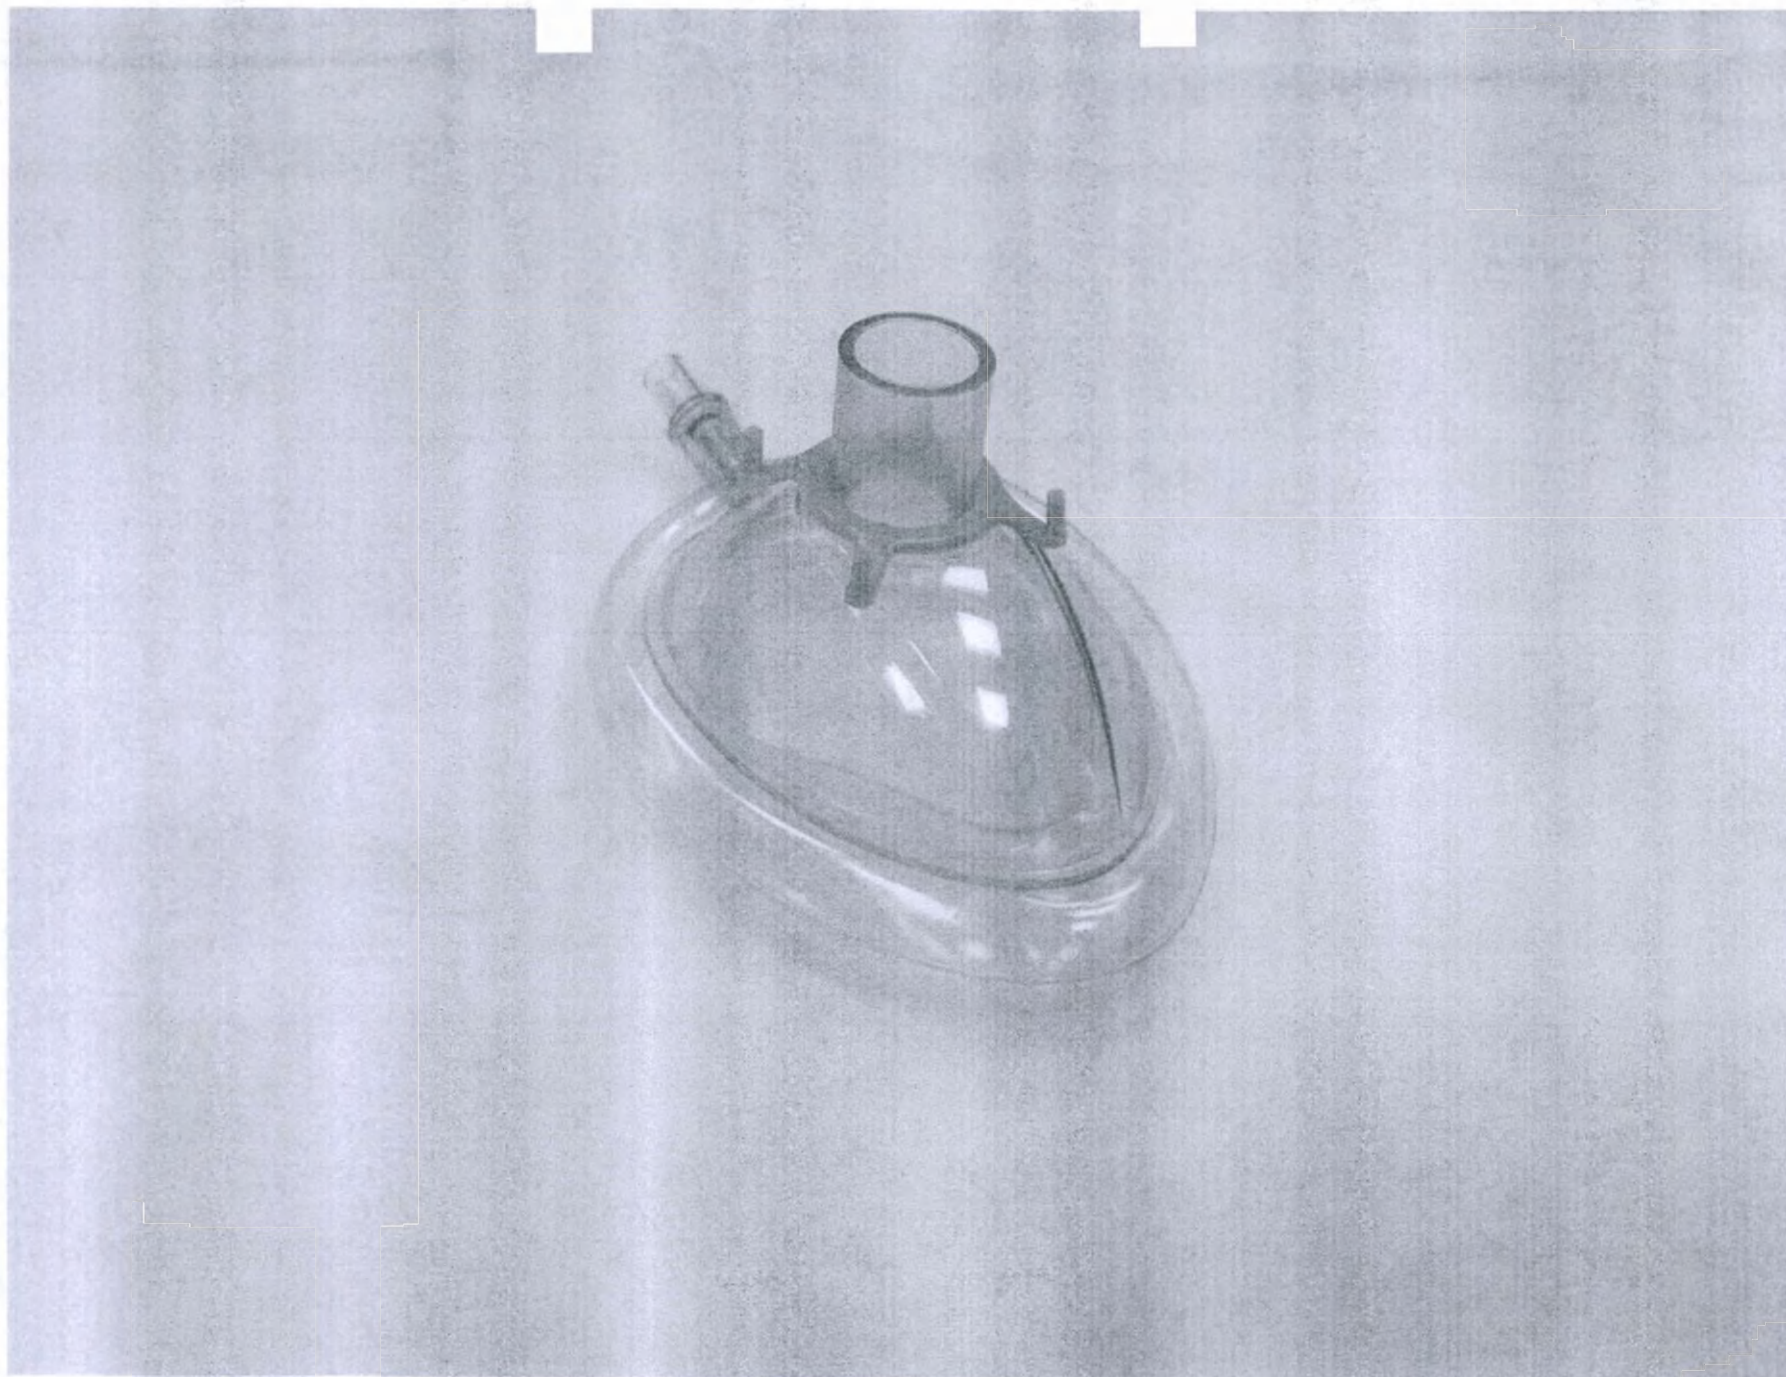


Рис. 43 Маска дыхательная наркозная, размер 1

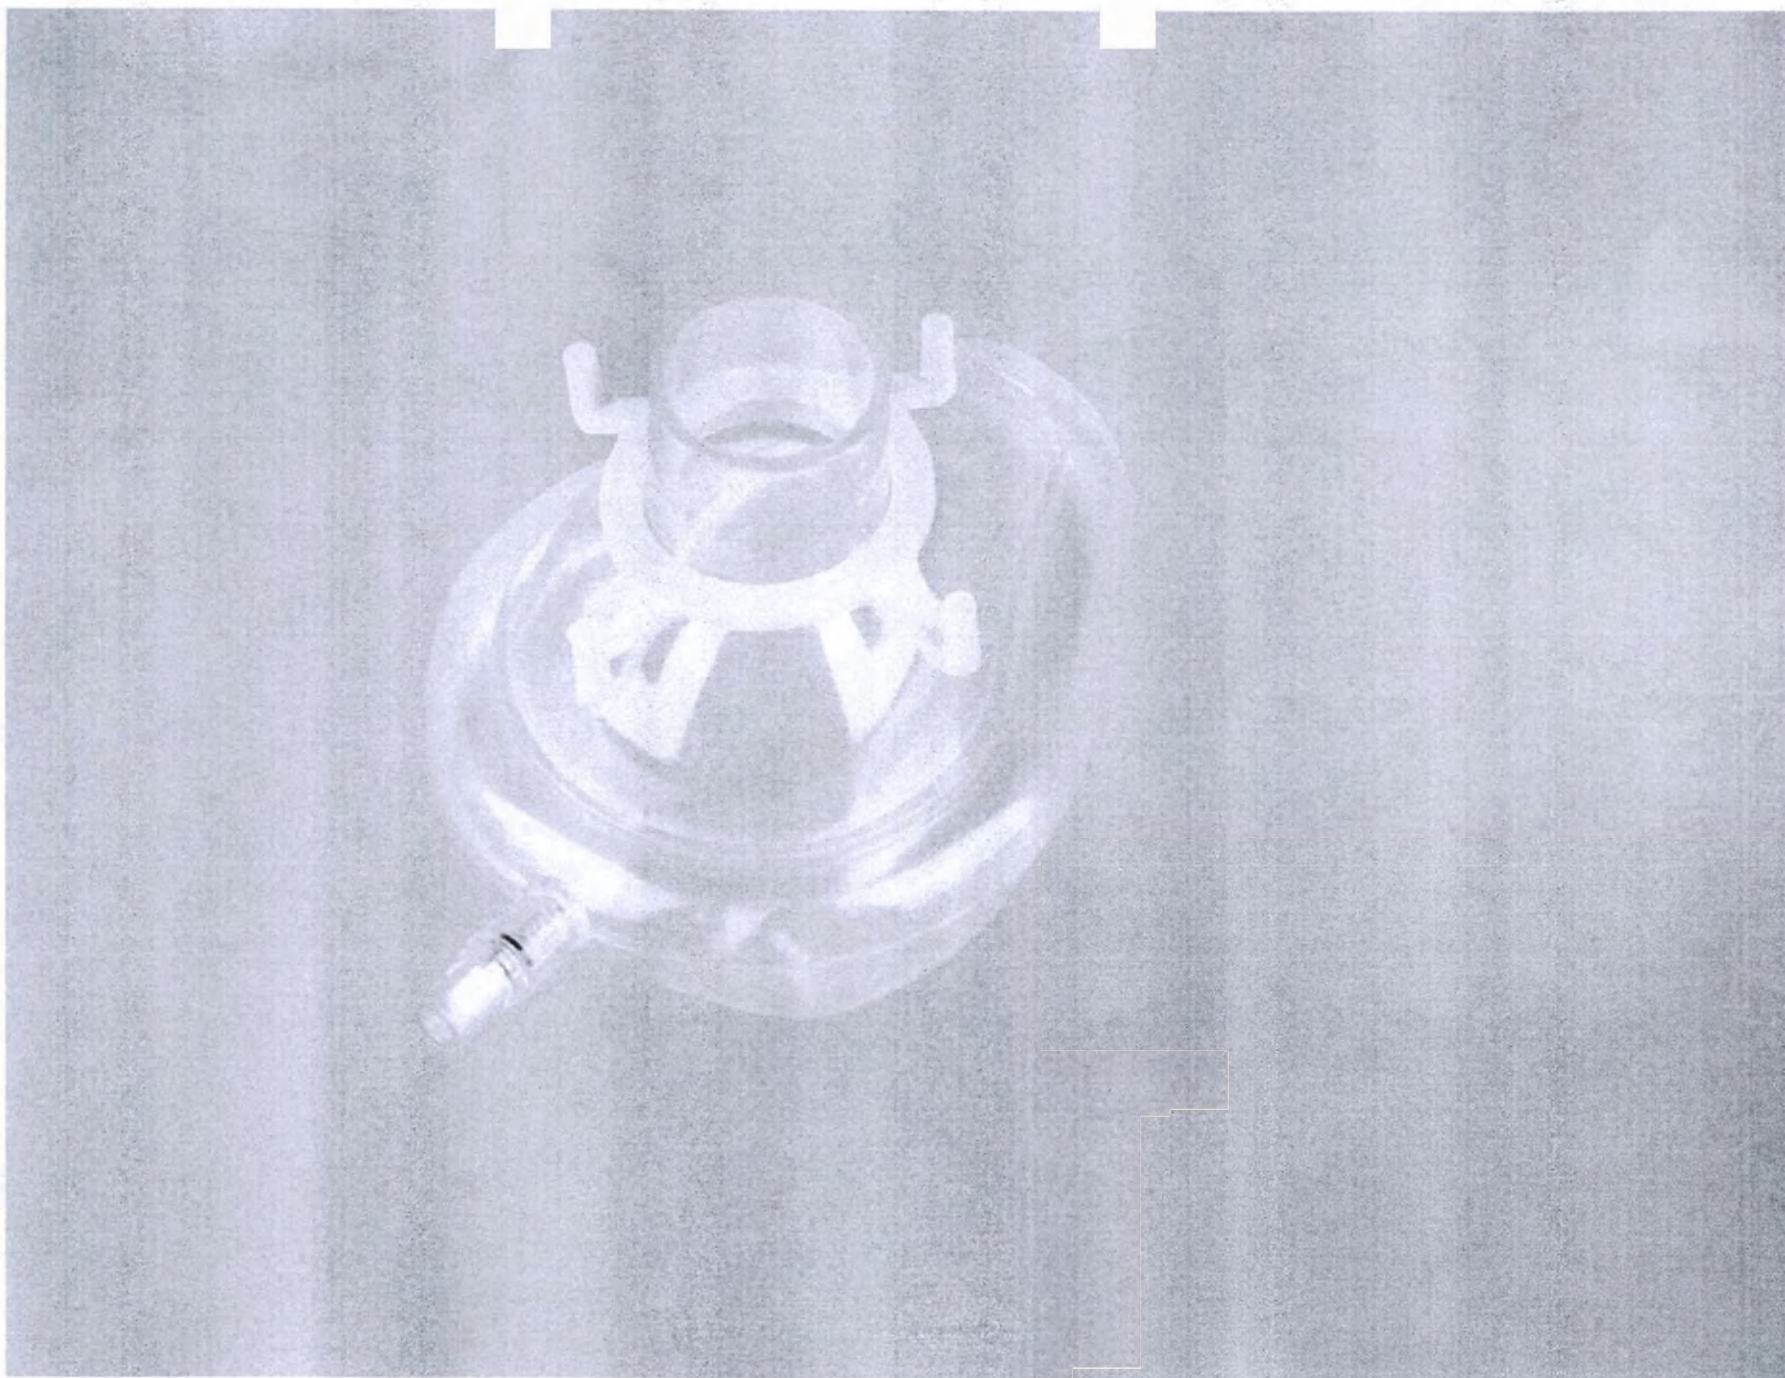


Рис. 44 Маска дыхательная наркозная, размер 2

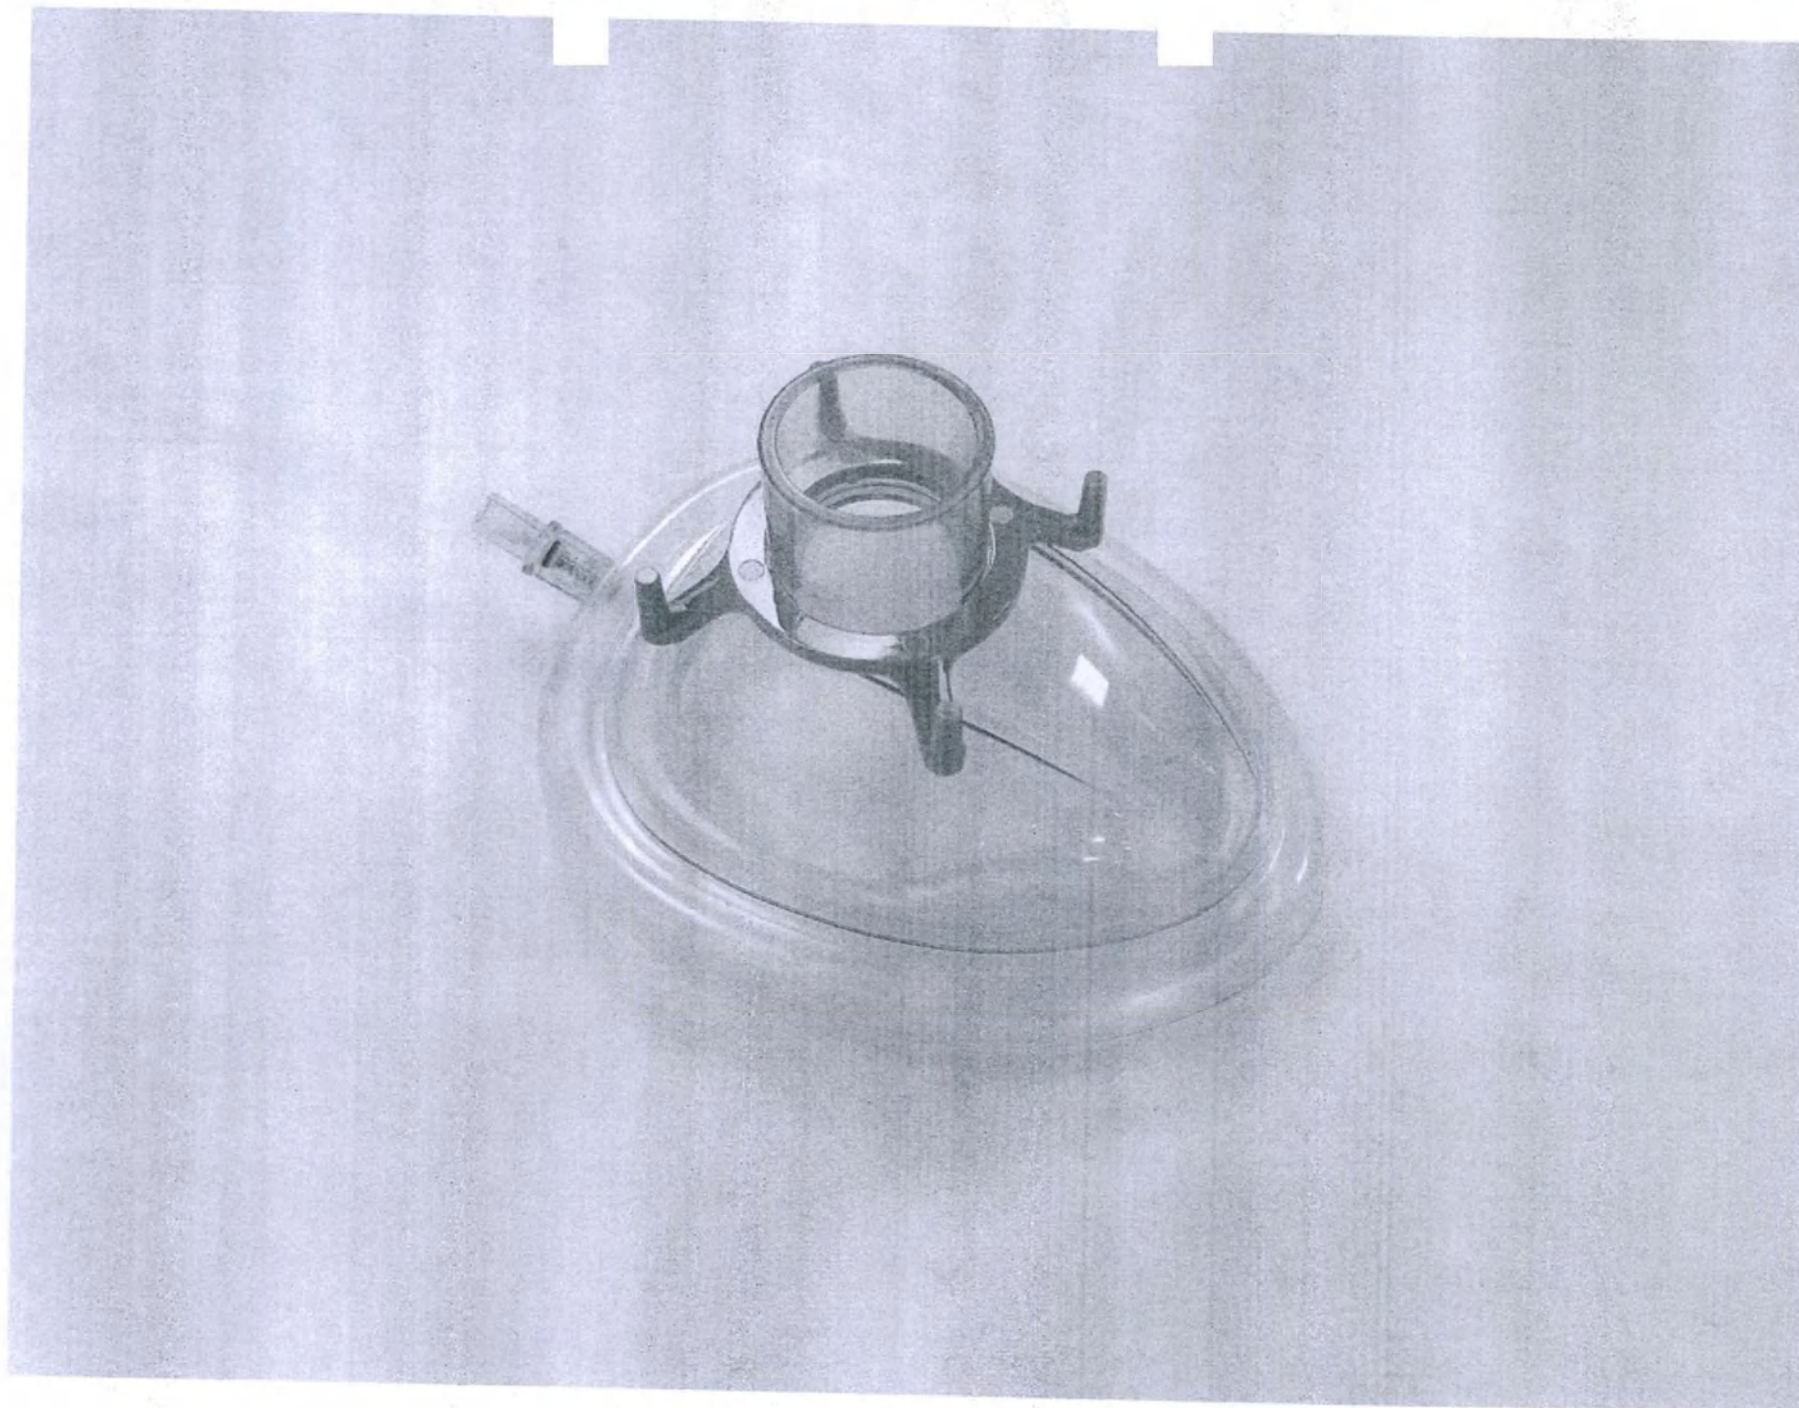


Рис. 45 Маска дыхательная наркозная, размер 3

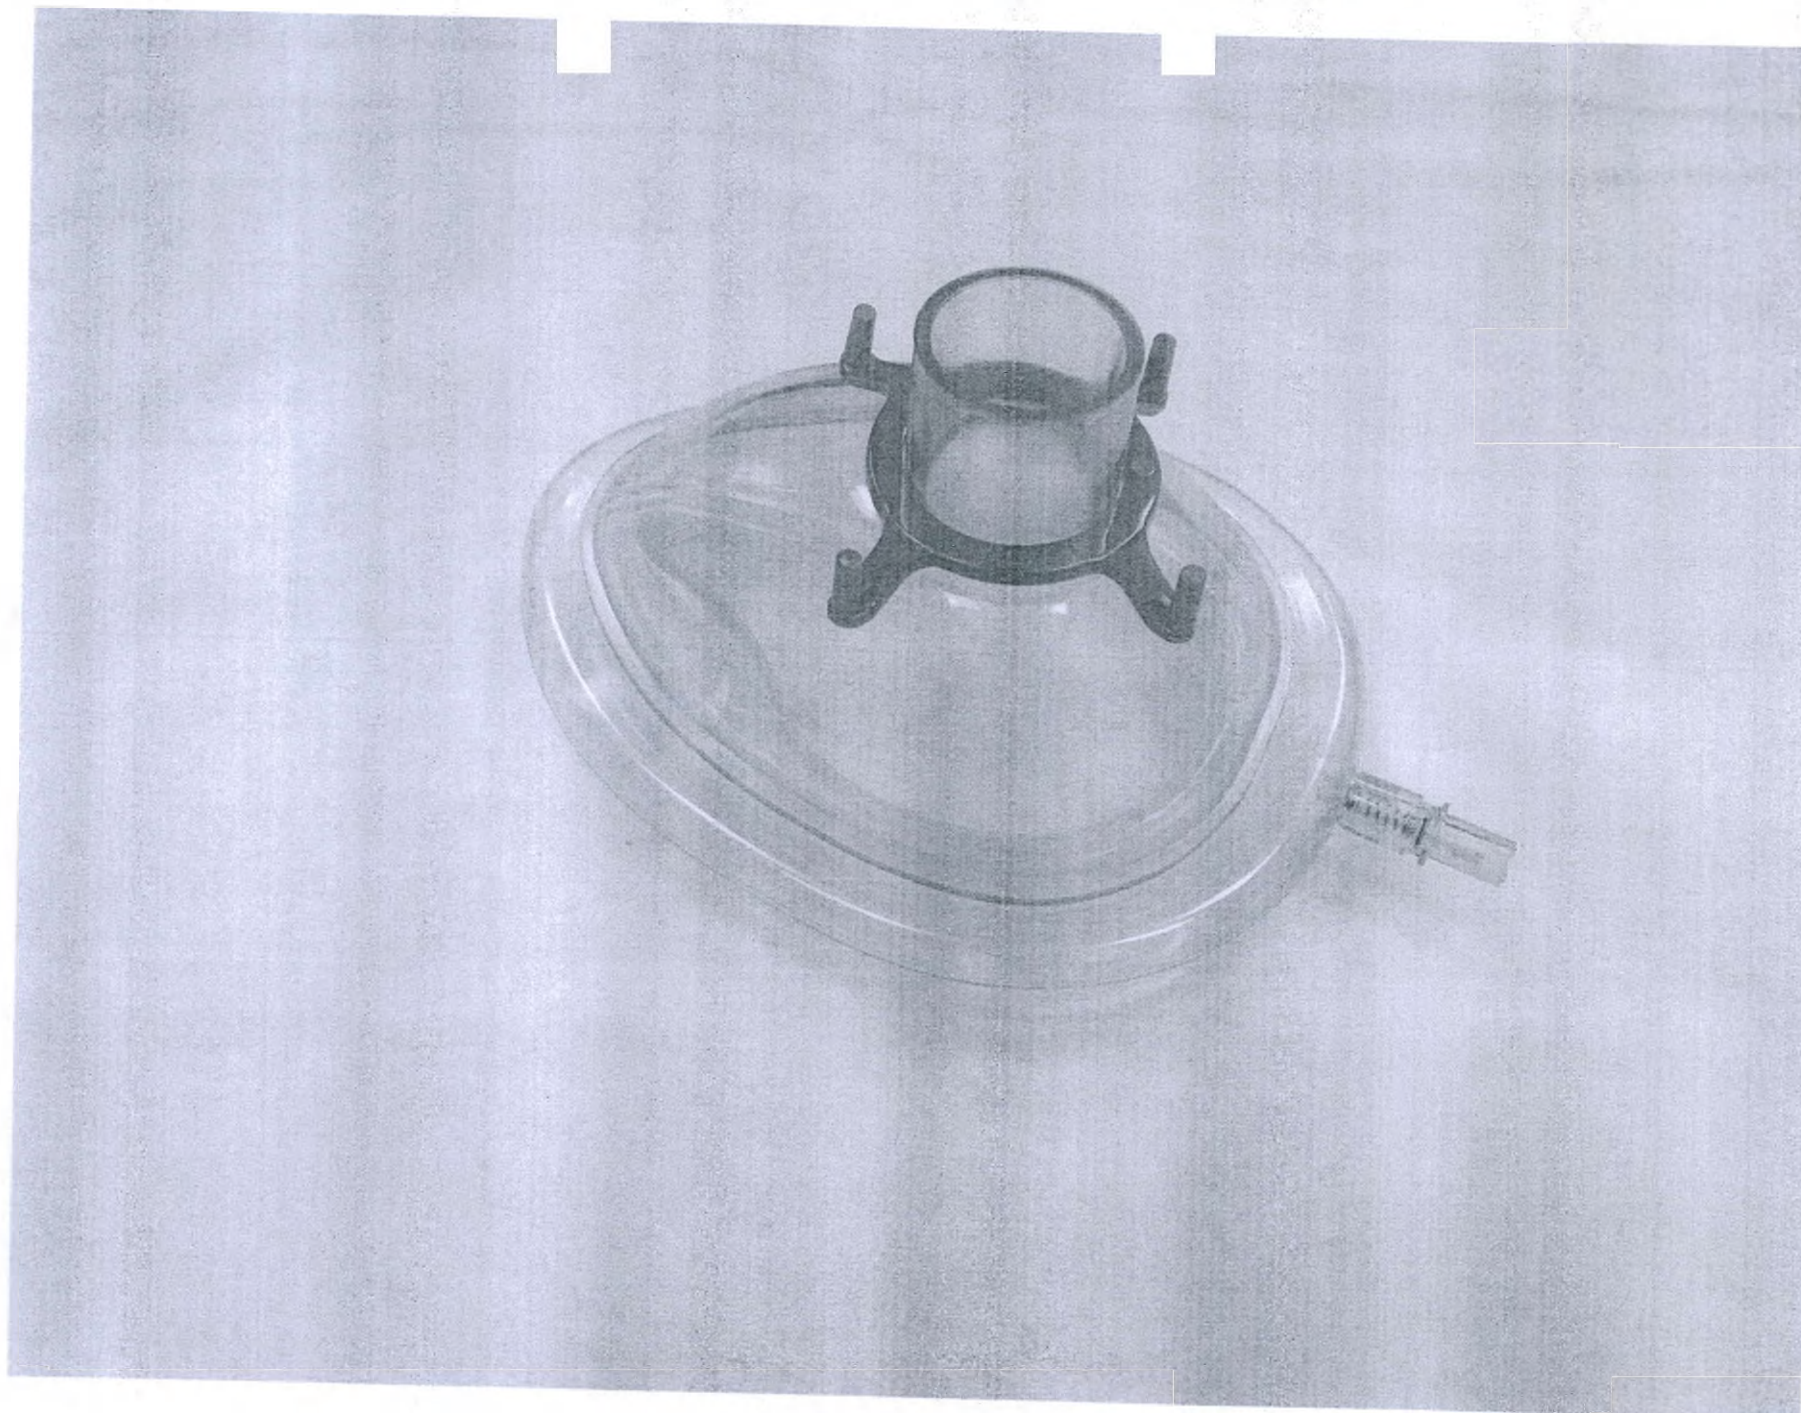


Рис. 46 Маска дыхательная наркозная, размер 4

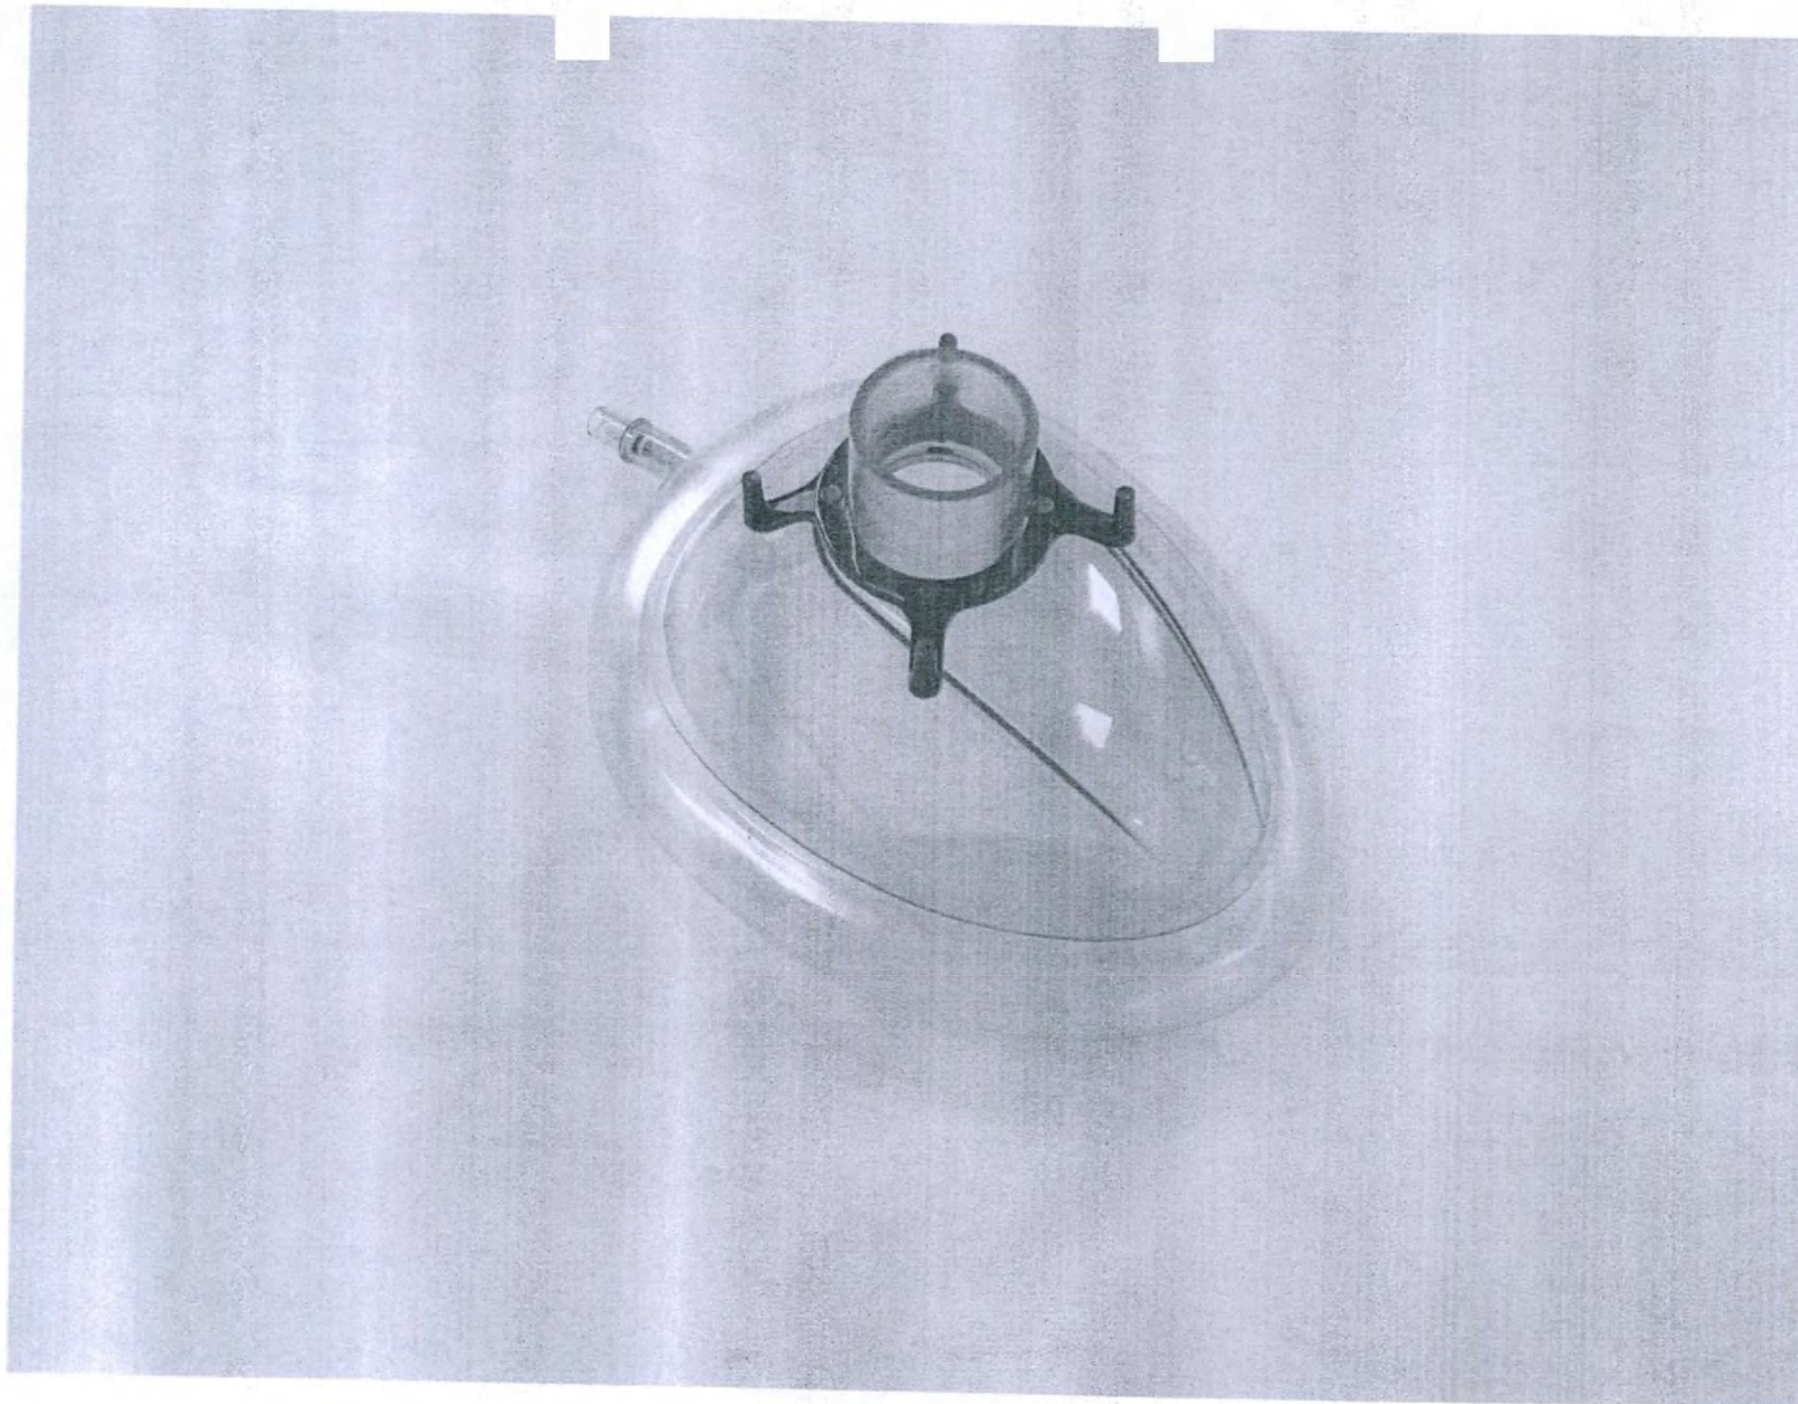


Рис. 47 Маска дыхательная наркозная, размер 5

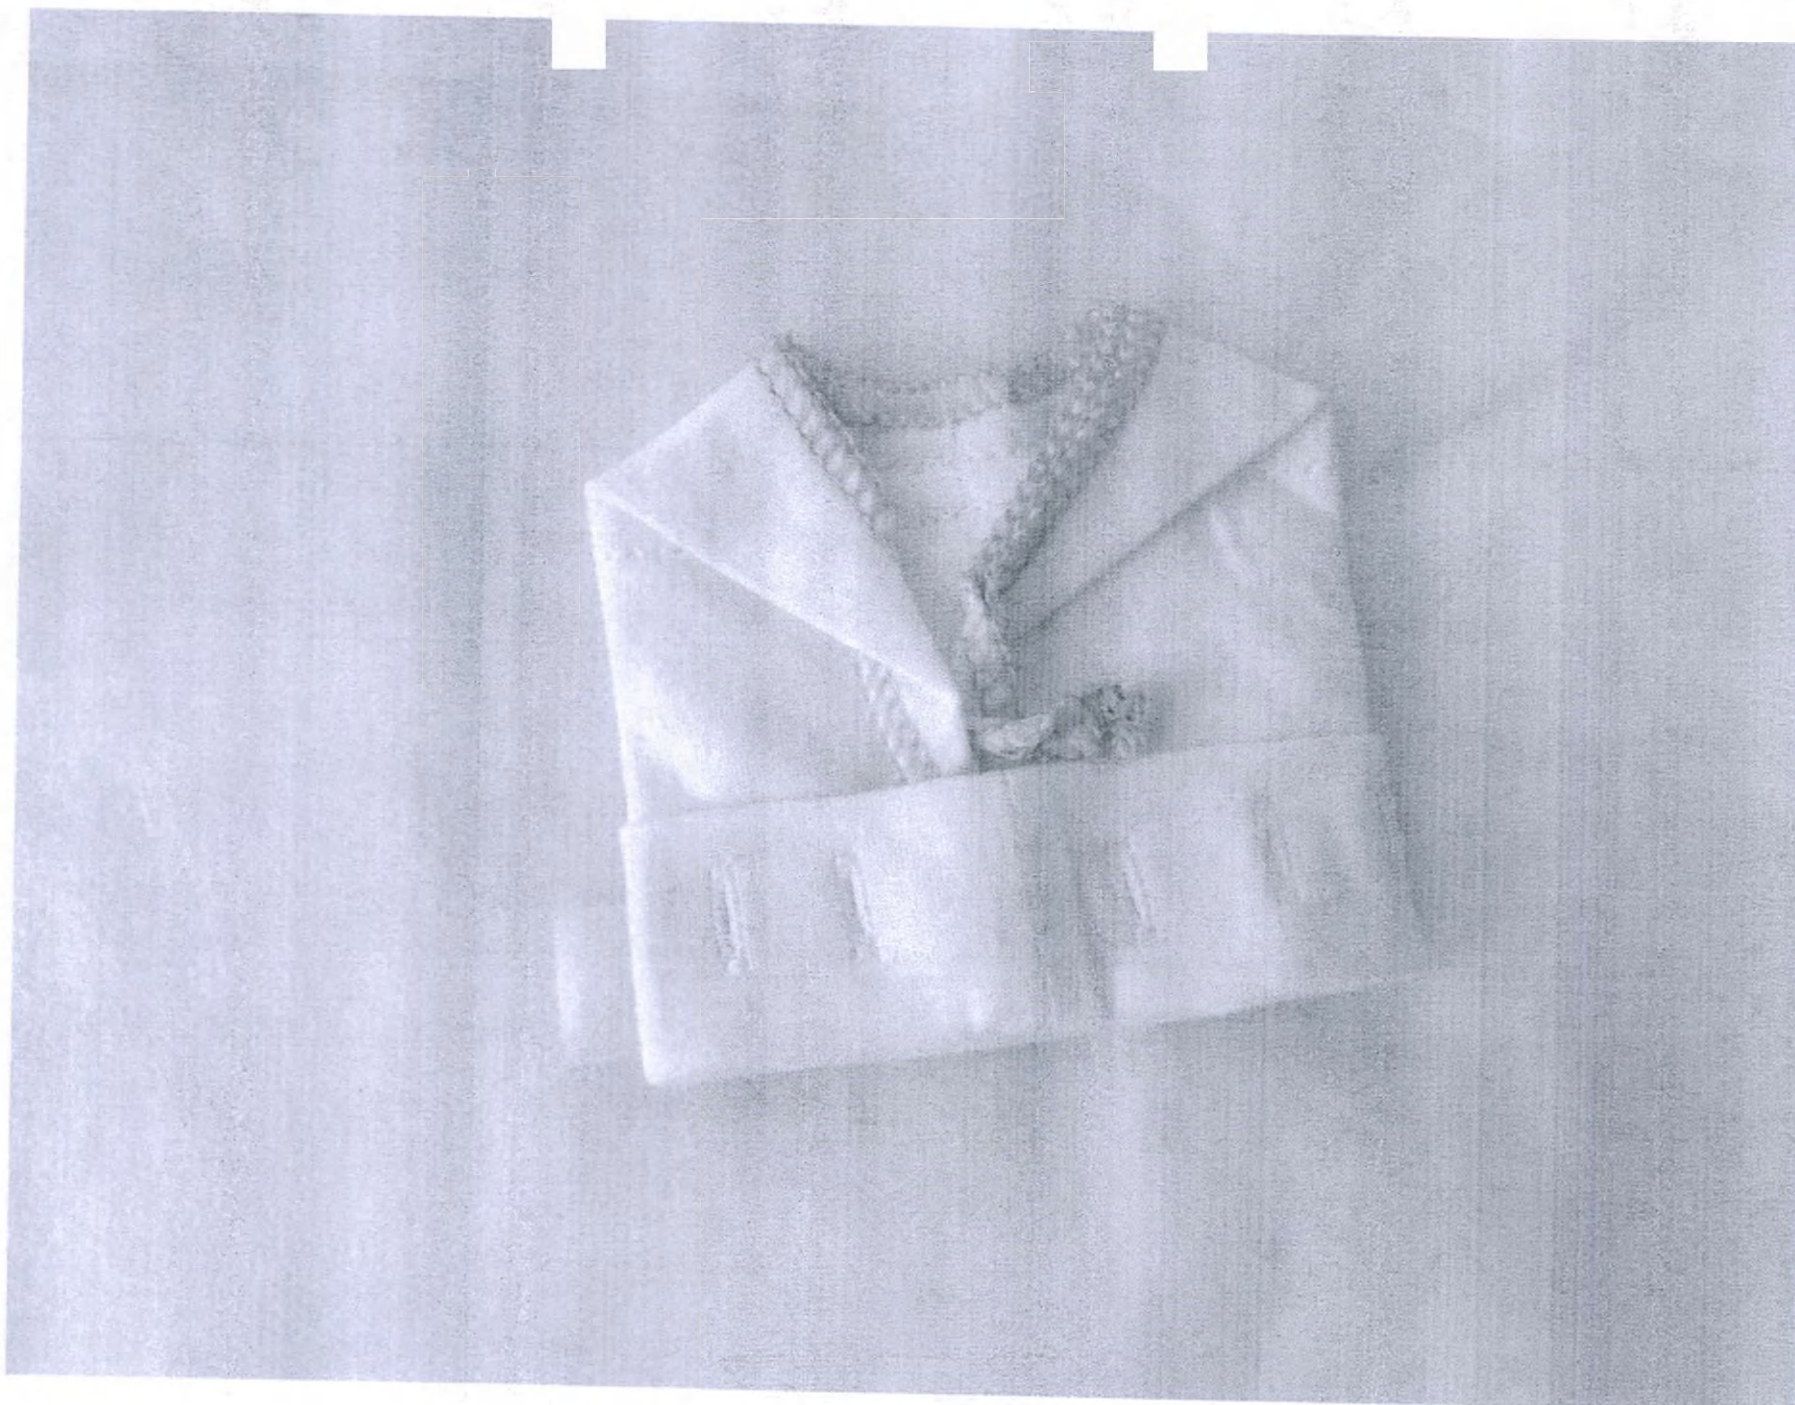


Рис. 48 Шапочка-фиксатор, размер 00

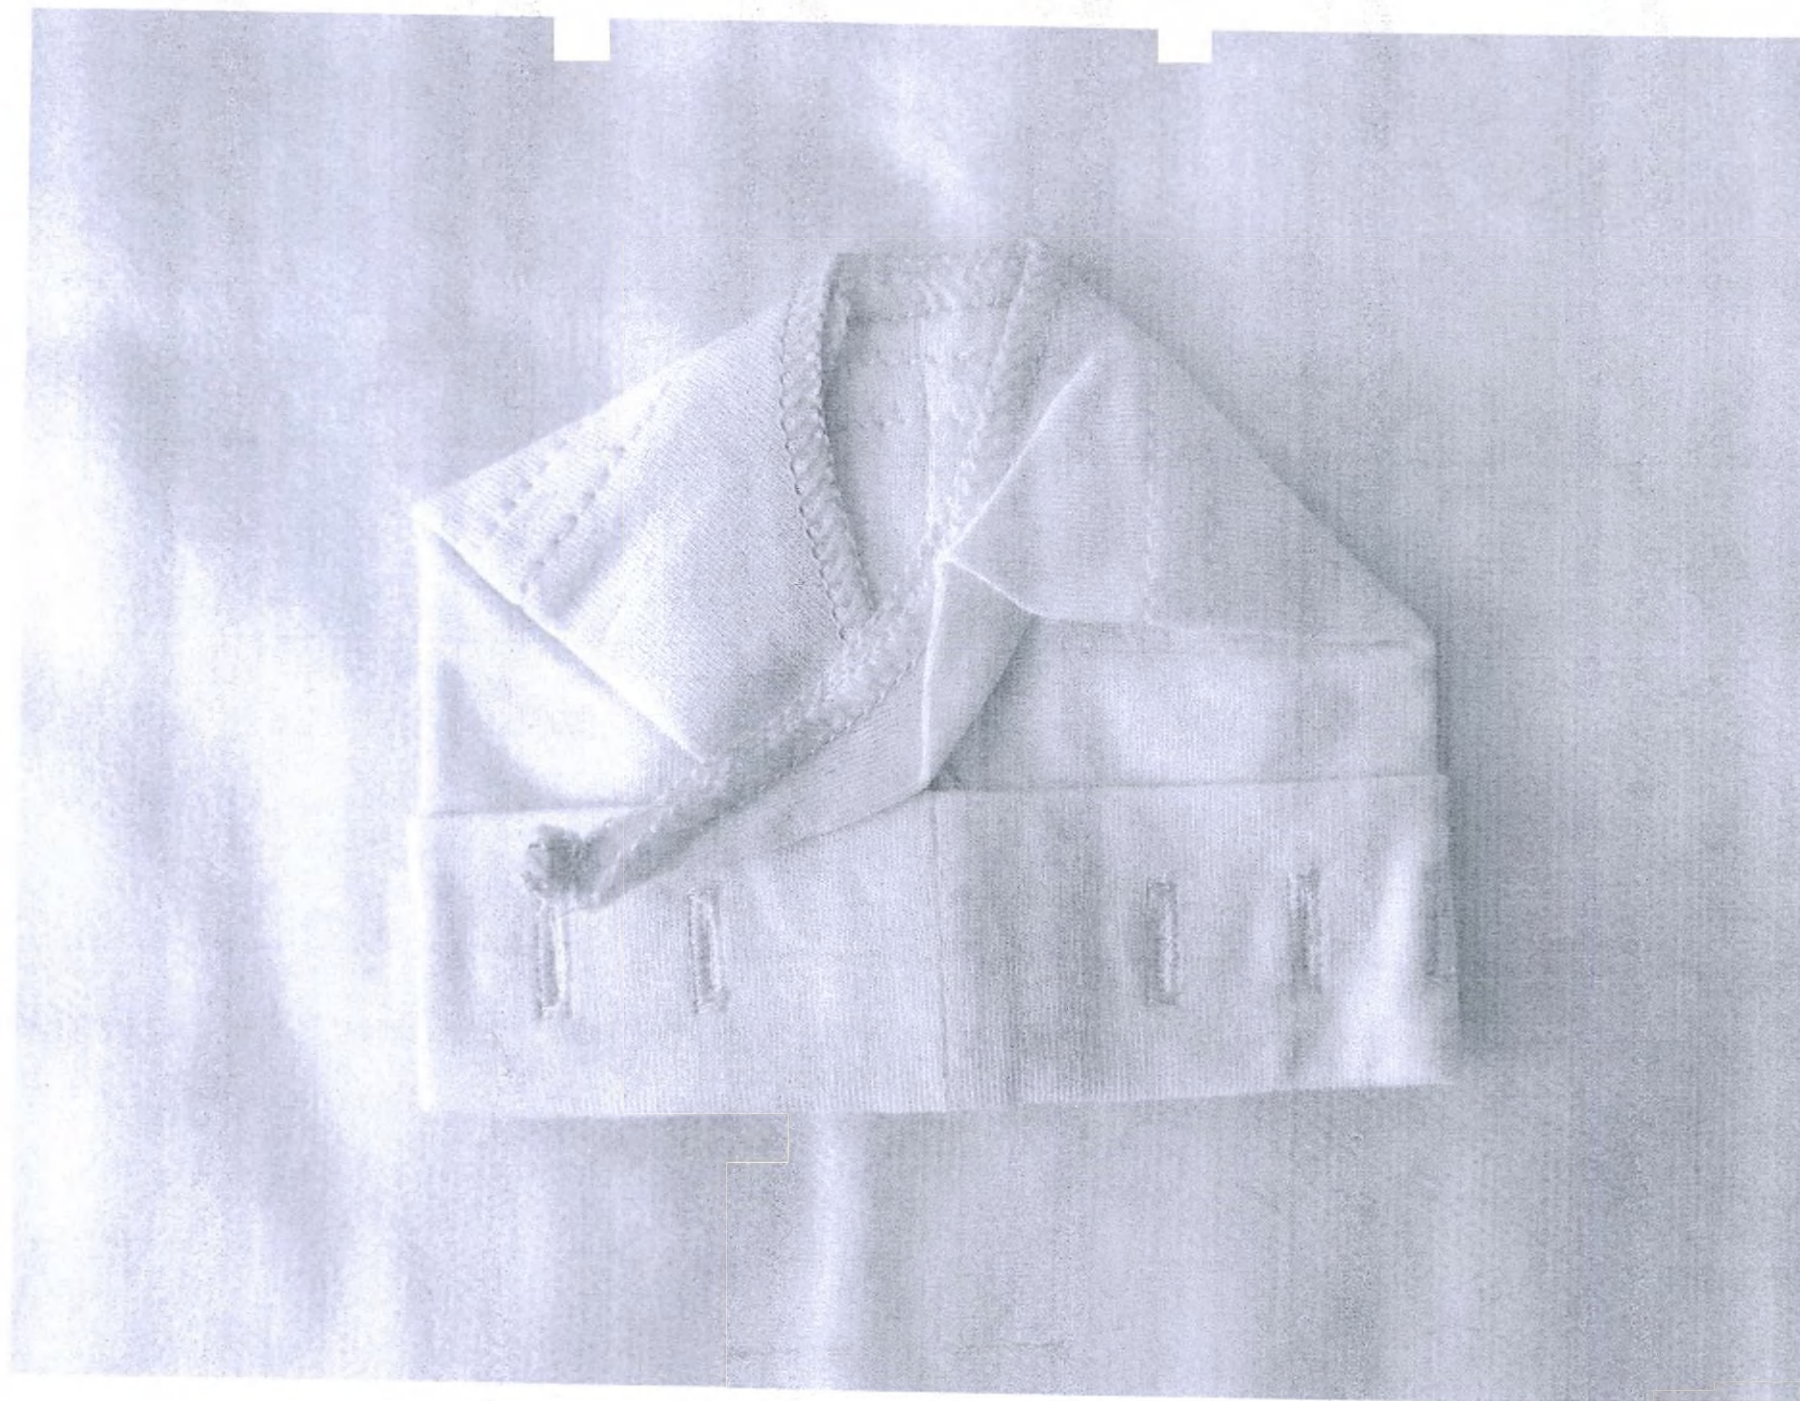


Рис. 49 Шапочка-фиксатор, размер 0

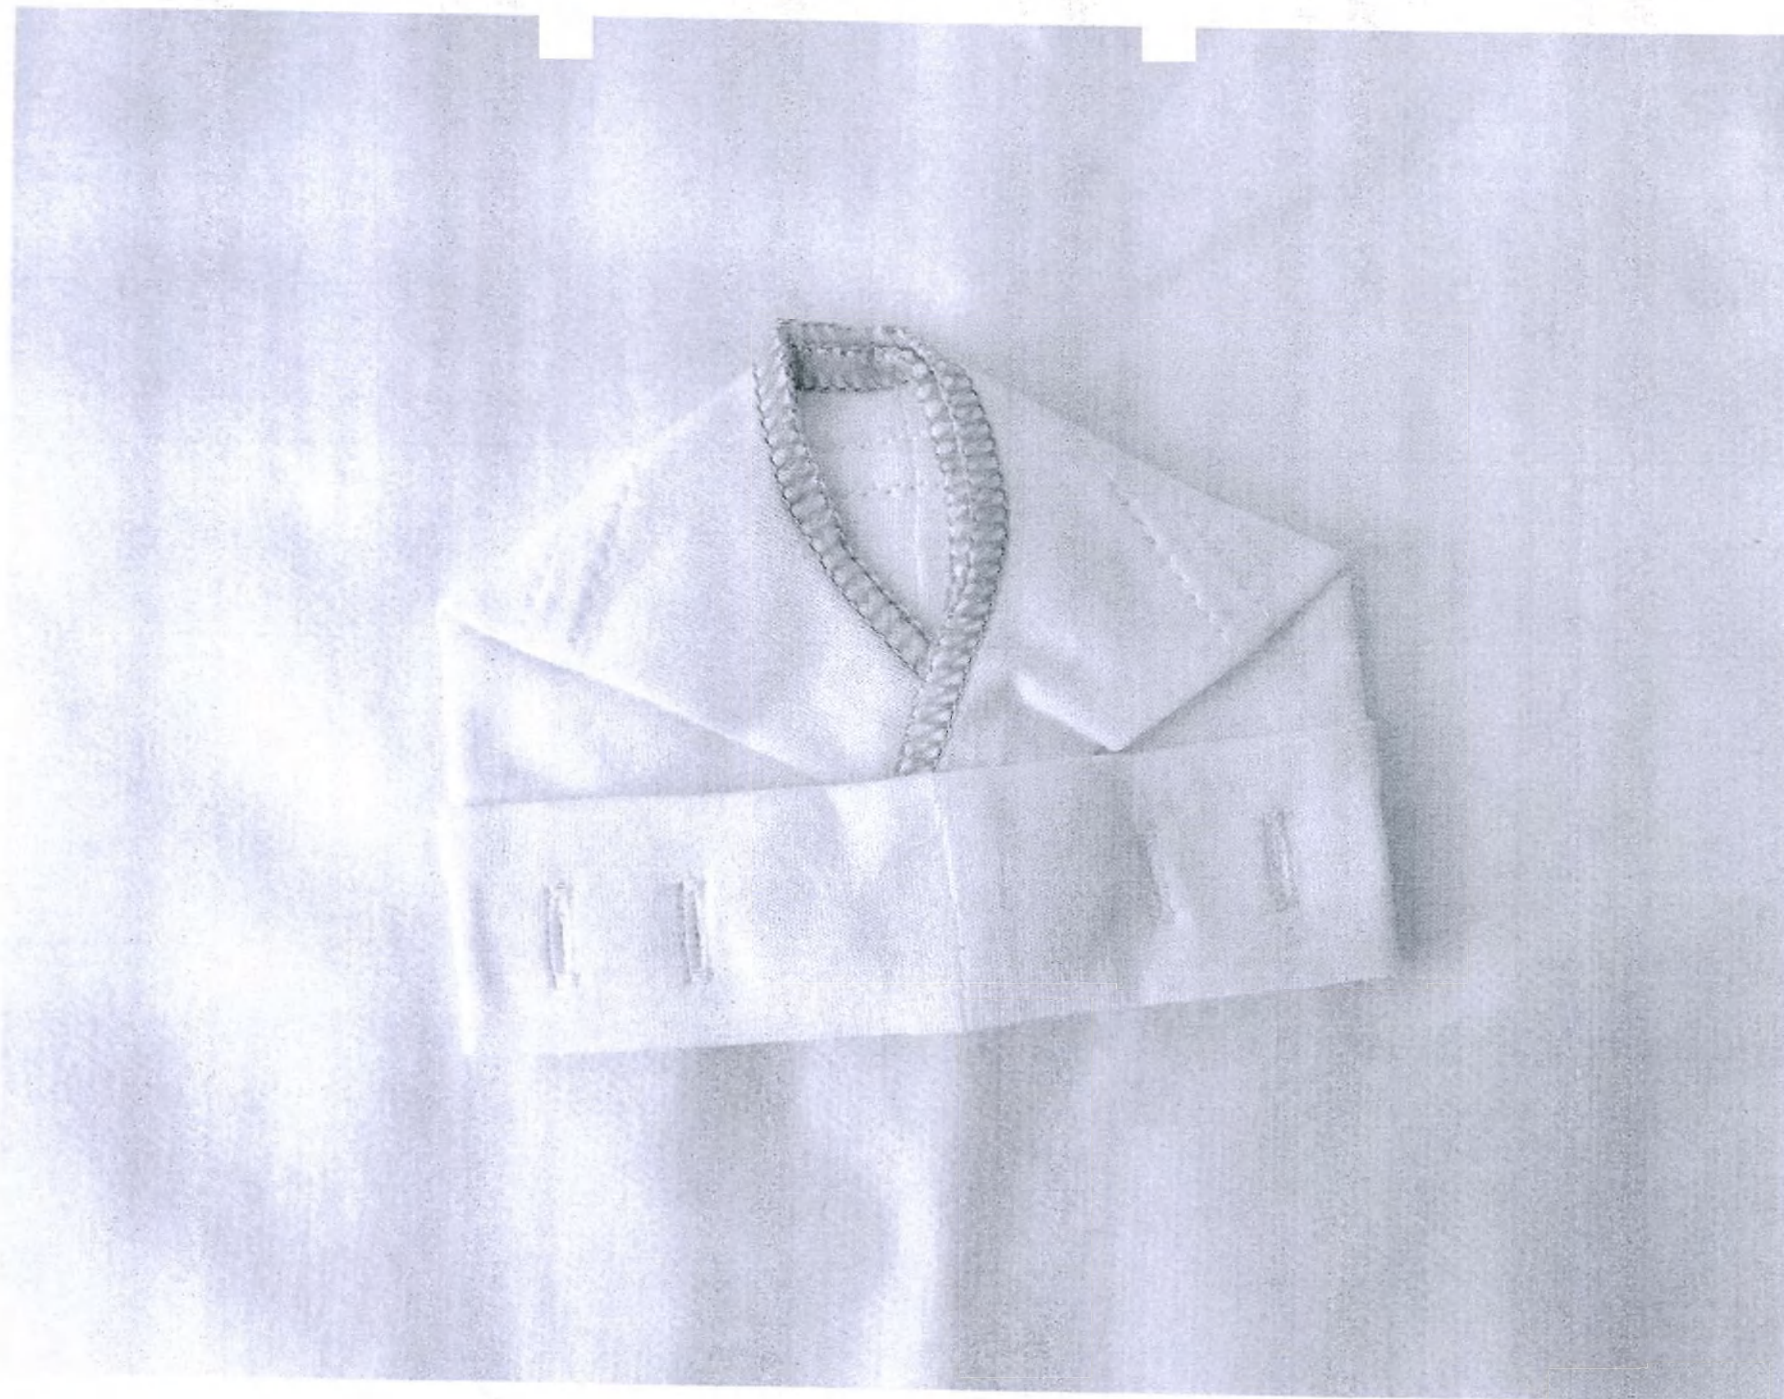


Рис. 50 Шапочка-фиксатор, размер 1

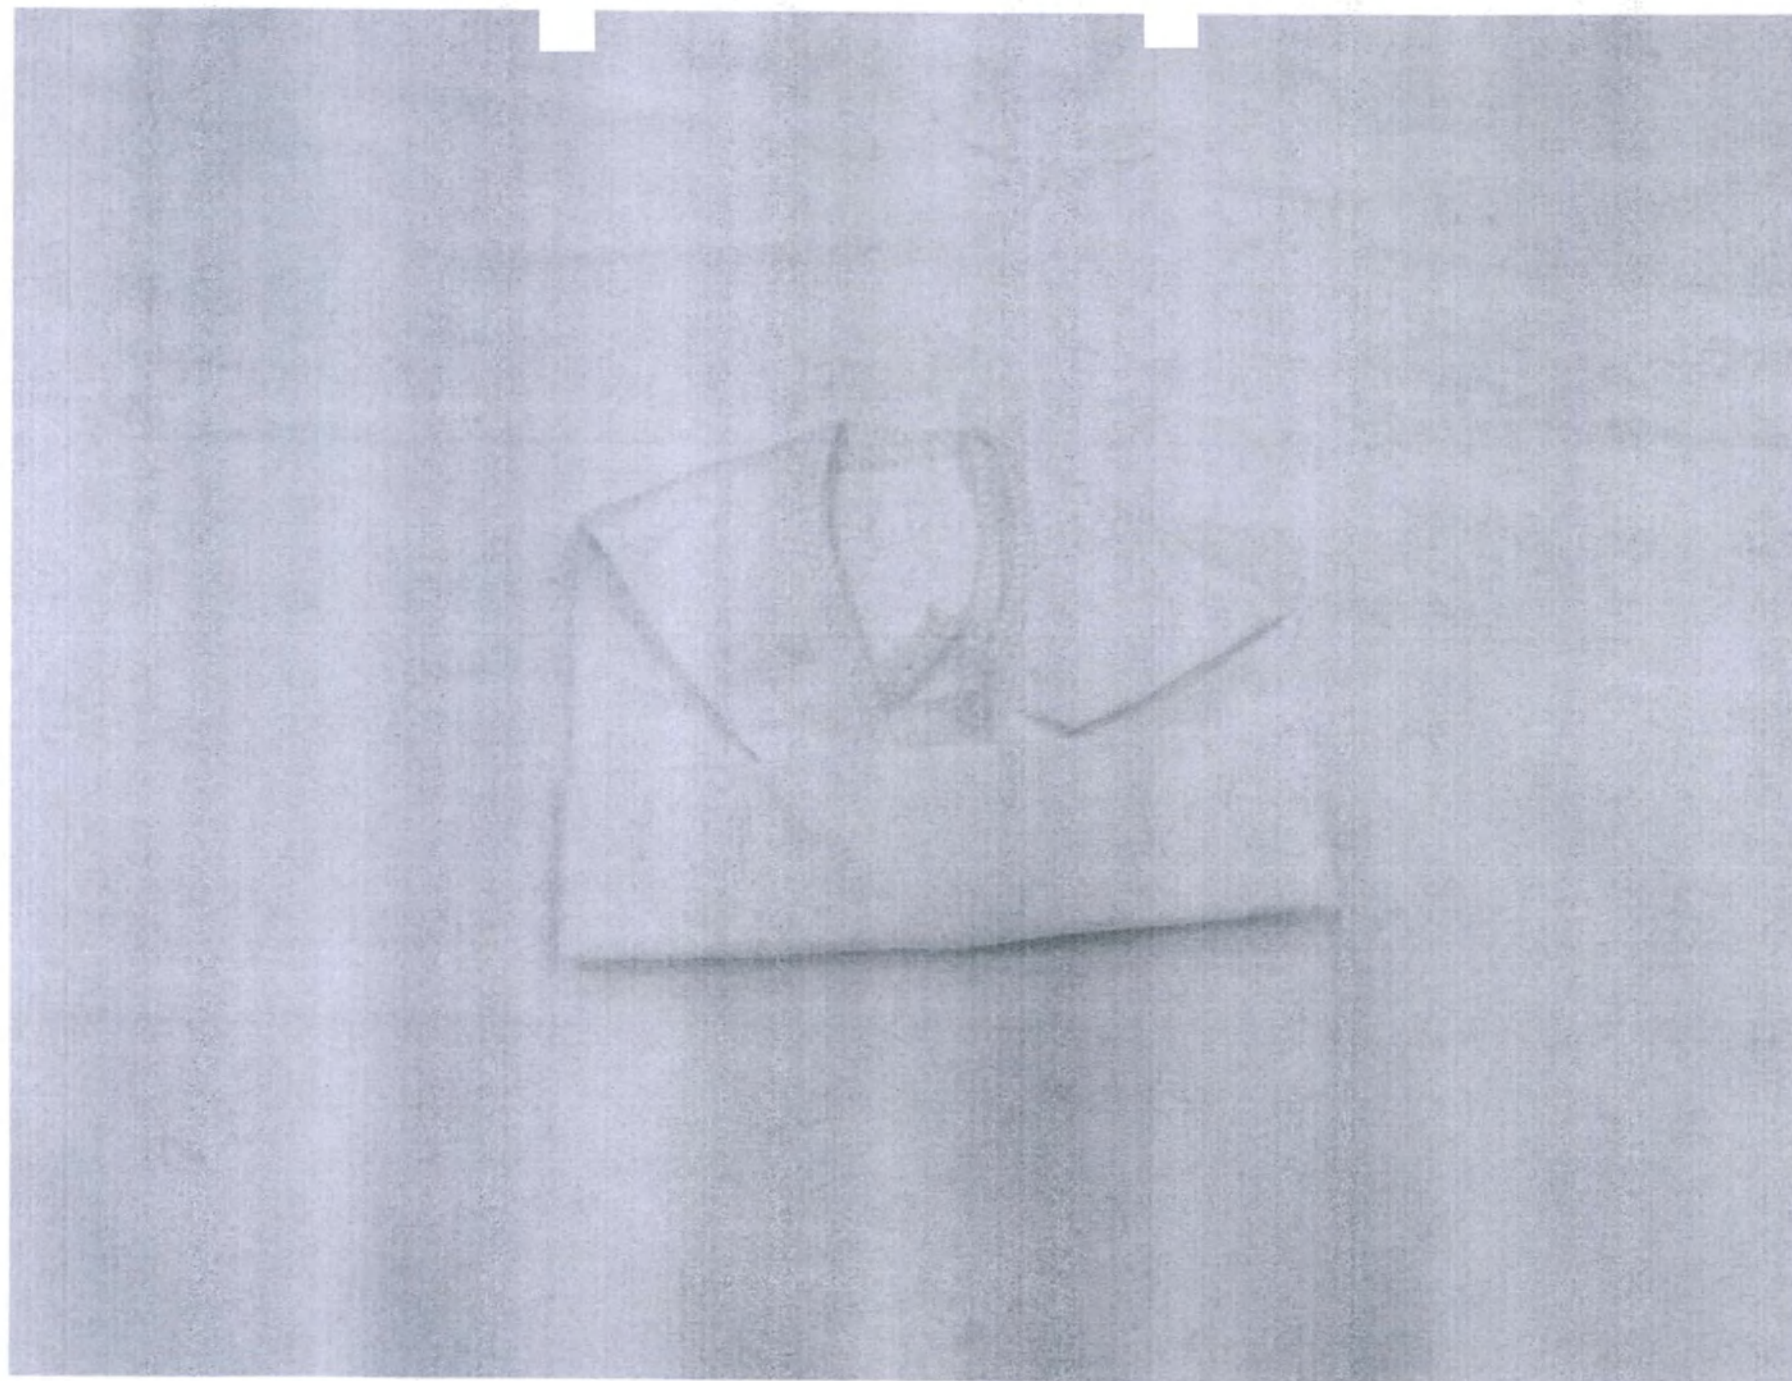


Рис. 51 Шапочка-фиксатор, размер 2

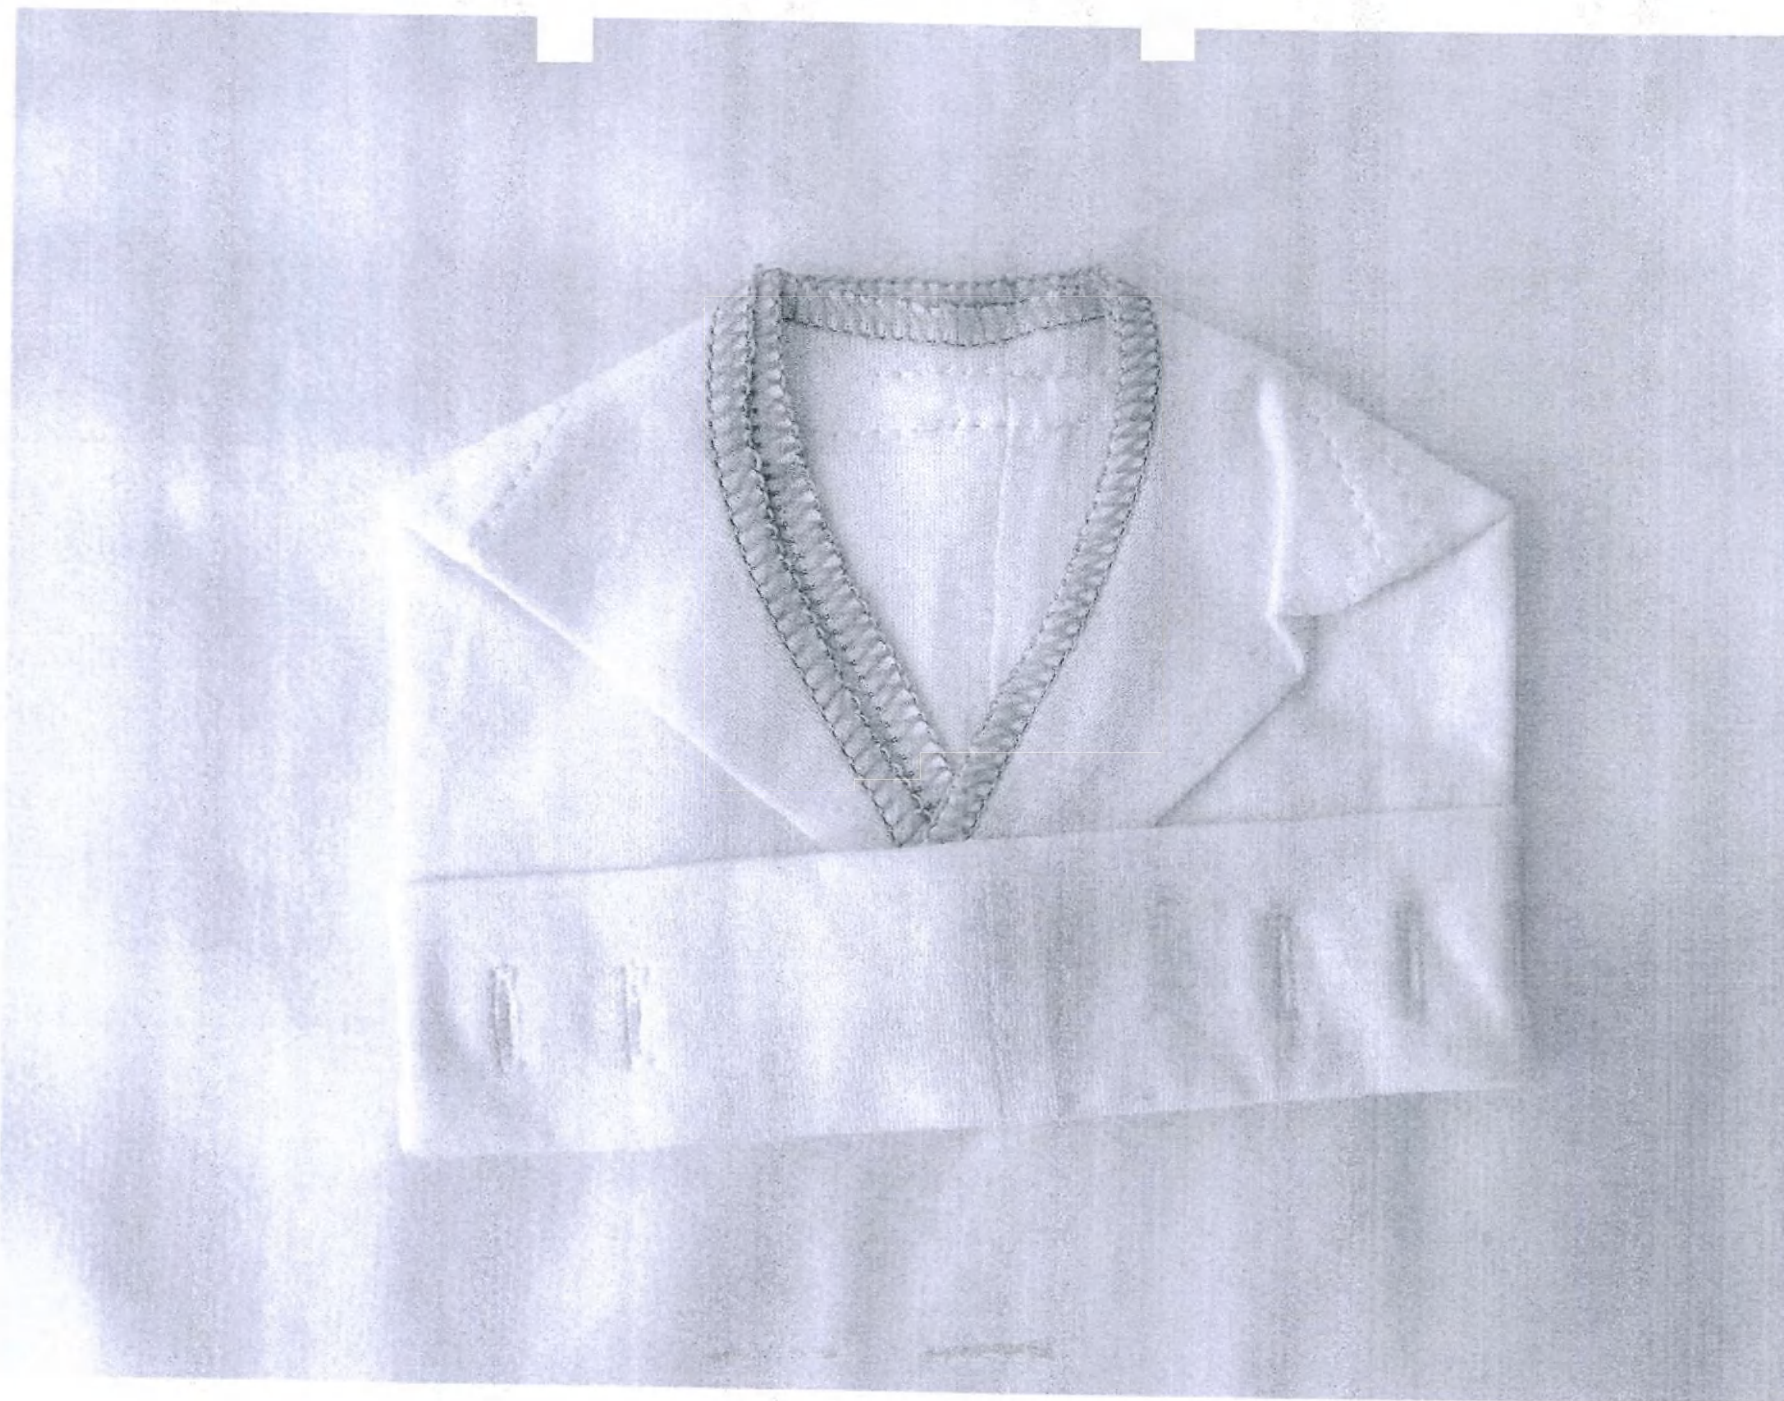


Рис. 52 Шапочка-фиксатор, размер 3

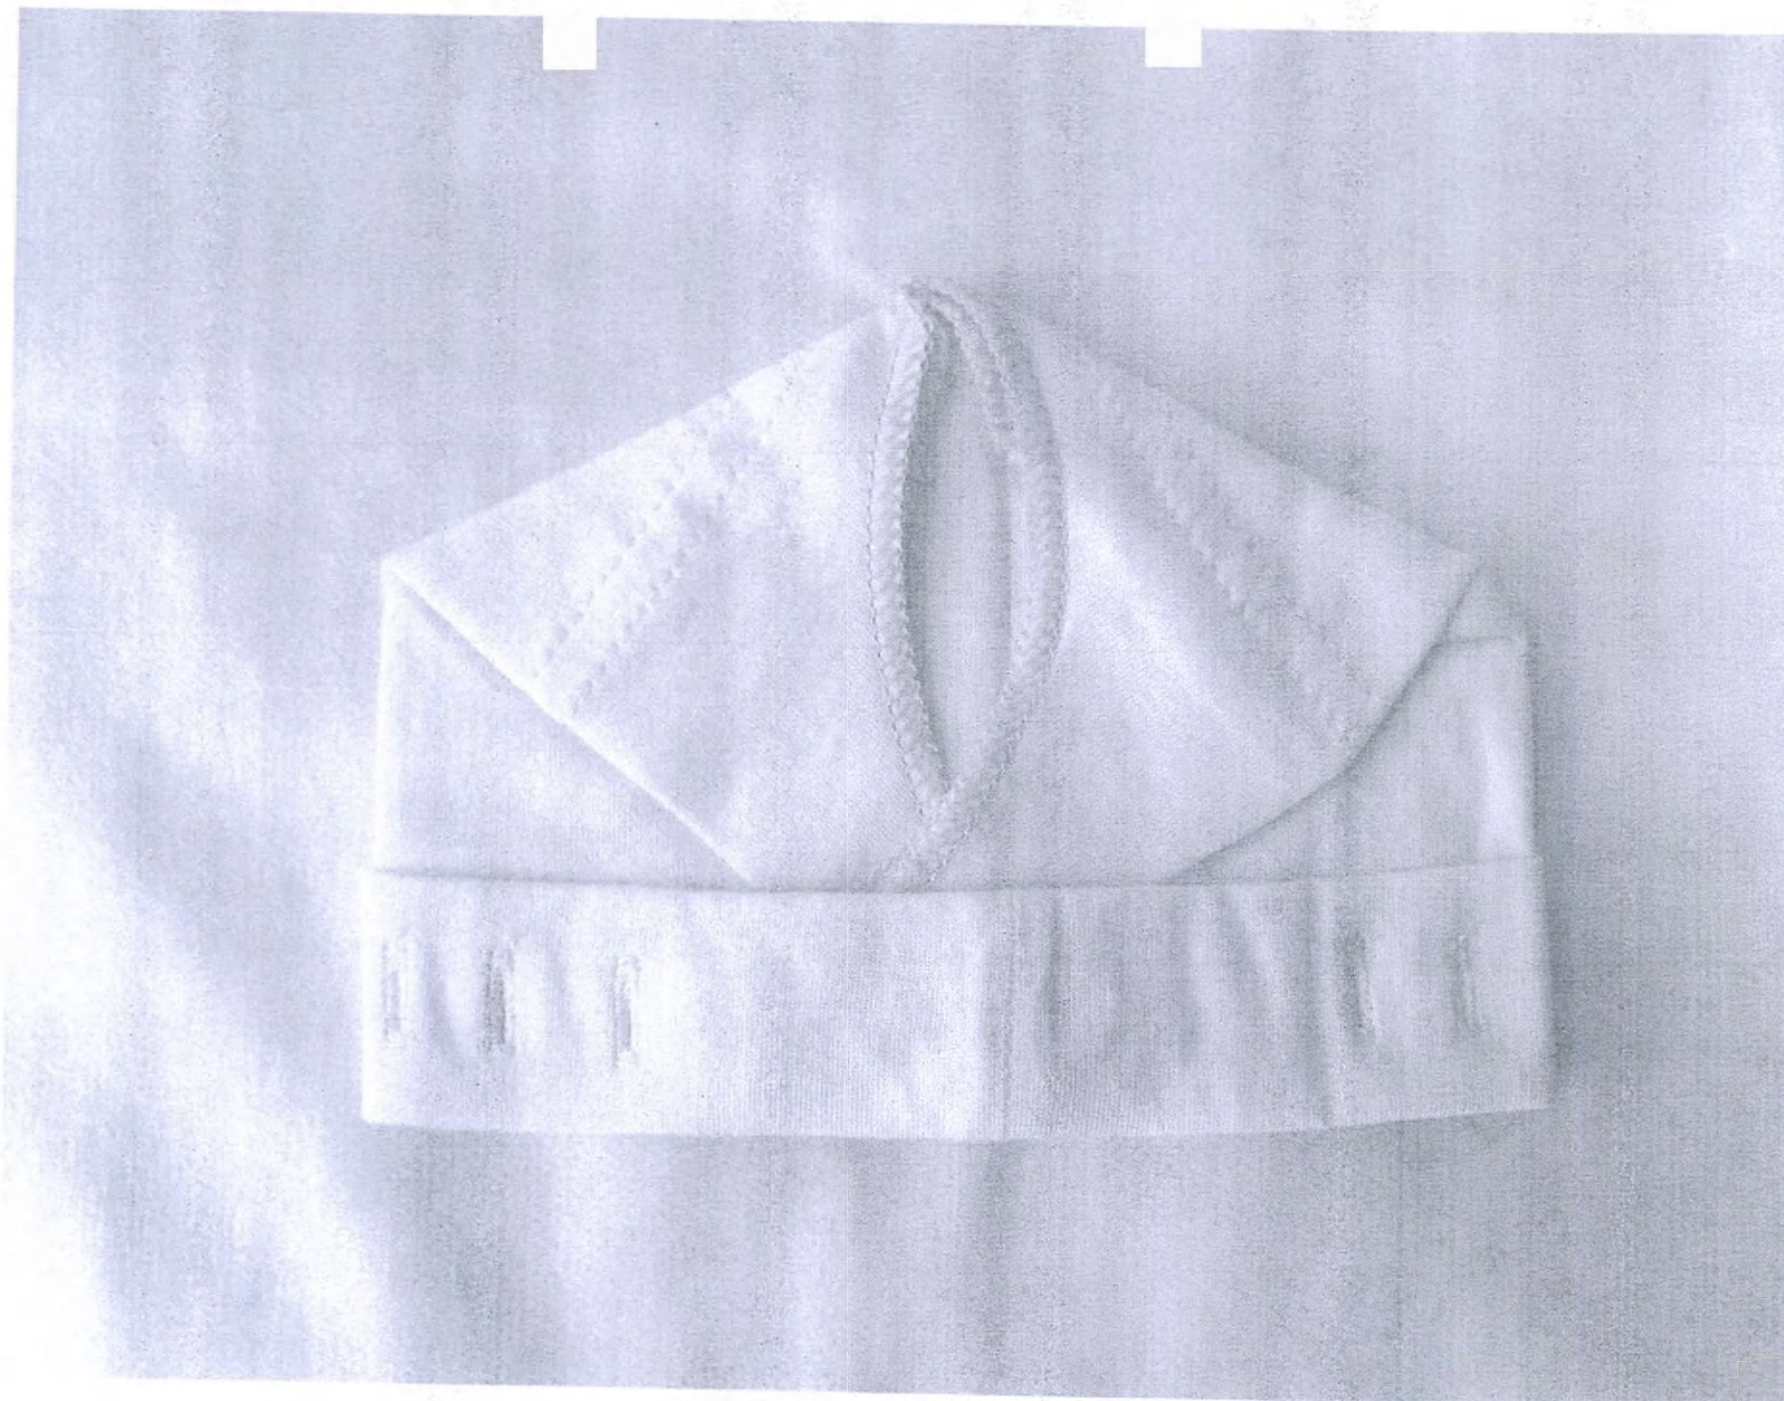


Рис. 53 Шапочка-фиксатор, размер 4

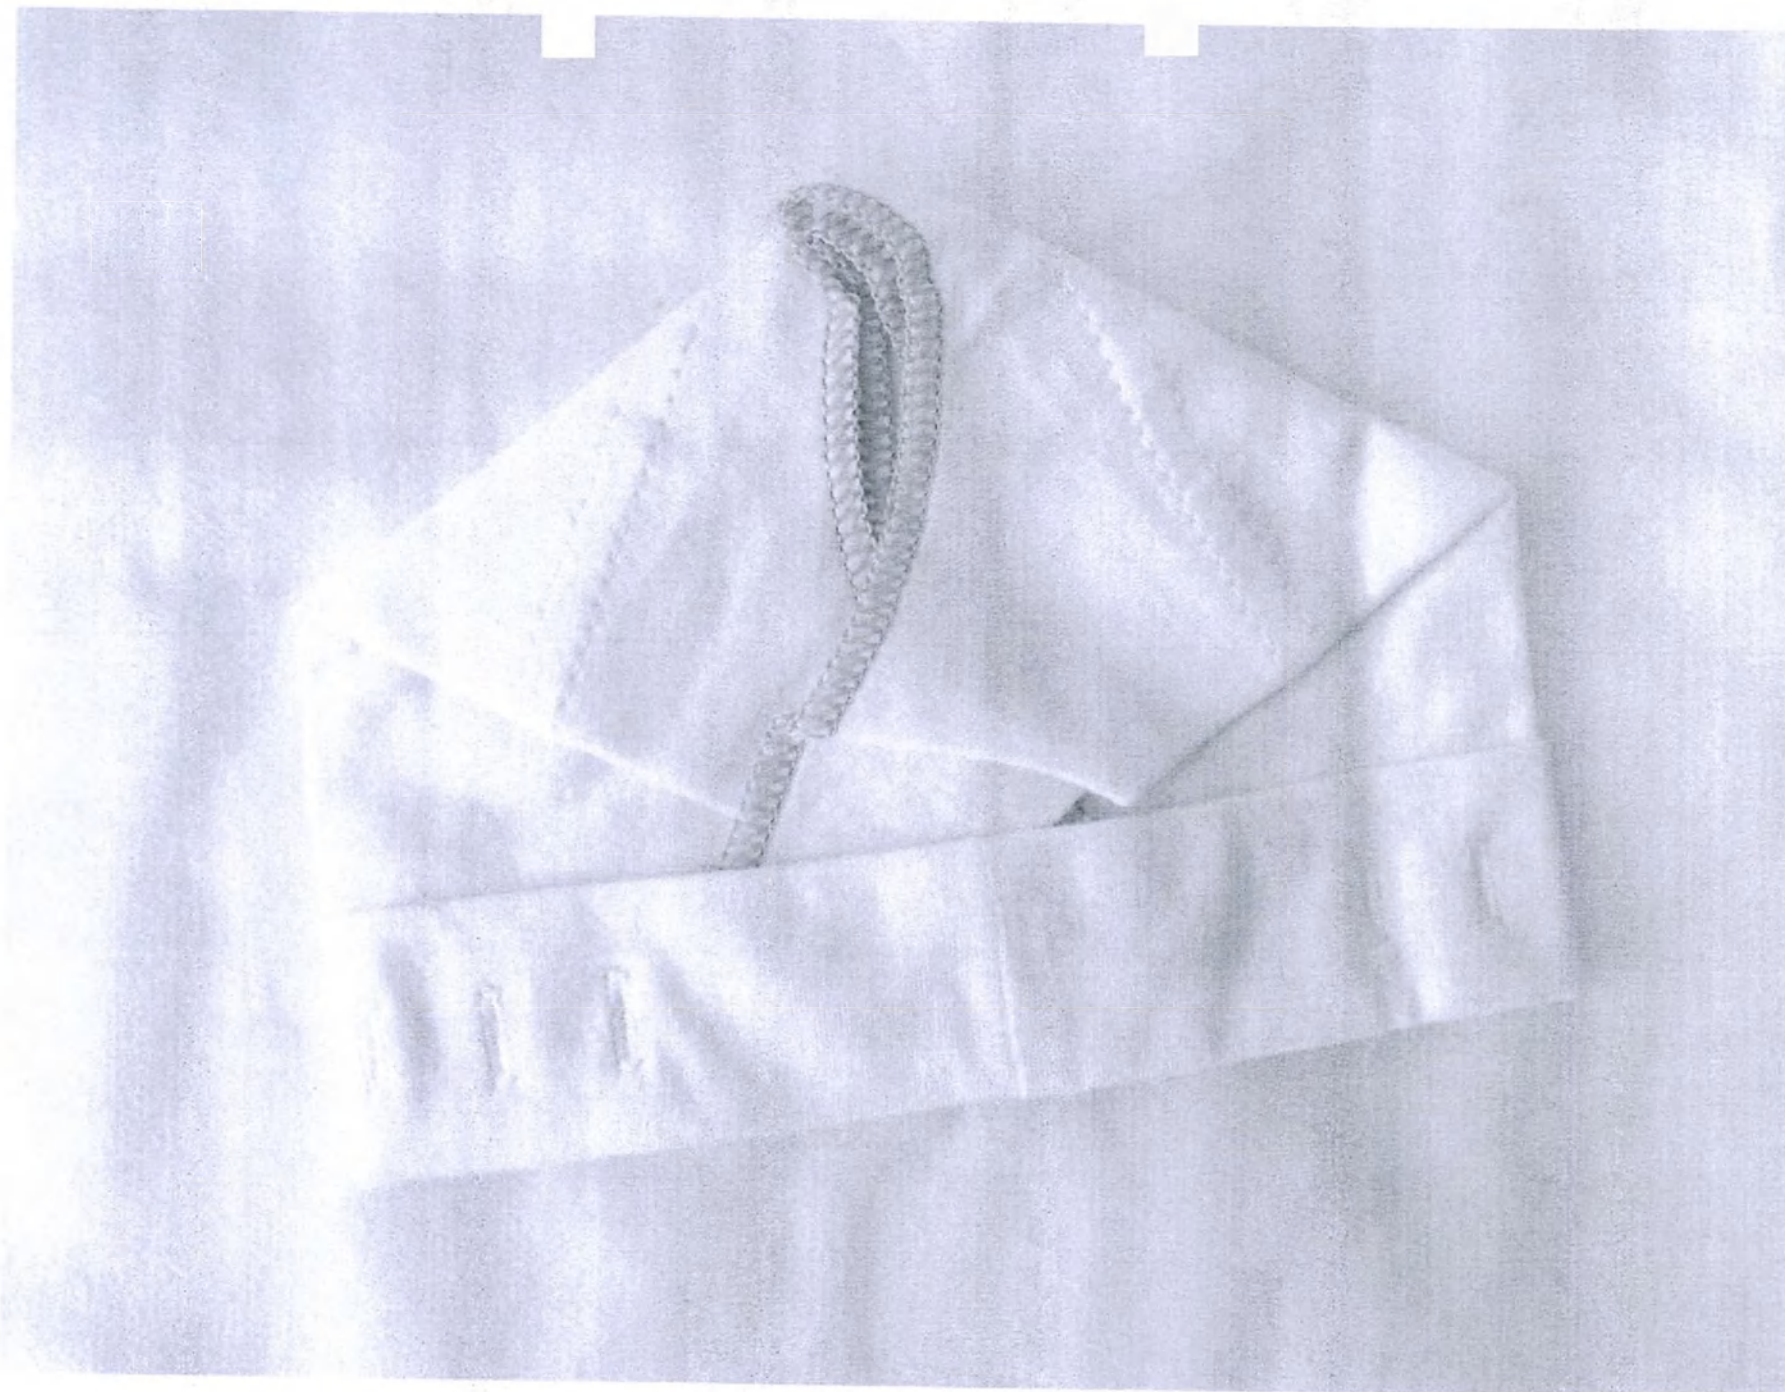


Рис. 54 Шапочка-фиксатор, размер 5

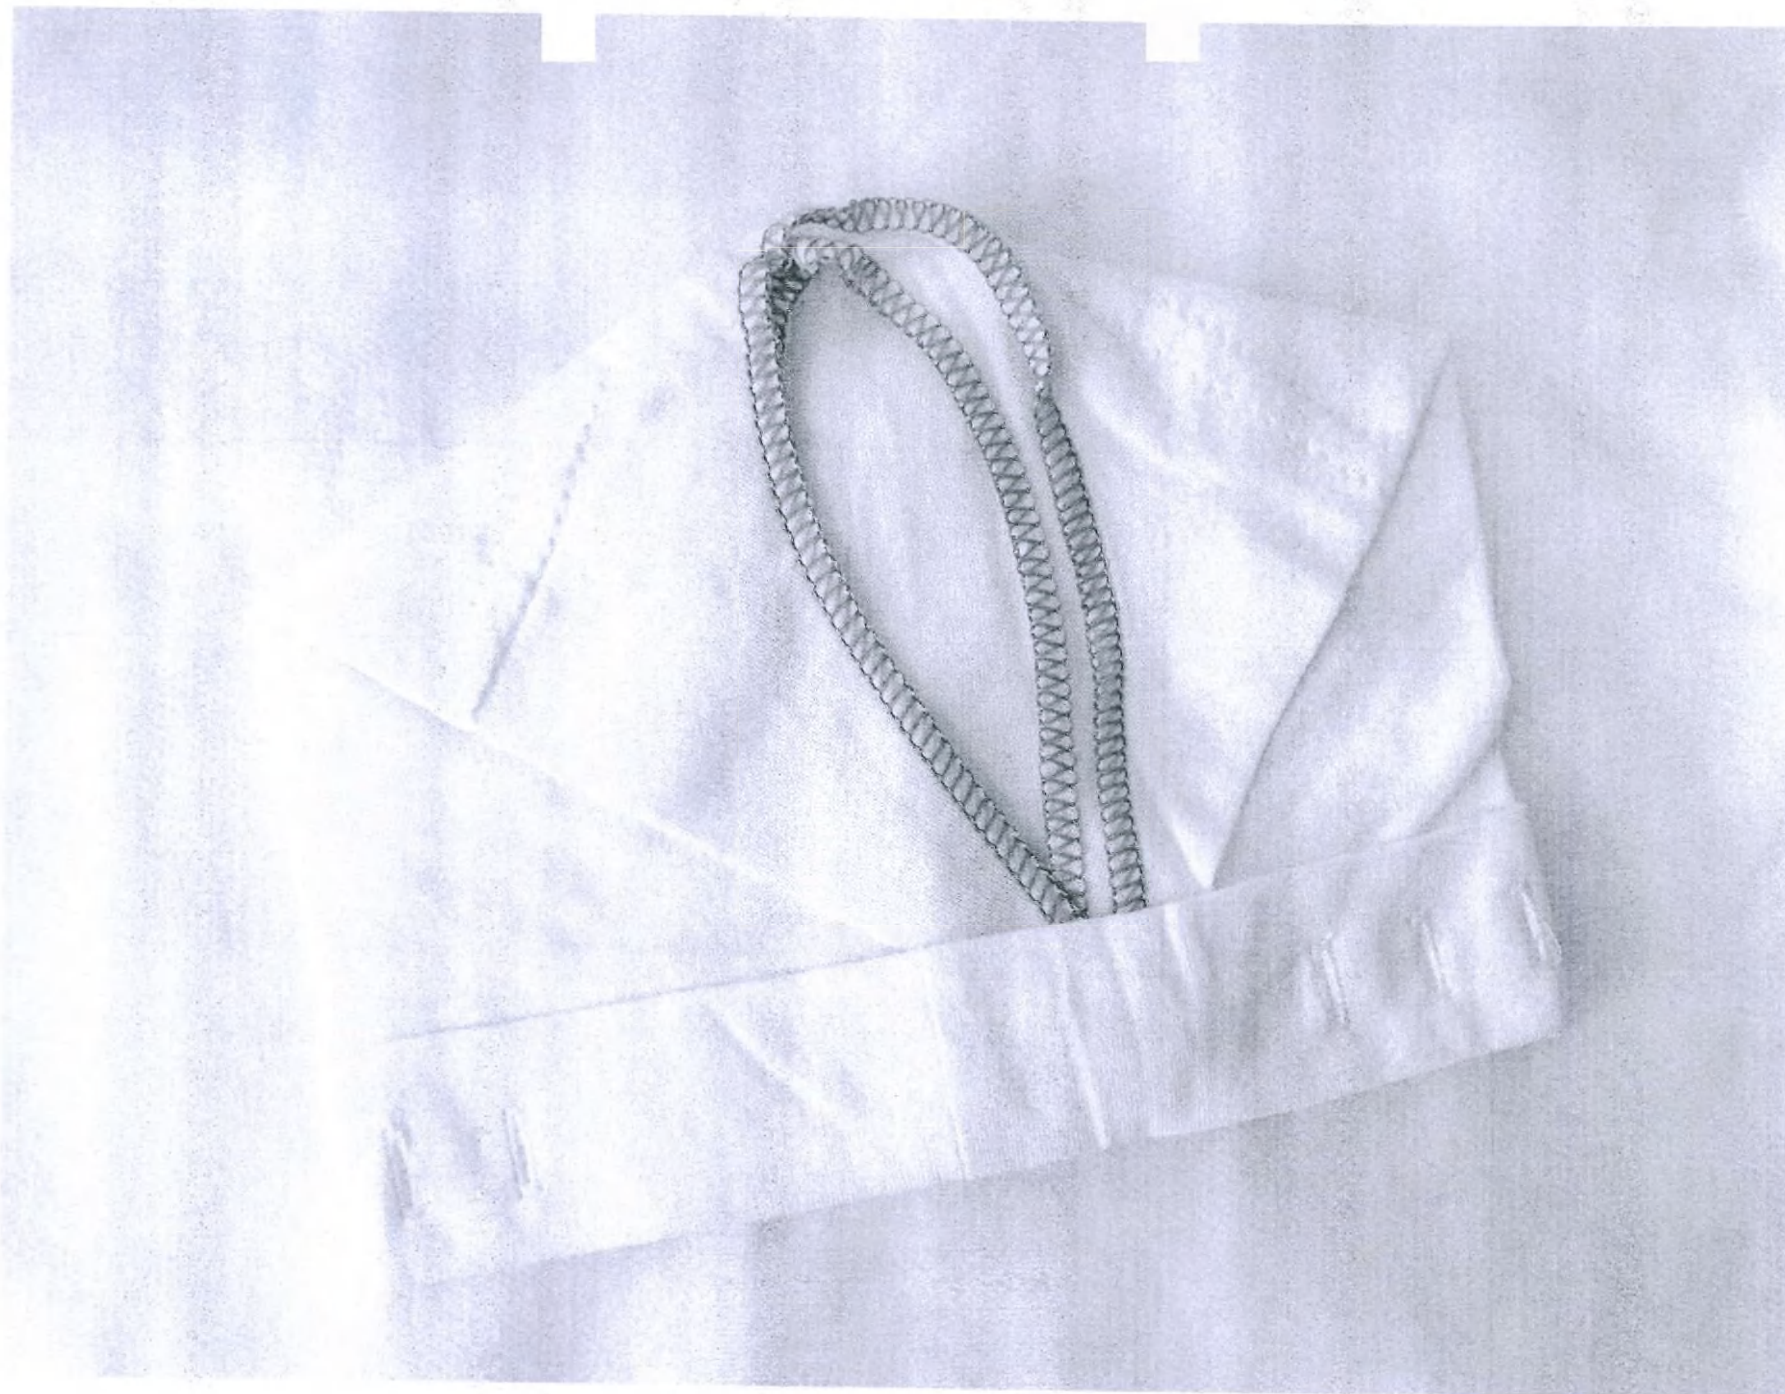


Рис. 55 Шапочка-фиксатор, размер 6

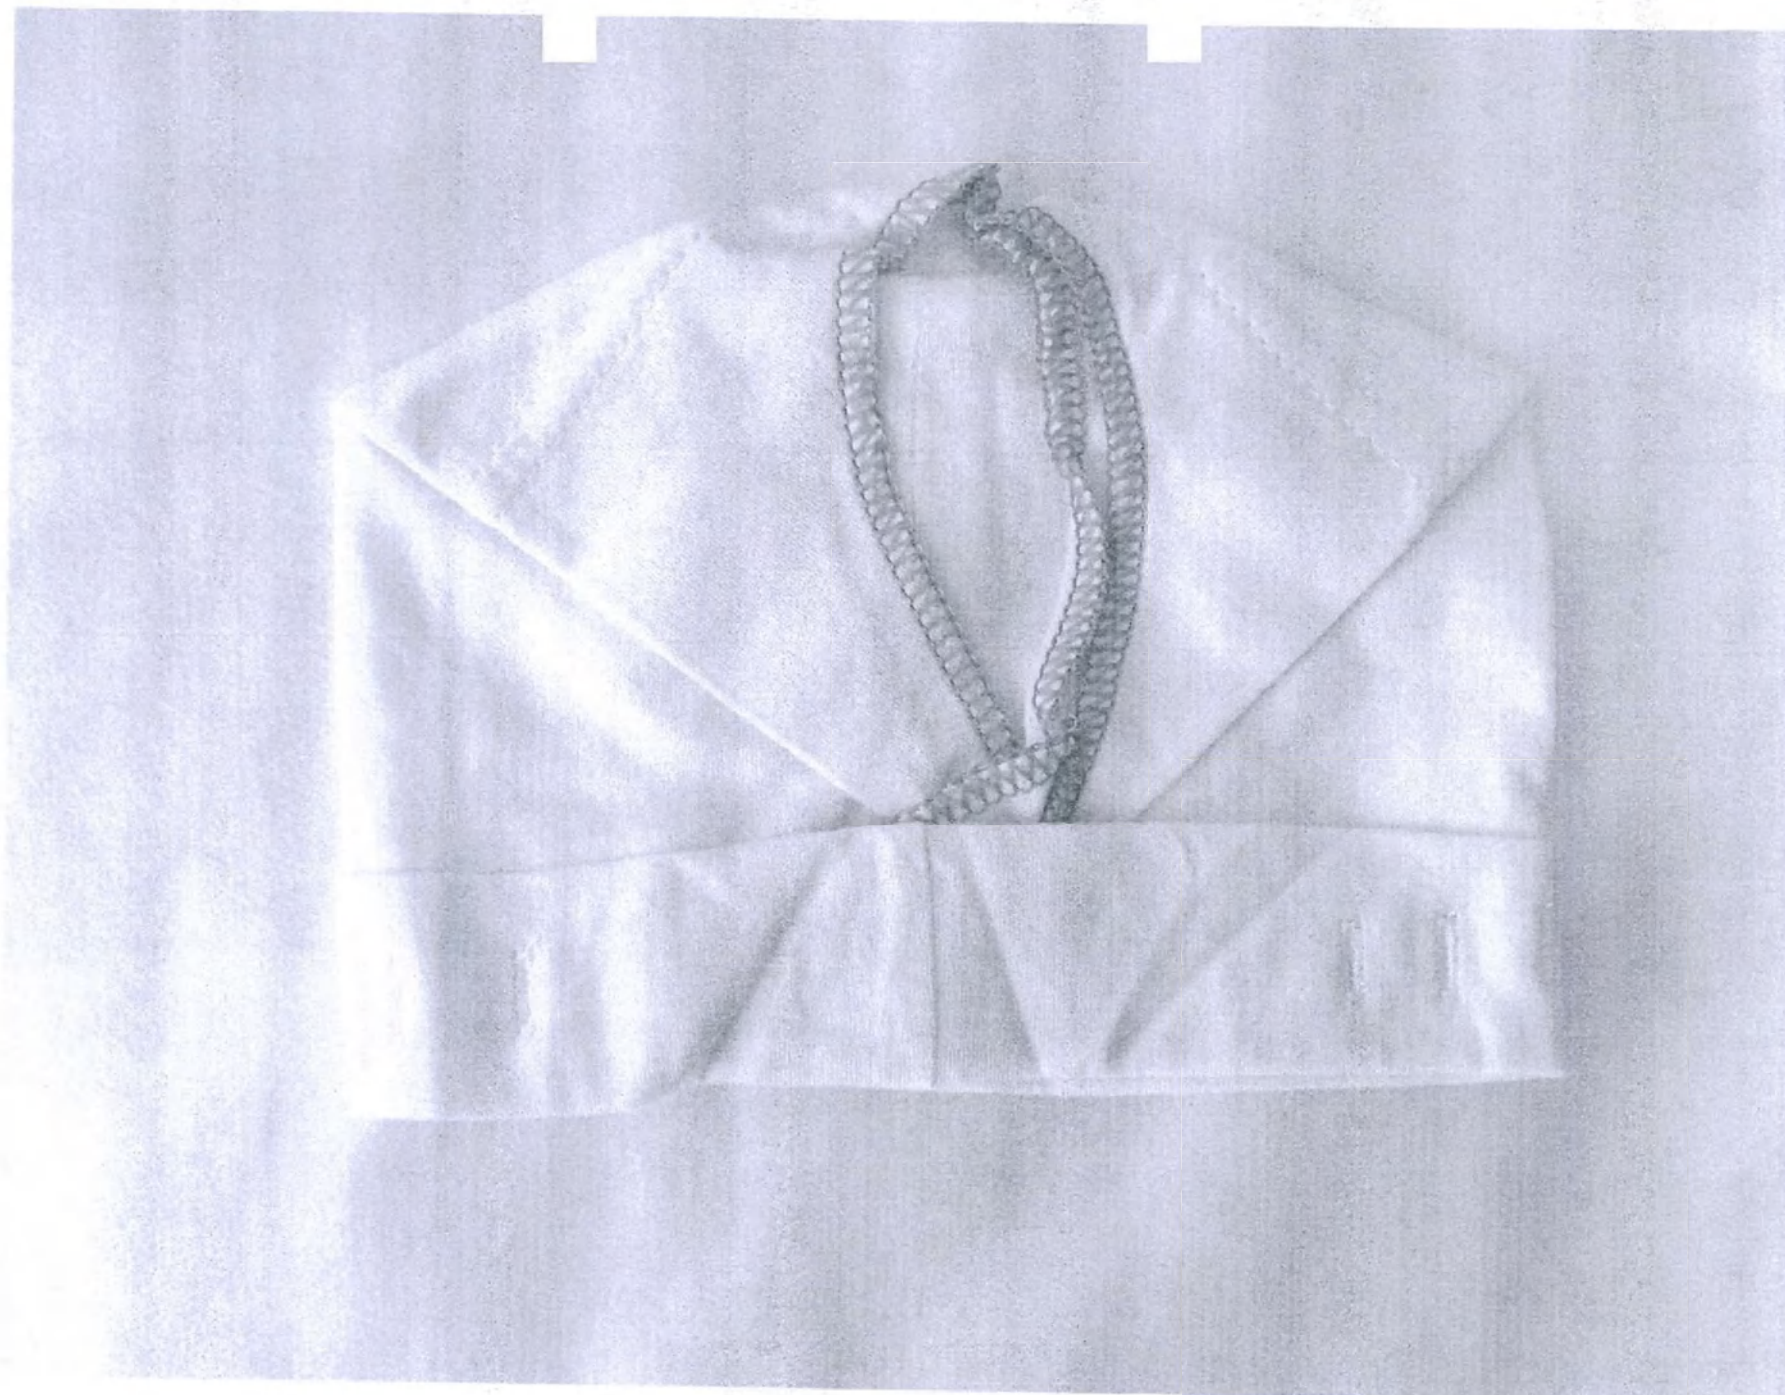


Рис. 56 Шапочка-фиксатор, размер 7

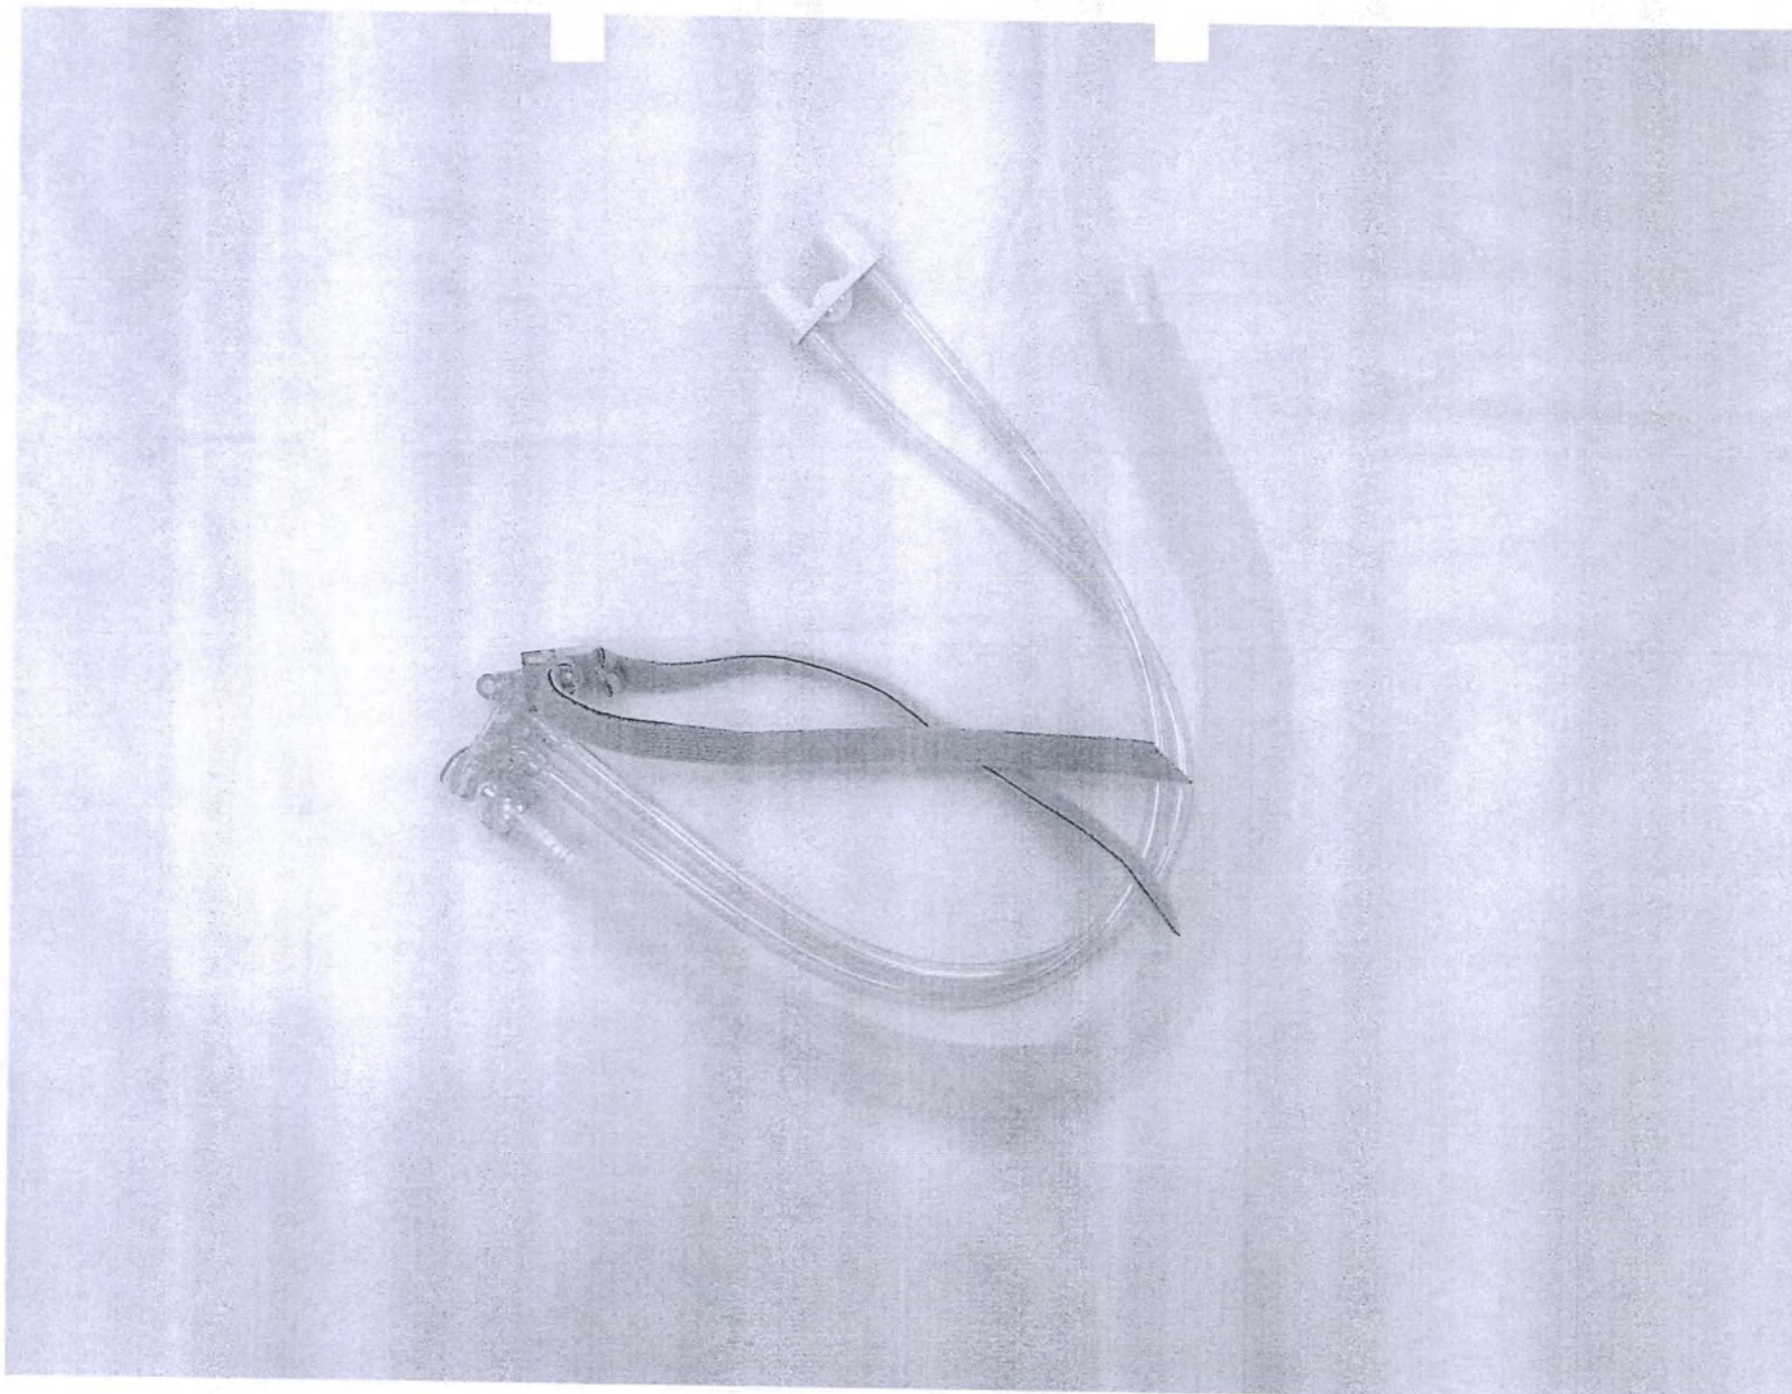


Рис. 57 Генератор дыхания

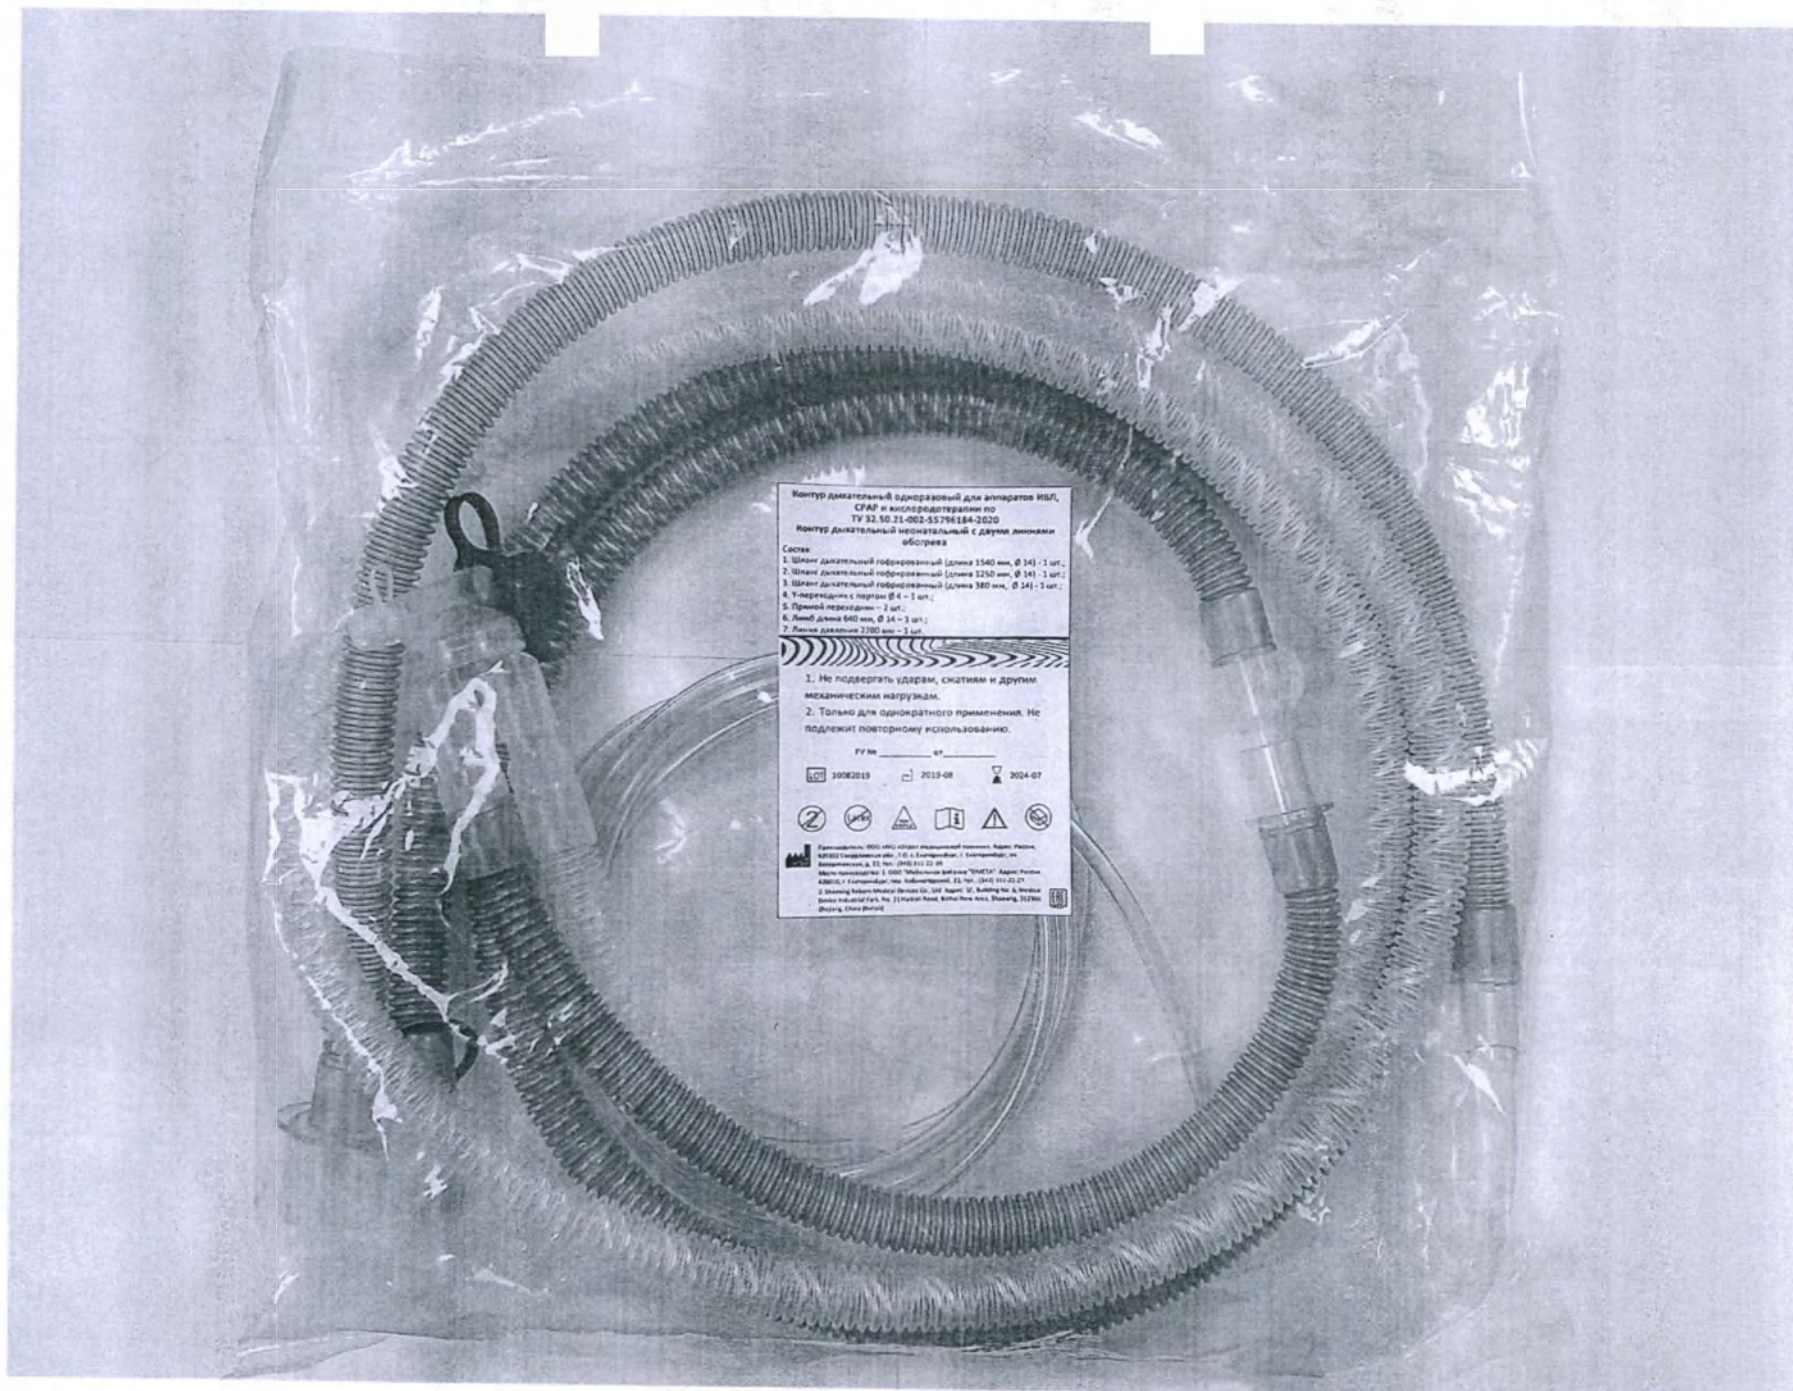


Рис. 58 Контур дыхательный однократный для аппаратов ИВЛ, СРАР и кислородотерапии по ТУ 32.50.21-002-55796184-2020 в упаковке.

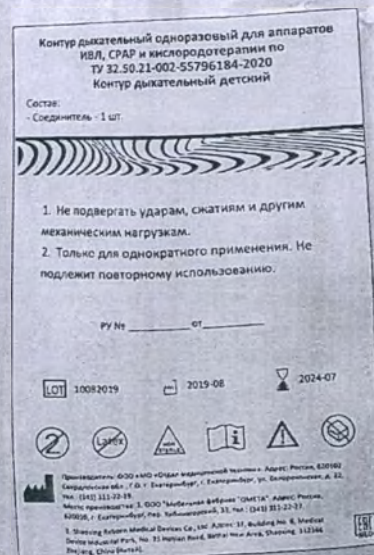


Рис. 60 Соединитель в упаковке.

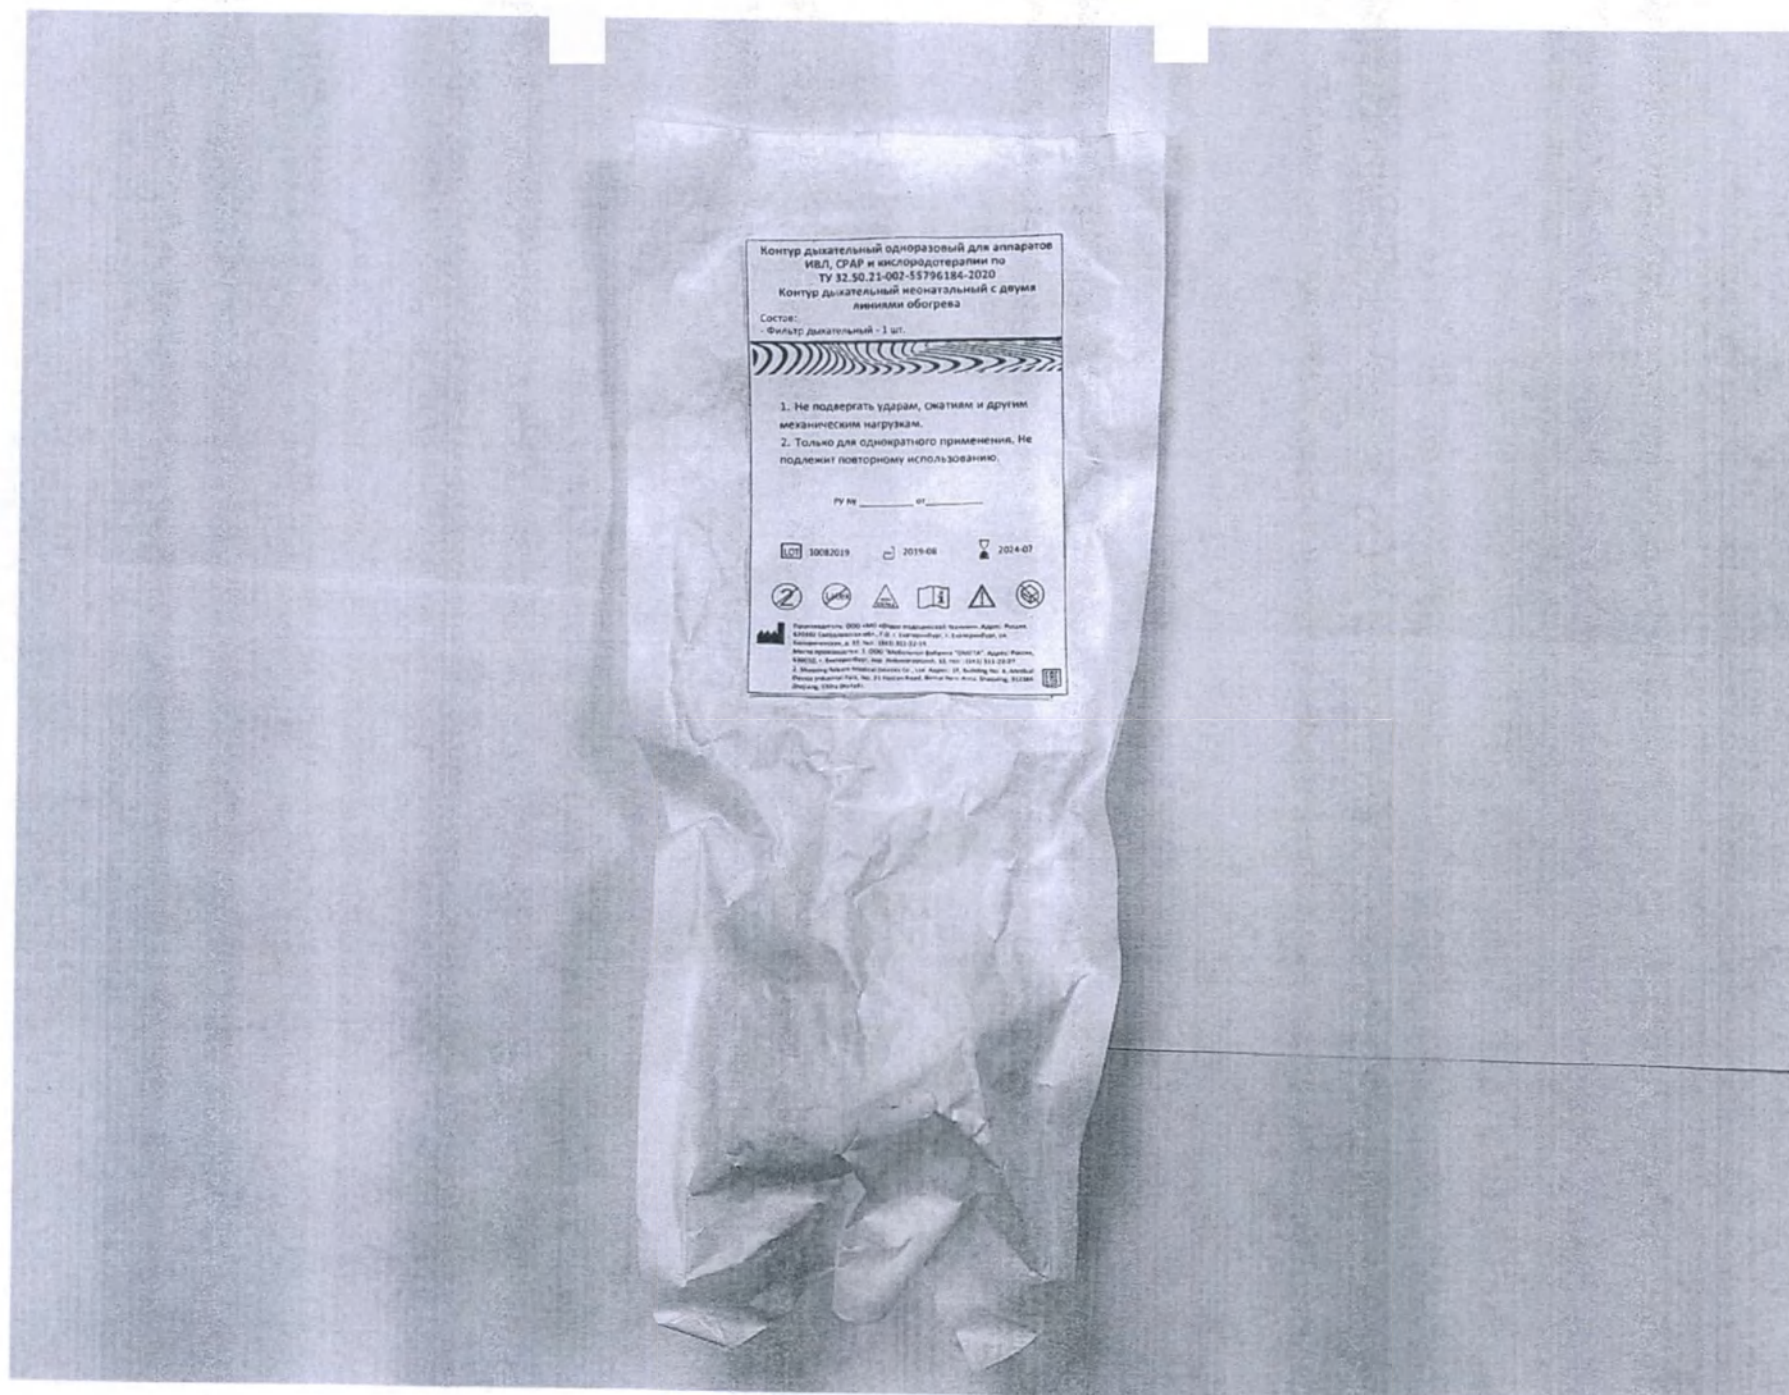


Рис.61 Фильтр дыхательный в упаковке

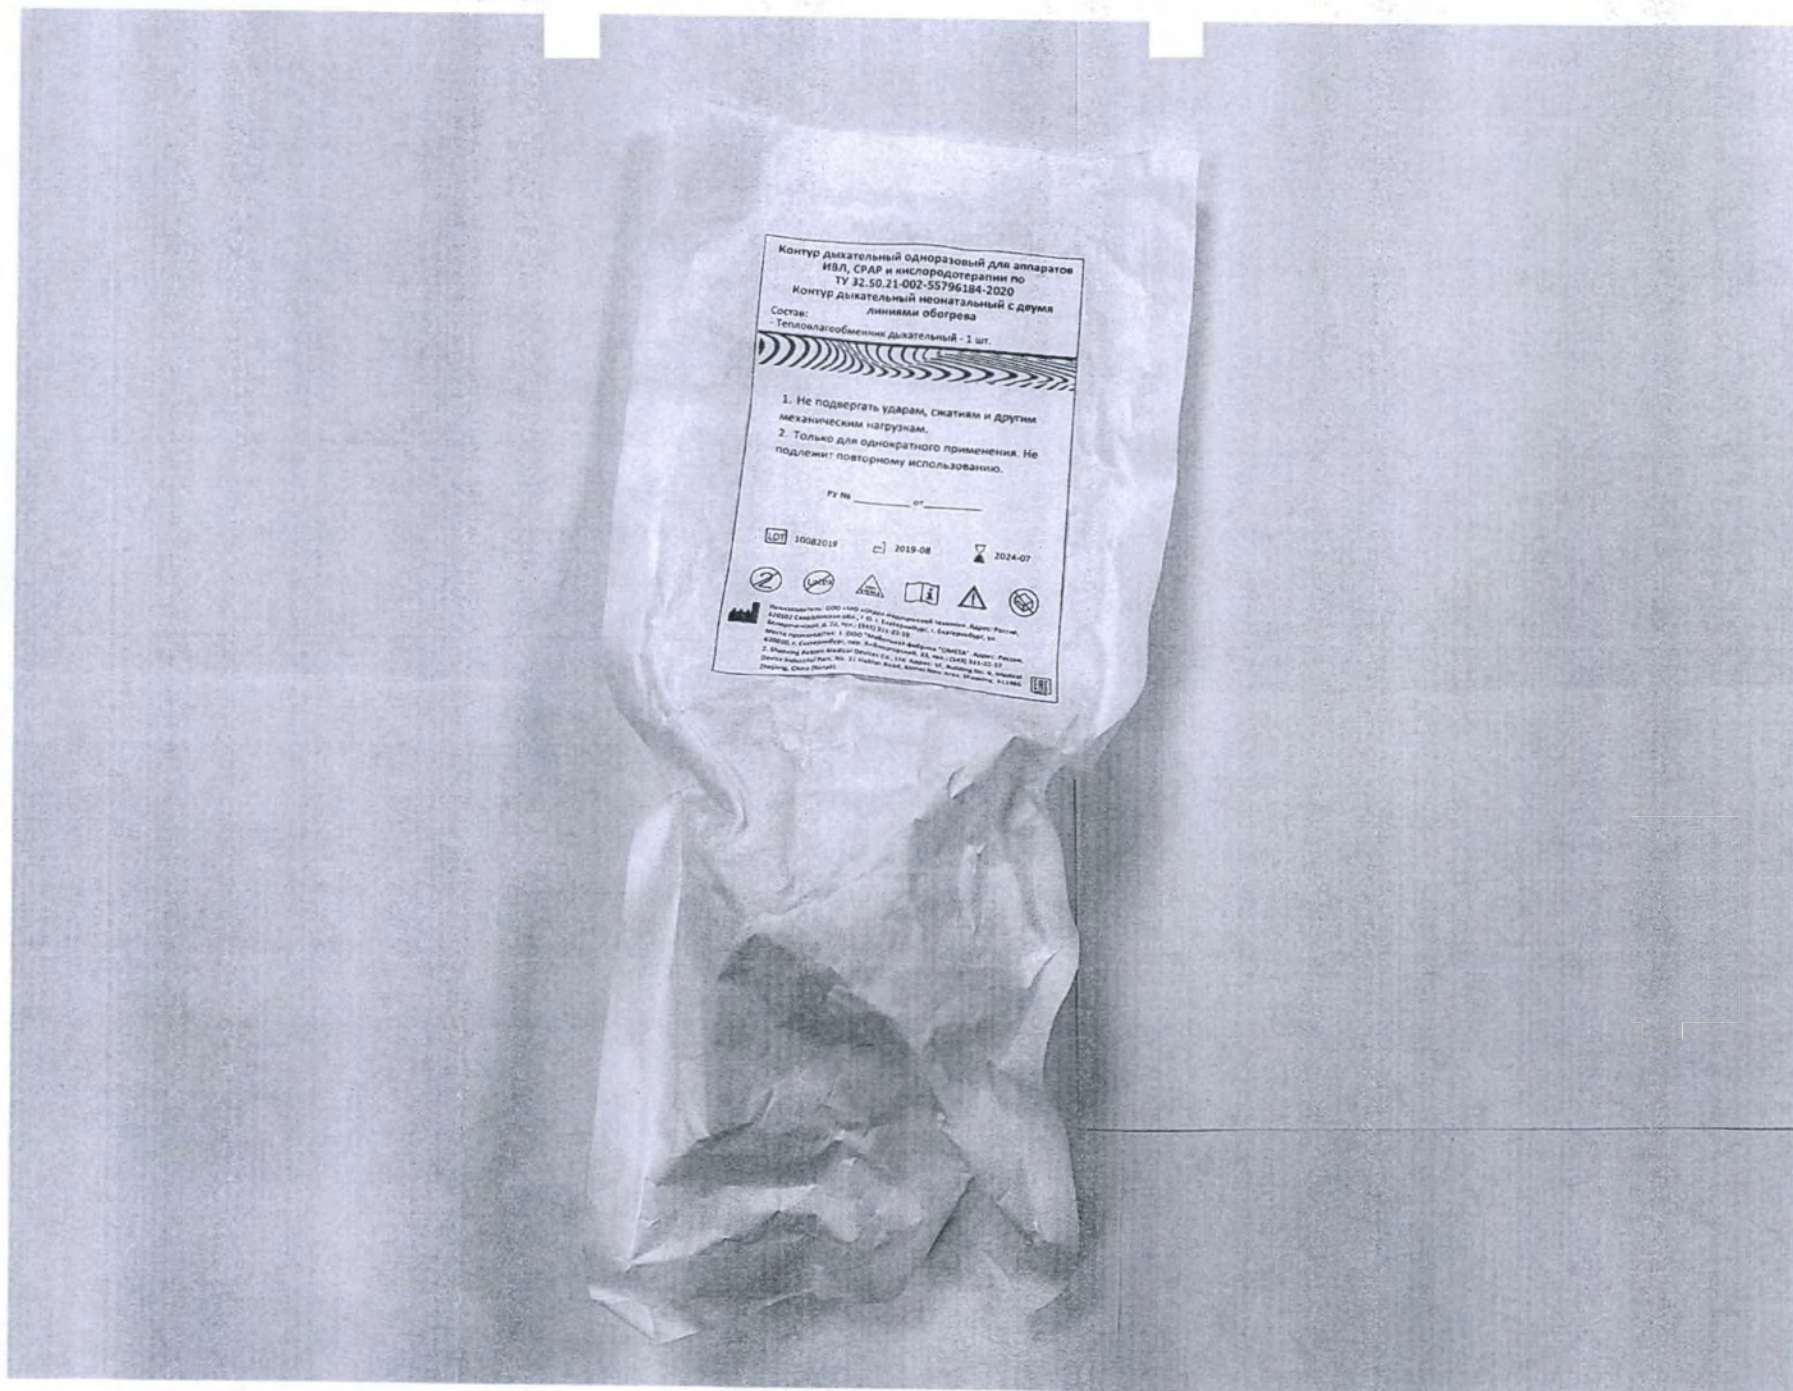
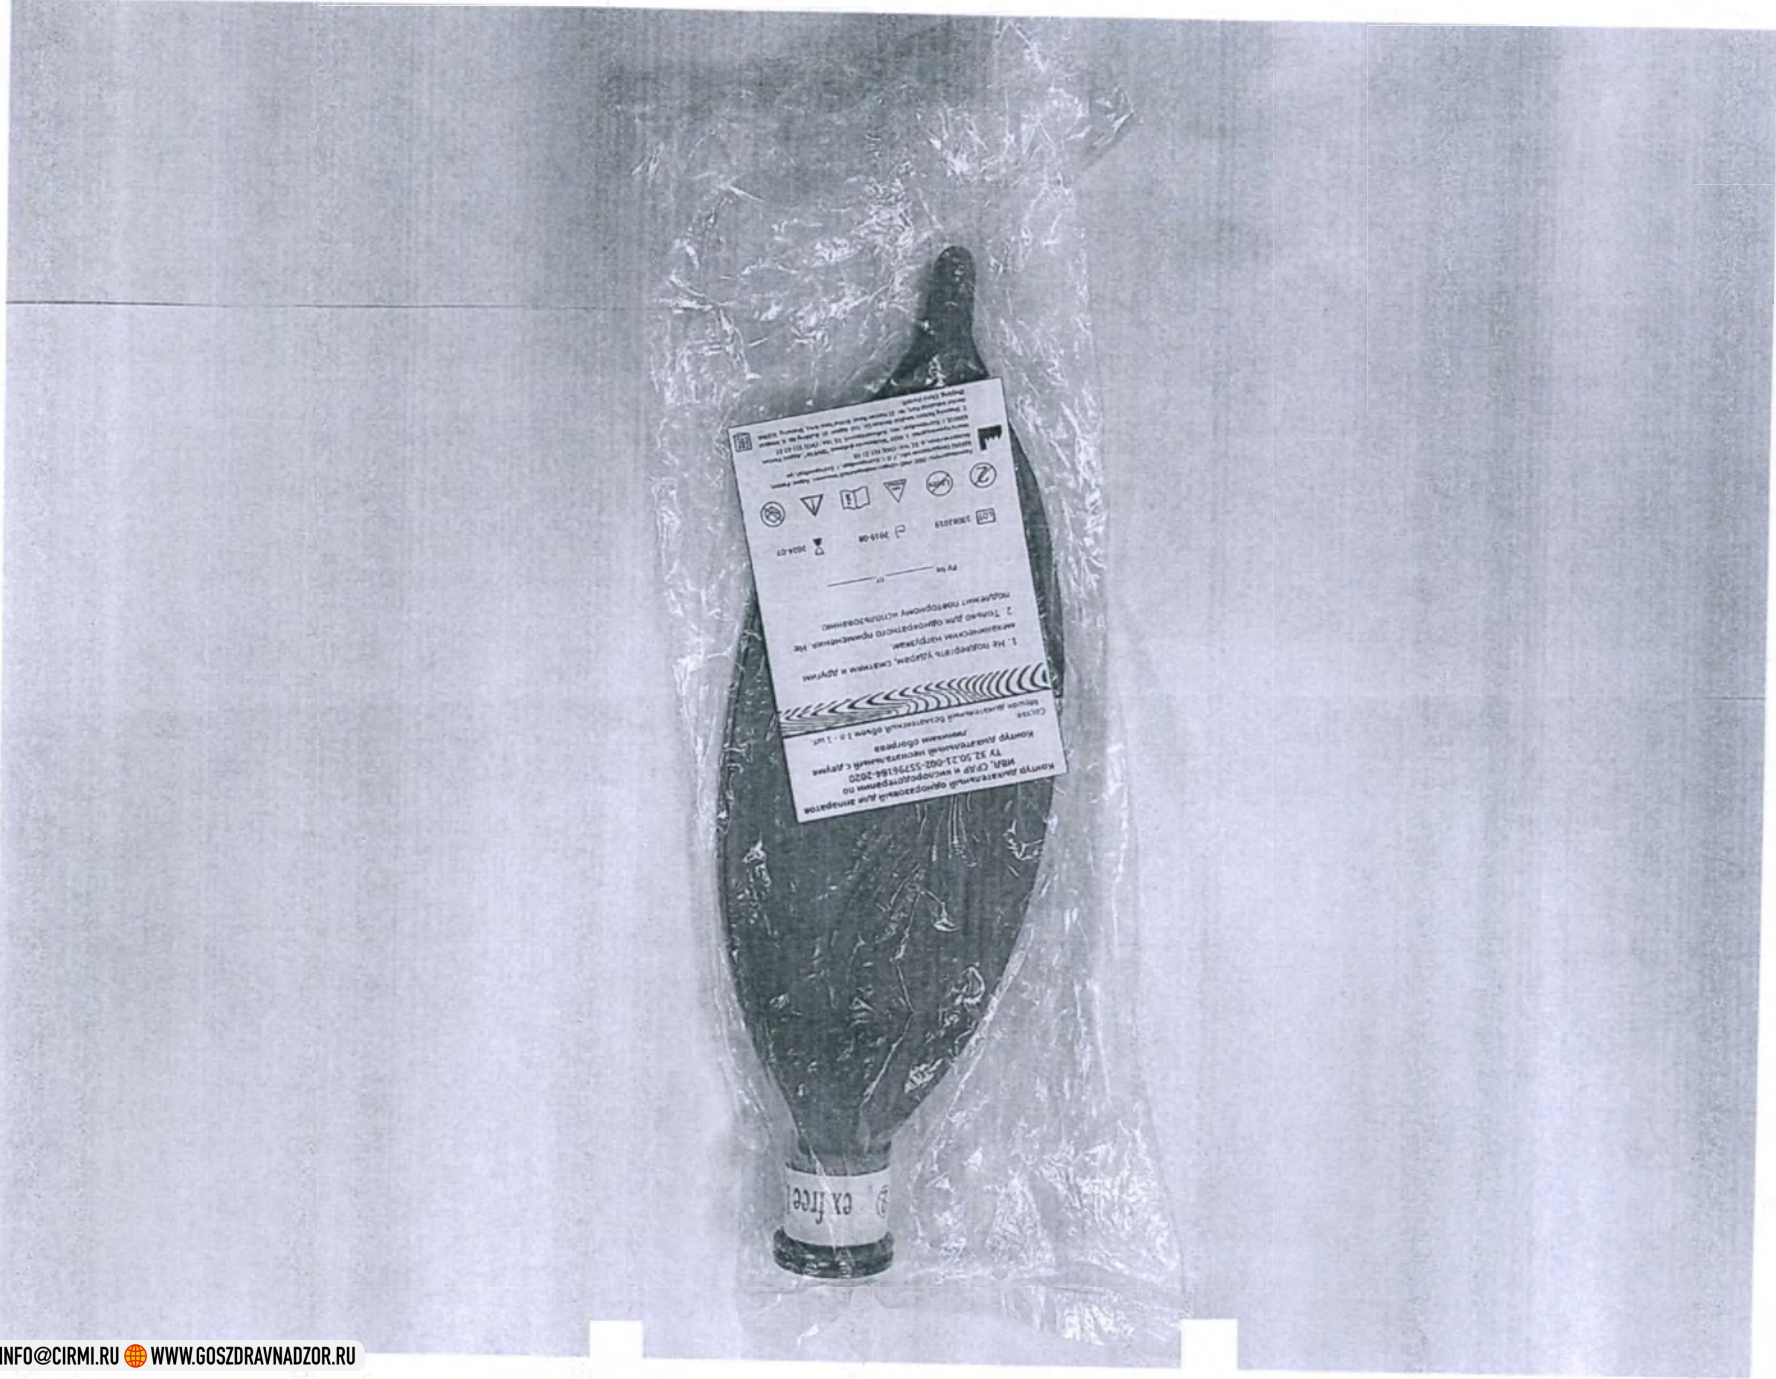


Рис. 62 Тепловлагодотделитель дыхательный в упаковке



Рис.63 Лимб в упаковке

Рис.64 Мешок дыхательный беззатескный в упаковке



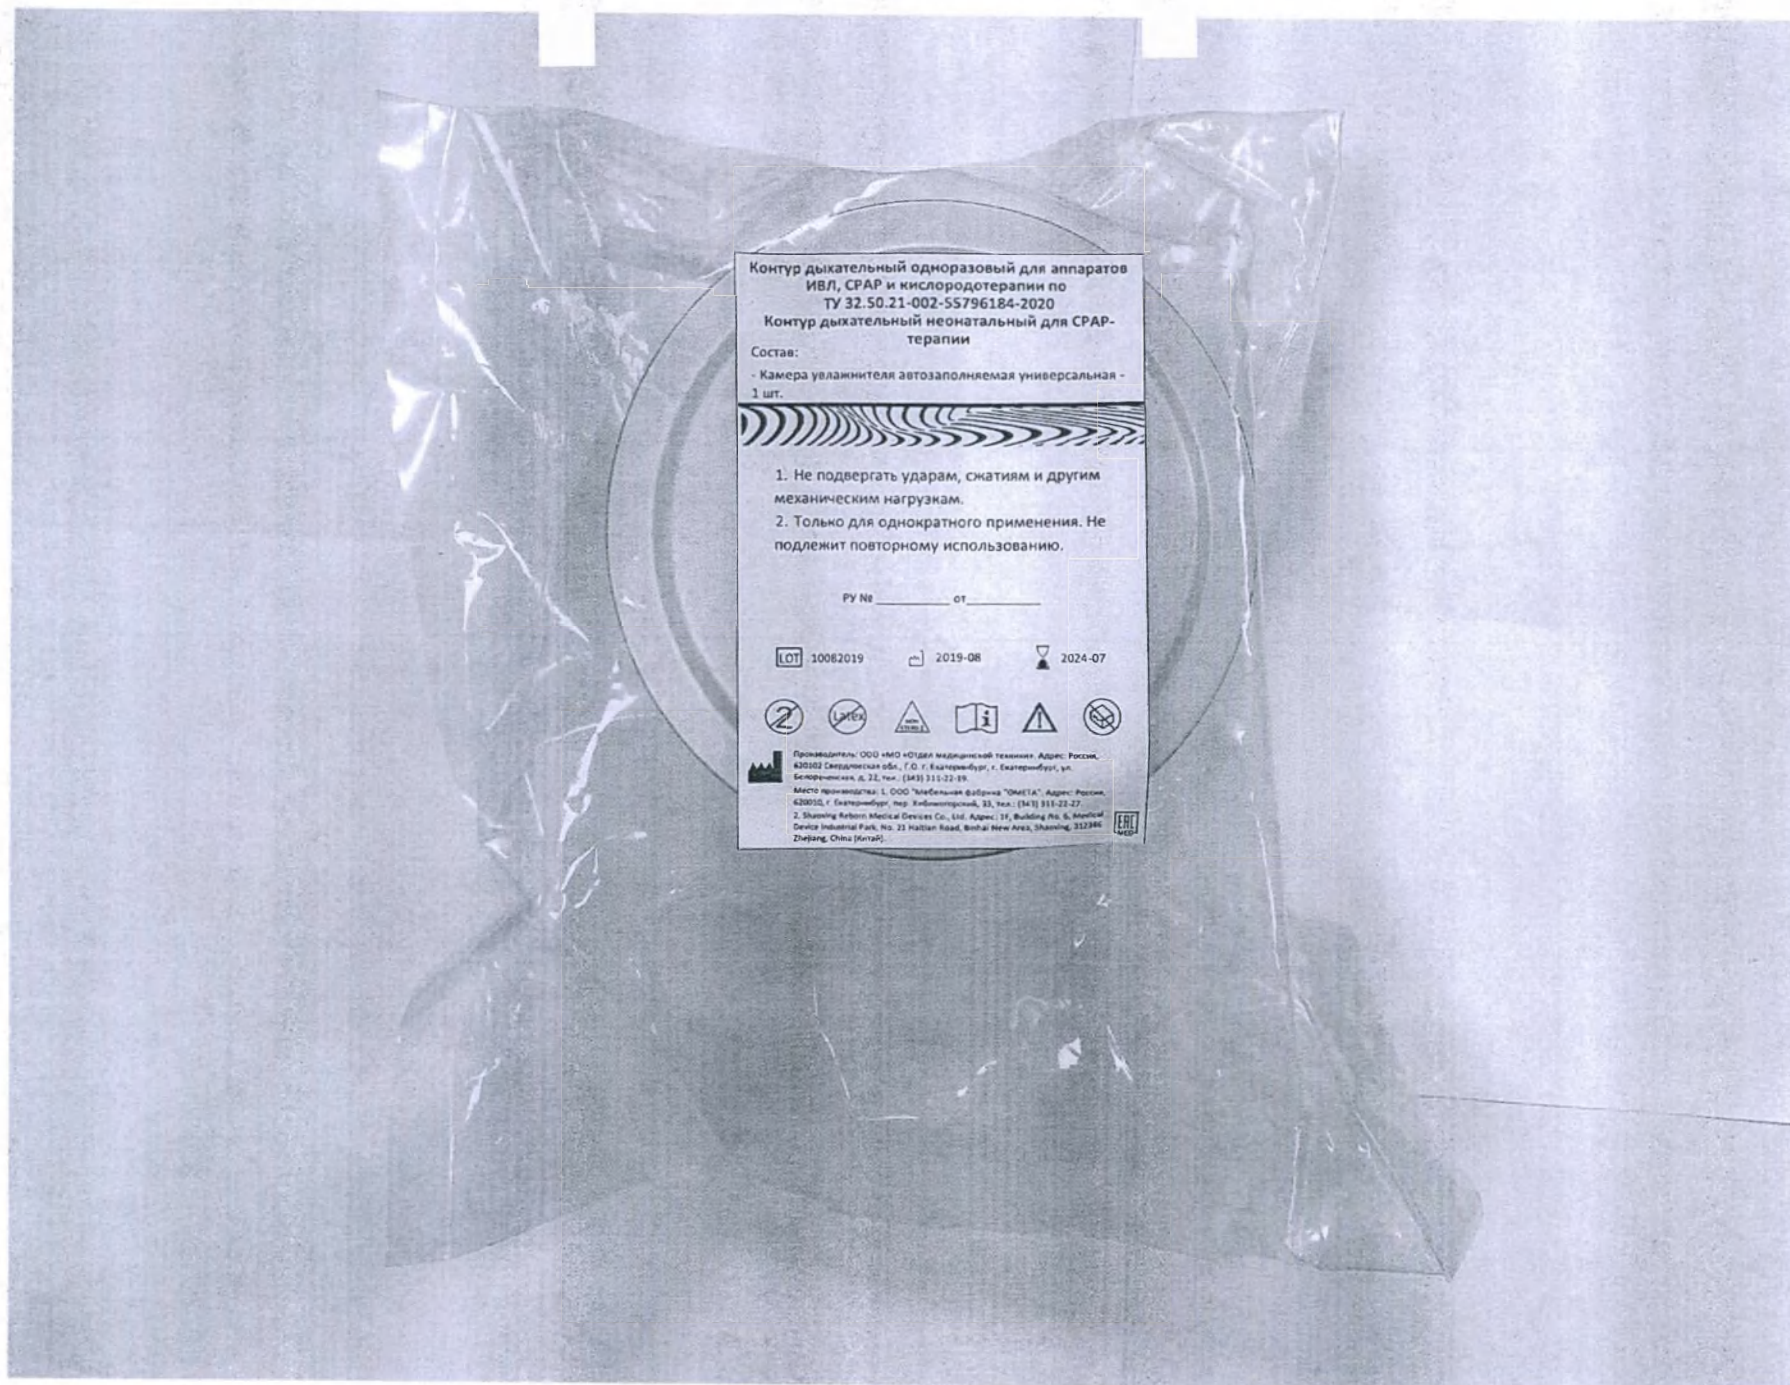


Рис. 65 Камера увлажнителя автозаполняемая универсальная в упаковке

Контур дыхательный одноразовый для аппаратов ИВЛ,
СРАР и кислородотерапии по
ТУ 32.50.21-002-55796184-2020
Контур дыхательный неонатальный с двумя линиями
обогрева

Состав:

- Канюля назальная детская (неонатальная) для пСРАР-
терапии, размер XS - 1 шт.

1. Не подвергать ударам, сжатиям и другим механическим нагрузкам.
2. Только для однократного применения. Не подлежит повторному использованию.

РУ № _____ от _____

LOT 10082019

2019-08

2024-07



Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники». Адрес: Россия,
620102 Свердловская обл., Г.О. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул.
Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19.

Место производства: 1. ООО «Мебельная фабрика "ОМЕТА"». Адрес: Россия,
620010, г. Екатеринбург, пер. Хибинский, 33, тел.: (343) 311-22-27.

2. Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. Адрес: 1F, Building No. 6, Medical
Device Industrial Park, No. 21 Haitian Road, Binhai New Area, Shaoxing, 312366
Zhejiang, China (China).



Рис. 66 Канюля назальная детская (неонатальная) для пСРАР-терапии в упаковке.

Контур дыхательный одноразовый для аппаратов ИВЛ,
CPAP и кислородотерапии по
ТУ 32.50.21-002-55796184-2020
Контур дыхательный неонатальный с двумя линиями
обогрева

Состав:
- Маска дыхательная для nCPAP-терапии, размер XL - 1 шт.

1. Не подвергать ударам, сжатиям и другим механическим нагрузкам.
2. Только для однократного применения. Не подлежит повторному использованию.

РУ № _____ от _____

LOT 10082019

2019-08

2024-07



Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники», Адрес: Россия,
620102 Свердловская обл., Г.О. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул.
Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19.

Место производства: 1. ООО "Мебельная фабрика "ОМЕТА", Адрес: Россия,
620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, тел.: (343) 311-22-27.

2. Shaoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. Адрес: 1F, Building No. 6, Medical
Device Industrial Park, No. 21 Haitian Road, Binhai New Area, Shaoxing, 312366
Zhejiang, China (Китай).



Рис. 67 Маска дыхательная для nCPAP-терапии в упаковке.

Контур дыхательный одноразовый для аппаратов
ИВЛ, СРАР и кислородотерапии по
ТУ 32.50.21-002-55796184-2020
Контур дыхательный неонатальный с двумя
линиями обогрева

Состав:

- Маска дыхательная наркозная, размер 0 - 1 шт.

1. Не подвергать ударам, сжатиям и другим механическим нагрузкам.
2. Только для однократного применения. Не подлежит повторному использованию.

РУ № _____ от _____

LOT 10082019

2019-08

2024-07



Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники». Адрес: Россия,
620102 Свердловская обл., Г.О. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул.
Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19.

Место производства: 1. ООО "Мебельная фабрика "OMETA". Адрес: Россия,
620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, тел.: (343) 311-22-27.
2. Sheoxing Reborn Medical Devices Co., Ltd. Адрес: 1F, Building No. 6, Medical
Device Industrial Park, No. 21 Hailian Road, Binhai New Area, Shaoxing, 312368
Zhejiang, China (Китай).



Рис.68 Маска дыхательная наркозная в упаковке.

Контур дыхательный одноразовый для аппаратов
ИВЛ, СРАР и кислородотерапии по
ТУ 32.50.21-002-55796184-2020
Контур дыхательный неонатальный с двумя
линиями обогрева

Состав:
- Шапочка-фиксатор, размер 1 - 1 шт.

1. Не подвергать ударам, сжатиям и другим механическим нагрузкам.
2. Только для однократного применения. Не подлежит повторному использованию.

РУ № _____ от _____

LOT 10082019

2019-08

2024-07



Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники». Адрес: Россия, 620102 Свердловская обл., г.О. г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 22, тел.: (343) 311-22-19.

Место производства: 1. ООО «Мебельная фабрика "ОМЕТА"». Адрес: Россия, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибинский, 33, тел.: (343) 311-22-27.

2. Shanghai Reborn Medical Devices Co., Ltd. Адрес: 1F, Building No. 6, Medical Device Industrial Park, No. 21 Haitan Road, Binhai New Area, Shuangqing, 312366 Zhejiang, China [Kunshan].



Рис.69 Шапочка-фиксатор в упаковке.

Контур дыхательный одноразовый для аппаратов
 ИВЛ, СРАР и кислородотерапии по
 ТУ 32.50.21-002-55796184-2020
 Контур дыхательный неонатальный для СРАР-
 терапии

Состав:
 - Генератор дыхания - 1 шт.

1. Не подвергать ударам, сжатиям и другим
 механическим нагрузкам.
 2. Только для однократного применения. Не
 подлежит повторному использованию.

РУ № _____ ОТ _____

LOT 10082019 2019-08 2024-07









Производитель: ООО «МО «Отдел медицинской техники». Адрес: Россия,
 620102 Свердловская обл., г.О. г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул.
 Белореченская, д. 22, тел. (343) 311-22-19.
 Место производства: 1. ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТ» Адрес: Россия,
 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, тел. (343) 311-22-27.
 2. Shanghai Reborn Medical Devices Co., Ltd. Адрес: 1F, Building No. 6, Medical
 Device Industrial Park, No. 21 Haitian Road, Bunkai New Area, Shanghai 312366
 Zhejiang, China (Китай)



Рис.70 Генератор дыхания в упаковке.

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
69 (шестьдесят девять) листа(-ов)

ООО «МО «Отдел медицинской техники».

Директор Цикин А.Ю.

Подпись _____

«10» ноя 2021 года

