

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

20 23 г.




Проект маркировки

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови
«ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023**




1. Образцы маркировки внутренней упаковки

1.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта №1

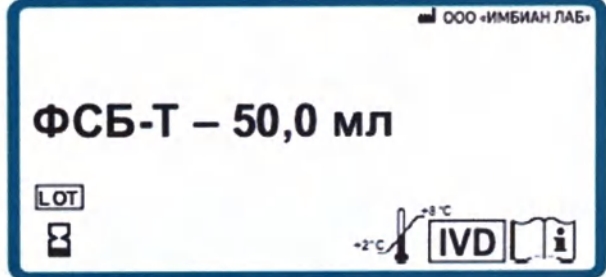Наименование компонента	Маркировка
Иммуносорбент	
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	
К(-) – отрицательный контрольный образец	
ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора	
РРО – раствор для разведения образцов	

К(-) – отрицательный контрольный образец	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА К(-) – 4,0 мл LOT -2°C
ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора	ФСБ-Т – 100,0 мл LOT -2°C
РРО – раствор для разведения образцов	РРО – 25,0 мл LOT -2°C
РК – раствор конъюгата	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА РК – 25,0 мл LOT -2°C
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ТМБ – 25,0 мл LOT -2°C
Стоп-реагент	Стоп-реагент – 25,0 мл LOT -2°C

1.3. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта №3

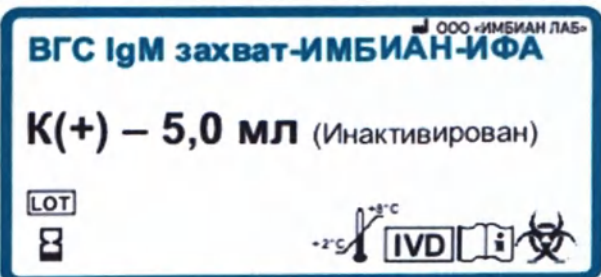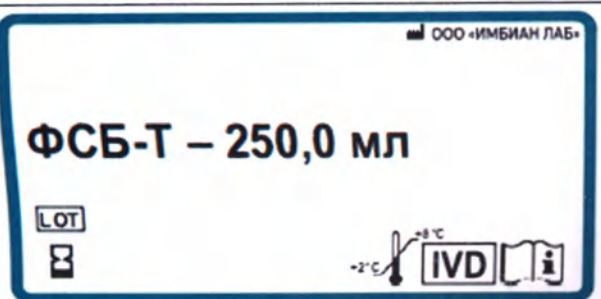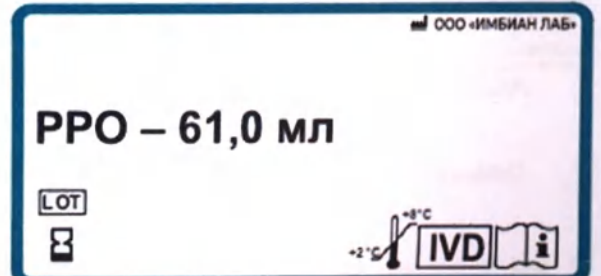Наименование компонента	Маркировка
Иммуносорбент	 ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Иммуносорбент 96-луночный разборный до лунок полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными мышинными моноклональными антителами против IgM человека LOT IVD Icons: -2°C, 8°C, IVD, information, 96, biohazard, no open flame, no fire
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	 ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(+) – 5,0 мл (Инактивирован) LOT IVD Icons: -2°C, 8°C, IVD, information, biohazard, no open flame, no fire
К(-) – отрицательный контрольный образец	 ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(-) – 10,0 мл LOT IVD Icons: -2°C, 8°C, IVD, information
ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора	 ООО «ИМБИАН ЛАБ» ФСБ-Т – 250,0 мл LOT IVD Icons: -2°C, 8°C, IVD, information
РРО – раствор для разведения образцов	 ООО «ИМБИАН ЛАБ» РРО – 61,0 мл LOT IVD Icons: -2°C, 8°C, IVD, information

РК – раствор конъюгата	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РК – 61,0 мл LOT
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ТМБ – 61,0 мл LOT
Стоп-реагент	Стоп-реагент – 61,0 мл LOT

1.4. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта №4

Наименование компонента	Маркировка
Иммуносорбент	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Imbian Иммуносорбент 96-луночный разборный до лунок полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными мышинными моноклональными антителами против IgM человека LOT
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(+) – 5,0 мл (Инактивирован) LOT

К(-) – отрицательный контрольный образец	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(-) – 10,0 мл LOT IVD +8°C -2°C
ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора	ФСБ-Т – 250,0 мл LOT IVD +8°C -2°C
РРО – раствор для разведения образцов	РРО – 100,0 мл LOT IVD +8°C -2°C
ПК – раствор конъюгата	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ПК – 80,0 мл LOT IVD +8°C -2°C
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ТМБ – 80,0 мл LOT IVD +8°C -2°C
Стоп-реагент	Стоп-реагент – 250,0 мл LOT IVD +8°C -2°C

2. Образцы маркировки потребительской упаковки

2.1. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта №1

ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА

Комплект №1

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

1 Иммуносорбент
2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 1,0 мл
3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 2,0 мл
4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 50,0 мл
5 РРО - раствор для разведения образцов, 13,0 мл
6 РК - раствор конъюгата, 13,0 мл
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 13,0 мл
8 Стоп-реагент, 13,0 мл
9 Пленка для заклеивания планшета
10 Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 30 мл РУ № РЗН 2019/8202
11 Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов по ТУ 32.50.50-002-72241324-2018 РУ № РЗН 2019/9159
12 Инструкция по применению


Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
24 шт.
1 шт.

РУ №

LOT

REF VE-016/96.1



Imbian

IVD    

+2°C  +8°C



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта №2

ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА

Комплект №2

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

1 Иммуносорбент
2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 2,0 мл
3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 4,0 мл
4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 100,0 мл
5 РРО - раствор для разведения образцов, 25,0 мл
6 РК - раствор конъюгата, 25,0 мл
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 25,0 мл
8 Стоп-реагент, 25,0 мл
9 Пленка для заклеивания планшета
10 Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 30 мл РУ № РЗН 2019/8202
11 Наконечник Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов по ТУ 32.50.50-002-72241324-2018 РУ № РЗН 2019/9159
12 Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
6 шт.
48 шт.
1 шт.

РУ №

LOT

REF VE-016/192.2



Imbian

IVD    

+2°C  +8°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

2.3. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта №3

ВГС IgM захват- ИМБИАН-ИФА

Комплект №3

Набор реагентов для качественного иммуноферментного
определения антител IgM к вирусу гепатита С в
сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- | | |
|---|---------|
| 1 Иммуносорбент | 5 шт. |
| 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл | 1 фл. |
| 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл | 1 фл. |
| 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл | 1 фл. |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов, 61,0 мл | 1 фл. |
| 6 РК - раствор конъюгата, 61,0 мл | 1 фл. |
| 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 61,0 мл | 1 фл. |
| 8 Стоп-реагент, 61,0 мл | 1 фл. |
| 9 Пленка для заклеивания планшета | 15 шт. |
| 10 Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов)
емкостью 30 мл РУ № РЗН 2019/8202 | 15 шт. |
| 11 Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов
по ТУ 32.50.50-002-72241324-2018 РУ № РЗН 2019/9159 | 120 шт. |
| 12 Инструкция по применению | 1 шт. |

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.

РУ №


LOT

REF

VE-016/480.3



Imbian



IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

2.4. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта №4

ВГС IgM захват- ИМБИАН-ИФА

Комплект №4

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 100,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 80,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 80,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 250,0 мл
- 9 Инструкция по применению

5 шт.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 шт.

ПУ №

LOT

REF

VE-016/480.4

VE-016/480.4

VE-016/480.4


VE-016/480.4



Imbian



Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.



IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

3.1. Образцы маркировки транспортной упаковки комплекта №1

Комплект №1

**Набор реагентов для качественного
иммуноферментного определения
антител IgM к вирусу гепатита С
в сыворотке и плазме крови
«ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023**

Рy №

Масса нетто **кг**

Количество	шт.	Масса брутто	кг
------------	-----	--------------	----

LOT



Imbian

REF VE-016/96.1



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
+7 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

**Замораживание не допускается.
Допускается транспортирование при
температуре от +9 до +30°C не более 15 суток.**



3.2. Образцы маркировки транспортной упаковки комплекта №2

Комплект №2

**Набор реагентов для качественного
иммуноферментного определения
антител IgM к вирусу гепатита С
в сыворотке и плазме крови
«ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023**

Py №

Масса нетто **кг**

Количество	ШТ.	Масса брутто	кг
------------	-----	--------------	----

LOT



Imbian

REF VE-016/192.2



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
+7 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

**Замораживание не допускается.
Допускается транспортирование при
температуре от +9 до +30°C не более 15 суток.**



**ВГС IgM захват-
ИМБИАН-ИФА****Комплект №3**

Набор реагентов для качественного
иммуноферментного определения
антител IgM к вирусу гепатита С
в сыворотке и плазме крови
«ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

РУ №**Масса нетто** кг**Количество****шт.****Масса брутто** кг**LOT****REF**

VE-016/480.3

**Imbian**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,

+7 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Замораживание не допускается.
Допускается транспортирование при
температуре от +9 до +30°C не более 15 суток.

**ВГС IgM захват-
ИМБИАН-ИФА****Комплект №4**

Набор реагентов для качественного
иммуноферментного определения
антител IgM к вирусу гепатита С
в сыворотке и плазме крови
«ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

РУ №**Масса нетто** кг**Количество****шт.****Масса брутто** кг**LOT****REF**

VE-016/480.4

**Imbian**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


630559, Новосибирская область,

р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,

+7 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Замораживание не допускается.
Допускается транспортирование при
температуре от +9 до +30°C не более 15 суток.



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



/В.В. Осипова/

2023 г.

Фотографические изображения общего вида

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения
антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови
«ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023**

Комплект №1



ВГС IgM захват- ИМБИАН-ИФА

Комплект №1

Набор реагентов для качественного иммуноферментного
определения антител IgM к вирусу гепатита С в
сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 1,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 2,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 50,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 13,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 13,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 13,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 13,0 мл
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов)
емкостью 30 мл РУ № РЗН 2019/8202
- 11 Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов
по ТУ 32.50.50-002-72241324-2018 РУ № РЗН 2019/9159
- 12 Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВГС 1, 2 и HbAg отсутствуют.

1 шт.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
3 шт.
3 шт.

РУ №

LOT

230522


REF

VE-016/96.1

2023-05-22


2025-07-22

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru



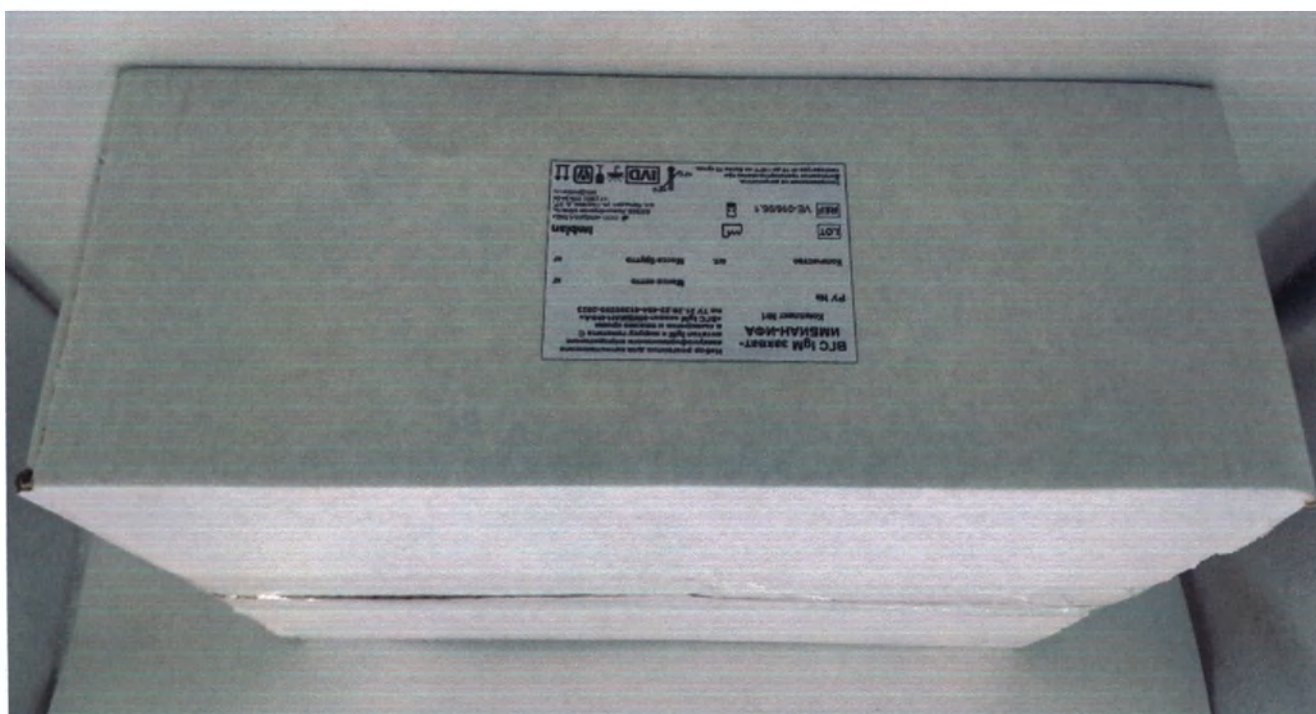

Комплект №2



ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА

Комплект №2

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инaktivированный положительный контрольный образец, 2,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 4,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 100,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 25,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 25,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 25,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 25,0 мл
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 30 мл РУ № РЗН 2019/8202
- 11 Наконечник Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов по ТУ 32.50.50-002-72241324-2018 РУ № РЗН 2019/9159
- 12 Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.

2 шт.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
6 шт.
6 шт.

РУ №

LOT 230524


REF VE-016/192.2

2023-05-24

2025-07-24

48 шт.

1 шт.




4620102805271



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru



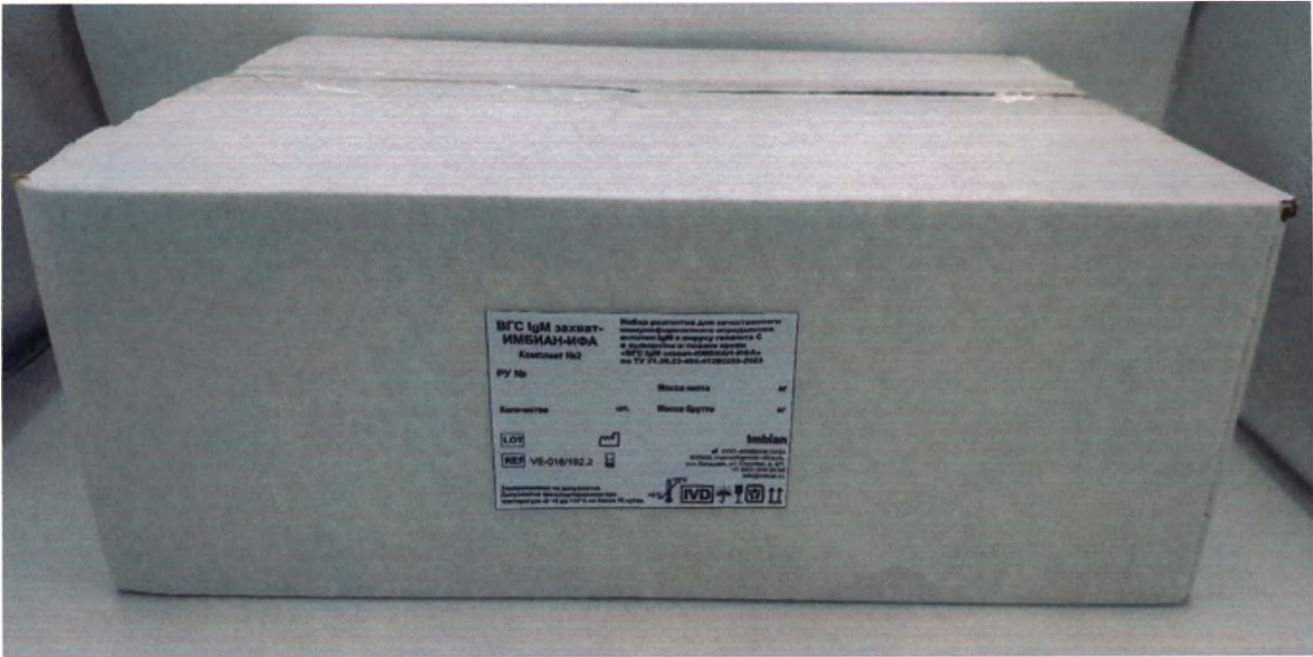

Комплект №3



ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА

Комплект №3

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 61,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 61,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 61,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 61,0 мл
- 9 Пленка для закрепления планшета
- 10 Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 30 мл РУ № РЗН 2019/8202
- 11 Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов по ТУ 32.50.50-002-72241324-2018 РУ № РЗН 2019/9159
- 12 Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HbAg отсутствуют.

- 5 шт.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 15 шт.
- 15 шт.
- 120 шт.
- 1 шт.

РУ №


LOT 230526

REF VE-016/480.3

2023-05-26

2025-07-26

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru





Комплект №4



ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА

Комплект №4

- Иммуносорбент
- K(+)- инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл
- K(-)- отрицательный контрольный образец, 10,0 мл
- ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл
- РРО - раствор для разведения образцов, 100,0 мл
- РК - раствор конъюгата, 80,0 мл
- ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 80,0 мл
- Стоп-реагент, 250,0 мл
- Инструкция по применению

Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения антител IgM к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

5 шт.	ПУ №
1 фп.	LOT 230530
1 фп.	REF VE-016/480.4
1 фп.	2023-05-30
1 фп.	2025-07-30

Замораживать не допускается.

Для сертифицированного персонала.

Анализаторы: BMS 1, 2 и IMBIAF сертифицированы.

**ВГС IgM захват-
ИМБИАН-ИФА**

Комплект №4

Набор реагентов для качественного иммуноферментного
определения антител IgM к вирусу гепатита С в
сыворотке и плазме крови «ВГС IgM захват-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-484-41390295-2023
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 100,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 80,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 80,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 250,0 мл
- 9 Инструкция по применению

5 шт.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 шт.

ПУ №

LOT 230530

REF VE-016/480.4


2023-05-30

2025-07-30

Imbian




Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.
Антитела к ВМС 1, 2 и ИВБ-Ав отсутствуют.



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru



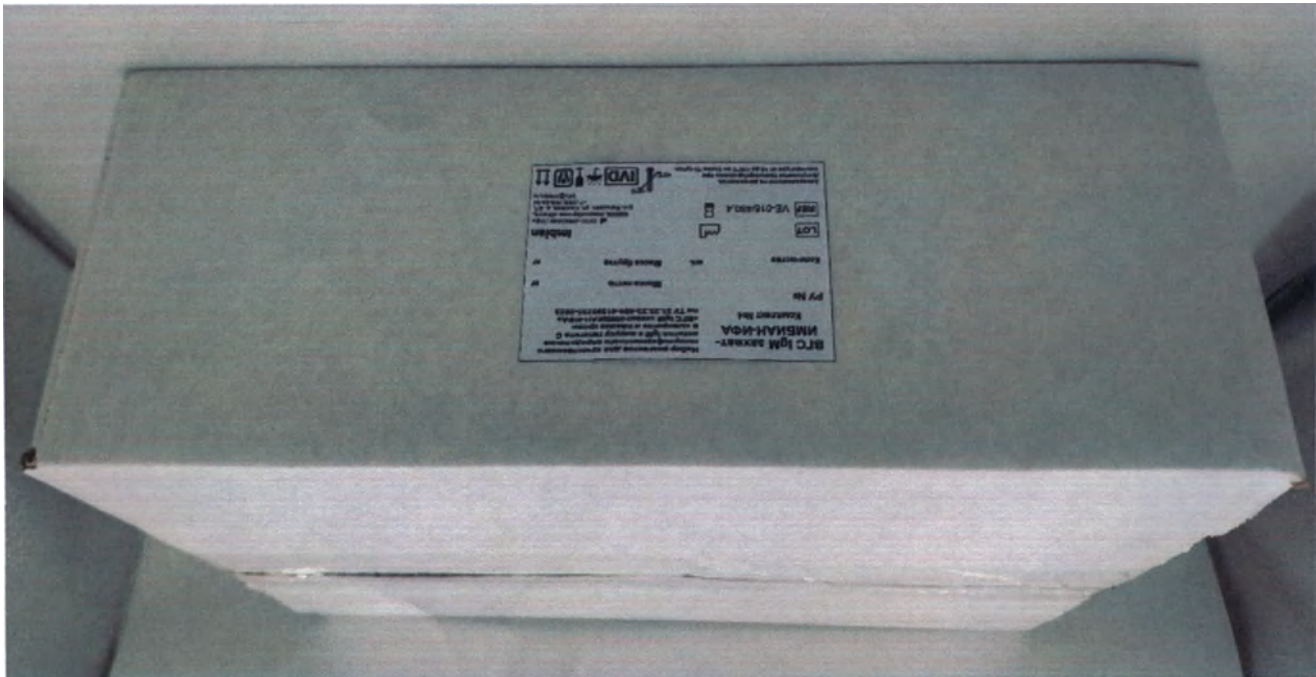

Пронумеровано, пронумеровано

и скреплено печатью

лист 86

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2023 г.