

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора

ООО НТО «ИРЭ – Полус»

А.О. Андреев

2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-
Use» по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018**



Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» по
ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, вариант исполнения:

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с
торцевым выходом, диаметр сердцевины 150 мкм *¹

*1 Внешний вид полностью идентичен вариантам исполнения:

- [illegible]



Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» по
ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, вариант исполнения:

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с
торцевым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм *²

*2 Внешний вид полностью идентичен вариантам исполнения:

- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с боковым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 940 мкм.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 940 мкм.



Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, вариант исполнения:

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
с боковым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм, разъем SMA-905, HP *3

*3 Внешний вид полностью идентичен вариантам исполнения:

- [illegible]




Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, вариант исполнения:

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU гр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, НР *4

*4 Внешний вид полностью идентичен вариантам исполнения:

- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, НР.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с боковым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, НР.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, НР.

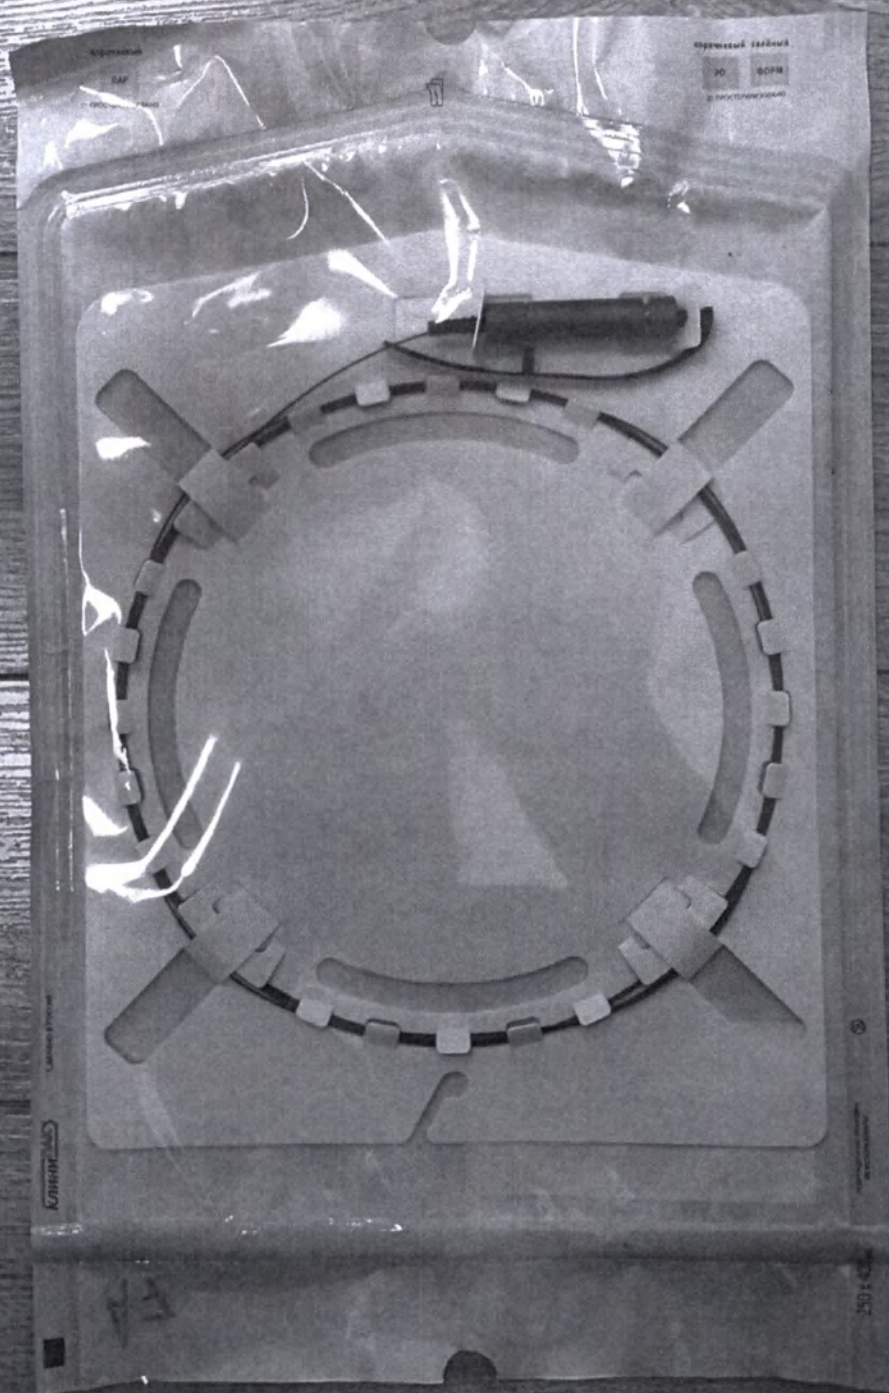


Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, вариант исполнения:


Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с
торцевым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP *⁵

*5 Внешний вид полностью идентичен вариантам исполнения:

- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 95 мкм, разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 110 мкм, разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 150 мкм, разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм, разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм, разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм, разъем SMA-905, LP.

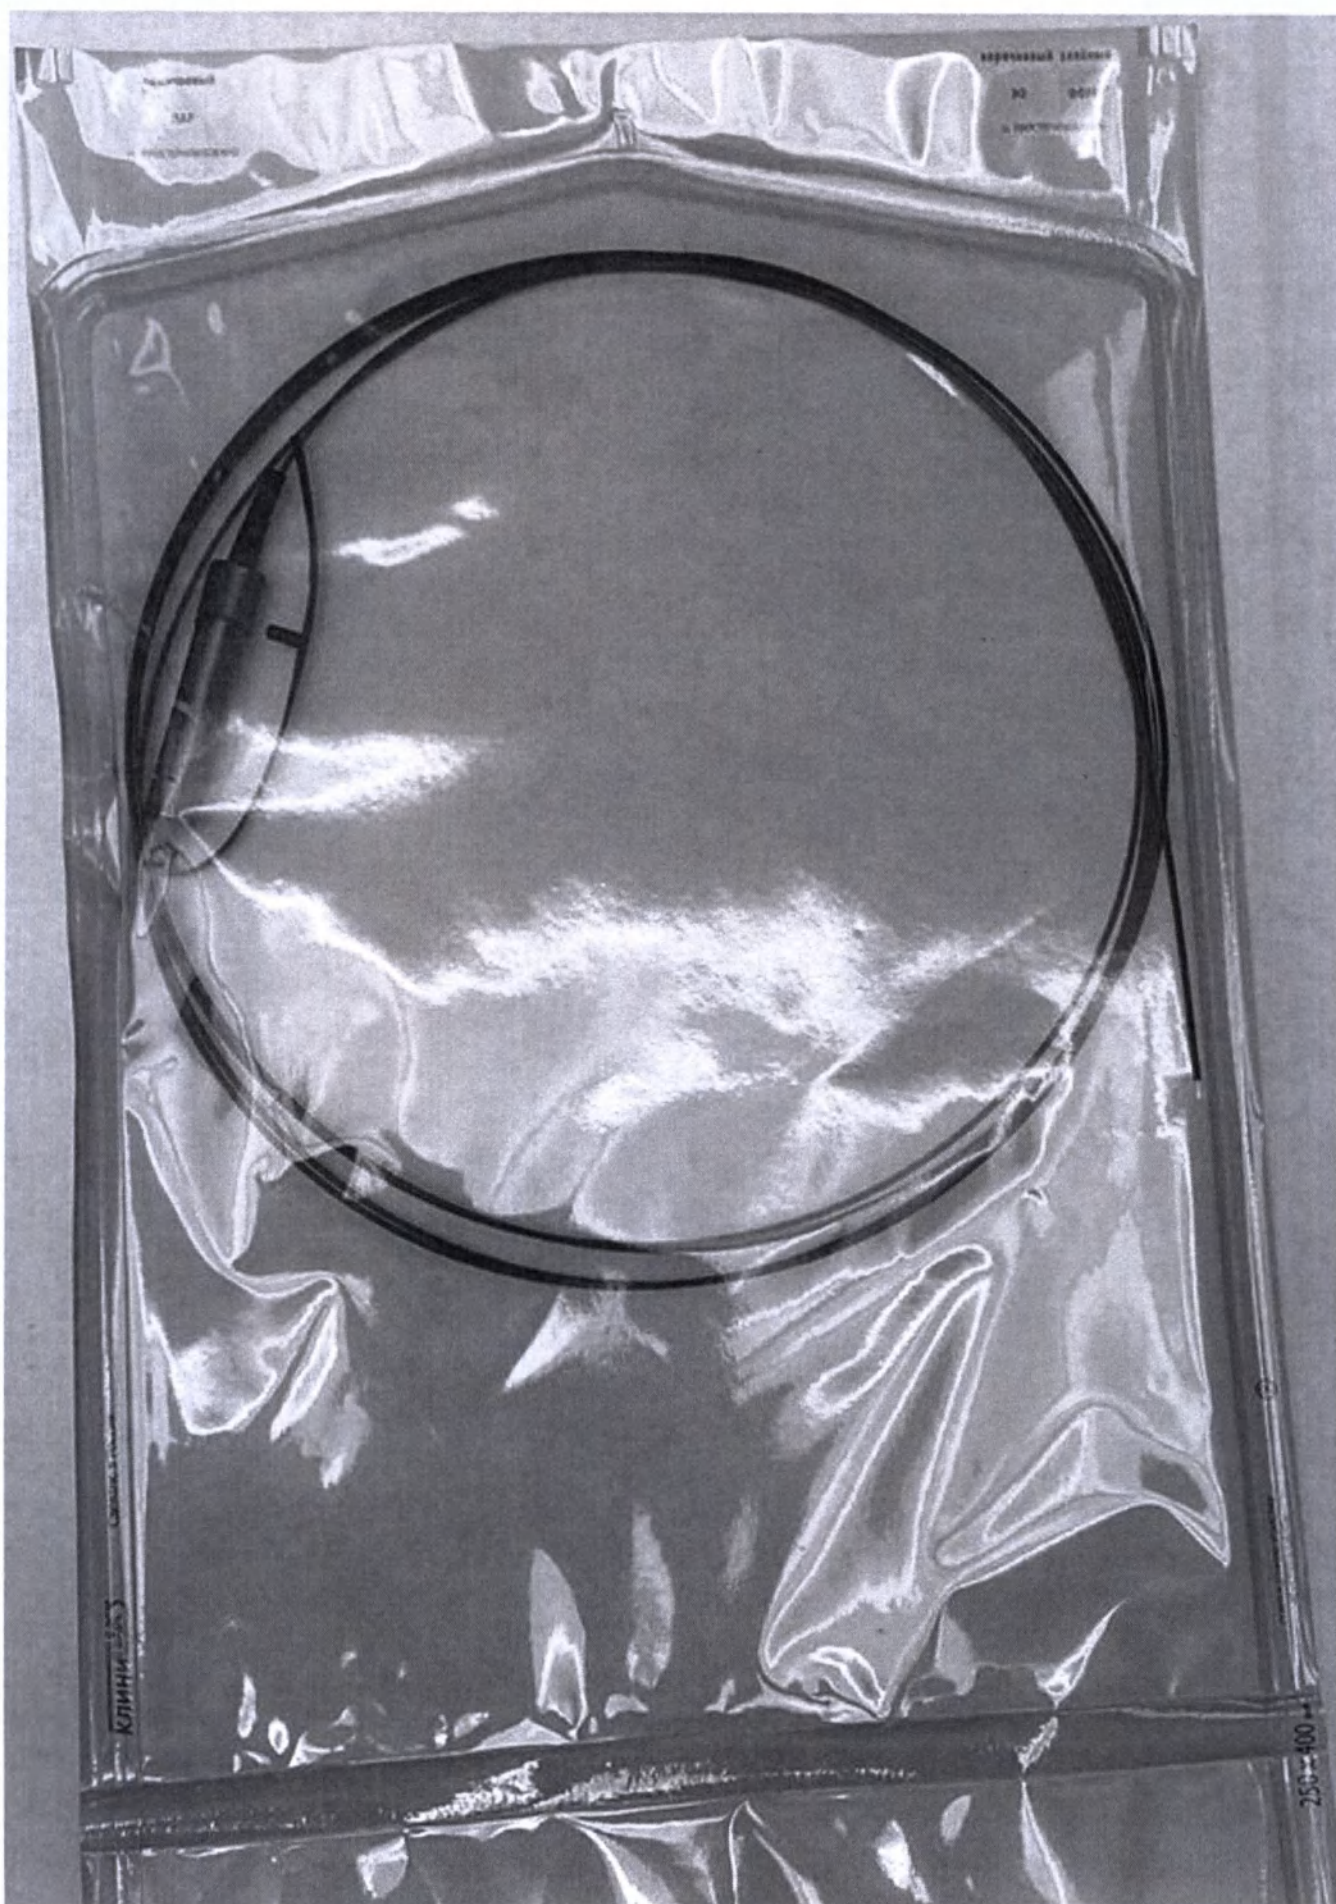

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм разъем SMA-905, LP

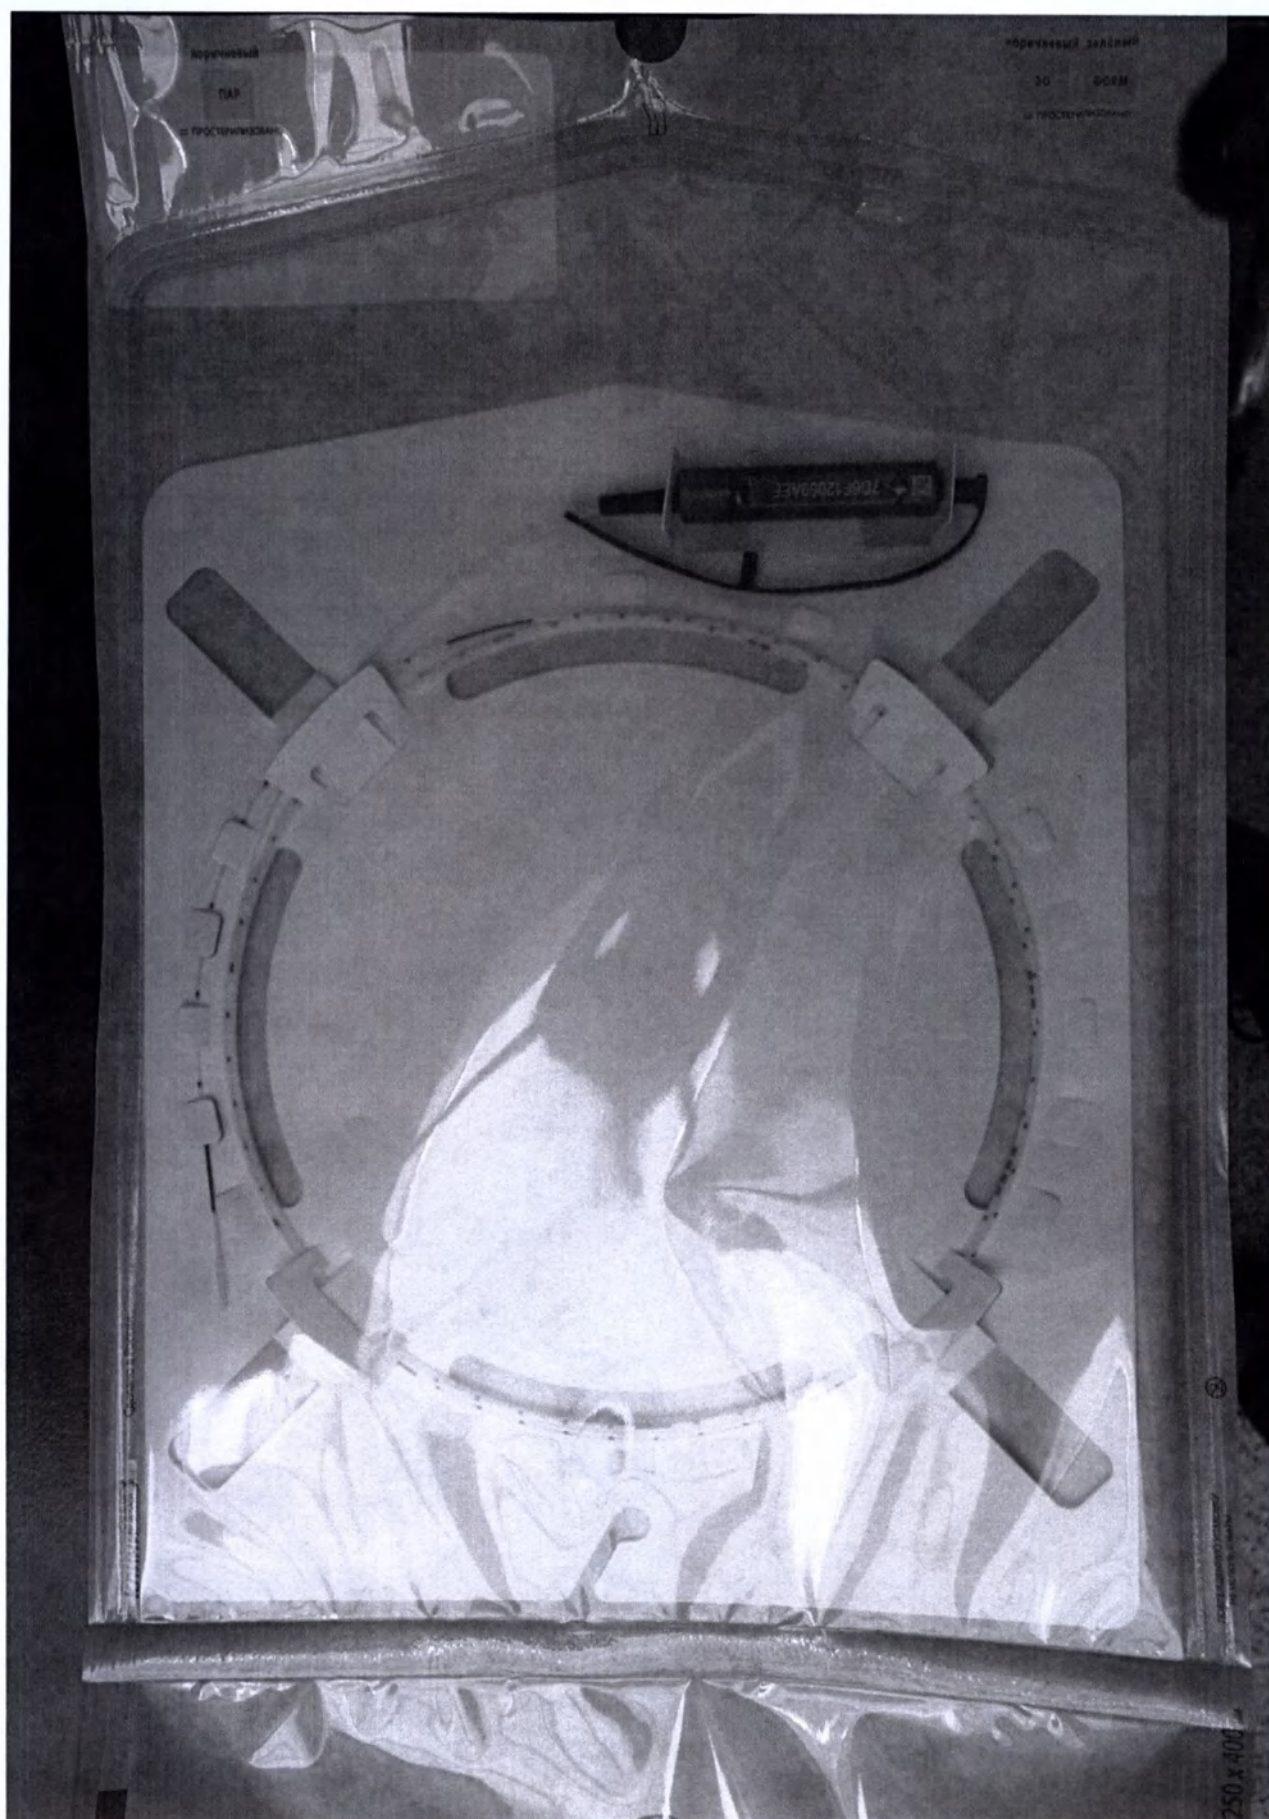


Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, вариант исполнения:


Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с
радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP *4

*4 Внешний вид полностью идентичен вариантам исполнения:

- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 110 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 150 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 200 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 365 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 940 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с конусовидным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP, max.
- Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с конусовидным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP, max.



IPG SURGICAL FIBER

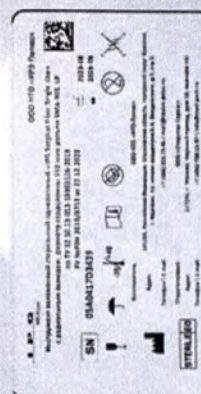


Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, внешний вид потребительской (транспортной) упаковки (варианты исполнения:

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм, разъем SMA-905, LP

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм, разъем SMA-905, LP, max)

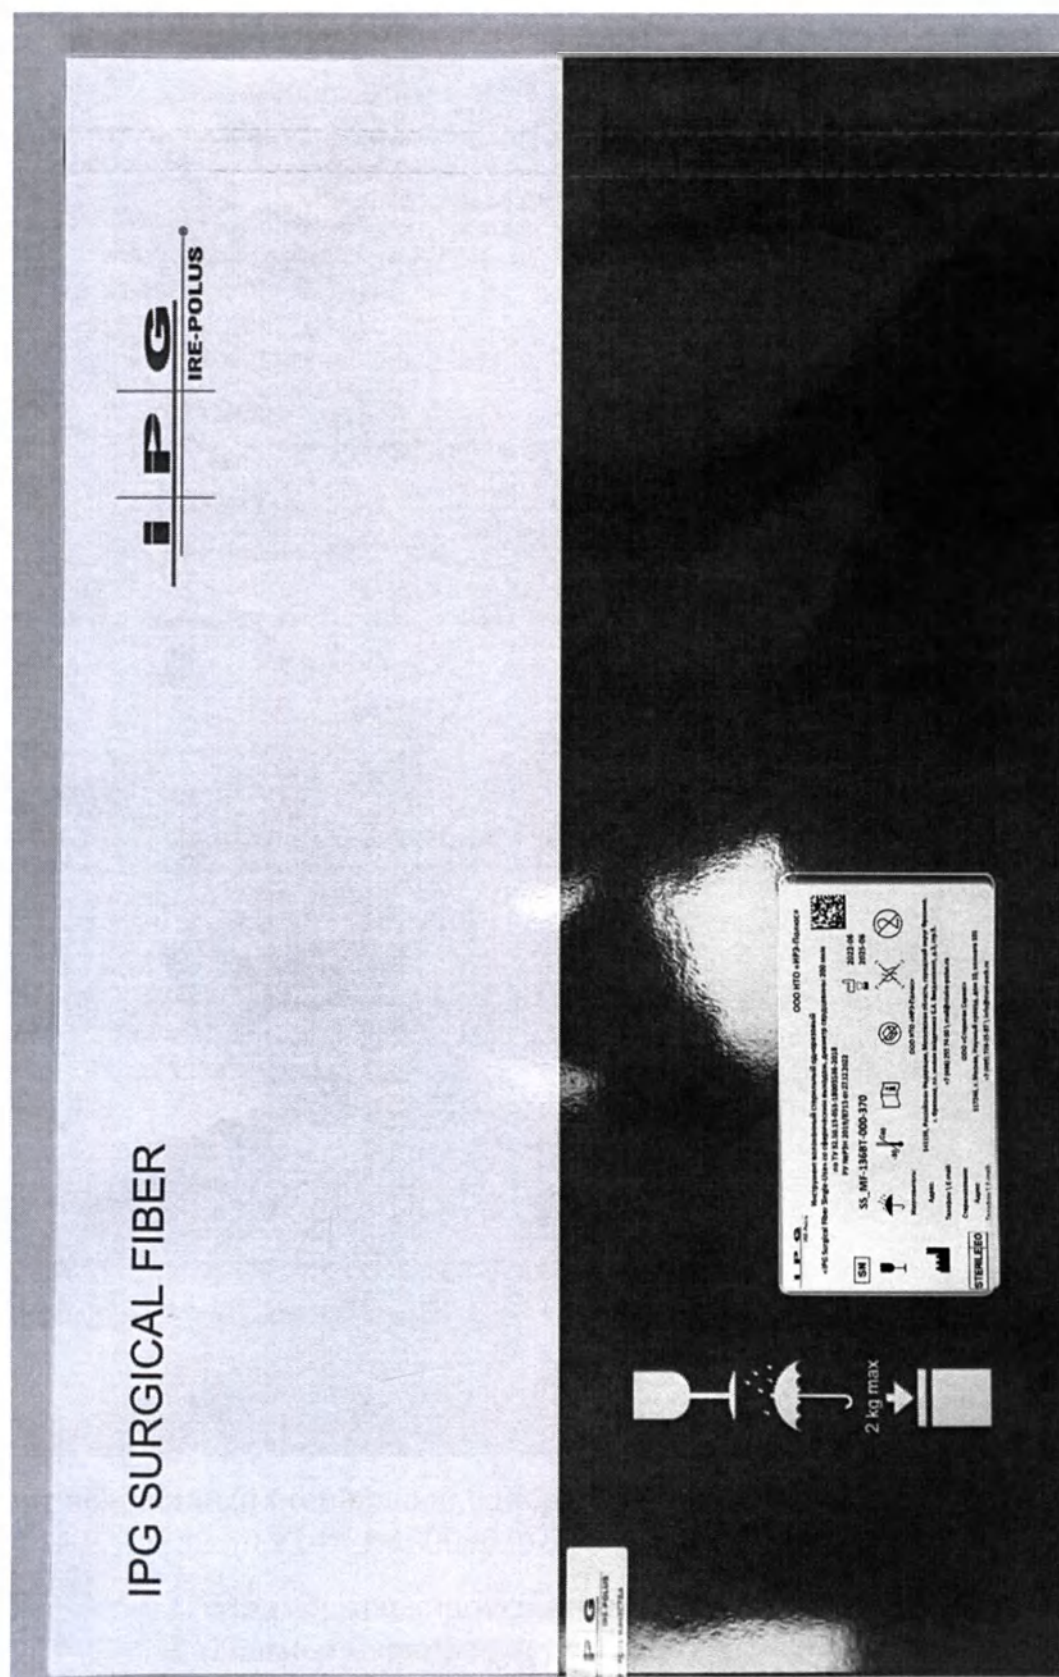

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, внешний вид потребительской (транспортной) упаковки
(все варианты исполнения, кроме:

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм, разъем SMA-905, LP

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм, разъем SMA-905, LP, max)

1

IPG
IRE-Polus


ООО НТО «ИРЭ-Полюс»

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP.

по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018

ПУ №РЗН 2019/8713 от 27.12.2022

SN



Изготовитель:

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»

Адрес:

141190, Российская Федерация, Московская область, городской округ Фрязино,
г. Фрязино, пл. имени академика Б.А. Введенского, д.3, стр.5.

Телефон \ E-mail:

+7 (496) 255 74 46 / mail@ntoire-polus.ru

Стерилизовано:

Адрес:

Телефон \ E-mail:

STERILE EO

2.1

IPG
IRE-Polus

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP.

по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018

ПУ №РЗН 2019/8713 от 27.12.2022

SN



Изготовитель:

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»

Адрес:

141190, Российская Федерация, Московская область, городской округ Фрязино,
г. Фрязино, пл. имени академика Б.А. Введенского, д.3, стр.5.

Телефон \ E-mail:

+7 (496) 255 74 46 / mail@ntoire-polus.ru

Стерилизовано:

Адрес:

Телефон \ E-mail:

STERILE EO

2.2




2 kg max



3.1



3.2

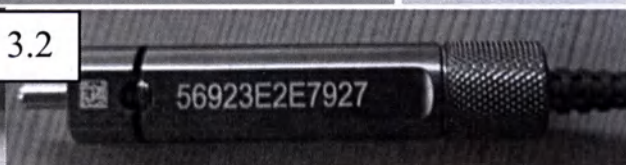

Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use» по
ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, пример маркировки:

1. Пример маркировки индивидуальной упаковки
2. Пример маркировки потребительской упаковки
3. Пример маркировки разъема



Инструмент волоконный стерильный одноразовый «IPG Surgical Fiber Single-Use»
по ТУ 32.50.13-053-18003536-2018, внешний вид и маркировка групповой упаковки

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18
листах

