



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации

медицинских изделий

ООО «Алкон Фармацевтика»



Д.О. Волкова

2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Антиглаукомное фильтрационное устройство EX-PRESS

производства «Алкон Лабораториз, Инк.», США (Alcon Laboratories, Inc., USA)

Русскоязычный стикер

Антиглаукомное фильтрационное устройство EX-PRESS
Модель P-50 или P-200 (см. упаковку)
СТЕРИЛЬНО. РАДИАЦИОННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ.
НЕТОКСИЧНО. АПИРОГЕННО.
НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 шт.

Производитель:
 «Алкон Лабораториз, Инк.», США
 Alcon Laboratories, Inc.,
 6201 South Freeway, Fort Worth,
 TX 76134-2099, USA.

Страна производства:
 США или Израиль (см. упаковку)

Регистрационное удостоверение
 № ФСЗ 2009/04320

Условия транспортирования и хранения: от -20°C до +55°C

Уполномоченный представитель производителя
 на территории Российской Федерации / импортер
 / организация, принимающая претензии на
 территории Республики Беларусь:
 ООО «Алкон Фармацевтика».
 Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.3.
 Тел. +7 (495) 961-1333.

Номер по каталогу **REF**: /Код партии **LOT**: /Использовать до : /Дата изготовления : /
 Серийный номер **SN**: см. упаковку.

Макеты англоязычных стикеров

EX-PRESS®
Glaucoma Filtration Device
Version P-50
GTIN
00380650704962
CE 0123

SN005 Rev02

REF 24053
LOT 000000
 2000-00-00
 2000-00-00
SN 00000000

EX-PRESS®
Glaucoma Filtration Device
Version P-200
GTIN
00380650704979
CE 0123

SN006 Rev02

REF 24203
LOT 000000
 2000-00-00
 2000-00-00
SN 00000000


ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
2 ЛИСТА(ОВ)

Д.О. Волкова




Фотографические изображения представленных образцов медицинского изделия

**«Антиглаукомное фильтрационное устройство EX-PRESS»,
производства «Алкон Лабораториз, Инк.», США (Alcon Laboratories, Inc.)**

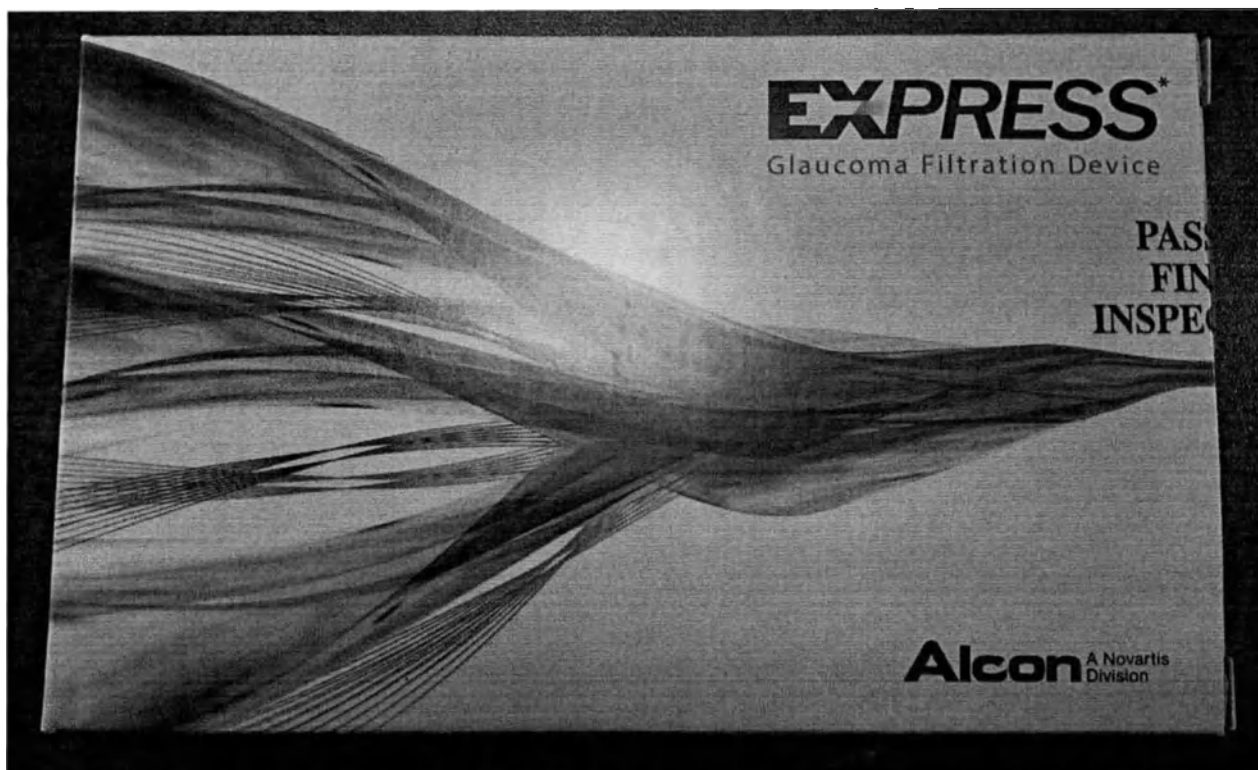


EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 μm).
Вид во внешней упаковке.

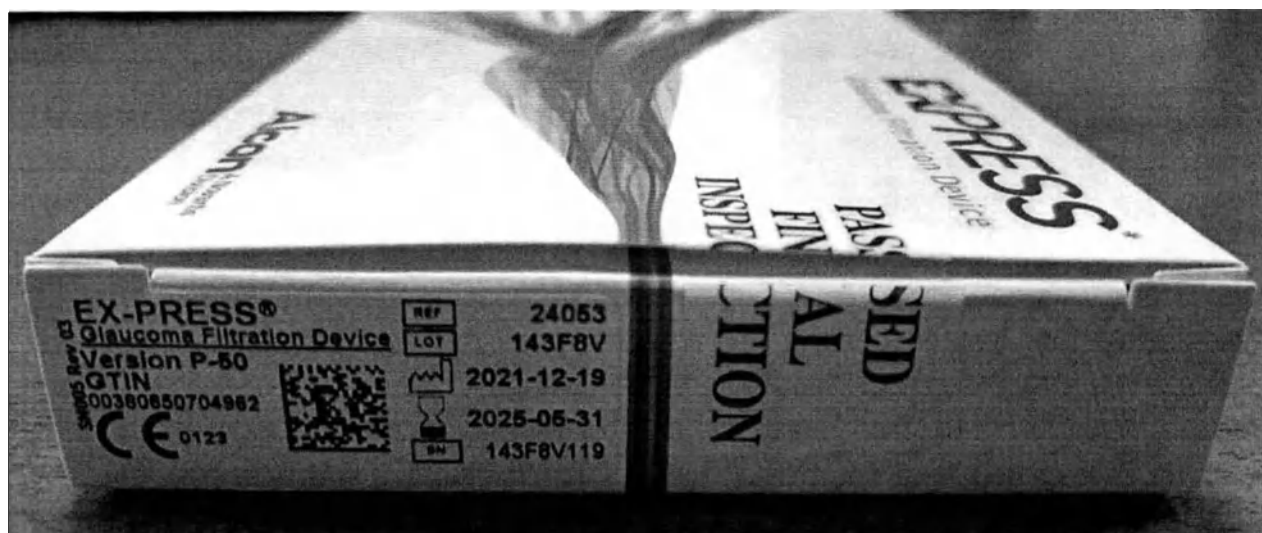


EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 μm).
Маркировка внешней упаковки.




EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 µm).
Содержимое упаковки.

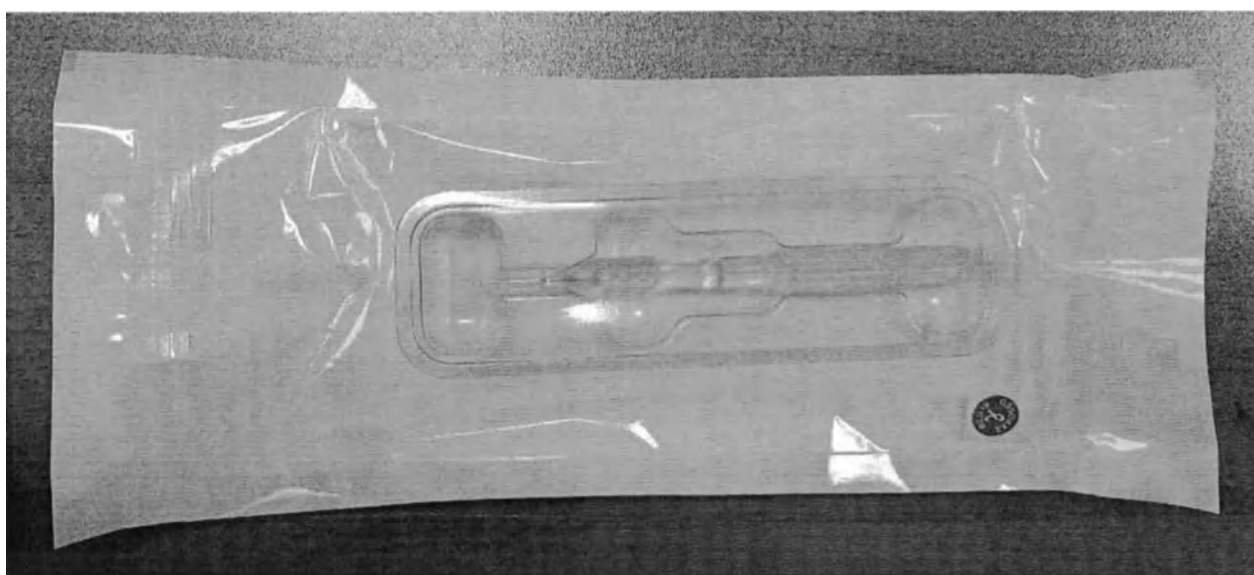


EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 µm).
Вид в стерильной упаковке.

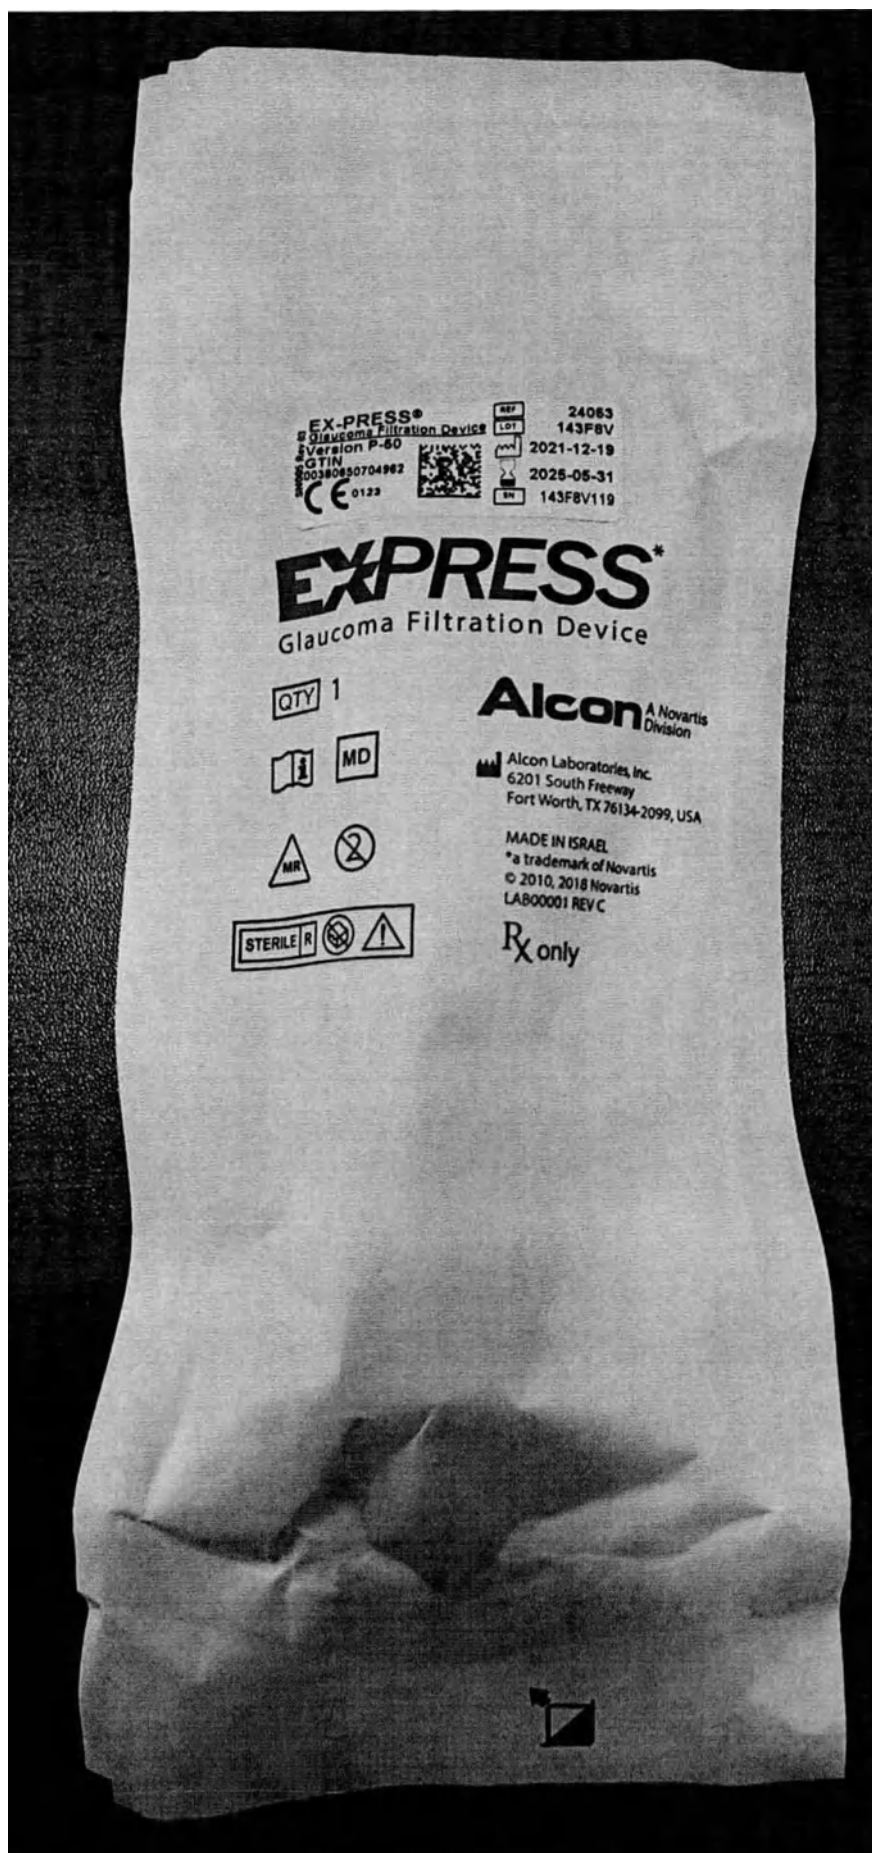


EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 µm).
Маркировка стерильной упаковки.

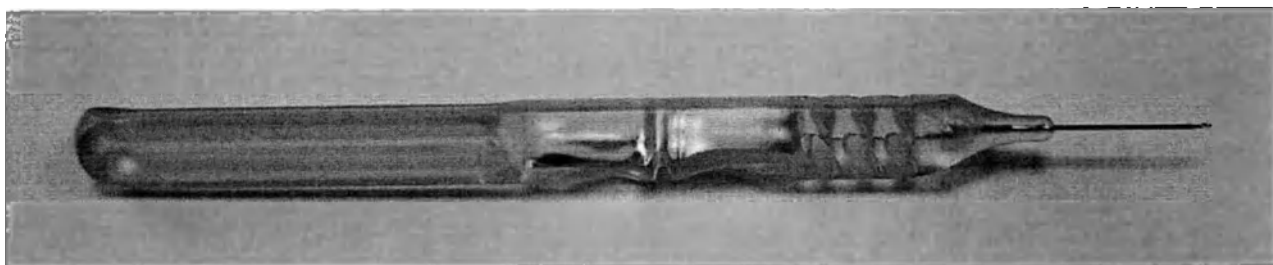


EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 μm).
Вид без упаковки. Ракурс 1.

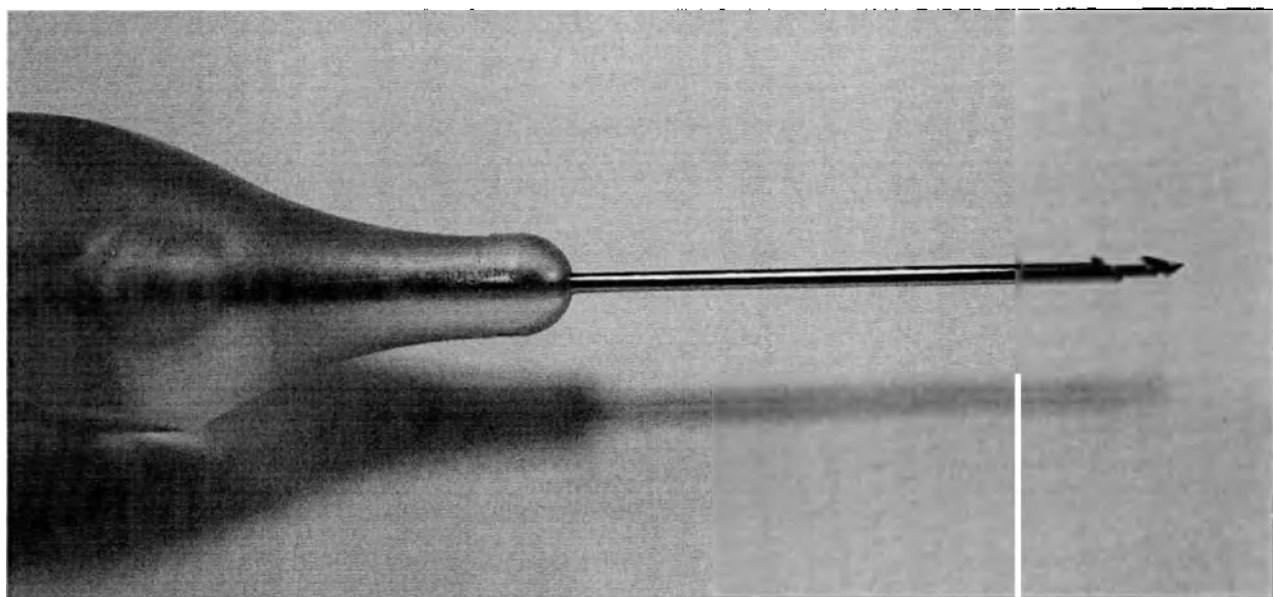

EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-50 (internal lumen size 50 μm).
Вид без упаковки. Ракурс 2.

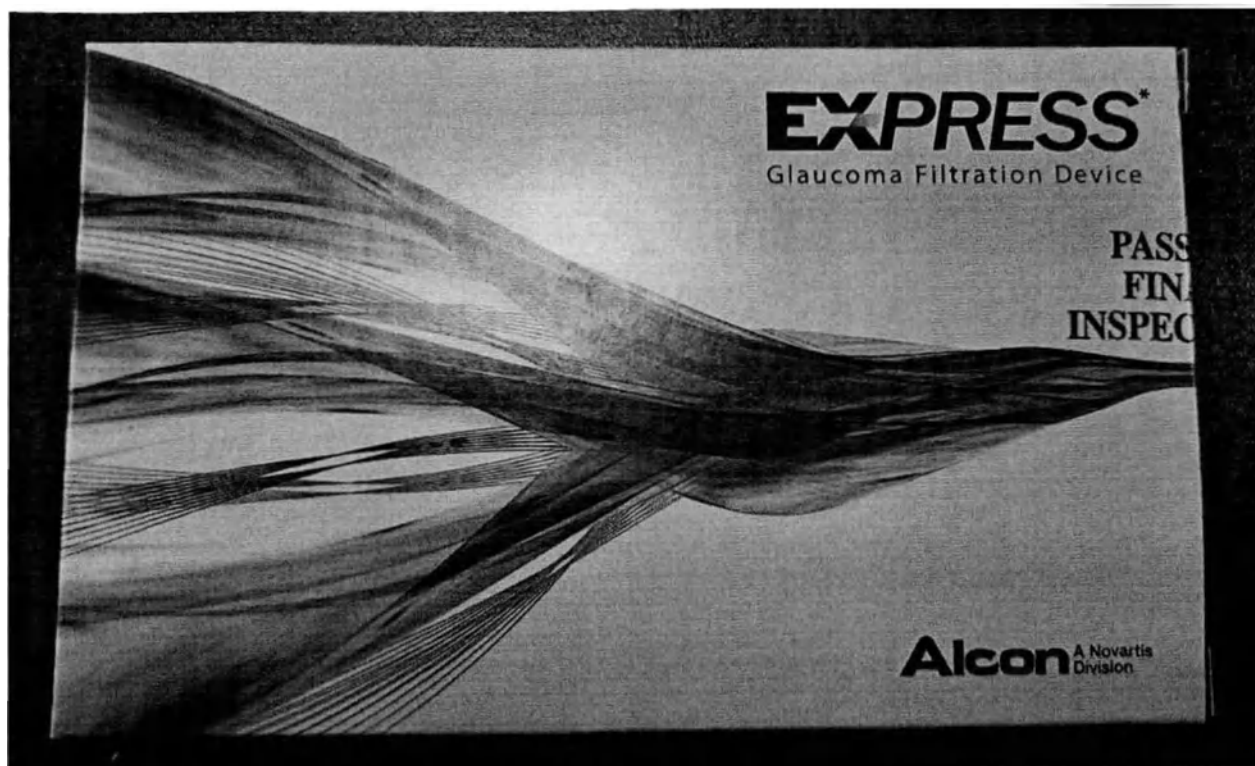

EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μm).
Вид во внешней упаковке.

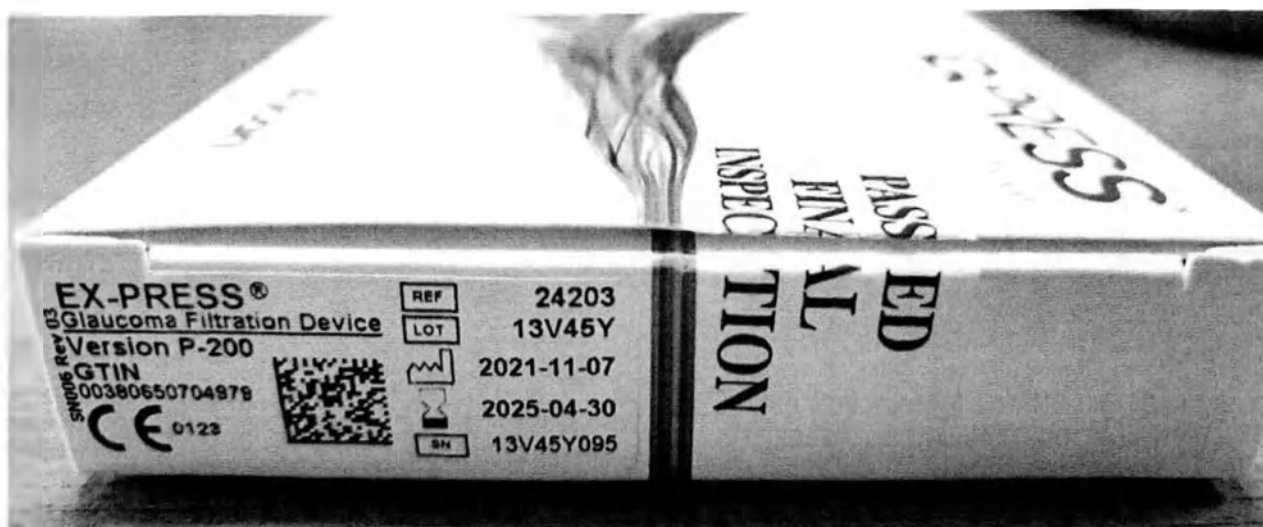


EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μm).
Маркировка внешней упаковки.




EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μ m).
Содержимое упаковки.




EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μ m).
Вид в стерильной упаковке.

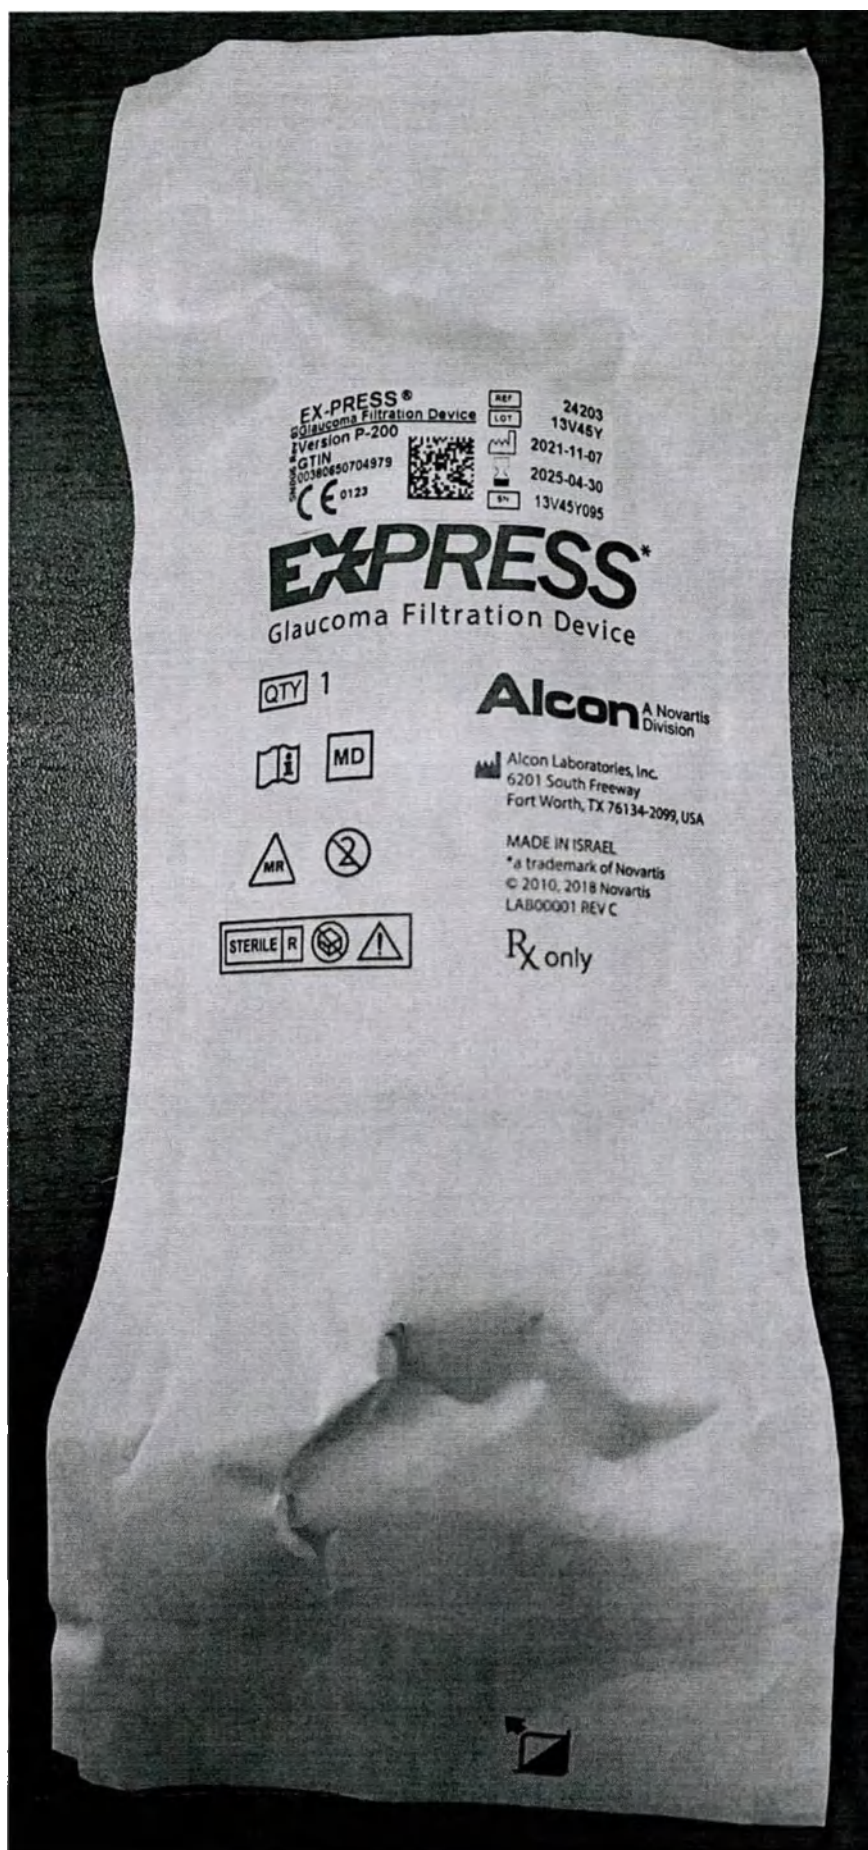

EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μ m).
Маркировка стерильной упаковки.

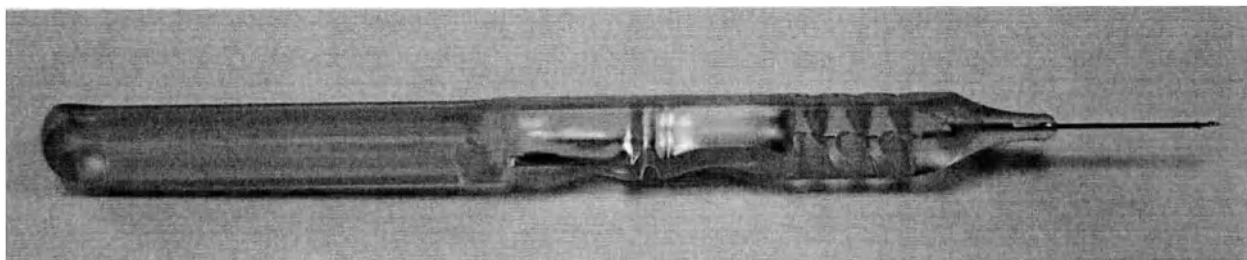

EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μm).
Вид без упаковки. Ракурс 1.

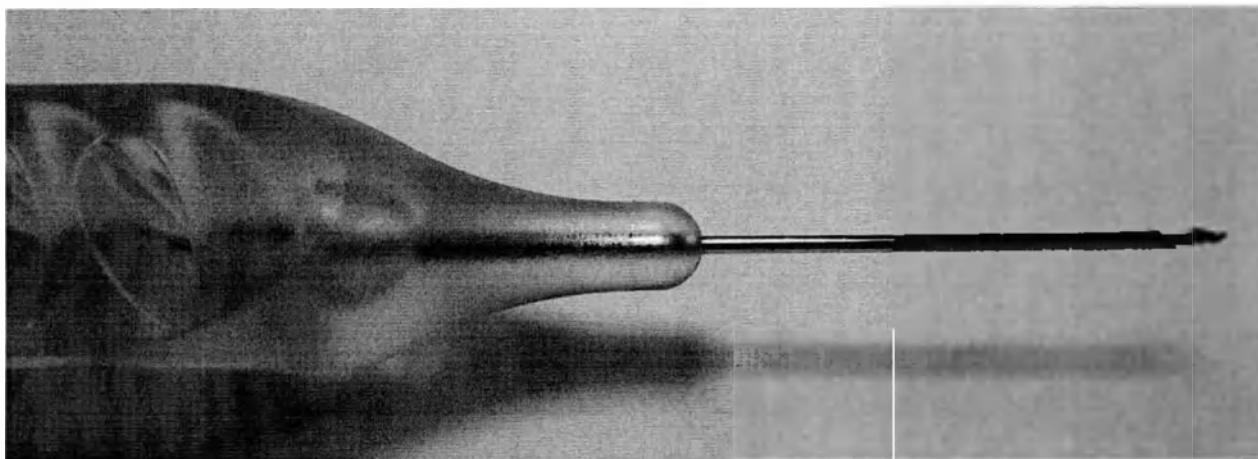

EX-PRESS Glaucoma Filtration Device, model P-200 (internal lumen size 200 μm).
Вид без упаковки. Ракурс 2.