

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СибАкадемТехнологии»

«23» октября 2023 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ГРЕБЕНКА НАКОНЕЧНИКОВ НА МАГНИТНЫЕ СТЕРЖНИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ НА 96 НАКОНЕЧНИКОВ, ВСМ®

Версия 1 от «23» октября 2023 г.

Образец маркировки потребительской упаковки:

Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с
системой выделения нуклеиновых кислот на 96 наконечников, ВСМ®
ТУ 32.50.50-007-72241324-2023

(2 шт.)

Изделие нестерильно

Изделие однократного применения

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



ММ.ГГГГ

Каталожный номер (артикул): ВСМ-PCR-GR-96



ММ.ГГГГ

Номер партии: ВСМGR/ММГГ



ООО «СибАкадемТехнологии», 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1
Адрес производства: 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 3

Уполномоченный представитель производителя:

АО «БиоХимМак Диагностика», 119311, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный
округ Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3

Изделие выдерживает температуру при хранении от минус 20 °С до плюс
35 °С. Относительная влажность воздуха не более 90 %.



РУ №



biochemmack.ru
+7 (495) 647-27-40
info@biochemmack.ru

Примечание: на маркировке указывается вместо ММ – месяц, ГГГГ и ГГ– год
(при заполнении значений допускается смещение последующего на строке текста).
Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки, а
также черного текста относительно цветного, не нормировано.

Образец маркировки транспортной упаковки:

Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот на 96 наконечников, BCM®, в составе:

- Гребенка наконечников на магнитные стержни для использования с системой выделения нуклеиновых кислот на 96 наконечников, BCM® – 25 упаковок по 2 гребенки;
- Инструкция по применению – 1 шт.

ТУ 32.50.50-007-72241324-2023

Изделие нестерильно

Изделие однократного применения

Не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия



ММ.ГГГГ

Каталожный номер (артикул): BCM-PCR-GR-96



ММ.ГГГГ

Номер партии: BCMGR/MMГГ



ООО "СибАкадемТехнологии", 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1

Адрес производства: 630068, г.Новосибирск, ул.Одоевского, д.3


Уполномоченный представитель производителя:

АО "БиоХимМак Диагностика", 119311, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ
Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3

РУ №



-20°C



35°C

Масса брутто: X,XXX кг



biochemmack.ru
+7 (495) 647-27-40
info@biochemmack.ru


Примечание: на маркировке указывается вместо X – цифра, ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год (при заполнении значений допускается смещение последующего на строке текста). Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки, а также черного текста относительно цветного, не нормировано.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 (*двух*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

[Подпись]
П.А. Самойлов



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СибАкадемТехнологии»


П.А. Самойлов
«23» октября 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**ГРЕБЕНКА НАКОНЕЧНИКОВ НА МАГНИТНЫЕ СТЕРЖНИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
НА 96 НАКОНЕЧНИКОВ, ВСМ®**

Версия 1 от «23» октября 2023 г.



Внешний вид, вид сверху

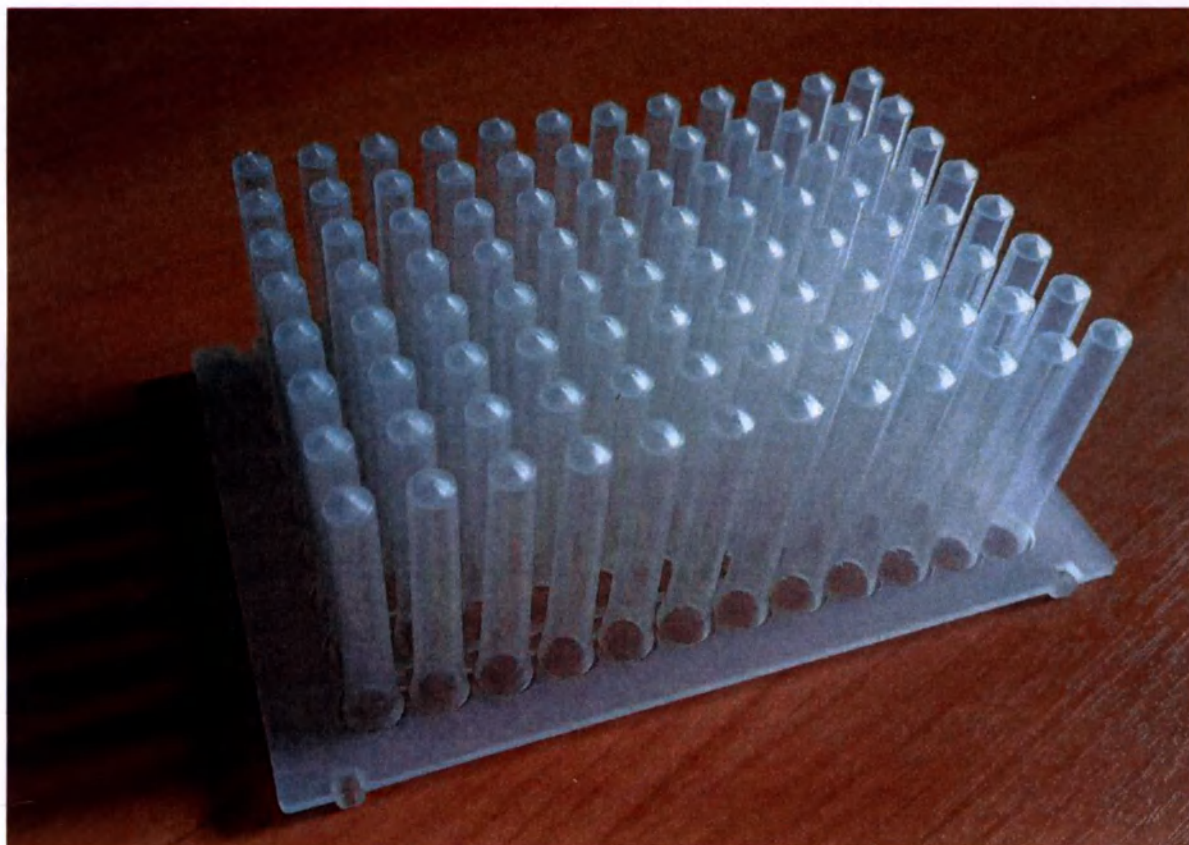


Внешний вид, вид снизу



Потребительская упаковка




Потребительская упаковка

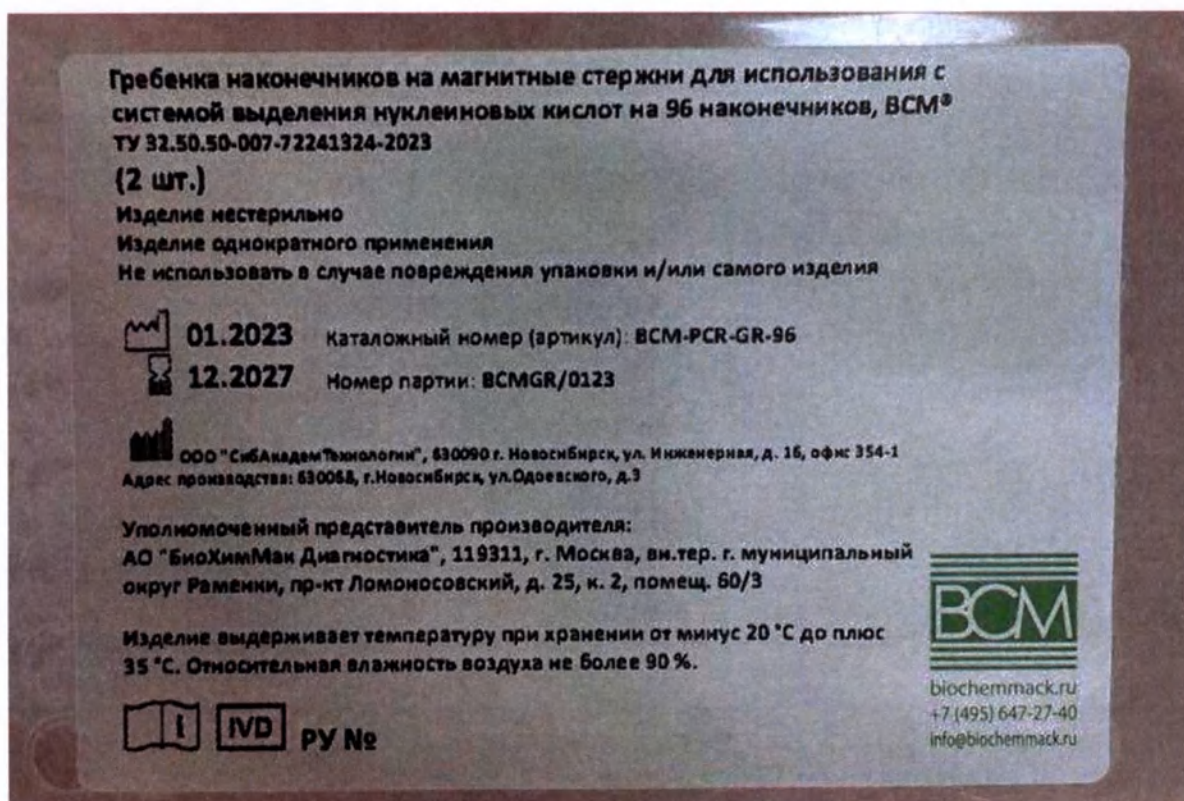

Маркировка потребительской упаковки



Транспортная упаковка

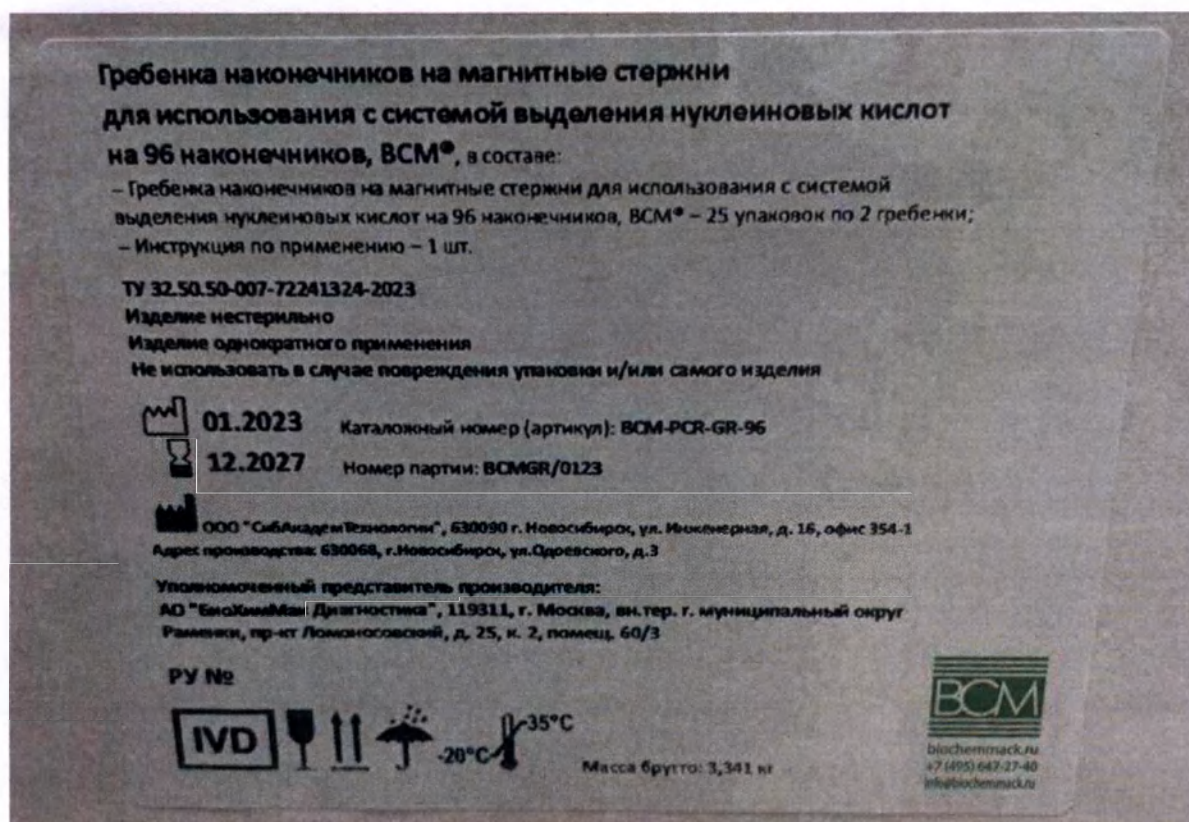

Маркировка транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 4 (четыре) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

С.А.

П.А. Самойлов

