

DIACONT



ООО «ДИАКОНТ» ИНН 7714792851, г. Москва, 125284, ул.Беговая дом 13, кв 90, Тел. +7(495)971-1944,
e-mail: diacont@diacontru.com www.diacontru.com

Фотографические изображения медицинского изделия

**Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией
голосового сопровождения Voice, в составе**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «ДИАКОНТ»



П.И.Шишко

2024г.



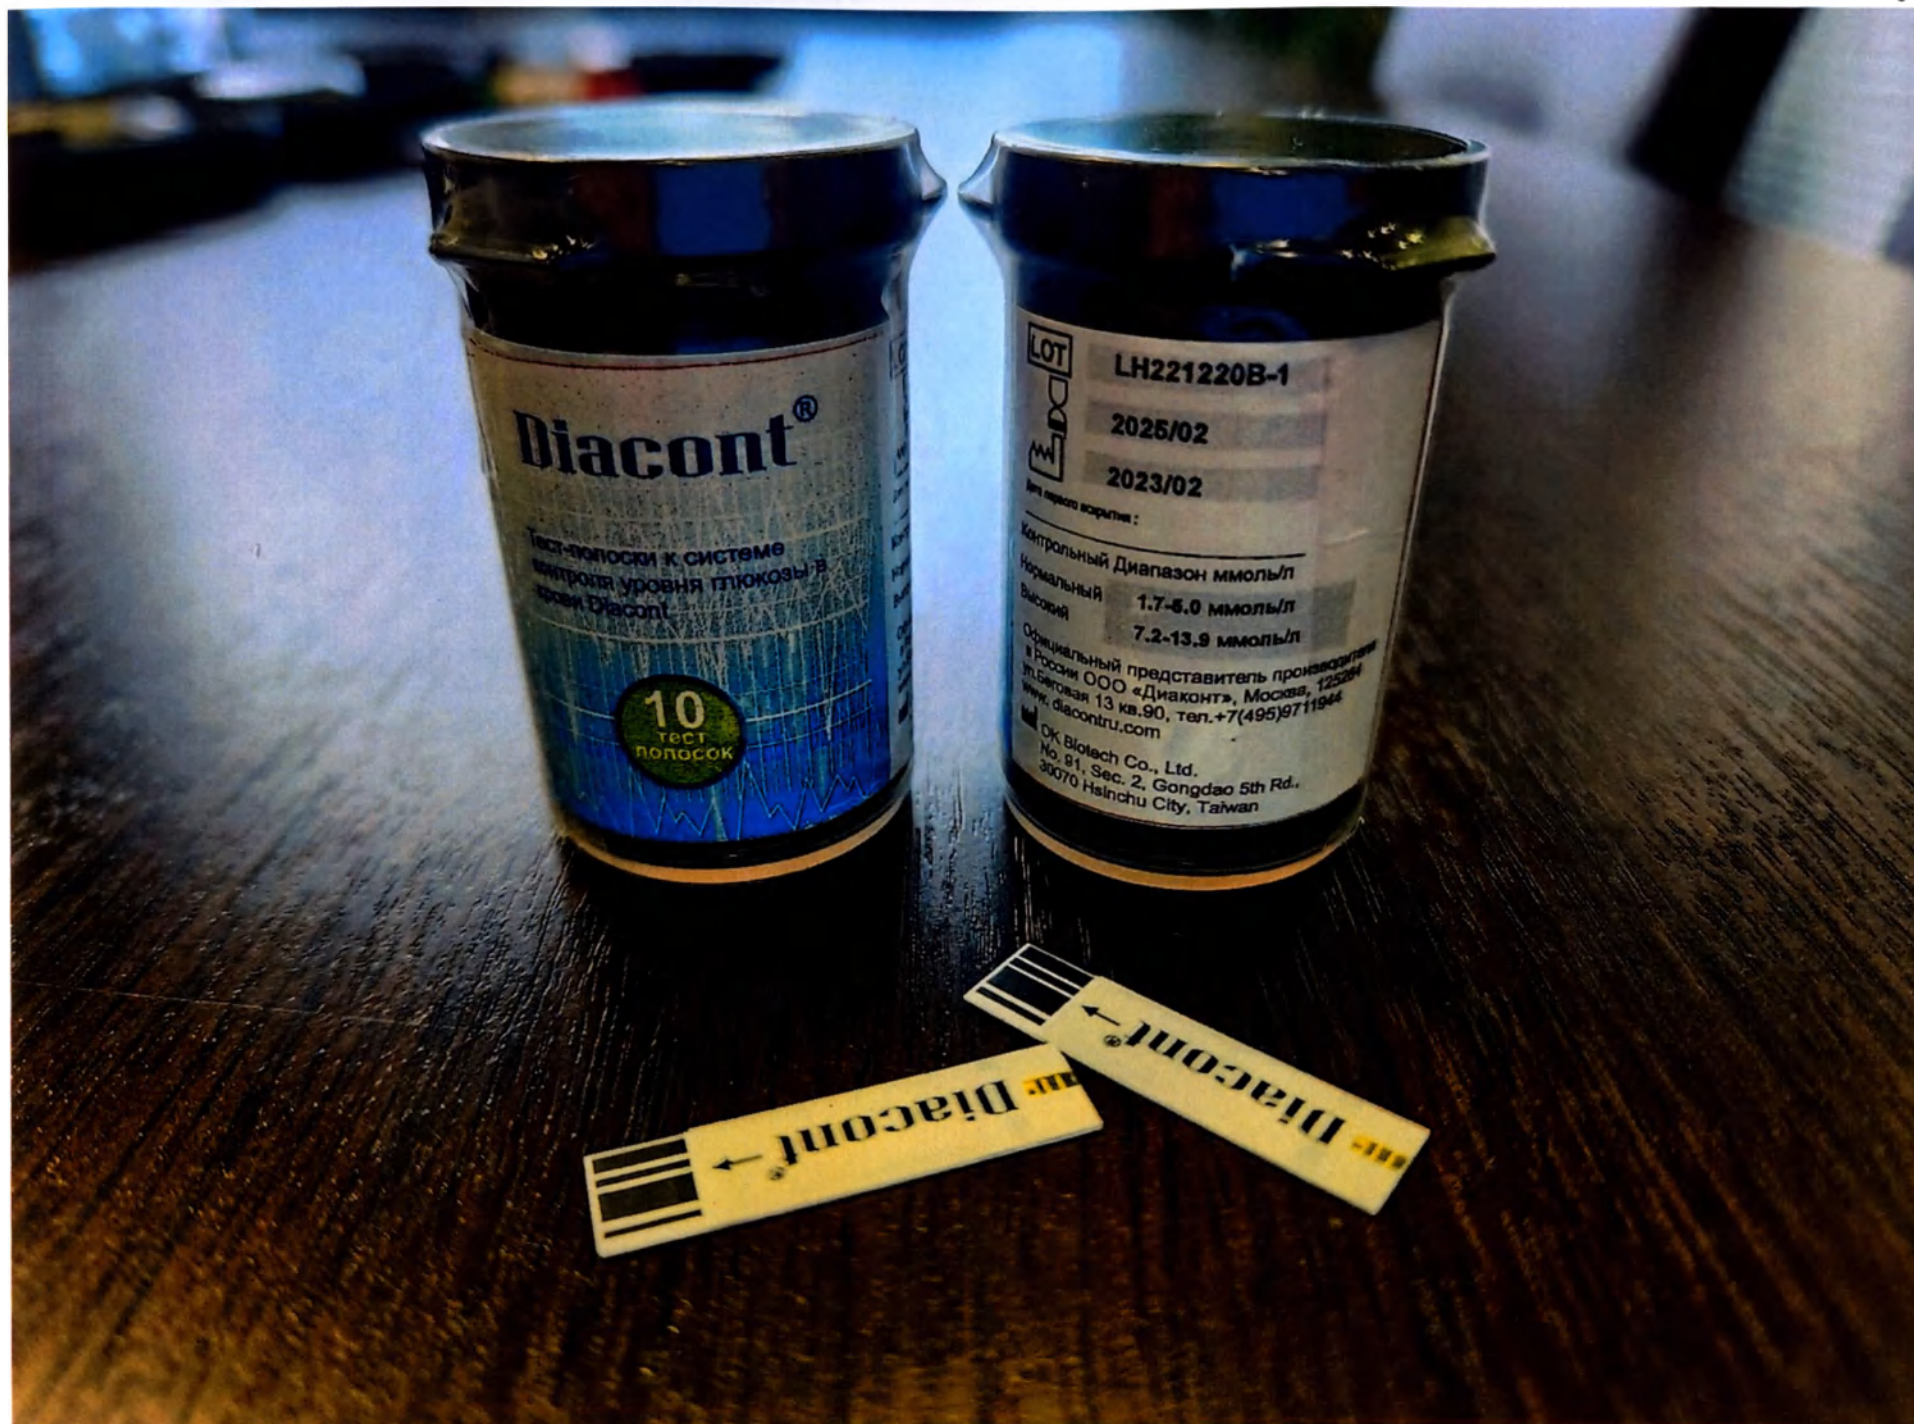











Для использования с тест-полосками и контрольным раствором «Diacont». Стандартный USB-кабель соединяет глюкометр с компьютером. На сайте www.diacont.ru скачайте программу для контроля диабета.

Вставьте тест-полоску в глюкометр. Прибор автоматически выключится. Не требуется кодирование глюкометра.

Прикоснитесь верхним краем тест-полоски к капле крови. Полоска сама втянет для анализа нужное количество крови.

Результат анализа вы увидите и услышите через 6 секунд.

Журнал «Математический анализ» выходит в свет
входит в ТУ 22.26.03-901-8879344-3023
в журналы «Математический анализ» и «Математический анализ»
в 1990 г.

5. Габариты по длине и высоте следующие в зависимости от типа: - 1 м;
6. Тип: блокные и панельные конструкции, имеющие следующие размеры: блокные - 1,0 м; панельные - 0,5 м. **OK Shalech Co. Ltd.**
P.1 No. 003 0019/0200 - 1,0 x 0,2 м
7. Конструкция: блокная и панельная
8. Тип: блокные и панельные конструкции: блокные - 1,0 м; панельные - 0,5 м. **OK Shalech Co. Ltd.** P.1 No. 003 0019/0200 - 1 м
9. Тип: блокные и панельные конструкции: блокные - 1,0 м; панельные - 0,5 м
10. Тип: блокные - 1 м
11. Высота: по высоте - 1 м

Присоединяется: ООО «Земан-Т», Россия,
125154 г. Москва, ул. Баранов, д. 11, кв. 92

Иванов Александр Иванович
У СОО «Визит-Медиа», Рязань, 161074,
Московский область, г. Ярославль,
ул. Пятницкая д. 4

[illegible]

Информация и приложения к статье
ссылается на журнал:
www.barnet.org, www.barnetra.com



**ПО ТУ 26.60.12-001-63752244-2023
С ФУНКЦИЕЙ ГОЛОСОВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ VOICE**



БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
МАЛЕНЬКАЯ КАПЛЯ
КРОВИ 0,7 мкл
ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЗА 6 СЕКУНД
ПАМЯТЬ НА 450
ИЗМЕРЕНИЙ
USB-ПОРТ
С КОМПЬЮТЕРОМ

ТОЧНО
ПРОСТО

10-62-7728-0020
V7-FEB21



Diacont

IVD Для IN VITRO диагностики

ВНИМАНИЕ!

- Для удобства монтажа изделие имеет специальные выступы, позволяющие вставить его в канал кабельной трассы.
- Благодаря своей прочной конструкции не деформируется при эксплуатации в системе Ресурс кабельных каналов.
- Не подвергается горению, поэтому не является источником дыма при пожаре.
- Не подвергается воздействию влаги. Под воздействием влаги не теряет своих свойств.
- Диапазон рабочих температур от +45°С до +120°С при относительной влажности 10-90%.
- Термометр Дэвидс — удобный прибор для измерения температуры в системах Дэвидс.
- Модульные элементы для обустройства кабельных трасс.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2009/06561 от 30.03.2009 г.



REF ID: A67351-002



4 670015 459993

Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice, в составе



Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice, в составе

Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont
по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice,
в составе:

1. Глюкометр Diacont с функцией голосового сопровождения – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор нормальной концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка «AAA» – 2 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice, в составе

Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont
по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice,
в составе:

1. Глюкометр Diacont с функцией голосового сопровождения – 1 шт.

SN

2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения Diacont, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2012/12700 – 10 шт./уп.

LOT

3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT

4. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.

LOT

5. Батарейка «AAA» – 2 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice, в составе

Комплектность

Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont
по ТУ 26.60.12-001-63752244-2023 с функцией голосового сопровождения Voice,
в составе:

1. Глюкометр Diacont с функцией голосового сопровождения – 1 шт.

SN

2. Батарейка «ААА» – 2 шт.
3. Футляр – 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 15 Л.

