

Система OPTIS Mobile для внутрисосудистой визуализации и внутрисосудистого измерения давления. Основной модуль-сойка оператора



Модуль лазера



Модуль вращения катетера














Блок соединения системы OPTIS Mobile с ангиографом



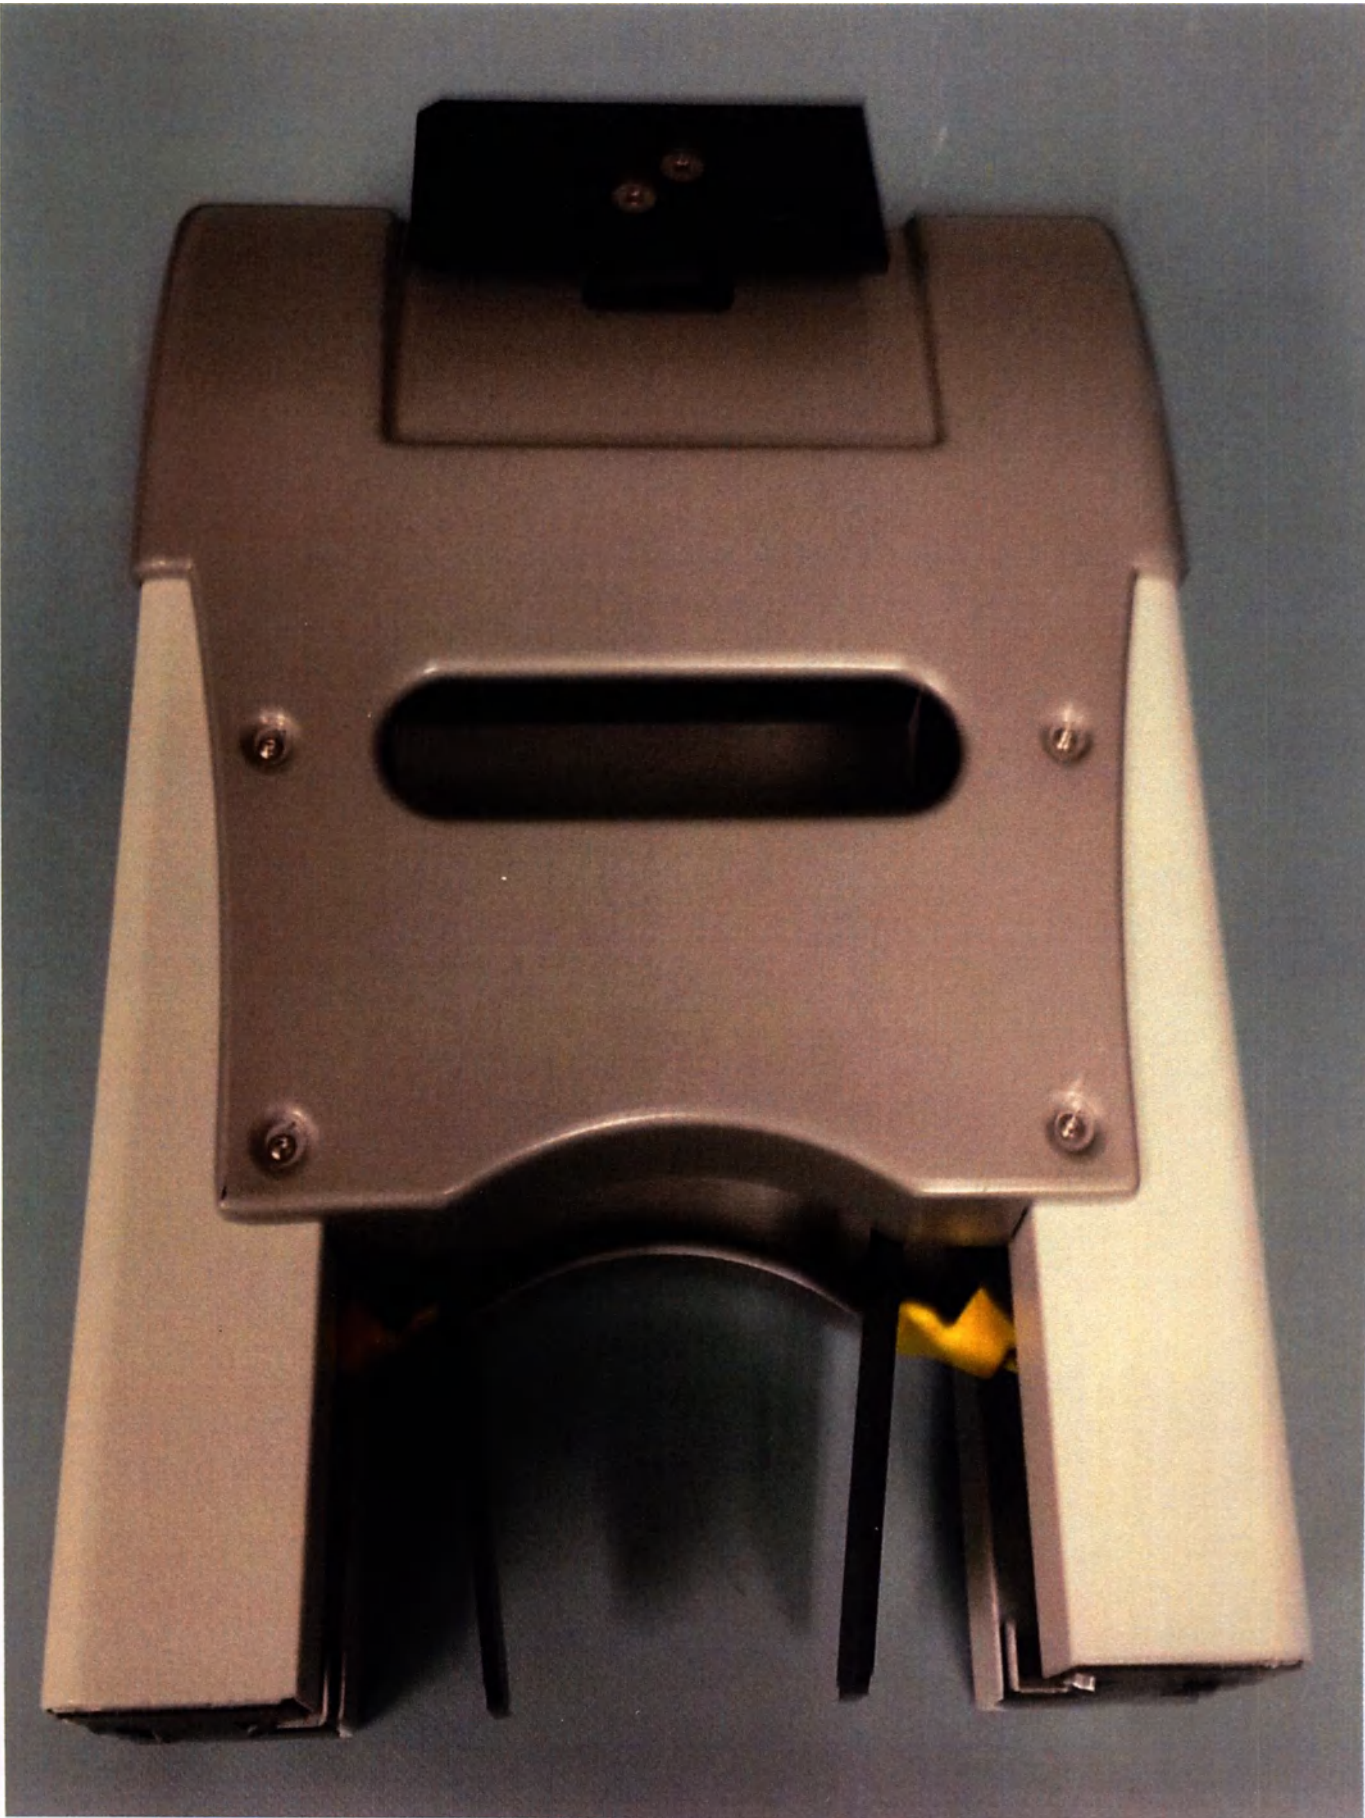

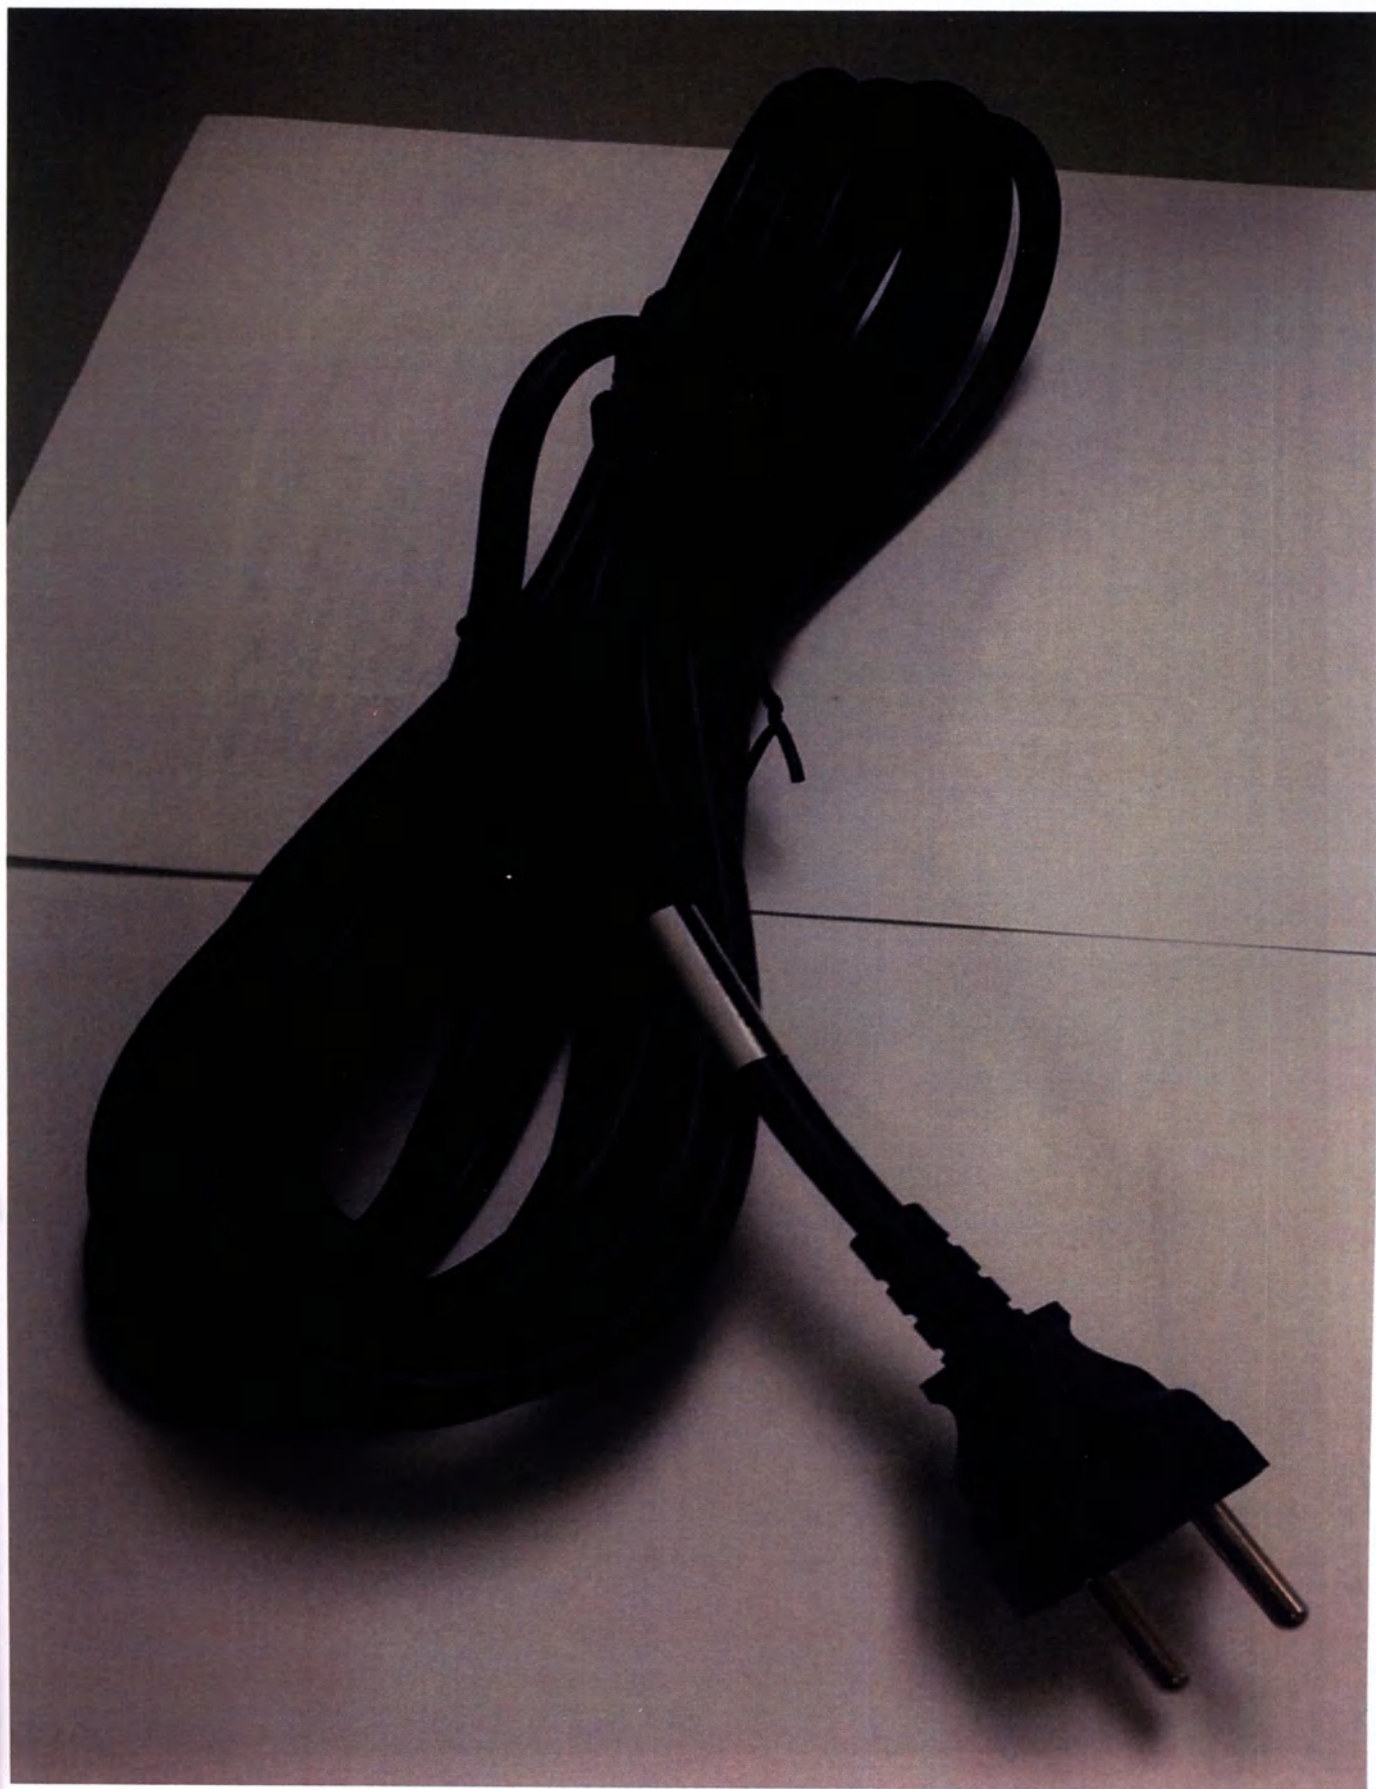

Кабель модуля лазера

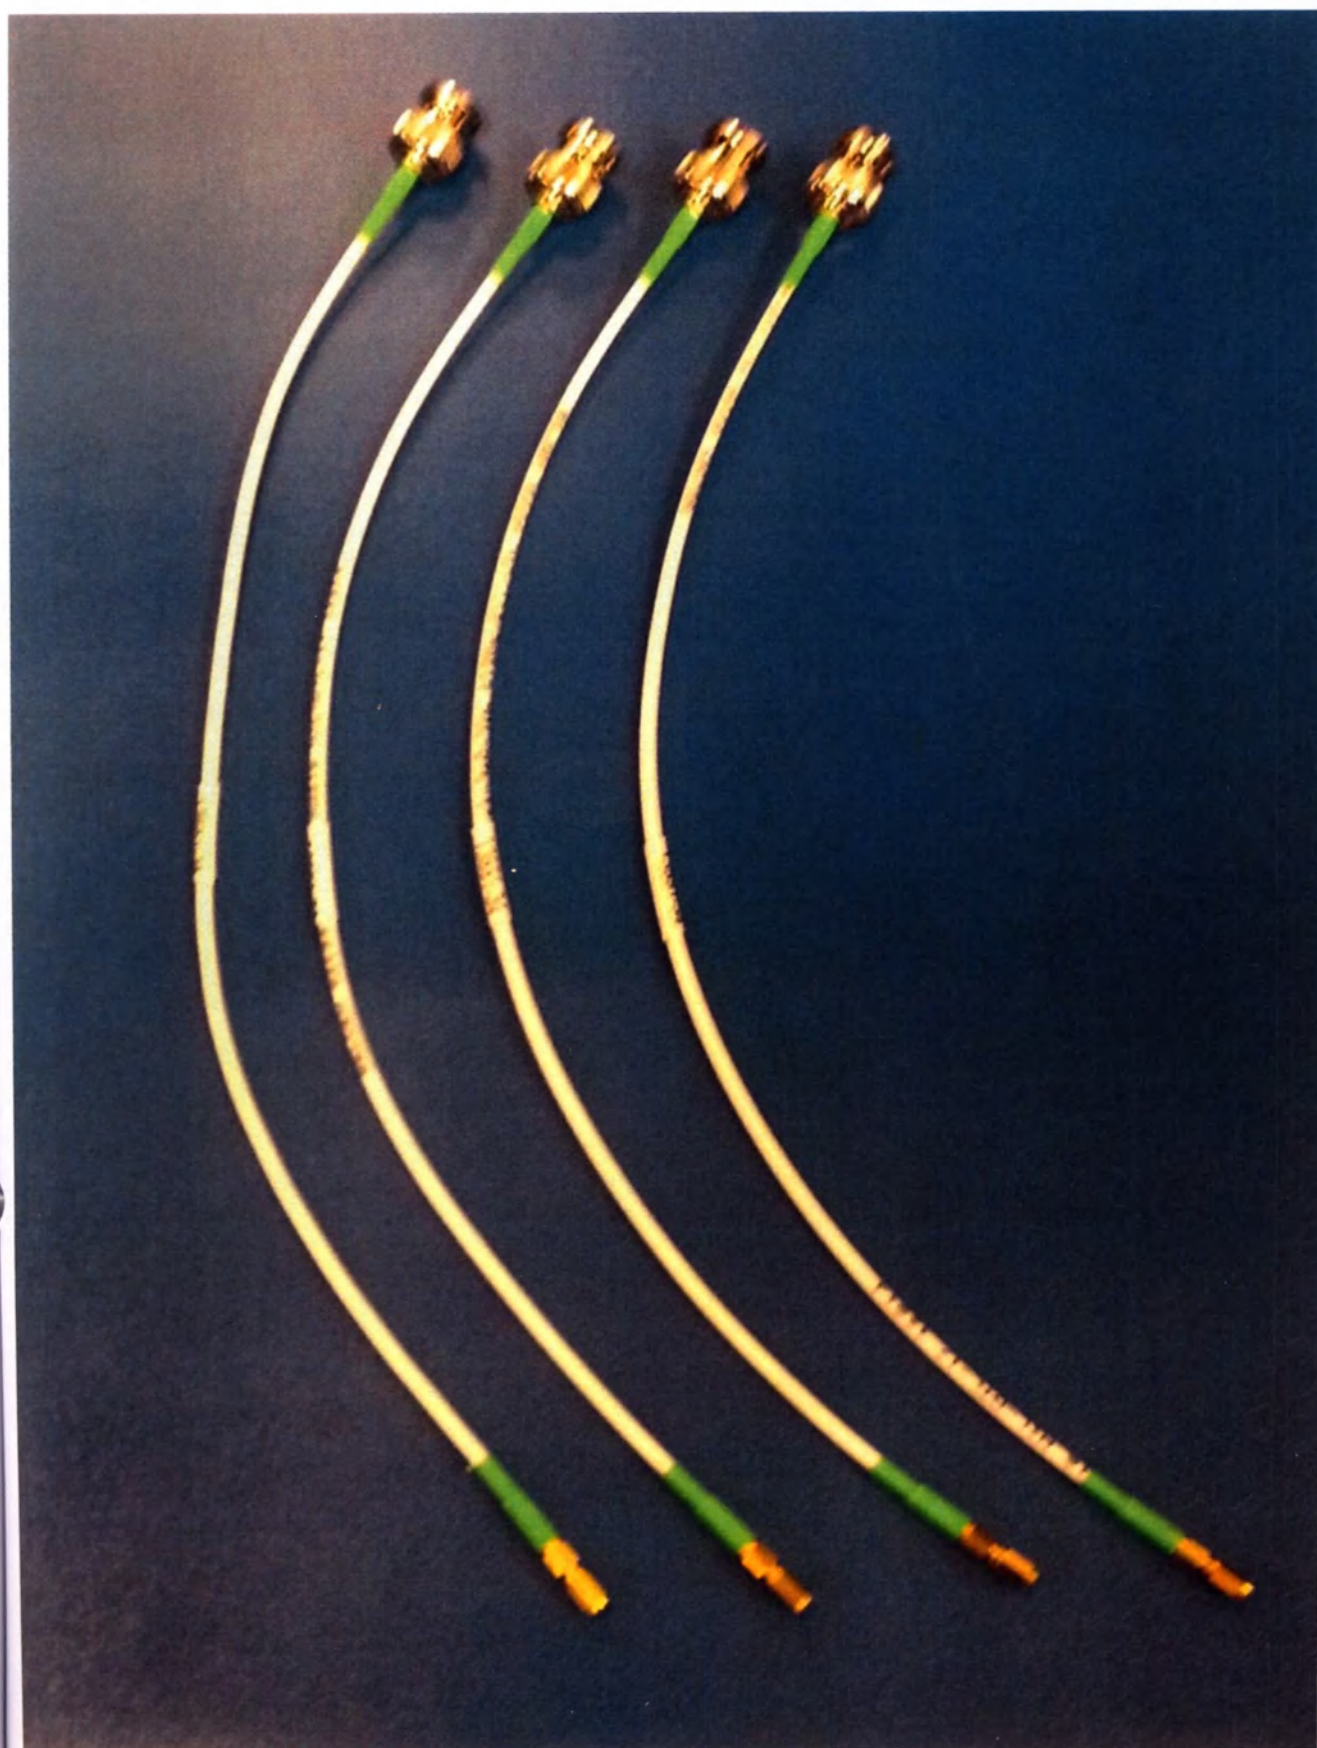



Кабели подключения монитора к компьютеру





Клавиатура компьютерная

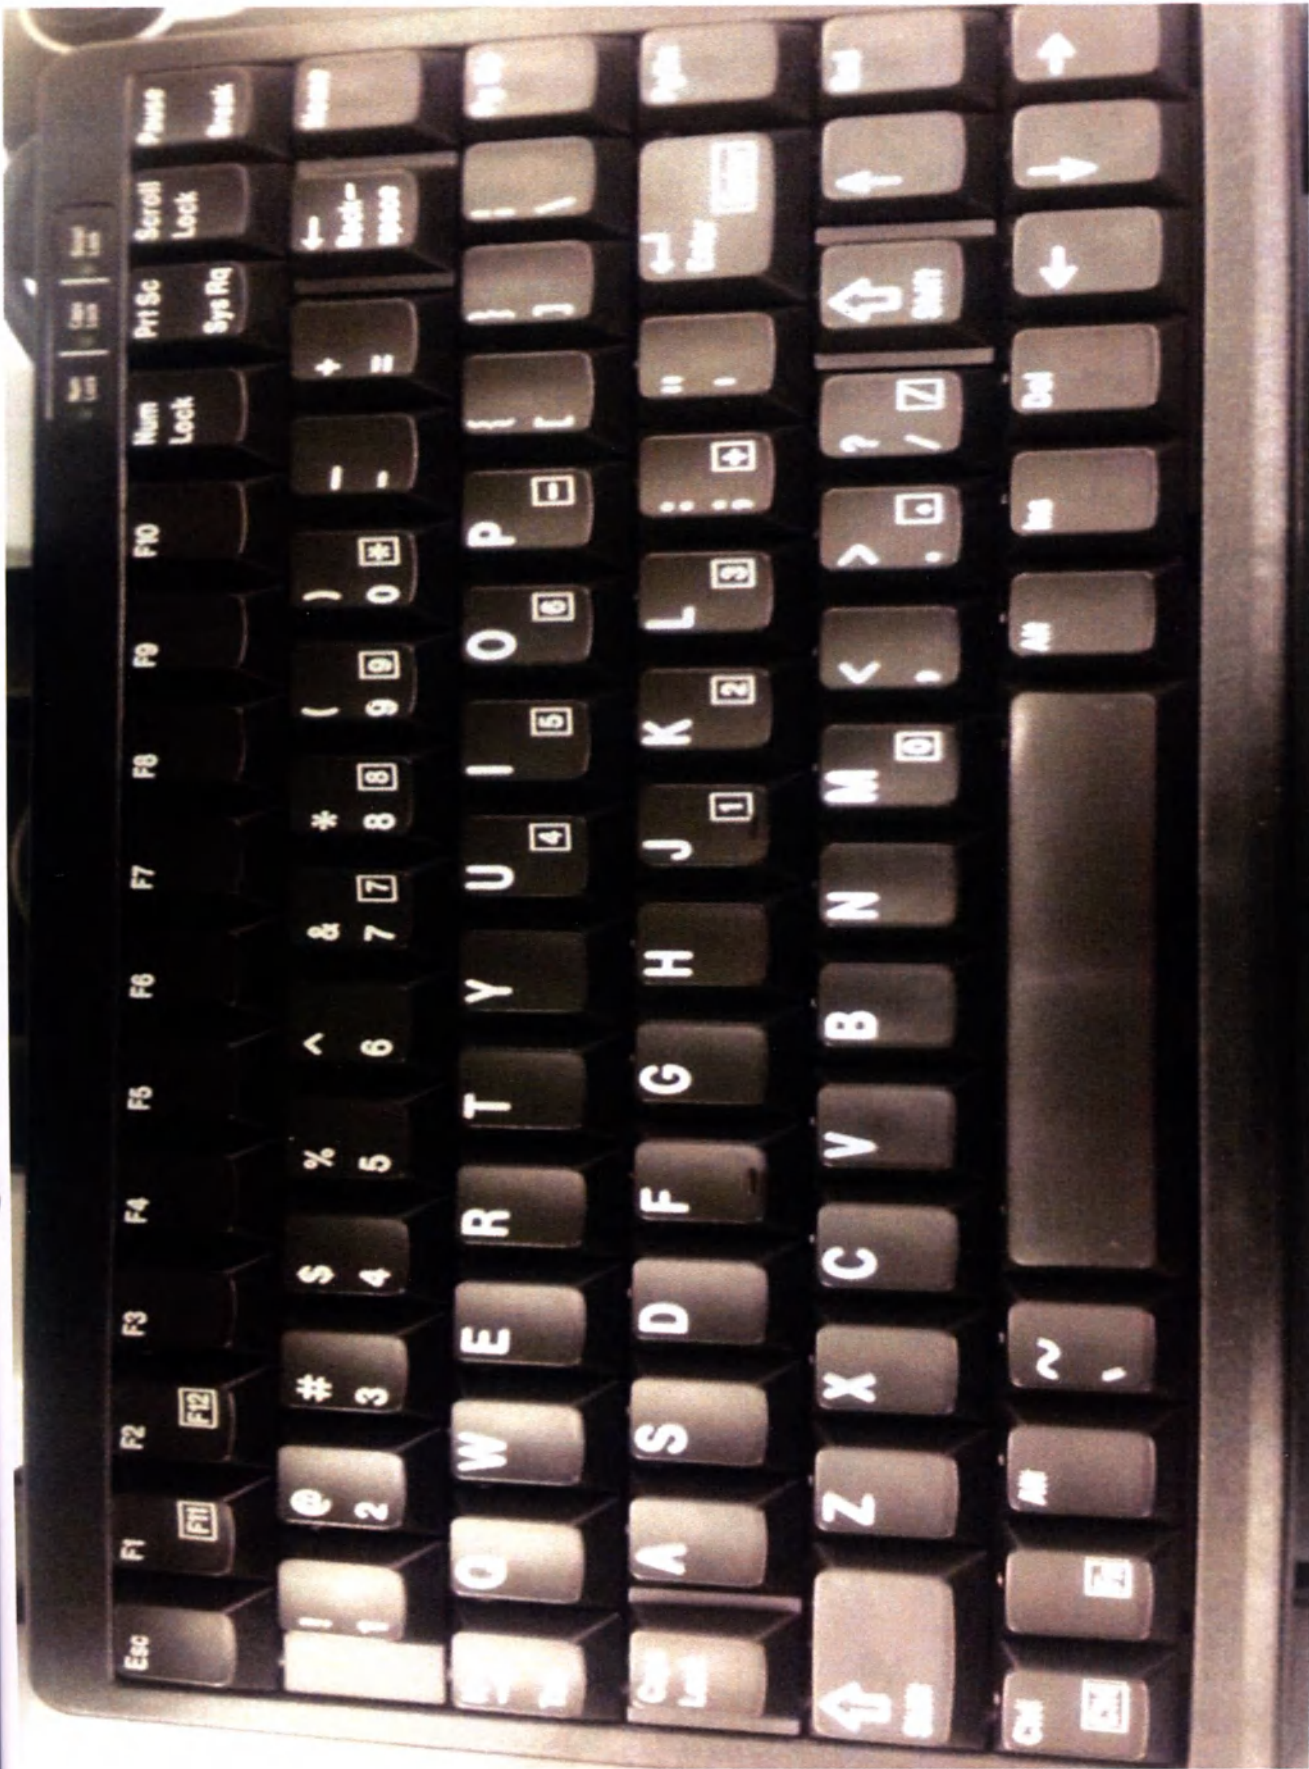

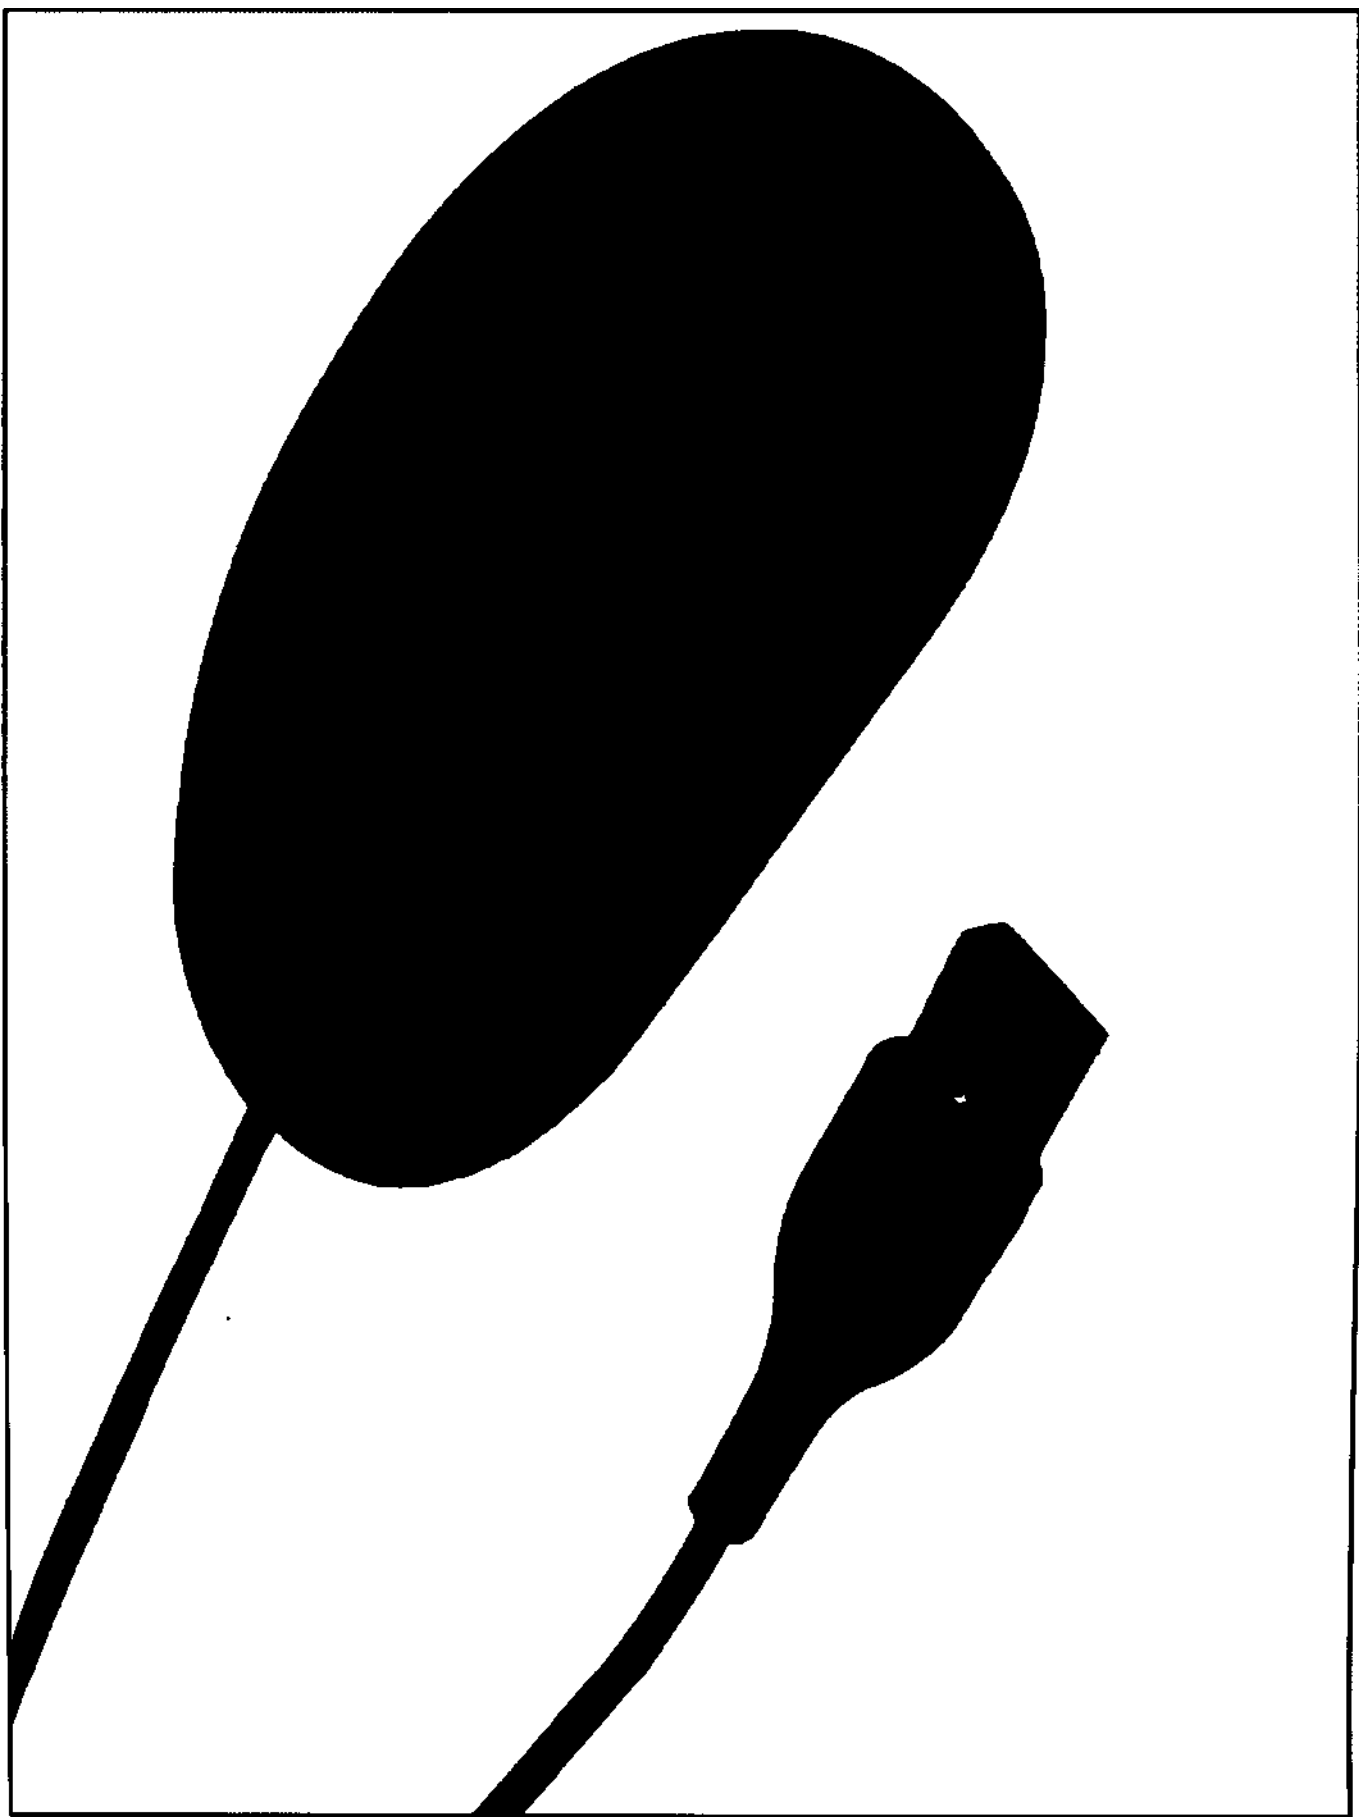

Сетевой кабель



Ресиверы для приема радиосигнала от трансмиттера Pressure Wire



Модули беспроводные для передачи сигнала Wi-Box




Блоки питания для беспроводного модуля Wi-Box PSU KIT




Кабели Wi-Box Xpress для подключения модуля Wi-Box к различным гемодинамическим системам



Кабели для соединения системы OPTIS Mobile с различными ангиографическими системами.

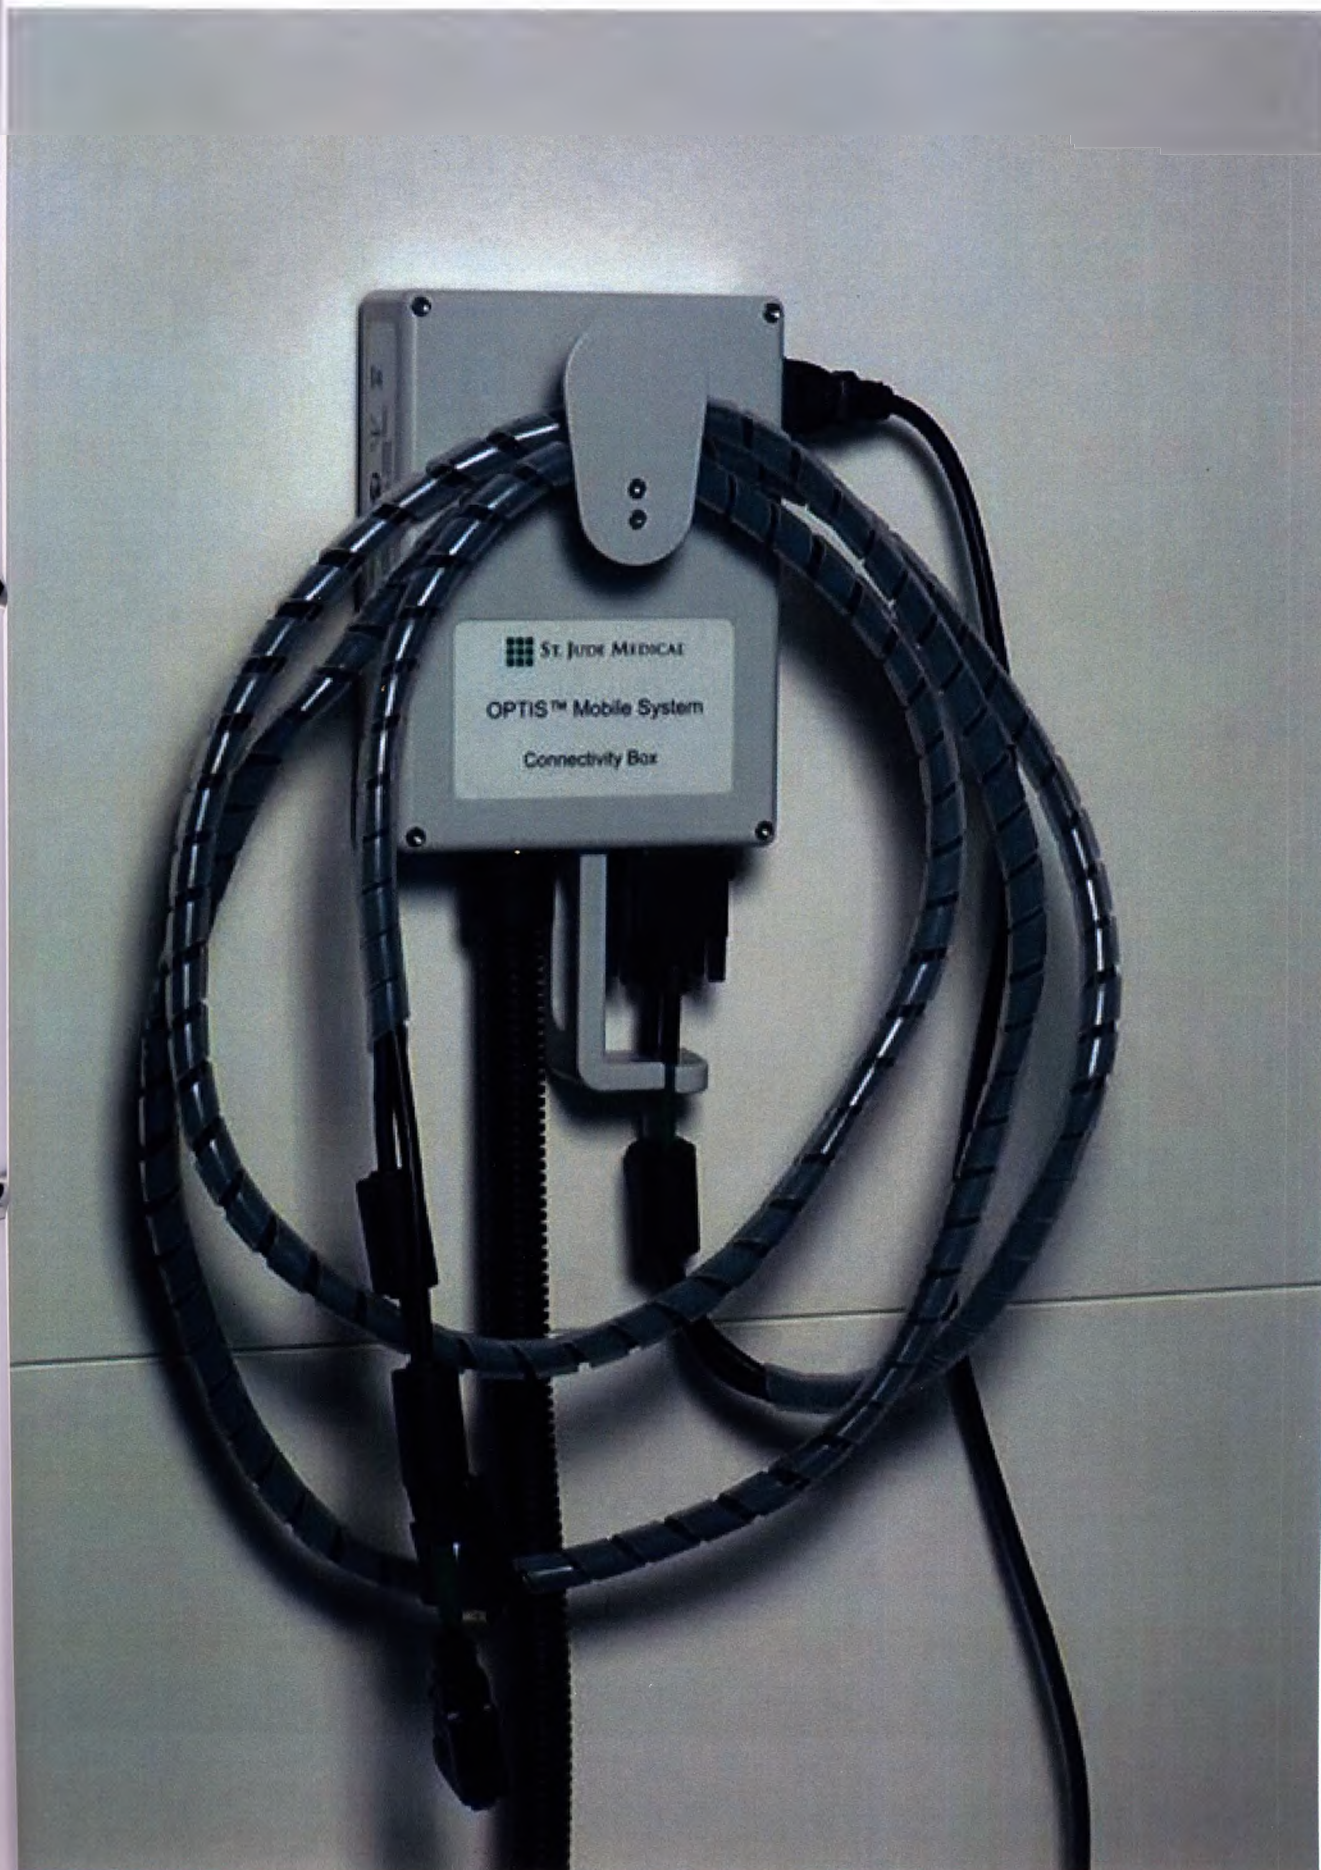

Катетер для внутрисосудистой визуализации Dragonfly Duo

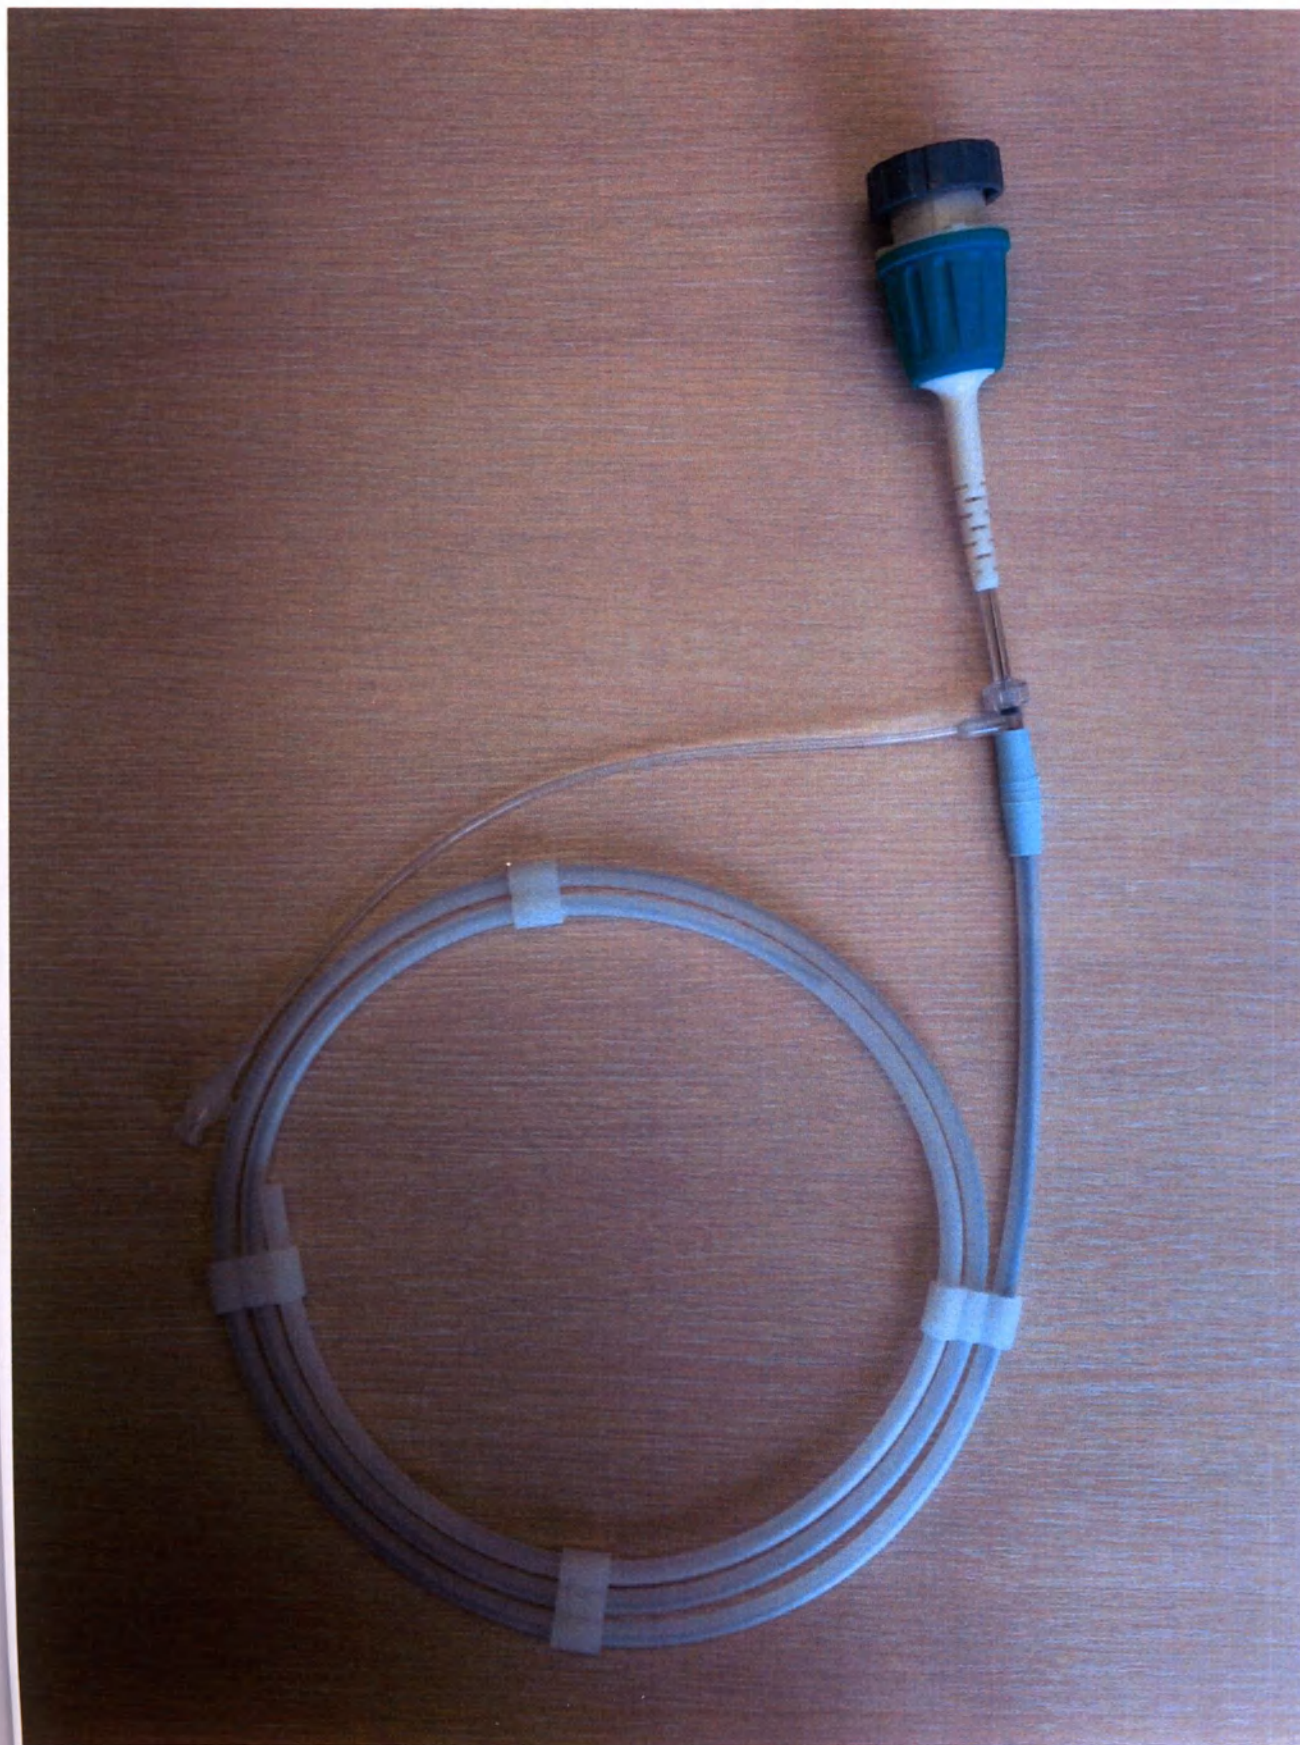

Катетер для внутрисосудистой визуализации Dragonfly OPTIS



Набор инструментов для внутрисосудистой визуализации Dragonfly Duo Kit: - Катетер для внутрисосудистой визуализации Dragonfly Duo; - Шприц стерильный Syringe; - Пакет стерильный Cover.



Набор инструментов для внутрисосудистой визуализации Dragonfly OPTIS Kit: - Катетер для внутрисосудистой визуализации Dragonfly OPTIS; - Шприц стерильный Syringe; - Пакет стерильный Cover.



Набор инструментов для внутрисосудистого измерения давления PressureWire Aeris:

- Проводник PressureWire; - Переходник PressureWire Transmitter.



Ресиверы AO USB Receiver

Ресиверы PW USB Receiver



Пакет стерильный Cover



ST. JUDE MEDICAL

Sterile DOC Cover
9" x 96"

Intended For Use With
DOC on OCT System

STERILE

Sterilized using ethylene oxide

Distributed By:
LightLab Imaging, Inc.
4 Robbins Road
Westford, MA 01886 USA

LightLab Imaging, Inc.
One Technology Park Drive
Westford, MA 01886 USA

REF 200-700-00
Catalog Number (11974-01)

QTY 1
Quantity

LOT 5682050415
Batch Code

EXP 27-Apr-2015
Date of Manufacture

EXP 27-Apr-2020
Use By Date

PACKAGE MUST BE ASEPTICALLY OPENED

**POUCH CONTENTS STERILE UNLESS SEAL
IS BROKEN OR PACKAGE IS PUNCTURED**

CE
Conforms to European
standards

CE
Conforms to European
standards

Do Not
Reuse

Do Not
Reuse

Do Not
Reuse

Do Not
Reuse

Manufactured By:
CPT Medical Solutions
Parsippany, NJ 07054 USA

Caution: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. (See results from the California Proposition 65 test.)

Made in USA

USA Rx Only
30965-300-000

Устройства для очистки Smart Cleaner



Устройства для очистки Fiber Connector Cleaner




Комплект для сервисного обслуживания OCT Field Service Kit Gen 2



Комплект для тестирования Dragonfly Reference Reflector Gen 2



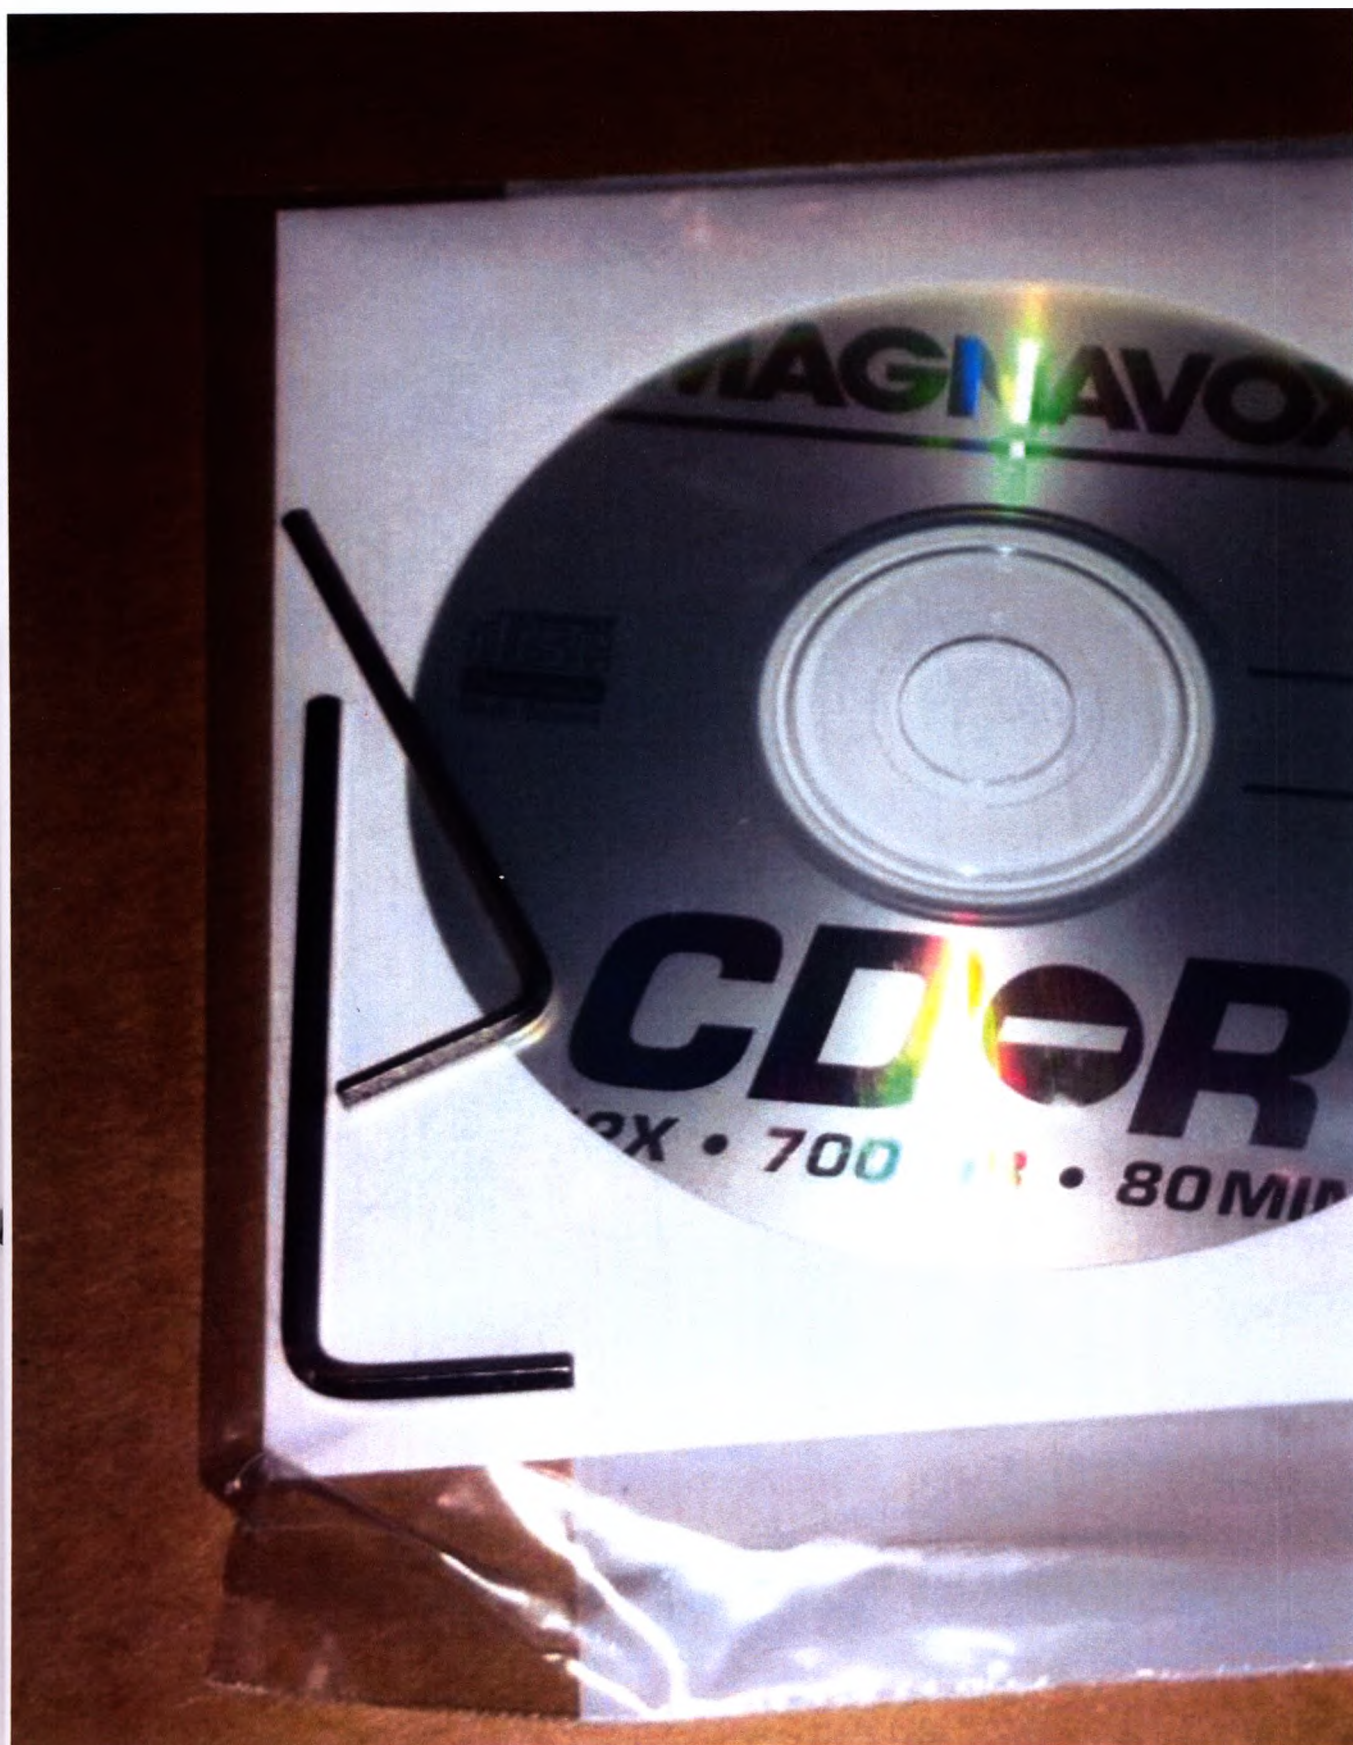

Оптический адаптер





LightLab Imaging Inc.
4 Robbins Road, Westford, Massachusetts,
01886-3139 USA

International Regulatory Affairs Specialist II

Должность (Position)

Pichsoth Kim

Имя (Name)

Pichsoth Kim

Подпись (Signature)



ST. JUDE MEDICAL

Система OPTIS Mobile

для внутрисосудистой визуализации и внутрисосудистого
измерения давления с принадлежностями

Инструкция по эксплуатации



ST. JUDE MEDICAL

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
36 (тридцать шесть) листов

Закрытое акционерное общество «ИМПЛАНТА»
Генеральный директор Лутцев А.П.

