

# Medtronic

**ООО «Медтроник»**

Вн. тер. г., м.о. Пресненский  
Пресненская наб., д.10  
Башня С  
9 эт., пом. III, ком.41  
г. Москва, 123112  
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77  
Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «Медтроник»

Е. В. Плясунова

«05» сентября 2023 г.



## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника

### Производитель:

Медтроник Софамор Данек ЮЭсЭй, Инк. (Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.)  
1800 Pyramid Place, Memphis, TN 38132, USA



Фото 1. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Стержень изогнутый LINED PRE-BENT ROD, 5.5 мм x 40 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

# Medtronic

CD HORIZON® Spinal System  
LINED PRE-BENT ROD

Size: D=5.5mm, L=40mm

Mat'l: TITANIUM COMMERCIALY PURE

Sterility assured only when package is undamaged.

REF 1553301040

**LOT** 0792372W

 Use By: 2028-08-12

QTY: 1 EA

  Date of Manufacture  
2020-08-12

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.  
1800 Pyramid Place

Memphis, Tennessee 38132

Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)

901 396 3133 (Outside U.S.A.)

Fax 901 396 0356

Manufactured in  
WARSAW ORTHOPEDIC, INC  
Also Known As Medtronic Sofamor Danek  
Manufacturing  
2500 SILVEUS CROSSING  
WARSAW, IN USA 46582

CD HORIZON® Spinal System  
LINED PRE-BENT ROD  
Size: D=5.5mm, L=40mm  
Mat'l: TITANIUM COMMERCIALY PURE



(01)00643169026735(17)280812(10)0792372W

**IUSA**  
For US  
Audiences  
Only

**Rx** only

  
www.medtronic.com/manuals  
Consult  
Instructions  
For Use

**STERILE R**

  
Do Not  
Reuse

**CE** 0123

FirstPrint: WARSAW, IN US 200812.MK

Фото 2. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Стержень изогнутый Стержень изогнутый LINED PRE-BENT ROD, 5.5 мм x 40 мм) – маркировка.

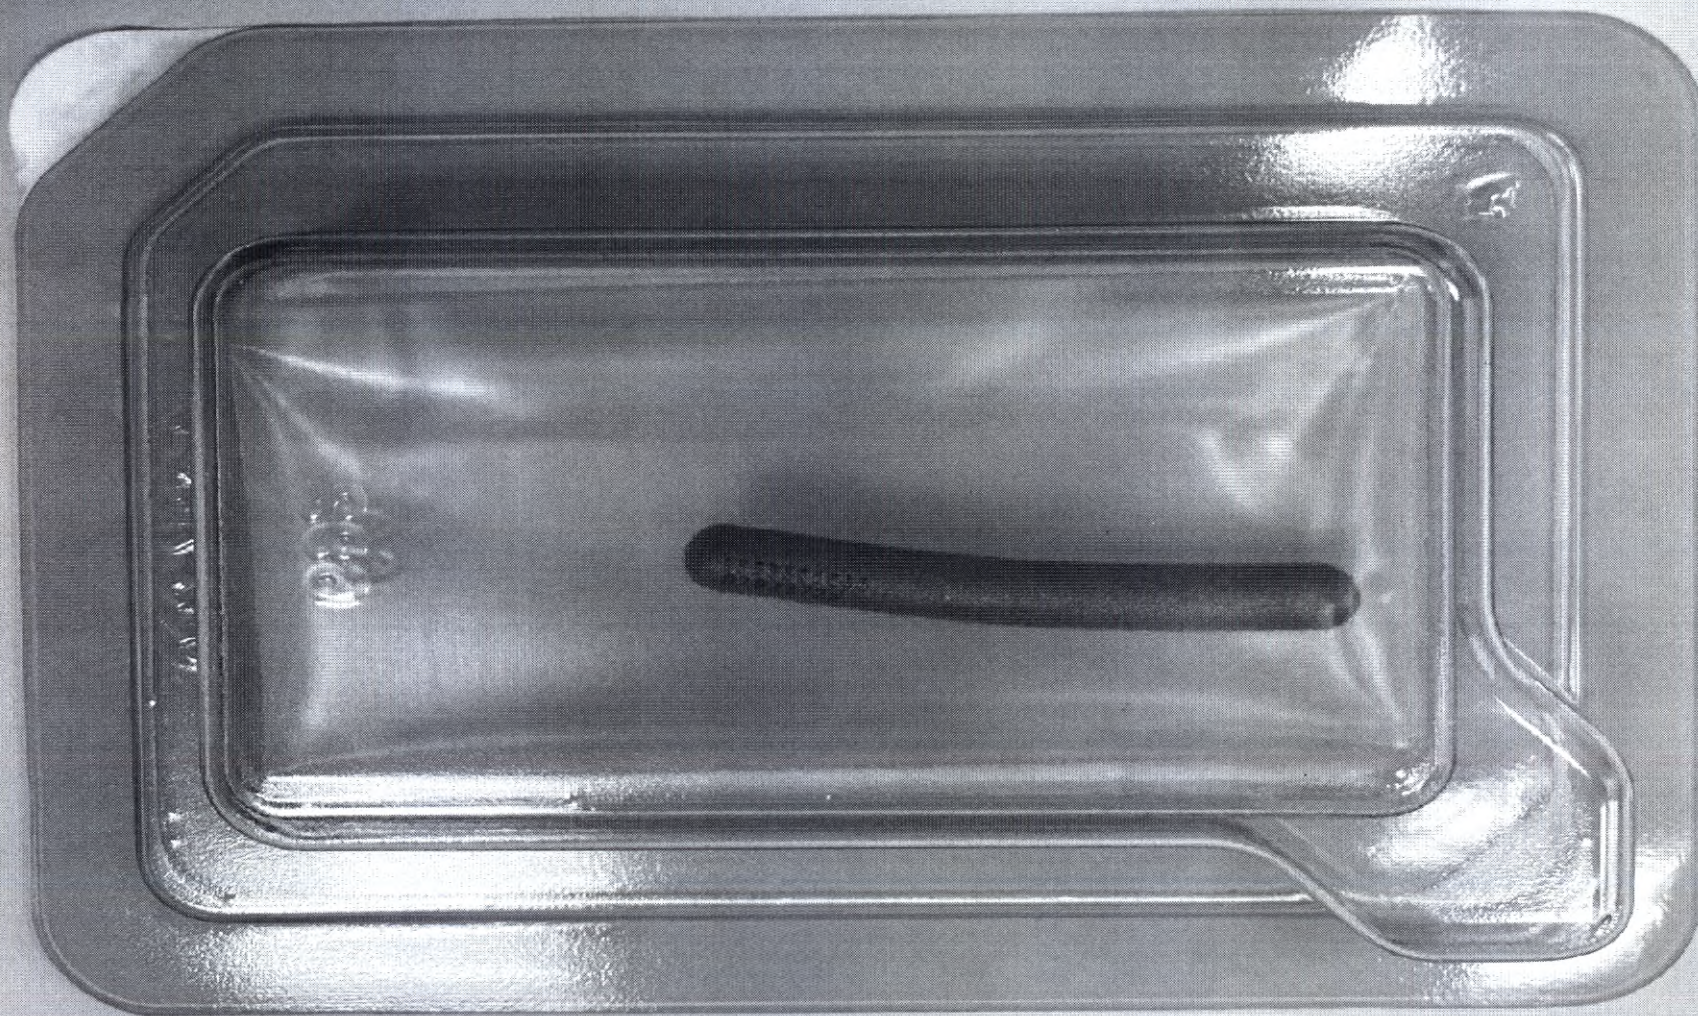


Фото 3. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Стержень изогнутый LINED PRE-BENT ROD, 5.5 мм x 40 мм) – первичная упаковка изделия.

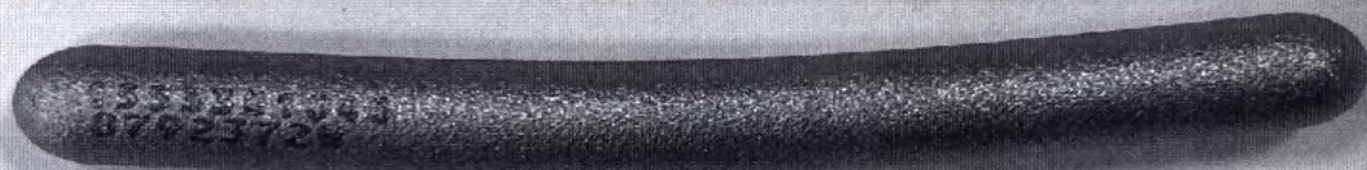



Фото 4. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON (На примере варианта исполнения Стержень изогнутый LINED PRE-BENT ROD, 5.5 мм x 40 мм) – общий вид изделия.



**Medtronic**

REF: 1555106070

LOT: 10823561W

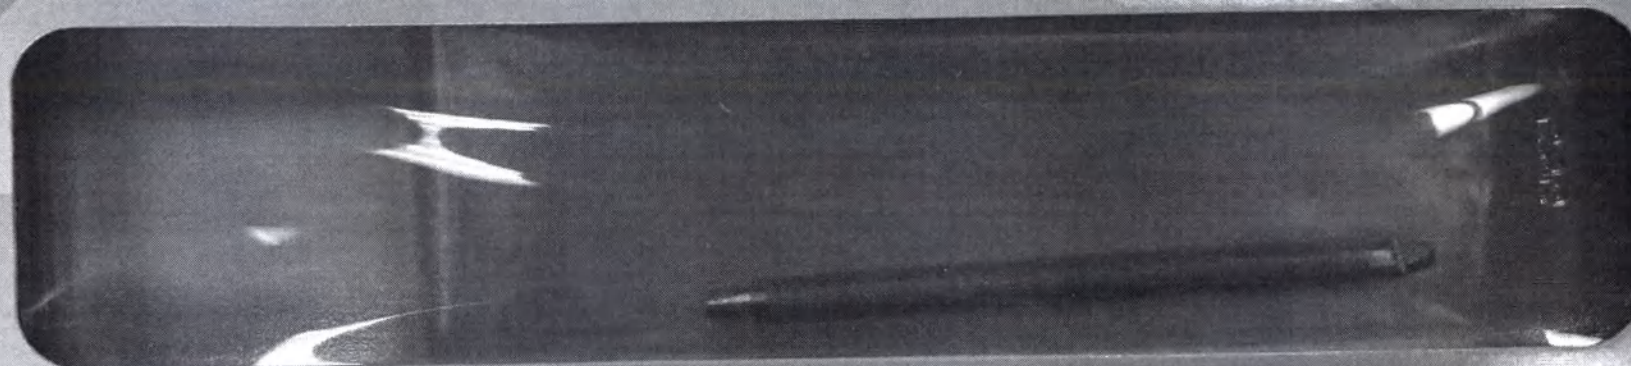

**Medtronic**

**SOFAMOR DANEK**

sofamordanek.com

Фото 6. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON LONGITUDE (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный LONGITUDE CHROMALOY ROD, 5.5 мм x 70 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

**Medtronic**

CD HORIZON® Spinal System  
LONGITUDE® CHROMALLOY™ ROD

Size: D=5.5mm, L=70mm

Mat'l: COBALT CHROME

Sterility assured only when package is undamaged.

REF 1555106070

**LOT** 0823561W

Use By: 2029-02-08

QTY: 1 EA



Date of Manufacture  
2021-02-08

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.  
1800 Pyramid Place  
Memphis, Tennessee 38132  
Telephone: 800 933 2635 (in U.S.A.)  
901 396 3133 (Outside U.S.A.)  
Fax 901 396 0356

Manufactured in  
WARSAW ORTHOPEDIC, INC.  
Also Known As: Medtronic Sofamor Danek  
Manufacturing  
2500 SILVEUS CROSSING  
WARSAW, IN USA 46582




(01)00643169261570(17)290208(10)0823561W

**USA**

For US  
Audiences  
Only

**Rx** only



**STERILE**

**R**



Do Not  
Reuse

**CE** 0123

CD HORIZON® Spinal System  
LONGITUDE® CHROMALLOY™ ROD  
Size: D=5.5mm, L=70mm  
Mat'l: COBALT CHROME

Фото 7. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON LONGITUDE (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный LONGITUDE CHROMALLOY ROD, 5,5 мм x 70 мм) – маркировка.

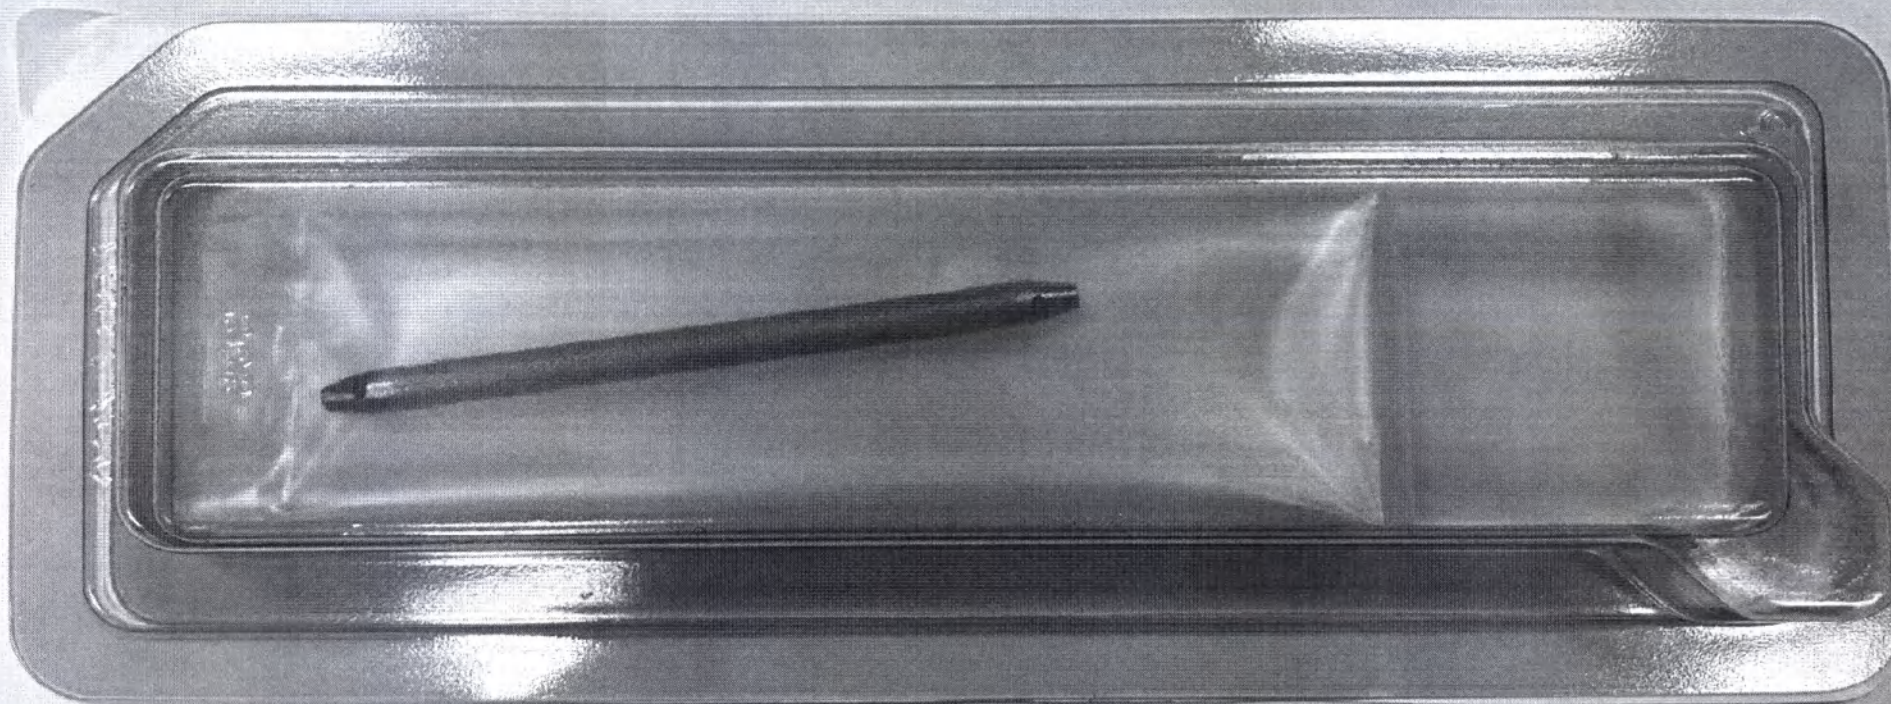


Фото 8. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON LONGITUDE (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный LONGITUDE CHROMALOY ROD, 5.5 мм x 70 мм) – первичная упаковка изделия.

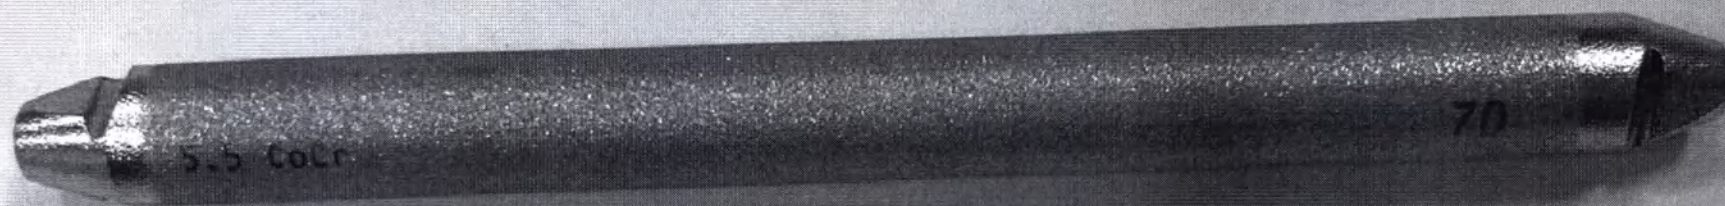


Фото 9. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON LONGITUDE (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный LONGITUDE CHROMALLOY ROD, 5.5 мм x 70 мм) – вид изделия без упаковки



Фото 10. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON LONGITUDE (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный LONGITUDE CHROMALLOY ROD, 5.5 мм x 70 мм) – комплект поставки.



Фото 11. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный PREBENT PERCUTANEOUS ROD, 5.5 мм x 55 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

# Medtronic

Use By: 2027-01-17

QTY: 1 EA

REF 654100055

LOT 0699930W

## CD HORIZON® SOLERA® Spinal System PREBENT PERCUTANEOUS ROD

Size: DIA=5.5mm x L=55mm

Mat'l: TITANIUM ALLOY

Sterility assured only when package is undamaged.

Manufactured in  
WARSAW ORTHOPEDIC, INC  
Also Known As Medtronic Sofamor Danek Manufacturing  
2500 SILVEUS CROSSING  
WARSAW, IN USA 46582


IUSA

For US  
Audiences  
Only

Rx only



STERILE R



CE 0123

FirstPrint.WARSAW, IN US.190117.CC

Фото 12. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный PREBENT PERCUTANEOUS ROD 5,5 мм x 55 мм) — маркировка.

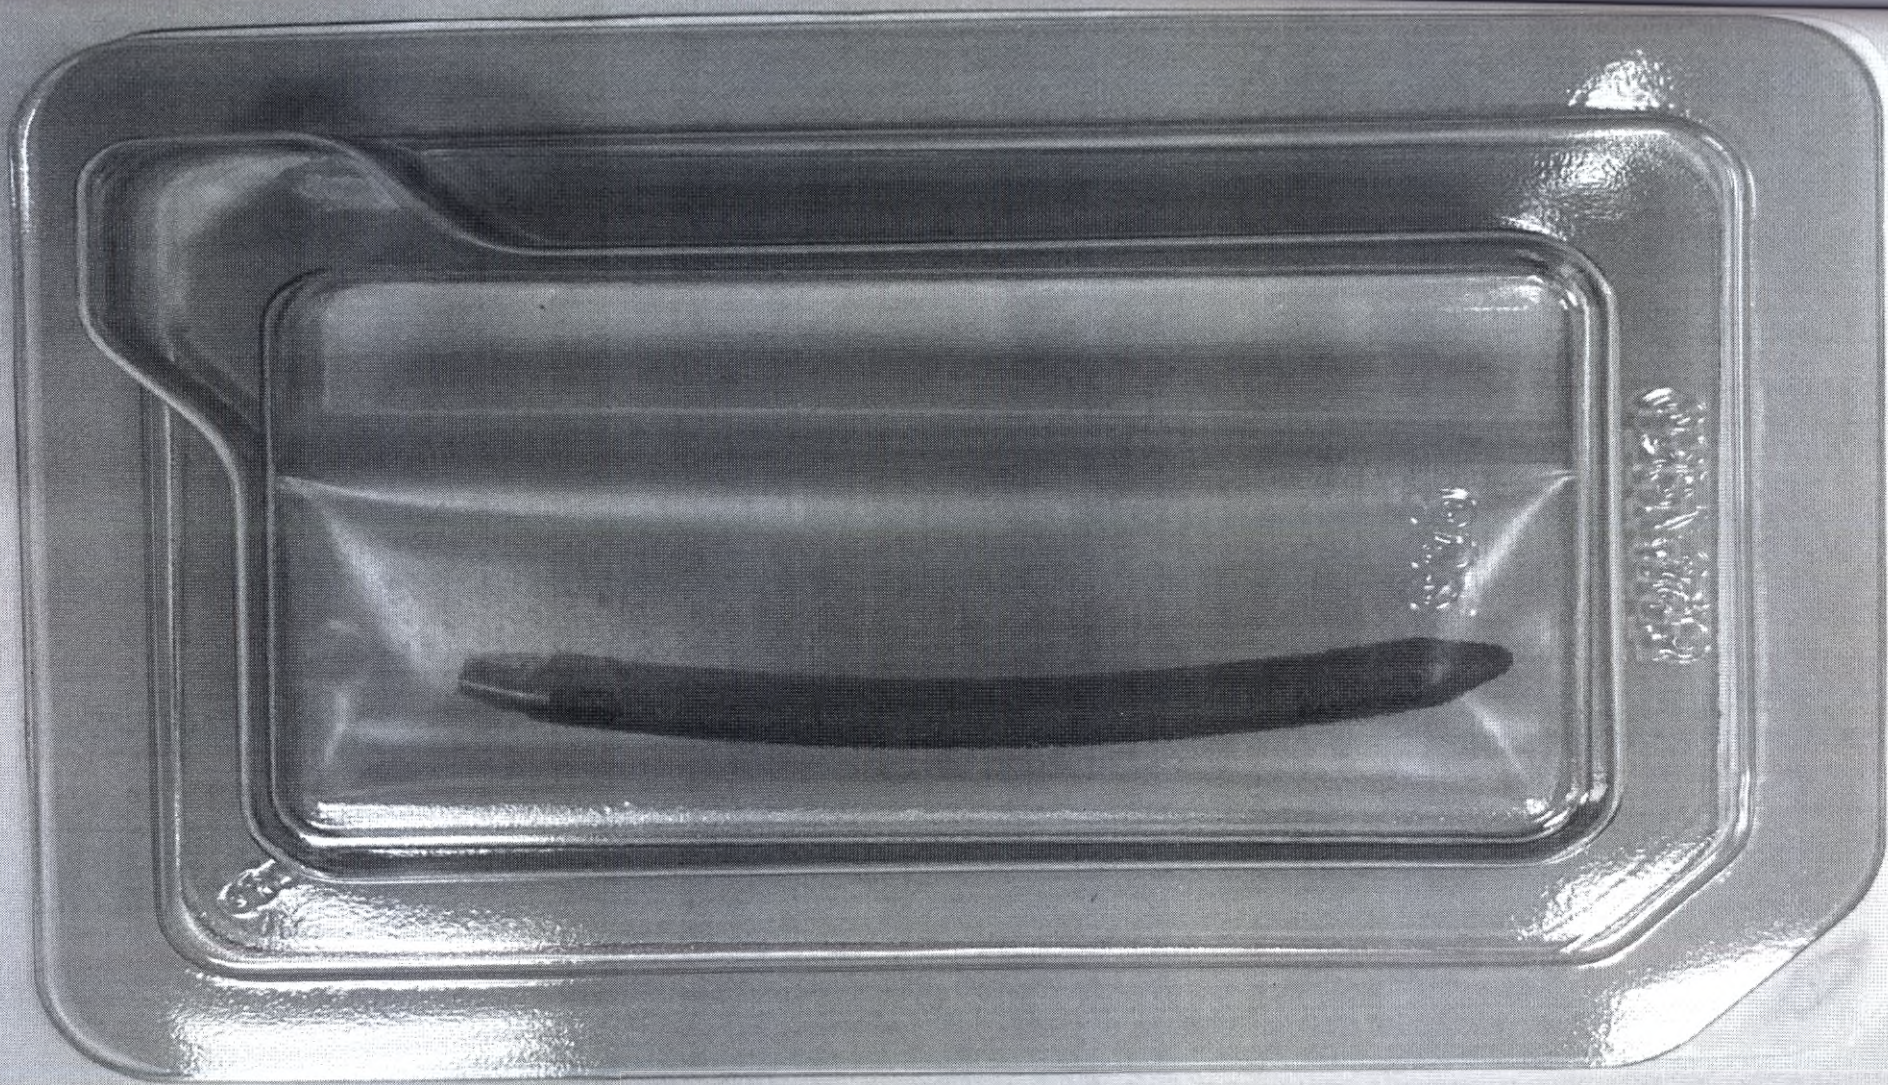


Фото 13. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный PREBENT PERCUTANEOUS ROD, 5.5 мм x 55 мм) – первичная упаковка изделия.

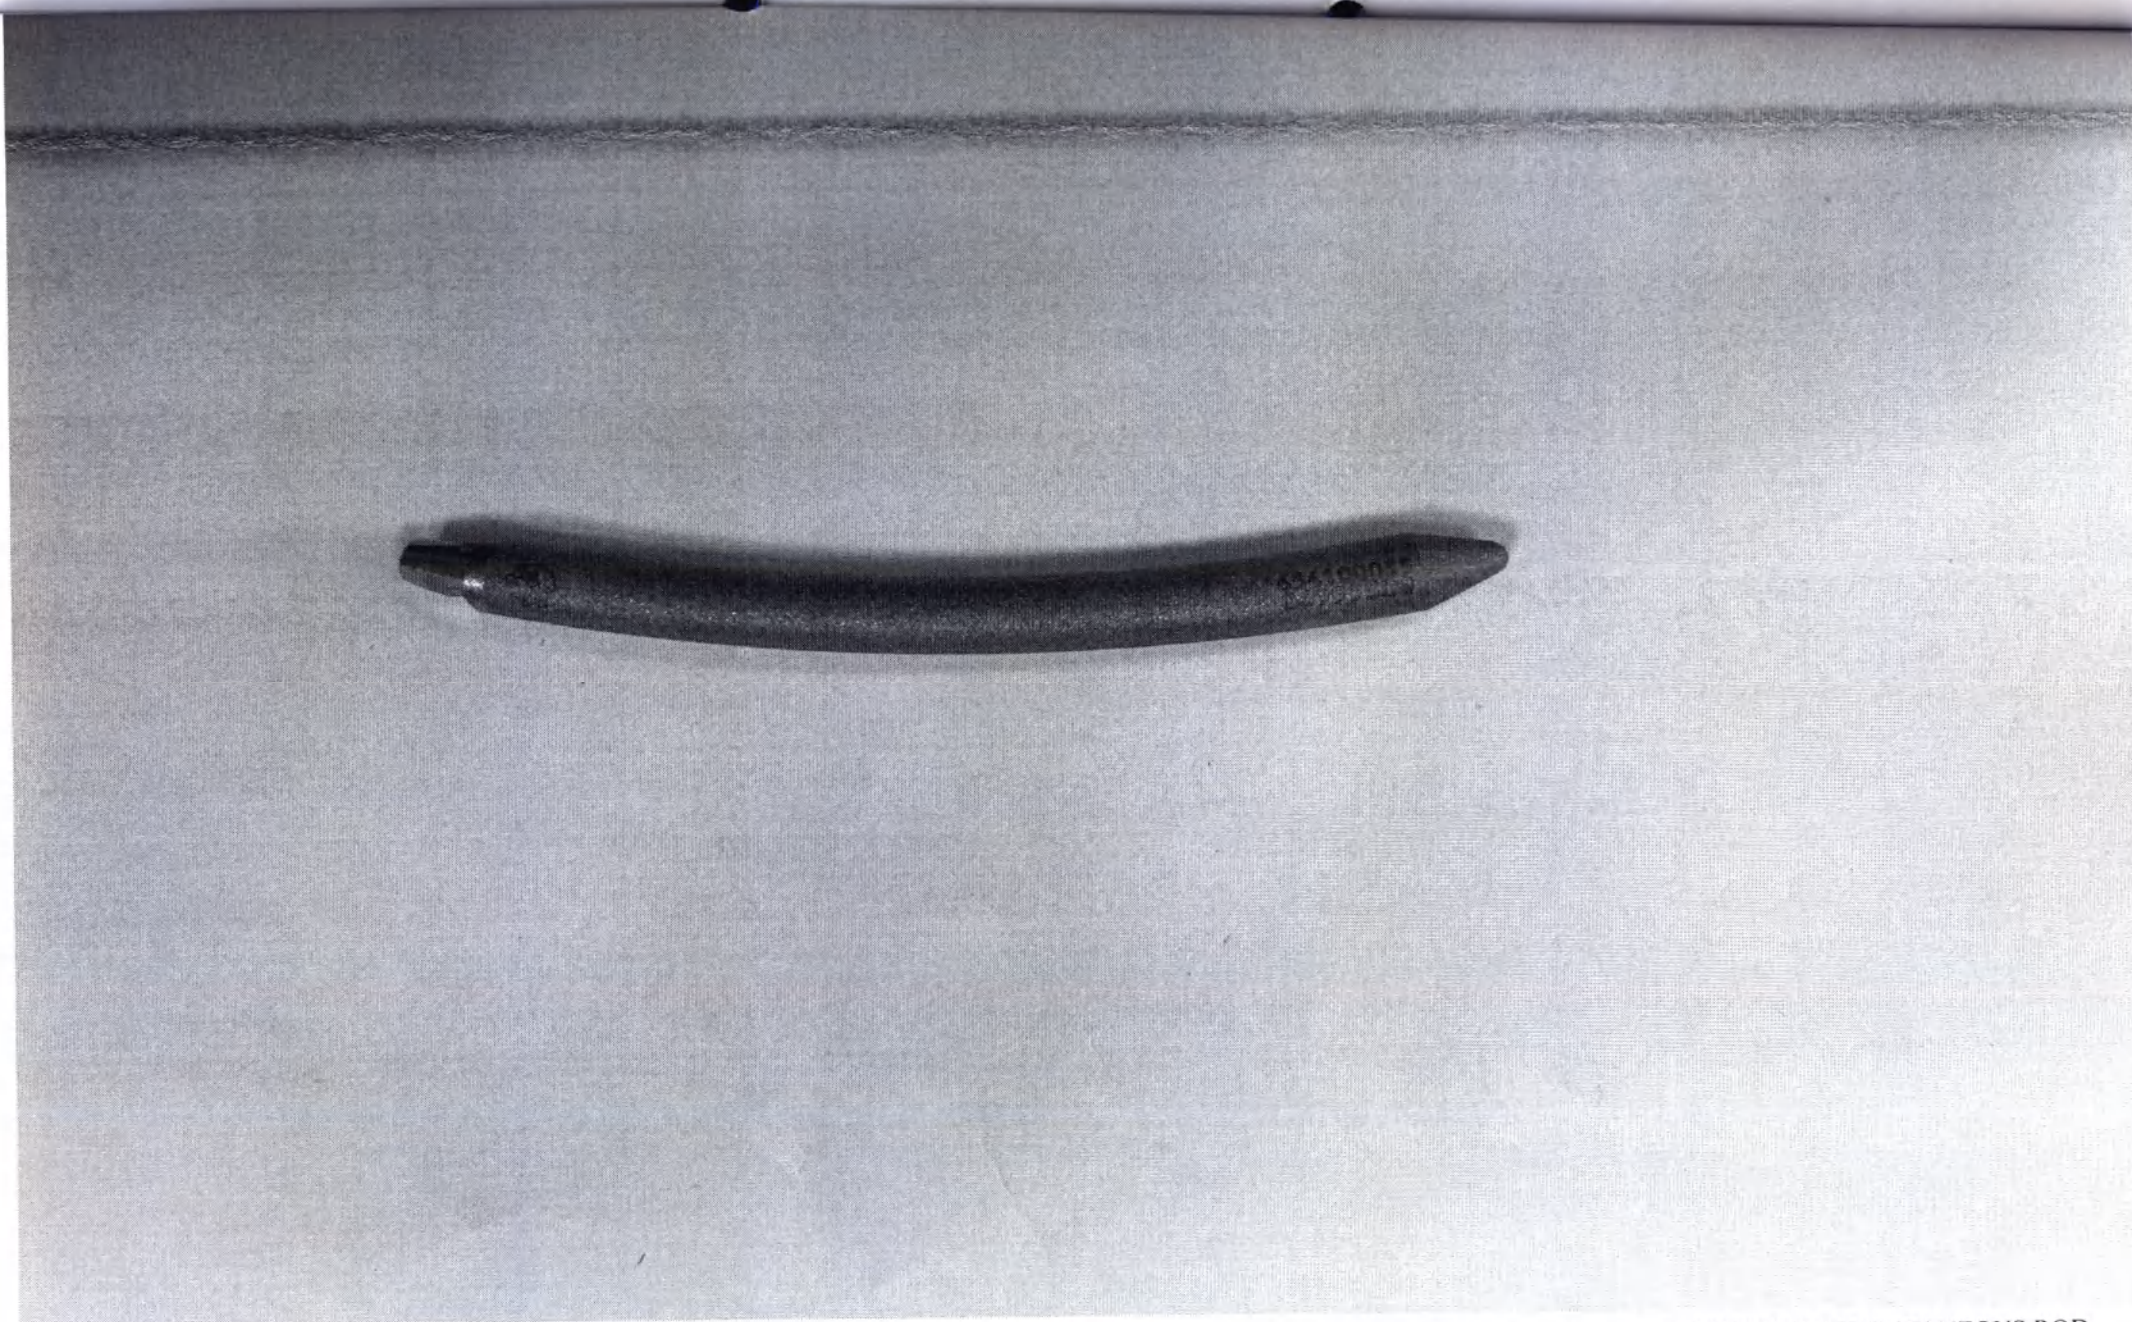


Фото 14. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный PREBENT PERCUTANEOUS ROD, 5.5 мм x 55 мм) – общий вид изделия.

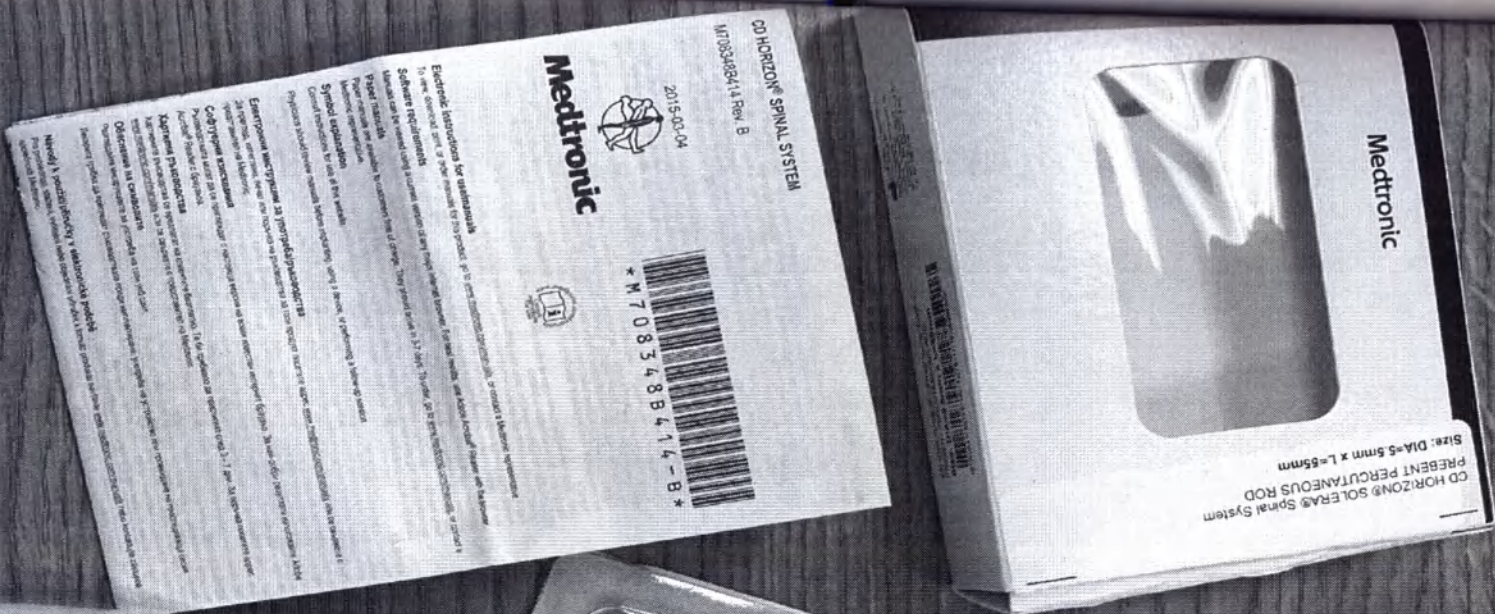


Фото 15. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень чрескожный PREBENT PERCUTANEOUS ROD, 5.5 мм x 55 мм) – комплект поставки.



Фото 16. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень CAPPED ROD, 5.5 мм x 70 мм) – изделие во вторичной упаковке.

**Medtronic** REF 651703070

**LOT** 0777822W

 Use By: 2025-04-30

**CD HORIZON® SOLERA® Spinal System  
CAPPED ROD**

**Size: DIA=5.5mm x L=70mm**

**Mat'l: COBALT CHROME**

**Sterility assured only when package is undamaged.**



Date of Manufacture

2020-04-30

**QTY: 1 EA**

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.

1800 Pyramid Place

Memphis, Tennessee 38132

Telephone 800 933 2635 (In U.S.A.)

901 396 3133 (Outside U.S.A.)

Fax 901 396 0356

Manufactured at  
**WARSAW ORTHOPEDIC, INC**  
Also Known As Medtronic  
Sofamor Danek Manufacturing  
**2500 SILVEUS CROSSING**  
**WARSAW, IN USA 46582**

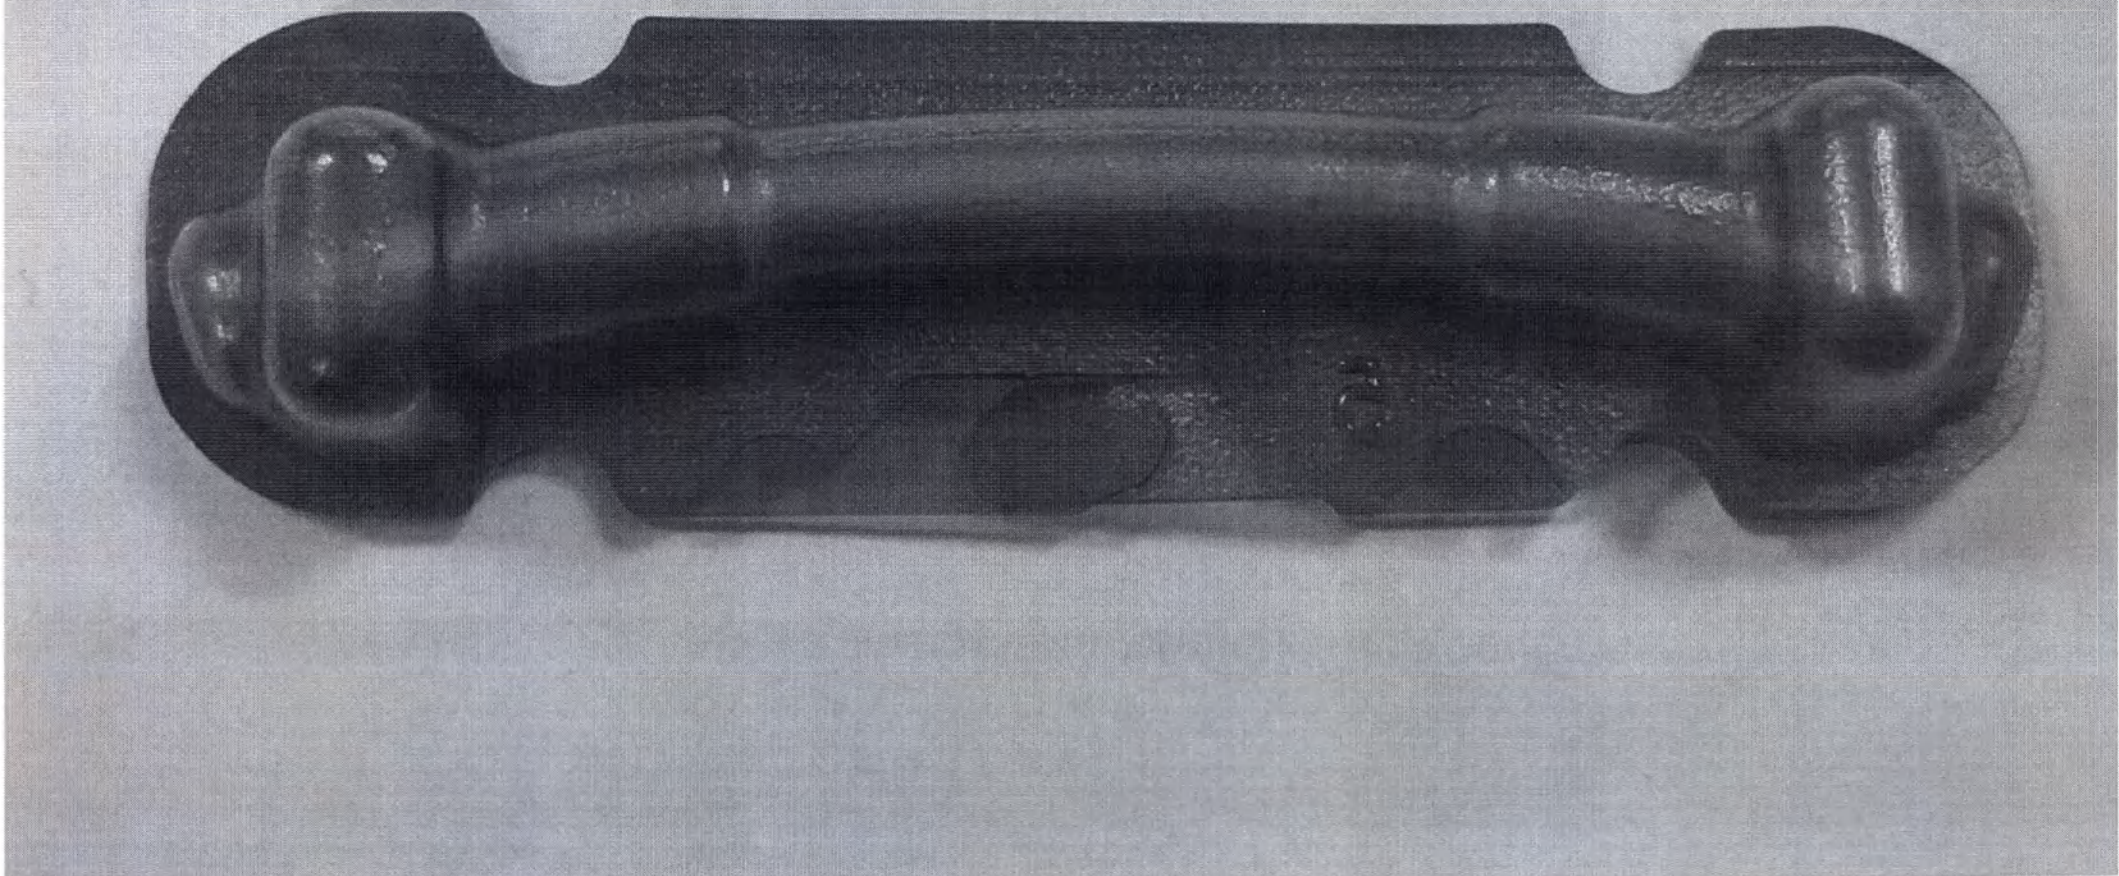


Фото 18. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень CAPPED ROD, 5.5 мм x 70 мм) – изделие в первичной упаковке



Фото 19. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника CD HORIZON SOLERA (На примере варианта исполнения Стержень CAPPED ROD, 5.5 мм x 70 мм) – изделие без упаковки



демонстрационных целях

**Medtronic**

VERTEX® Reconstruction System  
ROD

Size: 3.5mm x 300mm

Mat'l: COBALT CHROME

Sterility assured only when package is undamaged.

REF G7750088

**LOT** 0685431W

Use By: 2026-11-01

QTY: 1 EA

 Date of Manufacture  
2018-11-01

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.  
1800 Pyramid Place  
Memphis, Tennessee 38132  
Telephone 800 933 2635 (in U.S.A.)  
901 396 3133 (Outside U.S.A.)  
Fax 901 396 0356

Manufactured in  
WARSAW ORTHOPEDIC, INC  
Also Known As Medtronic Sofamor Danek Manufacturing  
2500 SILVEUS CROSSING  
WARSAW, IN USA 46582



011006 13994541915(17)261101(10)0685431W

**IUSA**

**Rx** only

For US  
Audiences  
Only



**STERILE** R



Do Not  
Reuse

FirstPoint, WARSAW, IN US 181101 KS



**CE** 0123

Фото 21. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень ROD, 3.5 мм x 300 мм) – маркировка



Фото 22. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень ROD, 3.5 мм x 300 мм) – вид в первичной упаковке

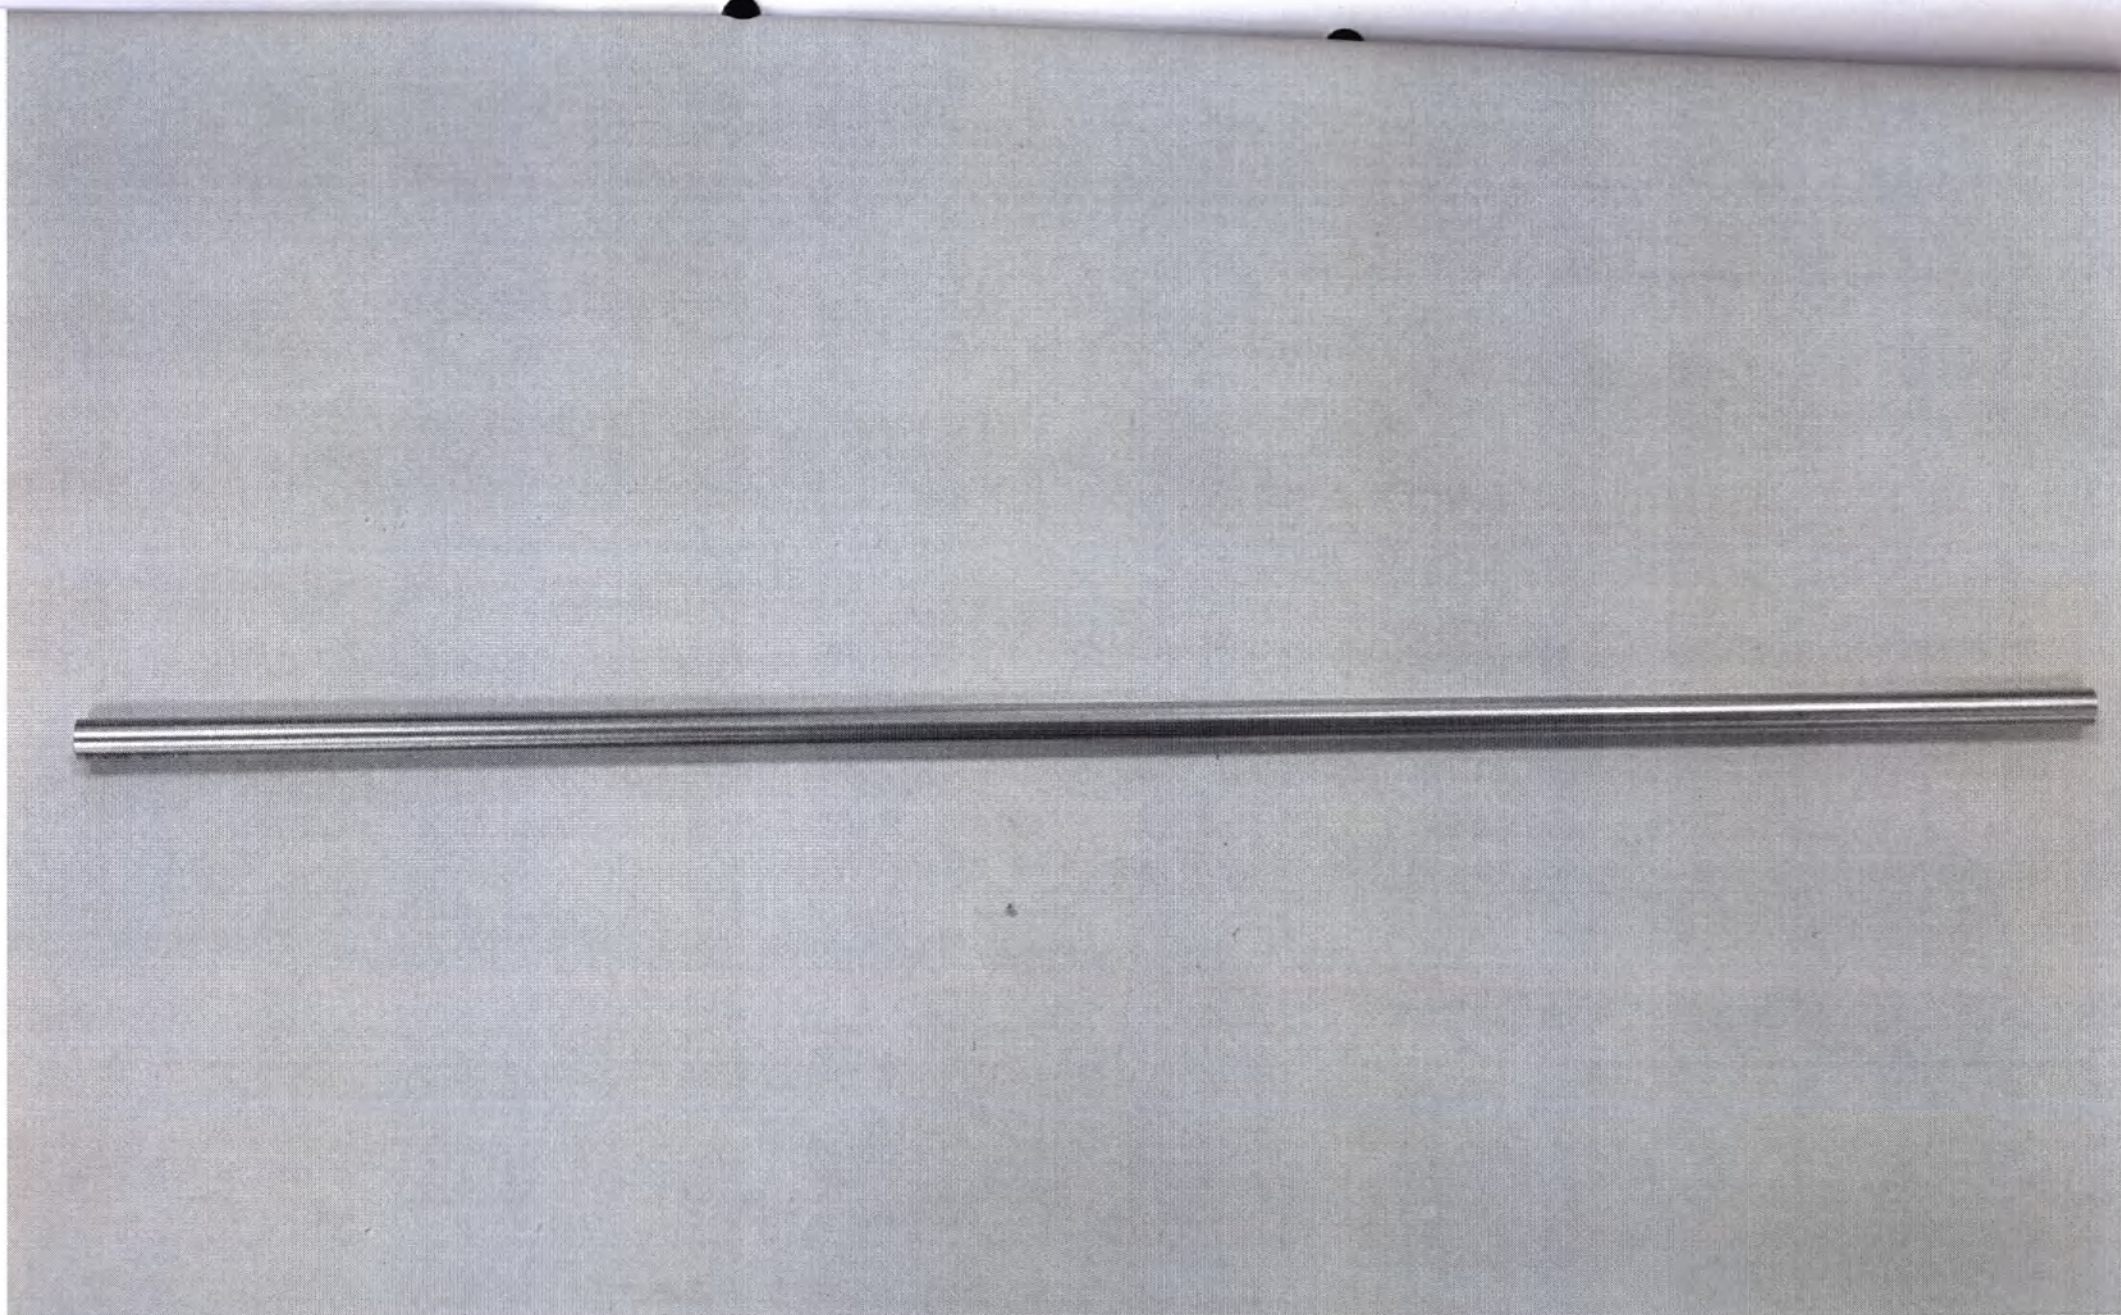


Фото 23. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень ROD, 3.5 мм x 300 мм) – вид изделия без упаковки

Medtronic

REF G7753880

LOT 0764982W



**Medtronic**  
SOFAMOR DANEK

sofamordanek.com

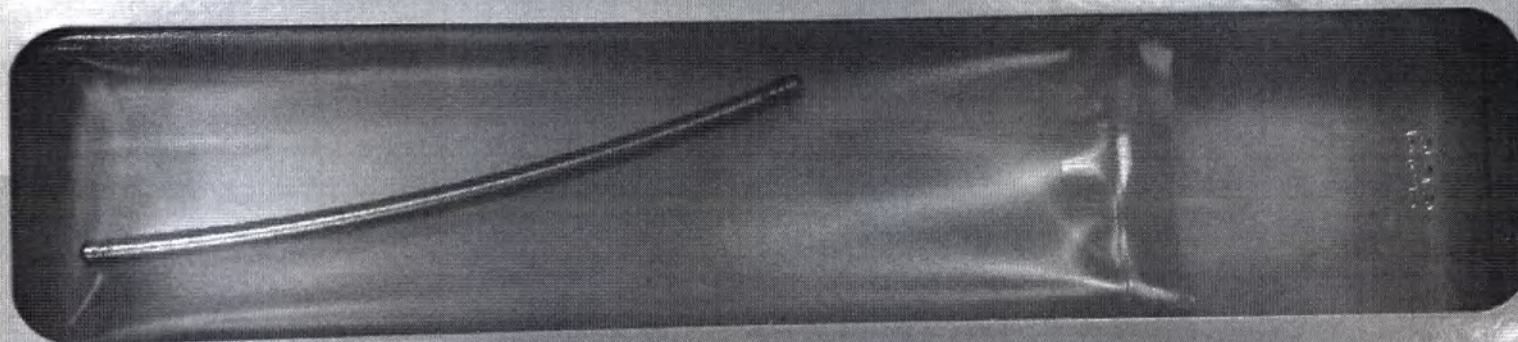


Фото 24. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень PRE-CUT/BENT CHROMALOY PLUS ROD 3.5 x 90 мм) – фото изделия во вторичной упаковке.

MEDTRONIC  Use By: 2026-08-19  
REF G7753890 QTY:  
**LOT** 0794496W 1 EA  
PRE-CUT/BENT CHROMALOY PLUS ROD  
Size: 3.5mm x 90mm

Фото 25. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень PRE-CUT/BENT CHROMALOY PLUS ROD 3.5 x 90 мм) —

маркировка.

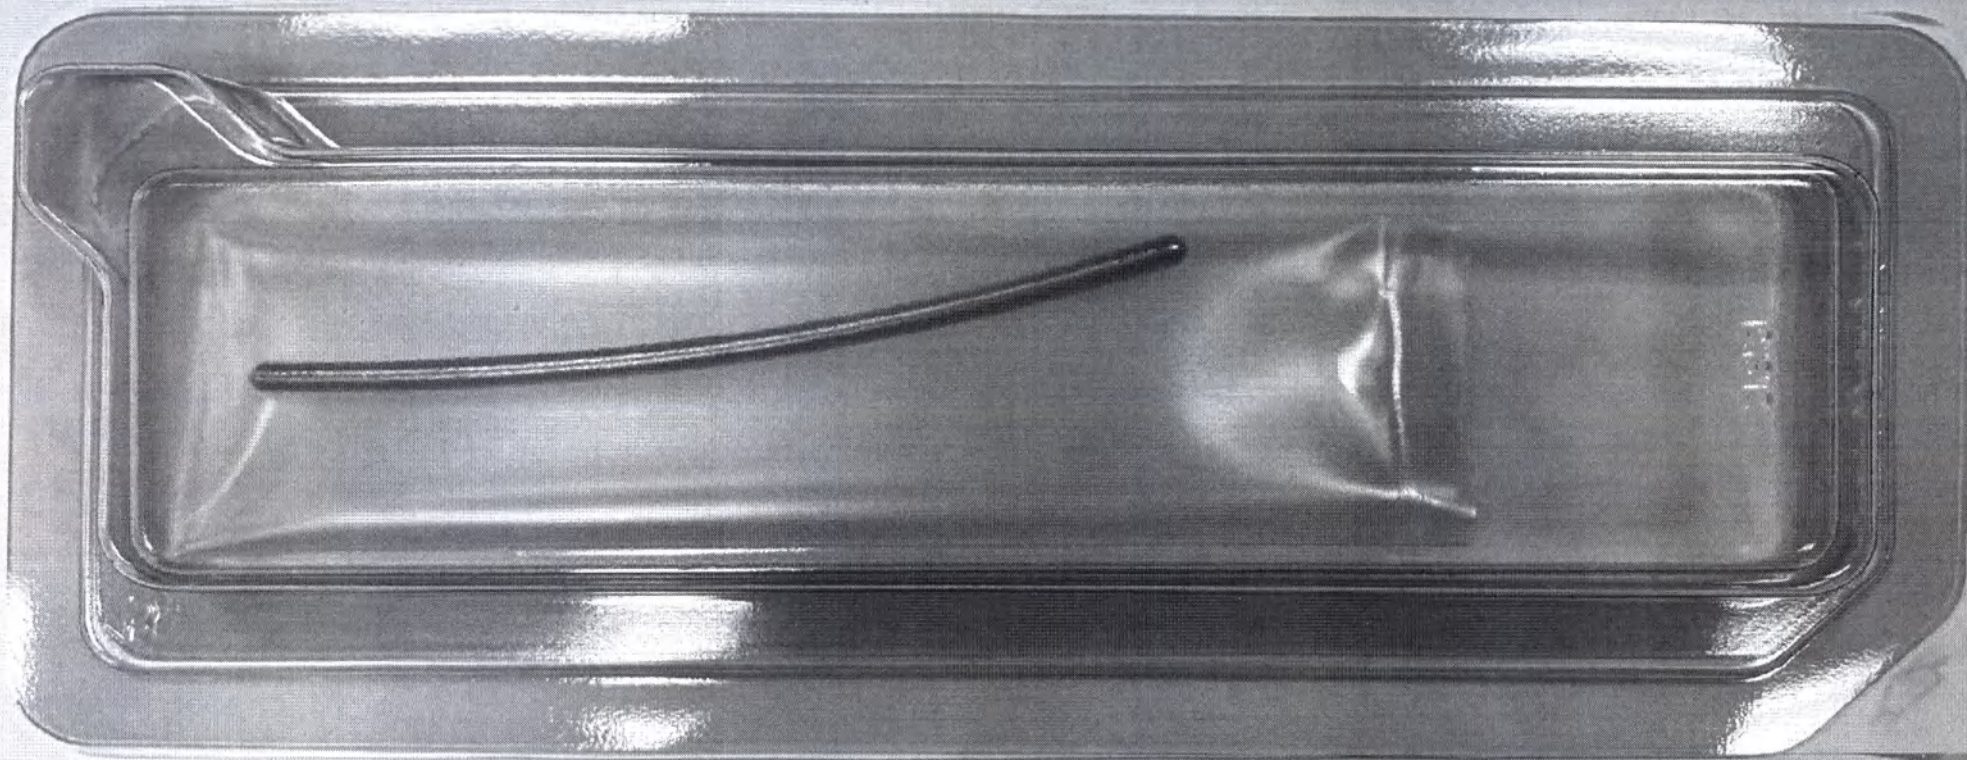


Фото 26. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень PRE-CUT/BENT CHROMALOY PLUS ROD 3.5 x 90 мм) – первичная упаковка изделия.

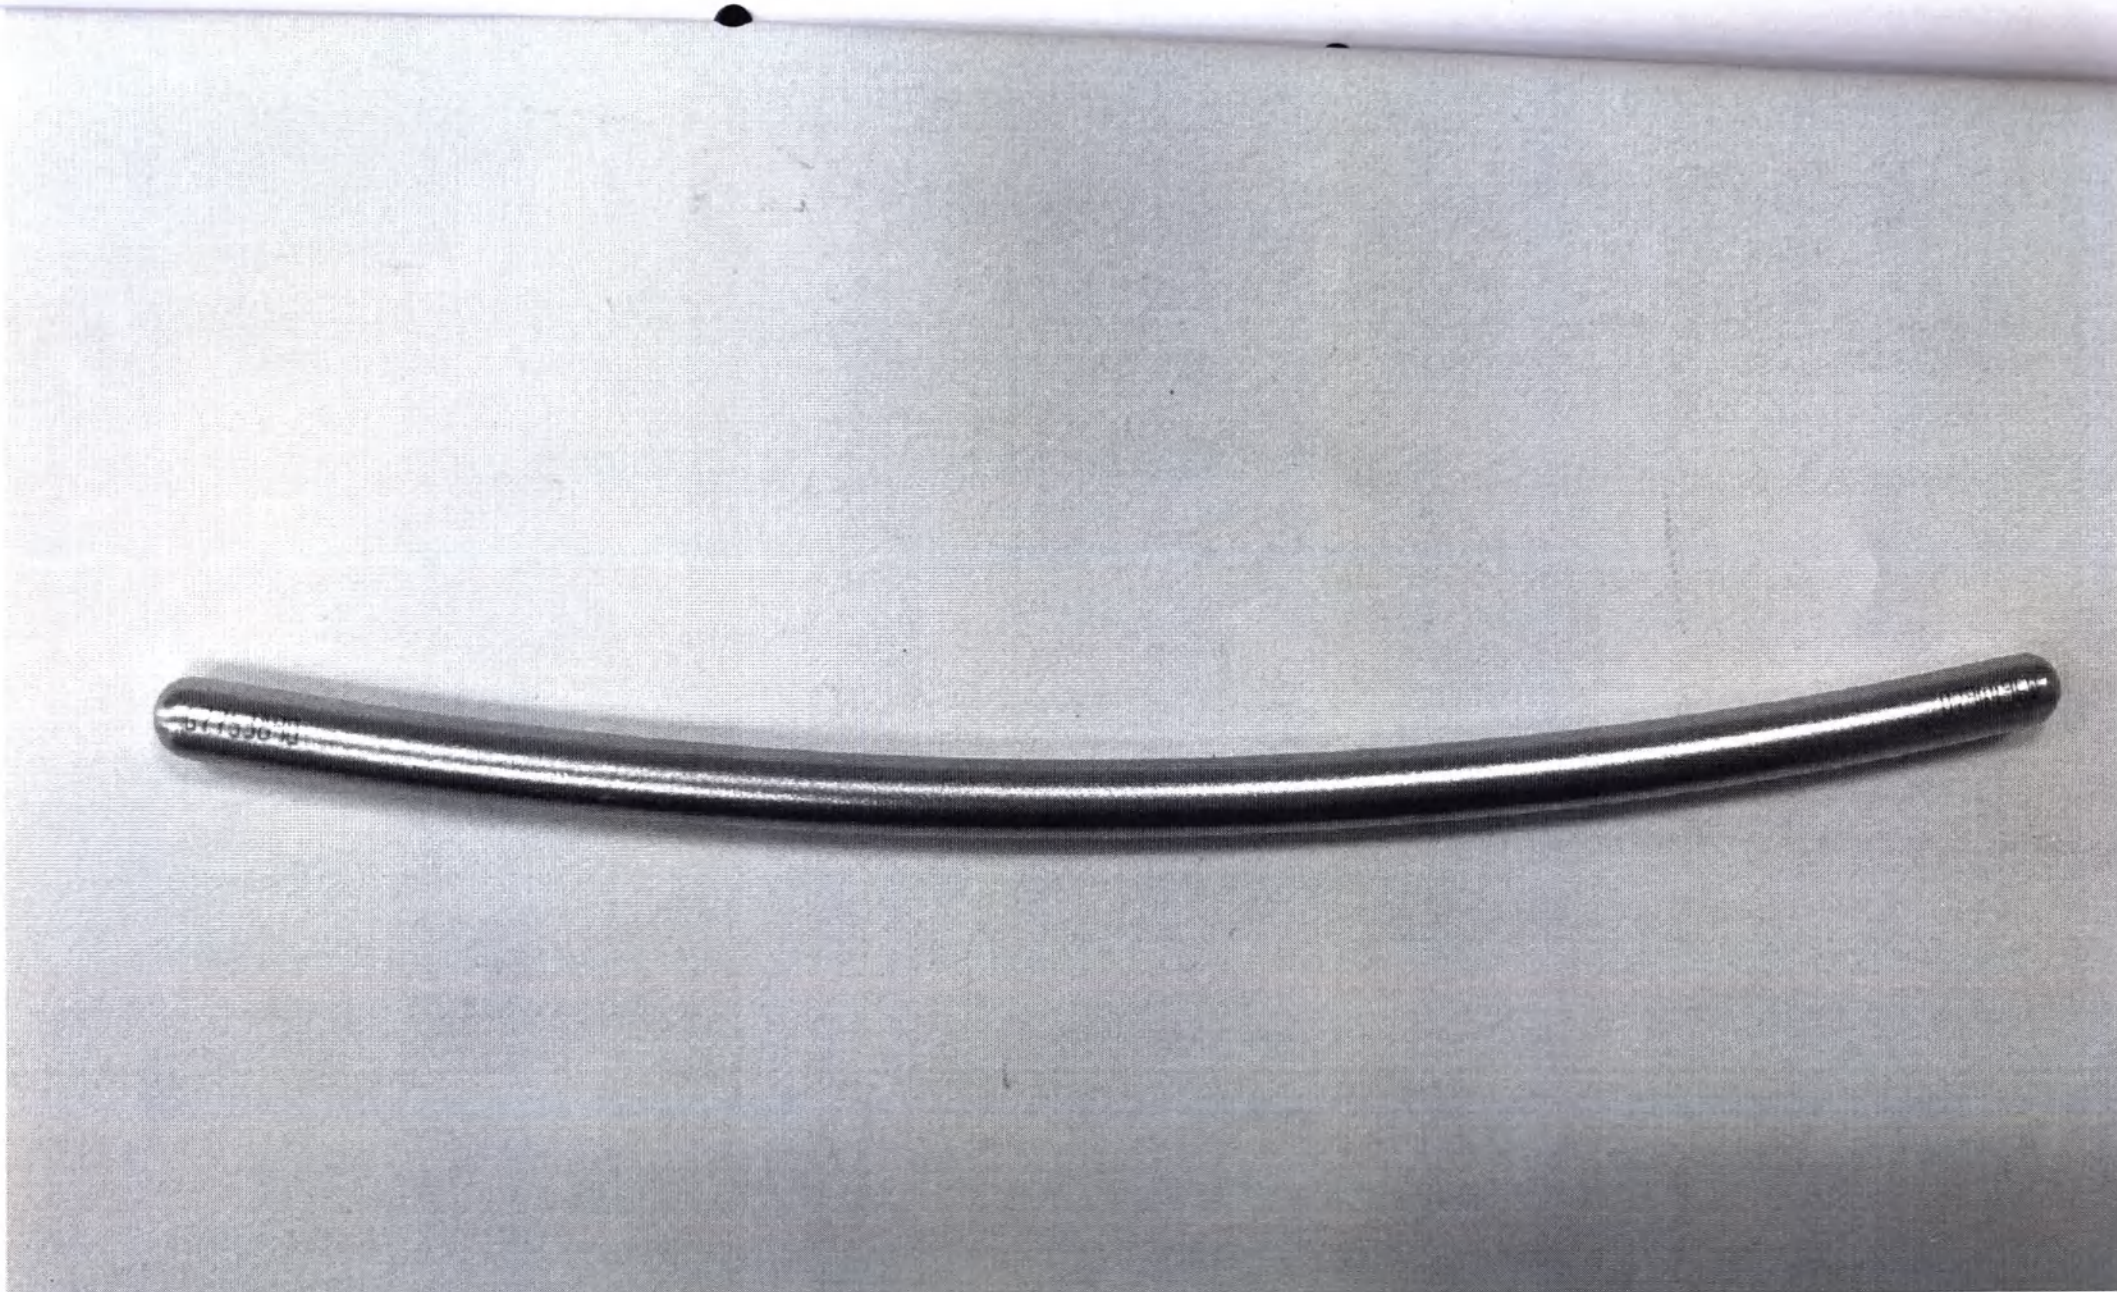


Фото 27. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень PRE-CUT/BENT CHROMALOY PLUS ROD 3.5 x 90 мм) – вид изделия без упаковки



Фото 28. Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника VERTEX (На примере варианта исполнения Стержень PRE-CUT/BENT CHROMALOY PLUS ROD 3.5 x 90 мм) – комплект поставки

Образец русскоязычного стикера

|                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название медицинского изделия: Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника |                                           |
| Производитель:                                                                  | Код UPN                                   |
| Страна происхождения:                                                           | REF                                       |
| Представитель производителя в РФ:                                               |                                           |
| Регистрационное Удостоверение № РЗН 2023/20010 от                               |                                           |
| Серия/Годен до:<br>см. упаковку                                                 | См. Инструкцию<br>См. символы на упаковке |

Пример русскоязычного стикера МИ “Стержни стерильные для остеосинтеза позвоночника”

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью ООО "Медтроник"

30 листа(ов)

