



**Abbott**

Фотографические изображения  
медицинского изделия

***Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторин-  
га глюкозы FreeStyle Libre***

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

подразделения средств диагностики диабета


ООО «Эбботт Лэбораториз»


Тямаева Л.А.

« 07 » сентября 2023 г.



Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе : 1. Сканер - 1 шт.

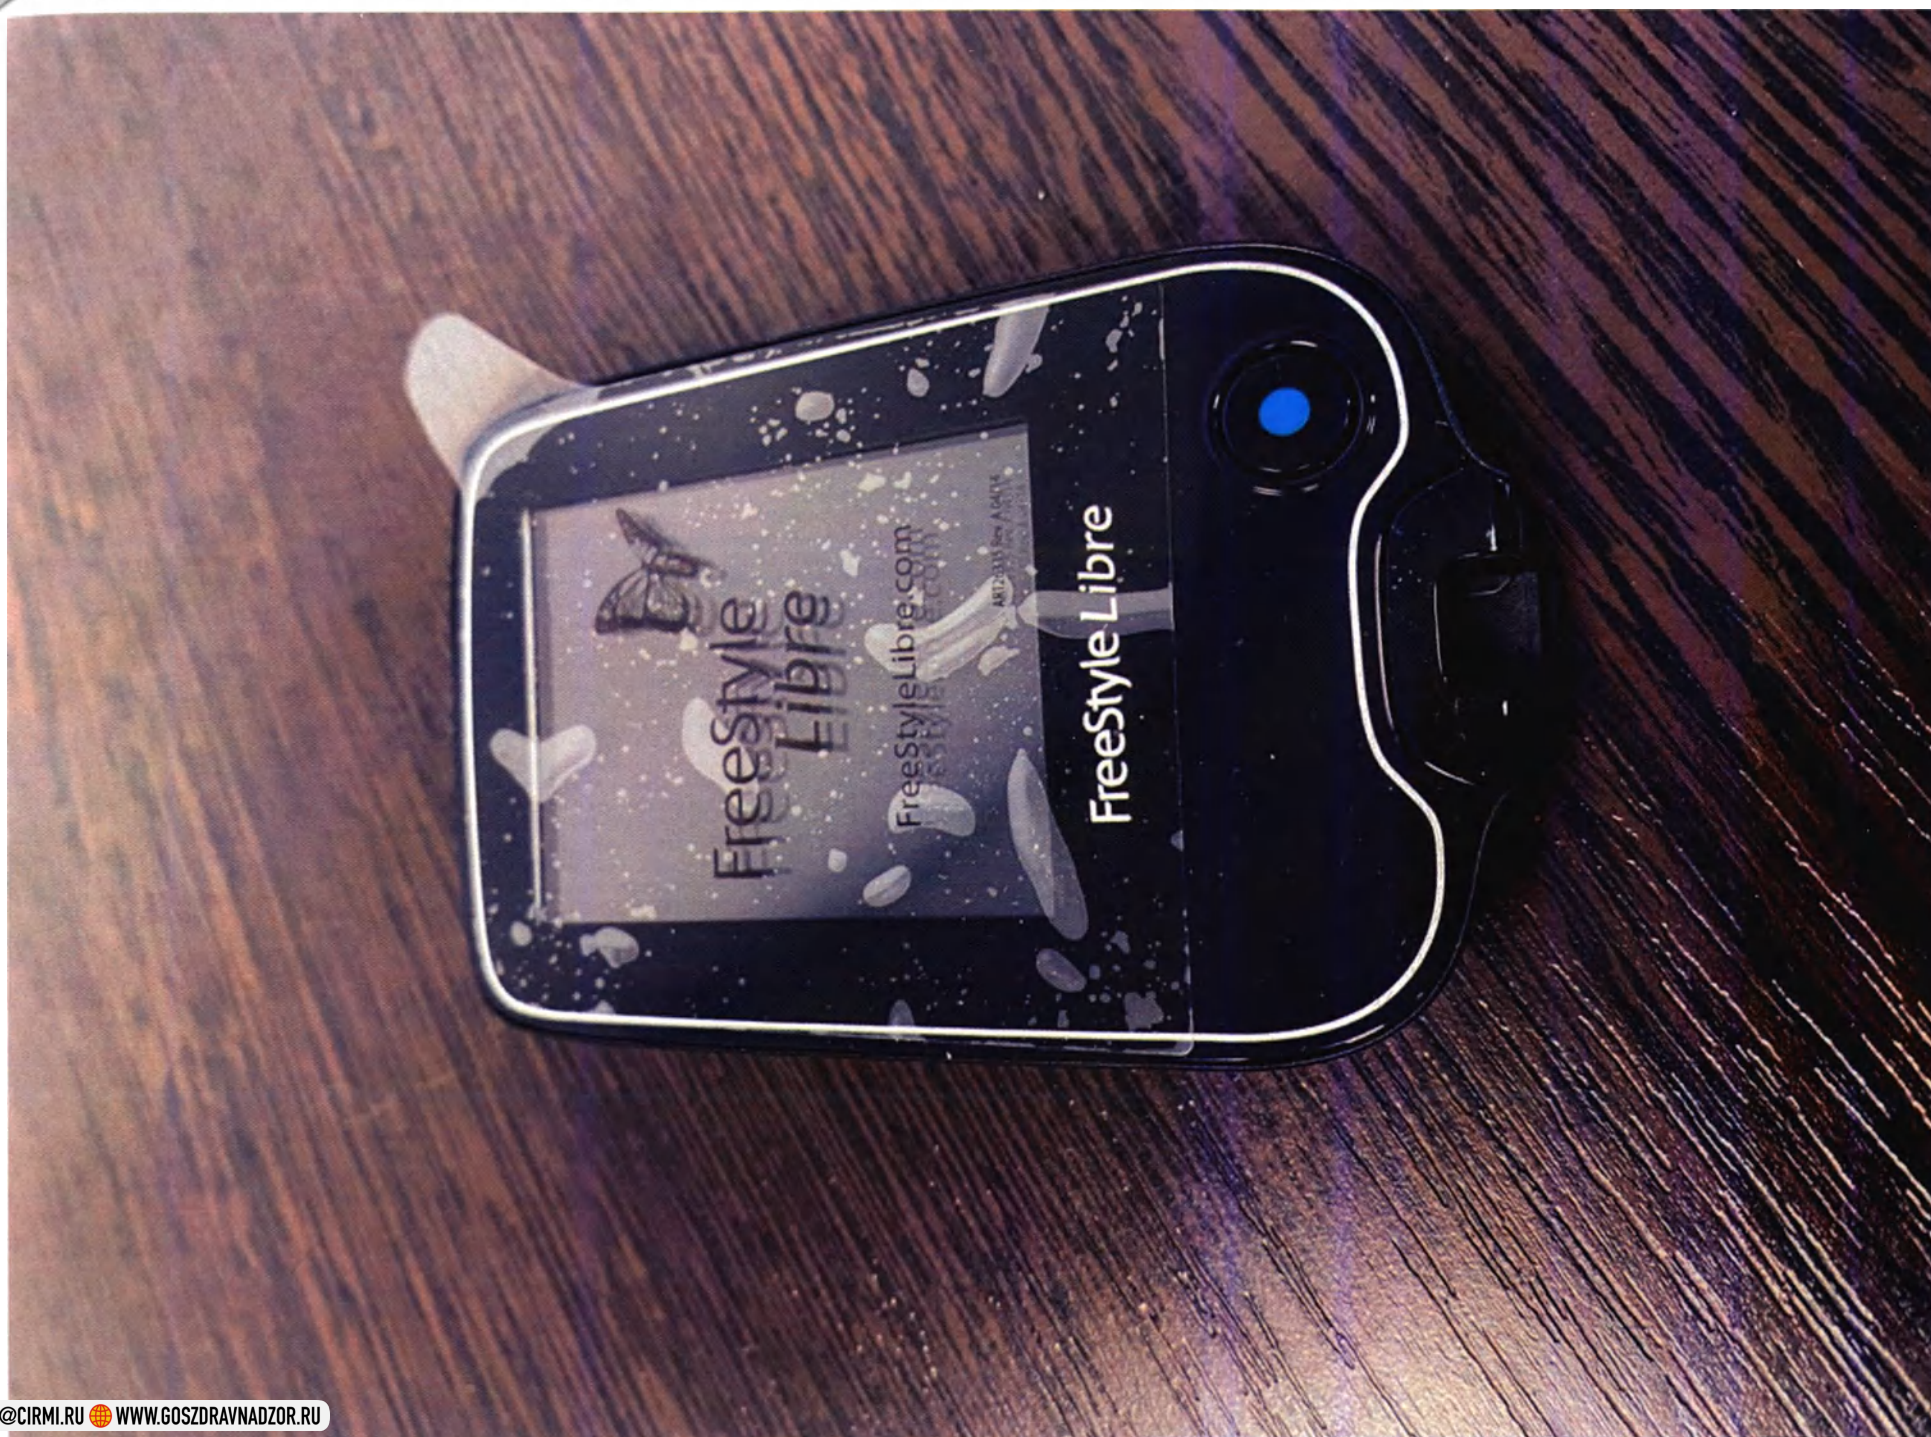

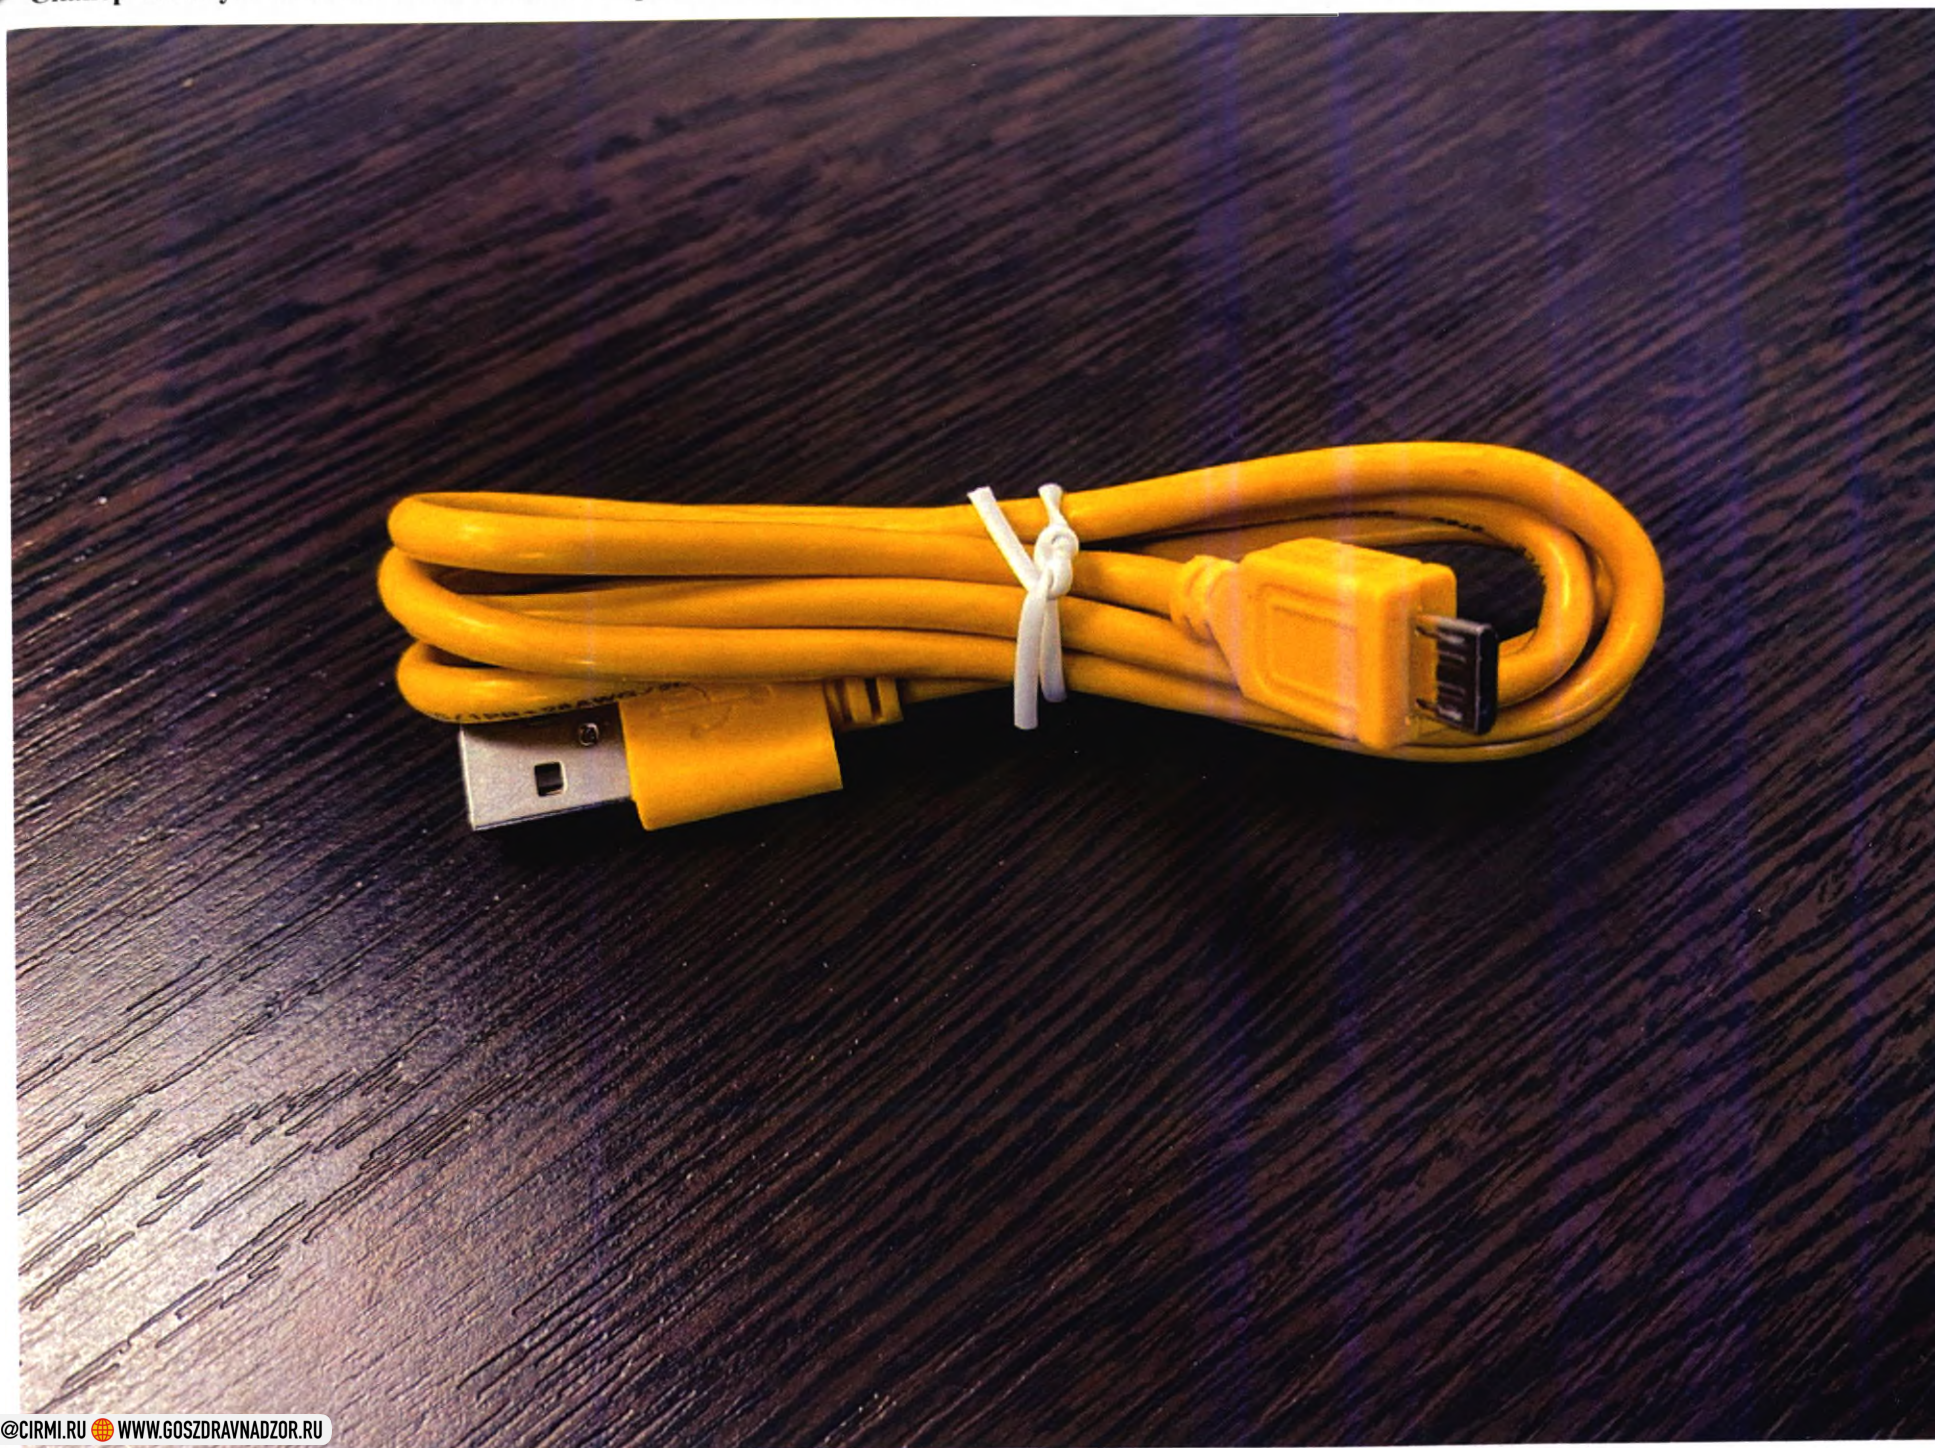

Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе : 3. Блок питания - 1 шт.





# FreeStyle *Libre*



**СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ**

Инструкция по применению  
медицинского изделия  
Сканер FreeStyle Libre системы  
Flash мониторинга глюкозы  
FreeStyle Libre






# FreeStyle *Libre*

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

**Краткое руководство по  
эксплуатации**



## Вкладыш с данными о производительности


**ПРИМЕЧАНИЕ:** проконсультируйтесь с медицинскими работниками о том, как использовать информацию этого раздела.

### Вещества, способные повлиять на результаты

Прием аскорбиновой кислоты после установки датчика может привести к ложно повышенным результатам определения уровня глюкозы датчиком. Прием салициловой кислоты может немного снизить результаты измерения датчиком уровней глюкозы. Погрешность измерений зависит от количества в организме активного вещества, способного повлиять на результаты.

### Рабочие характеристики

Рабочие характеристики системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre были оценены в контролируемом клиническом исследовании. Это исследование было проведено в 4 центрах, и в анализ эффективности были включены в общей сложности 72 больных диабетом. Каждый участник исследования носил два датчика на задней поверхности плеча в течение 14 дней. Во время исследования пациенты восемь раз в день проверяли уровень глюкозы в капиллярной крови из пальца. В исследовании были испытаны три партии датчиков.

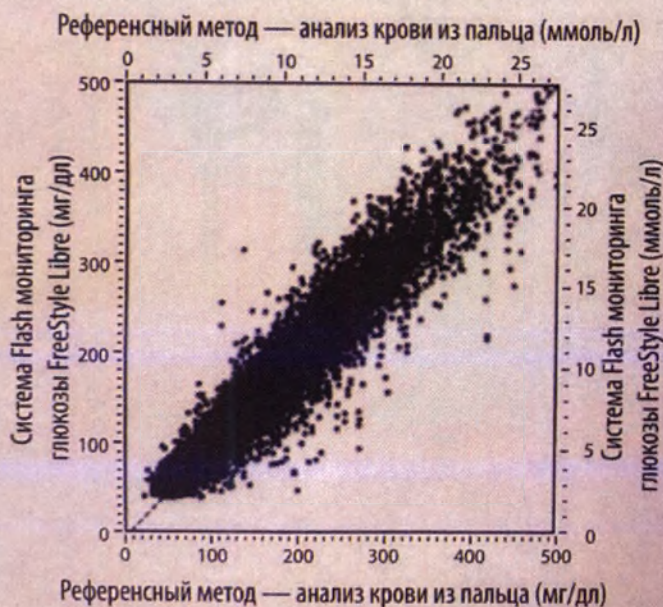

**Рис. 1.** Сравнение результатов, полученных датчиками системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre и референсным методом, анализом крови из пальца.

**Таблица 1.** Регрессионный анализ результатов, полученных датчиками системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre и при помощи референсного метода, анализа крови из пальца





Уполномоченный  
представитель/импортер в РФ:  
ООО «Зеленая Лаборатория»  
125171, г. Москва,  
Ленинградское шоссе,  
д. 16 А, стр. 1,  
телефон 8-800-100-88-07

A MediSense product  
with PRECISION technology

Регистрационное удостоверение:  
ИРЭН 2018/6766 от 11.12.2020

Производитель:  
«Зеленая Лаборатория»  
Abbott Diabetes Care Ltd.  
Range Road  
Witney, Oxon  
OX29 0YL, UK (Соединенное Королевство)



REF

71629-01





Сканер и кабель USB произведены в Китае. Блок питания произведен во Вьетнаме.  
Патент: <https://www.abbott.com/patents>  
FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.  
ART32076-S16 Rev. A 01/23 ©2021-2023 Abbott



FreeStyle  
Libre



**СОСТАВ:**

Сканер - 1 шт.  
Кабель USB - 1 шт.  
Блок питания - 1 шт.  
Инструкция по применению медицинского изделия  
«Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга  
глюкозы FreeStyle Libre» - 1 шт.  
Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт.  
Выпадыш с данными о производительности - 1шт.



FreeStyle  
Libre



**СКАНЕР FREESTYLE LIBRE СИСТЕМЫ FLASH  
МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ FREESTYLE LIBRE**

Для получения результатов определения глюкозы  
сканируйте датчик в течение 1 секунды



Для применения с датчиком FreeStyle Libre

Не использовать, если опломбирование нарушено или отсутствует.

|                                                                                    |                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NDC</b>                                                                         | <b>AREA 1</b><br><b>AREA 2</b><br><b>AREA 3</b><br><b>AREA 4</b><br><b>AREA 5</b> | ART0910J Rev A 1.2.05 |
| <b>REF</b>                                                                         |                                                                                   |                       |
| <b>SN</b>                                                                          |                                                                                   |                       |
| <b>LOT</b>                                                                         |                                                                                   |                       |
|  |                                                                                   |                       |




 The Peoples' Republic of China  
 Beijing 100000  
 Limited liability company  
 Abbot Laboratories

