

УТВЕРЖДАЮ  
Управляющий  
ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

ИП Син О.В.

«10» апреля 2023г.

## Макеты маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

### Комплект № 1

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

REF

FOB-AG-22



Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»  
Для профессионального применения

**Комплект № 1 (рассчитан на исследование 1 образца)**  
**Состав набора:**

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Инструкция пользователя                                                   | 1 шт. |
| Тест-картридж                                                             | 1 шт. |
| Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца | 1 шт. |




ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022  
РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro  
Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов



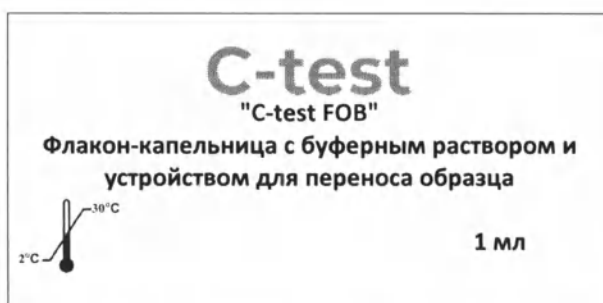


Макет маркировки транспортной тары




## Комплект № 2

Макет маркировки внешней упаковки

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>C-test</h1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>REF</b> FOB-AG-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>25 |
| <b>Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022» для профессионального применения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| <b>Комплект № 2 (рассчитан на исследование 25 образцов)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| <b>Состав набора:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| Инструкция пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 шт.                                                                                     |
| Тест-картридж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 шт.                                                                                    |
| Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 шт.                                                                                    |
|  ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»<br>454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ<br>КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,<br>тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: <a href="http://www.c-test.ru">www.c-test.ru</a> , e-mail: <a href="mailto:info@c-test.ru">info@c-test.ru</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
|         |                                                                                           |
| ТУ 21.20.23-012-46753495-2022<br>РУ № РЗН XXXX/XXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Только для диагностики in vitro<br>Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |

Макет маркировки компонентов

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>C-test</h2> <p>"C-test FOB"</p> <p>Тест-картридж</p>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <h2>C-test</h2> <p>"C-test FOB"</p> <p>Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца</p>  | <b>1 мл</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

# C-test

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX




ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



FOB-AG-22

Нетто XX кг  
Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт  
Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## Комплект № 3

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

**REF** FOB-AG-22



**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»**  
Для профессионального применения

**Комплект № 3 (рассчитан на исследование 1 образца)**

**Состав набора:**

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Инструкция пользователя                                                   | 1 шт. |
| Тест-полоска                                                              | 1 шт. |
| Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца | 1 шт. |



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,

тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro

Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов

## C-test

"C-test FOB"


Тест-полоска



## C-test

"C-test FOB"

Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца



1 мл

# C-test

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX




ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).

**REF** FOB-AG-22

Нетто XX кг  
Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт  
Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## Комплект № 4

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

**REF** FOB-AG-22



Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

**Комплект № 4 (рассчитан на исследование 25 образцов)**

**Состав набора:**

Инструкция пользователя

1 шт.

Тест-полоска

25 шт.

Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца

25 шт.



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,

тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro

Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов

## C-test

"C-test FOB"

Тест-полоска



## C-test

"C-test FOB"

Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца



1 мл

# C-test

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX




ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



FOB-AG-22

Нетто XX кг  
Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт  
Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## Комплект № 5

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

REF

FOB-AG-22

$\Sigma$

50

**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»**  
Для профессионального применения

**Комплект № 5 (рассчитан на исследование 50 образцов)**  
**Состав набора:**

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Инструкция пользователя                                                   | 1 шт.  |
| Тест-полоска                                                              | 50 шт. |
| Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца | 50 шт. |



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022  
РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro  
Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов

## C-test

"C-test FOB"


Тест-полоска



## C-test

"C-test FOB"

Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца



2°C 30°C

1 мл

# C-test

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX




ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).

**REF** FOB-AG-22

Нетто XX кг  
Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт  
Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## Комплект № 6

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

REF

FOB-AG-22



100

**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022» для профессионального применения**




**Комплект № 6 (рассчитан на исследование 100 образцов)**

**Состав набора:**

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Инструкция пользователя                                                   | 1 шт.   |
| Тест-полоска                                                              | 100 шт. |
| Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца | 100 шт. |



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022  
РУ № РЗН XXXX/XXXXX



Только для диагностики in vitro  
Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов

## C-test

"C-test FOB"


Тест-полоска



## C-test

"C-test FOB"

Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца



1 мл

# C-test

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,


тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).

**REF**

FOB-AG-22

Нетто XX кг  
Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт  
Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## Комплект № 7

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

REF

FOB-AG-22



**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»**  
Для профессионального применения

**Комплект № 7 (рассчитан на исследование 1 образца)**  
**Состав набора:**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Инструкция пользователя                  | 1 шт. |
| Тест-полоска в тубе с буферным раствором | 1 шт. |



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022  
РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro  
Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов

# C-test

"C-test FOB"

**Тест-полоска в тубе с буферным раствором**



# C-test

**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»**

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,

тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



FOB-AG-22

Нетто XX кг  
Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт  
Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## Комплект № 8

Макет маркировки внешней упаковки

# C-test

REF

FOB-AG-22



**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»**  
Для профессионального применения

**Комплект № 8 (рассчитан на исследование 25 образцов)**  
**Состав набора:**  
Инструкция пользователя 1 шт.  
Тест-полоска в тубе с буферным раствором 25 шт.



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»  
454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ  
КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,  
тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



ТУ 21.20.23-012-46753495-2022  
РУ № РЗН XXXX/XXXXX

Только для диагностики in vitro  
Набор использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора)

Макет маркировки компонентов

## C-test

"C-test FOB"

**Тест-полоска в тубе с буферным раствором**



# C-test

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»

Для профессионального применения

Только для диагностики in vitro

ТУ 21.20.23-012-46753495-2022

РУ № РЗН XXXX/XXXXX



ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ»

454016, ОБЛ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН. Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, ДОМ 85Б, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 6,

тел./факс: +7 351 230-03-88, сайт: [www.c-test.ru](http://www.c-test.ru), e-mail: [info@c-test.ru](mailto:info@c-test.ru).



FOB-AG-22

Нетто XX кг

Брутто XX кг

Число единиц потребительских упаковок XX шт

Масса нетто потребительской упаковки XX кг



## C-test

Прошито, пронумеровано и скреплено  
Печатью 16 листов.

Управляющий

ООО «Контрольный тест»

ИП Син О. И



**«Утверждаю»**  
**Управляющий**  
**ООО «Контрольный тест»**  
**ИП Син О.В.**  
**«16» мая 2023**



## **ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале иммунохроматографическим методом «C-test FOB» по ТУ 21.20.23-012-46753495-2022»**

## Комплект № 1 (для исследования 1 образца):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-картридж – 1 шт.
- Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца – 1 шт.

Изображение общего вида



## Компоненты набора




## Комплект № 2 (для исследования 25 образцов):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-картридж – 25 шт.
- Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца – 25 шт.

### Изображение общего вида




## Компоненты набора

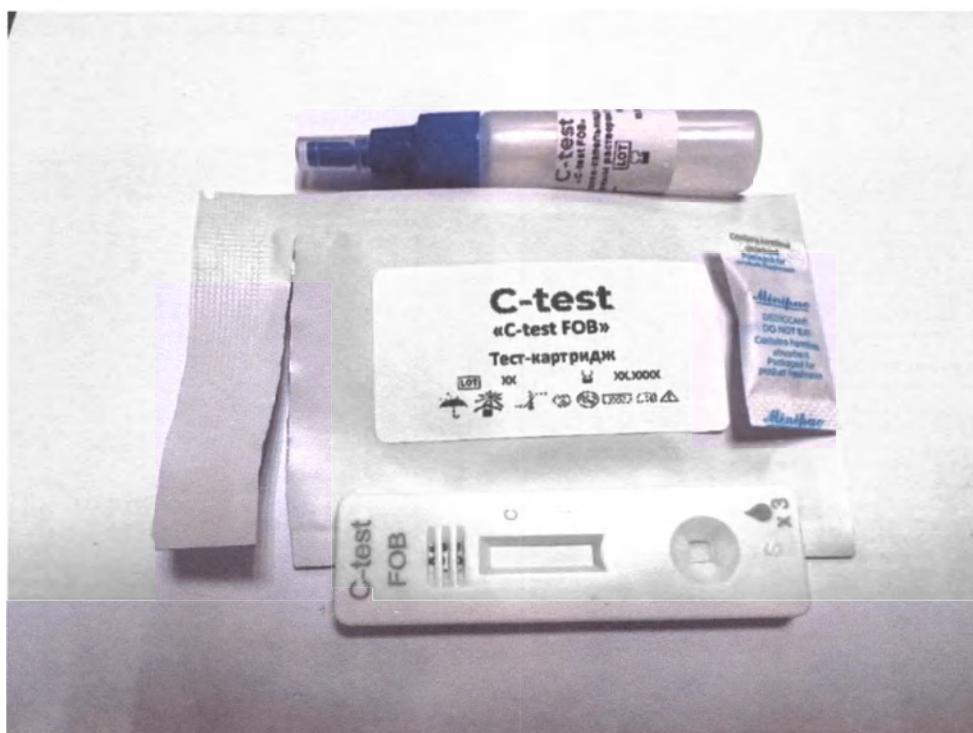

### Комплект № 3 (для исследования 1 образца):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-полоска – 1 шт.
- Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца – 1 шт.

Изображение общего вида

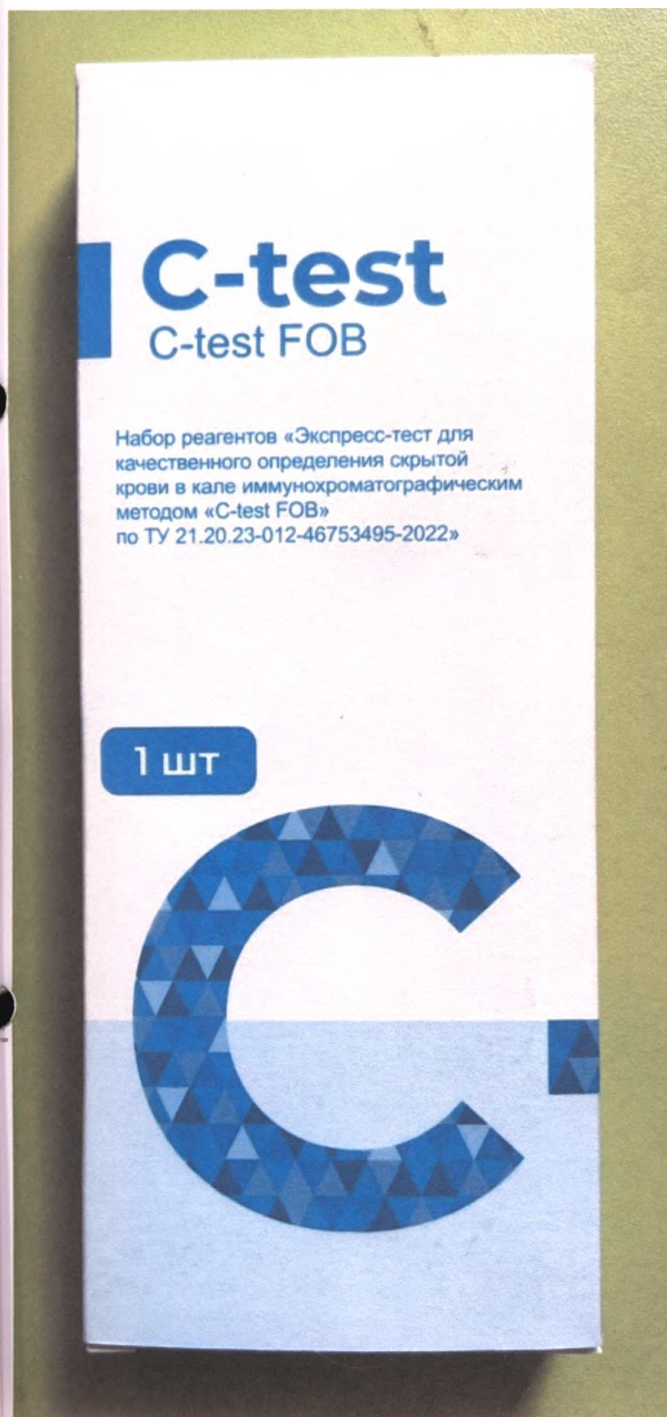


## Компоненты набора



## Комплект №4 (для исследования 25 образцов):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-полоска – 25 шт.
- Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца – 25 шт.

### Изображение общего вида

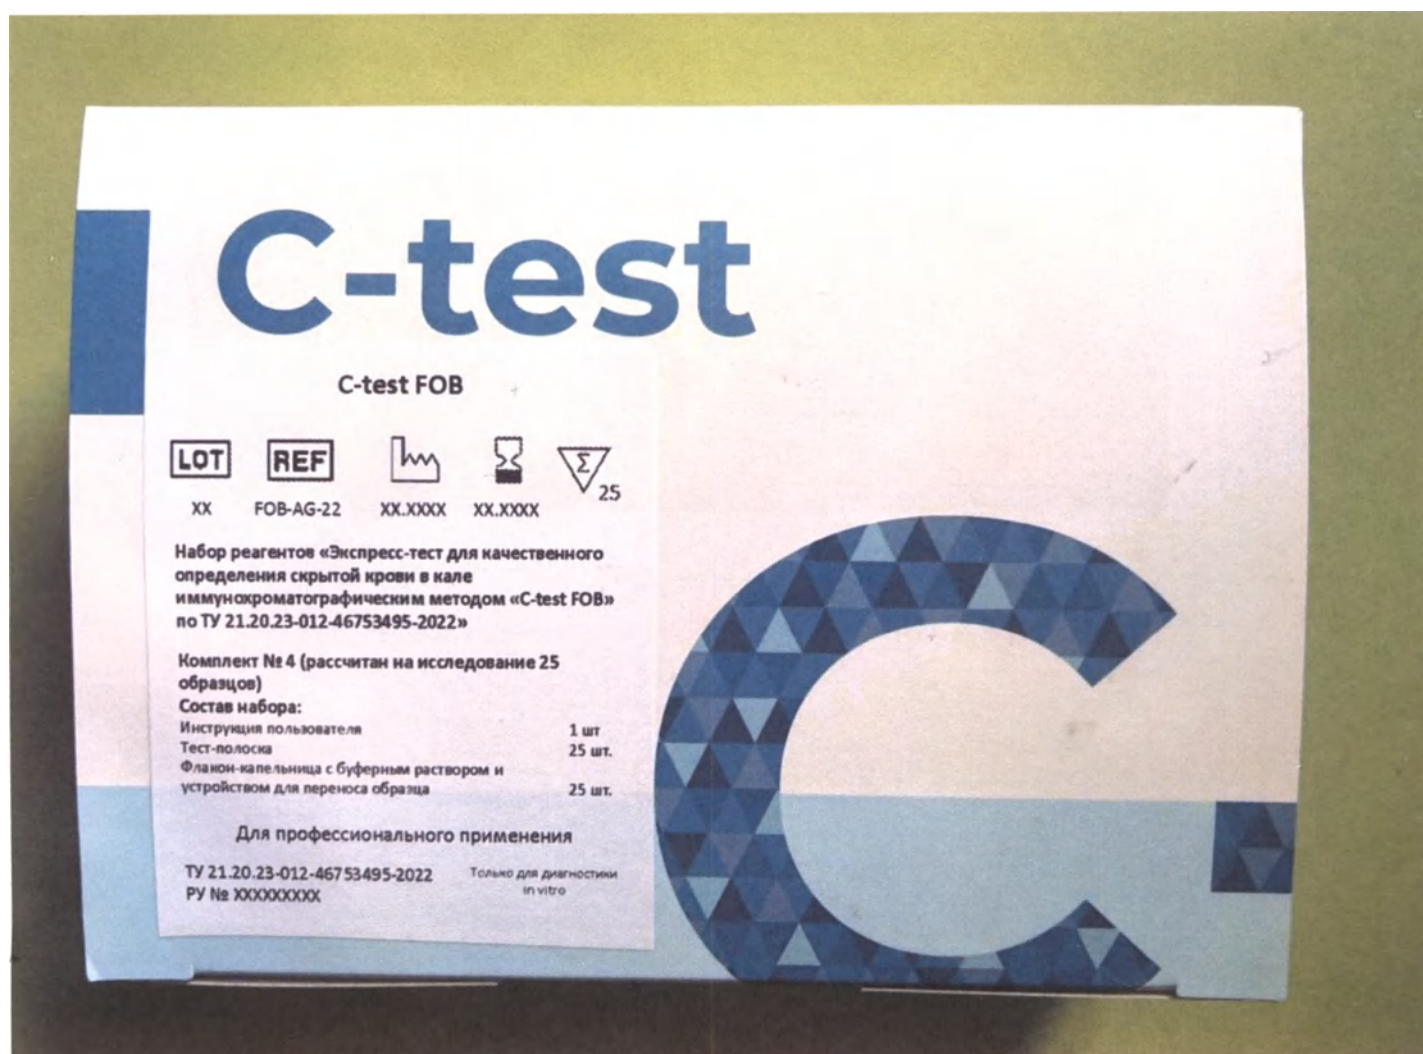

## Компоненты набора




### Комплект № 5 (для исследования 50 образцов):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-полоска – 50 шт.
- Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца – 50 шт.

Изображение общего вида



## Компоненты набора




### Комплект № 6 (для исследования 100 образцов):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-полоска – 100 шт.
- Флакон-капельница с буферным раствором и устройством для переноса образца – 100 шт.

Изображение общего вида




## Компоненты набора

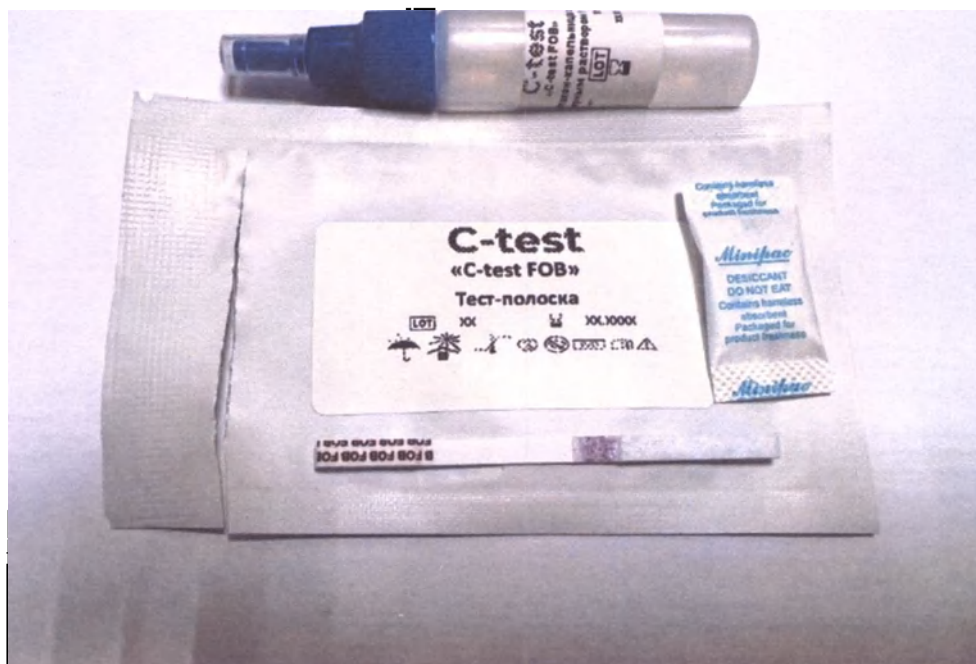

## Комплект № 7 (для исследования 1 образца):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-полоска в тубе с буферным раствором – 1 шт.

Изображение общего вида

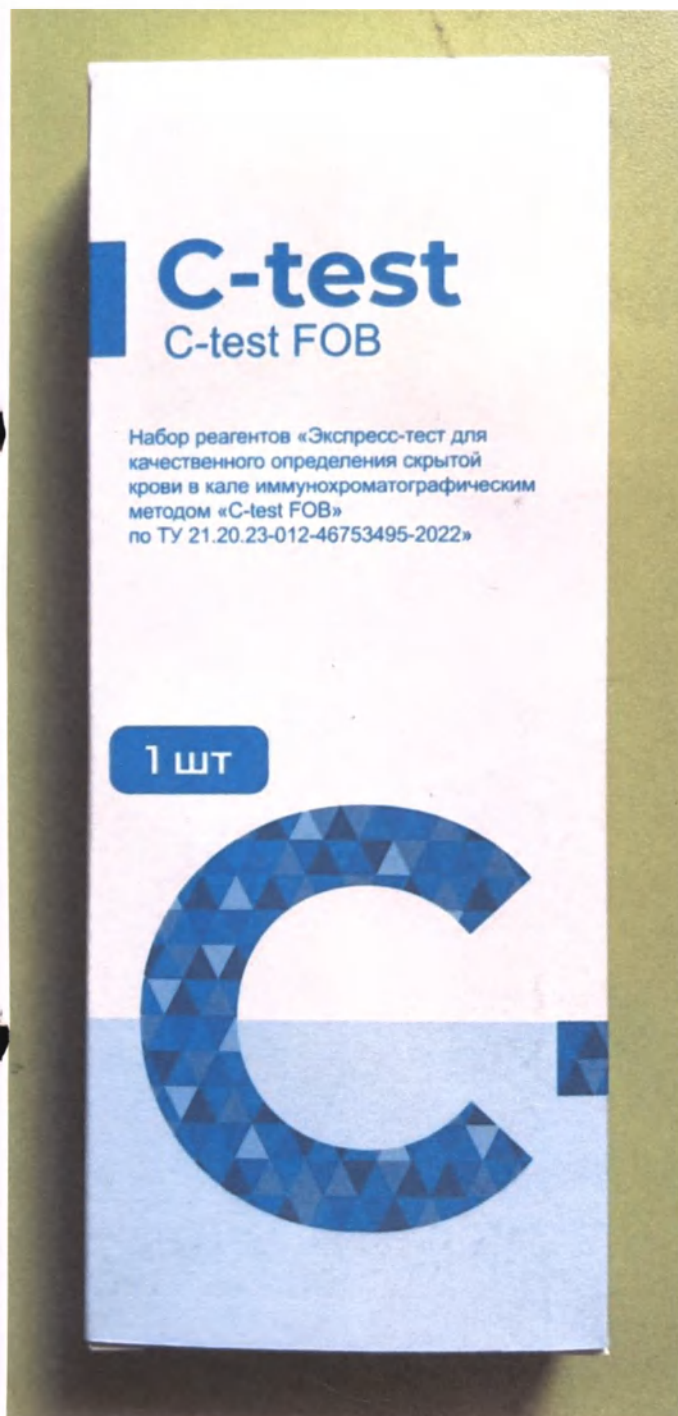

## Компоненты набора



### Комплект № 8 (для исследования 25 образцов):

- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Тест-полоска в тубе с буферным раствором– 25 шт.

#### Изображение общего вида



## Компоненты набора



C-test

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 17 листов.

Управляющий

ООО «Контрольный тест»

ИП Син О. И

