
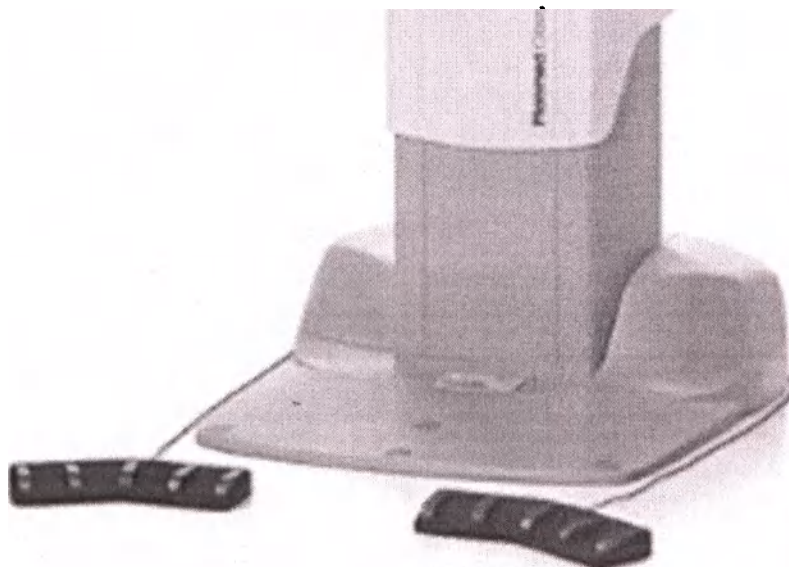


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Аппарат рентгеновский маммографический Planmed Clarity с принадлежностями в вариантах исполнения:

Planmed Clarity 2D/3D

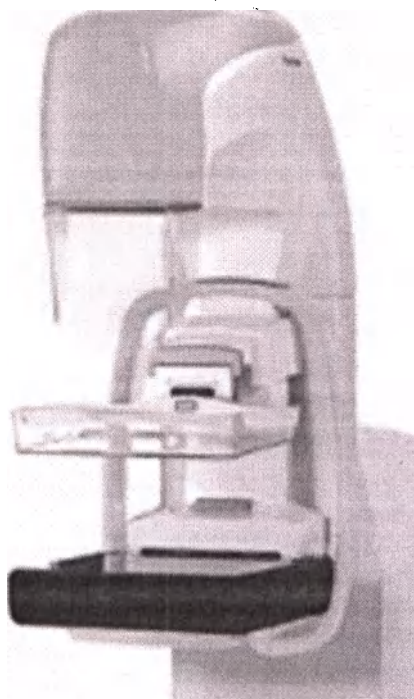


I. Planmed Clarity 2D в составе:


1. Трубка рентгеновская – 1 шт.

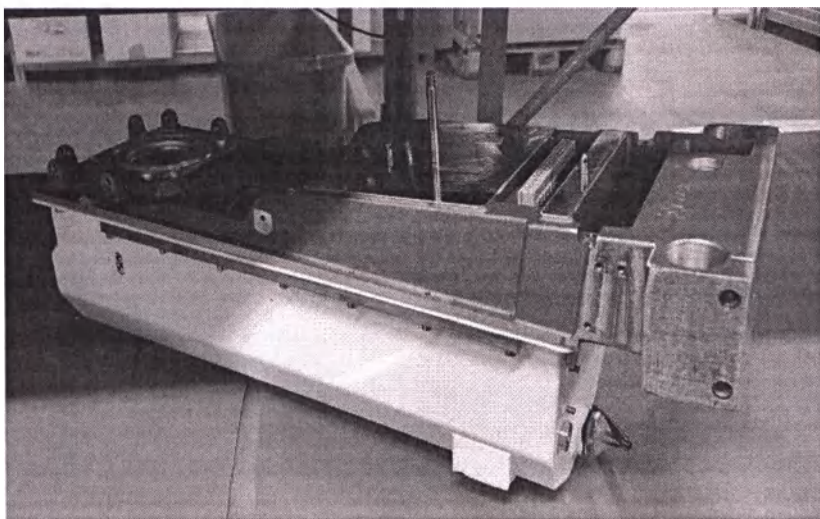


2. Детектор цифровой – 1 шт.

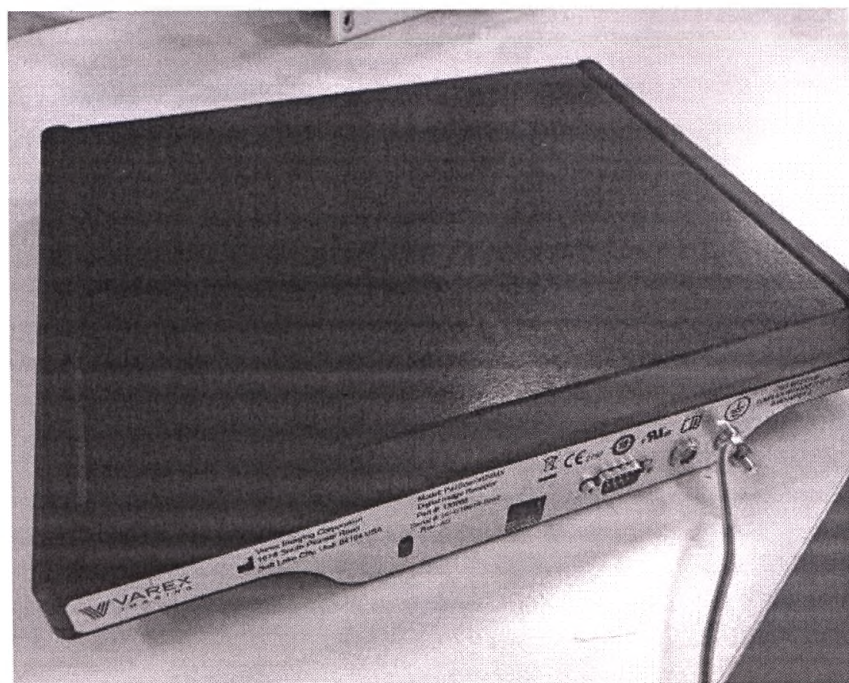


3. Коллиматор – не более 3 шт. (при необходимости)

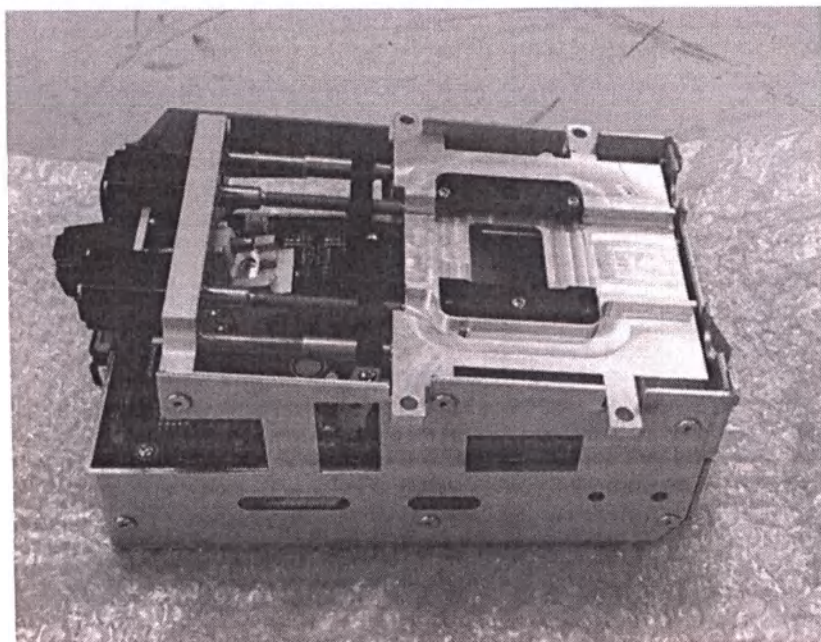


4. Решетка Букки 24 x 30 – 1 шт.

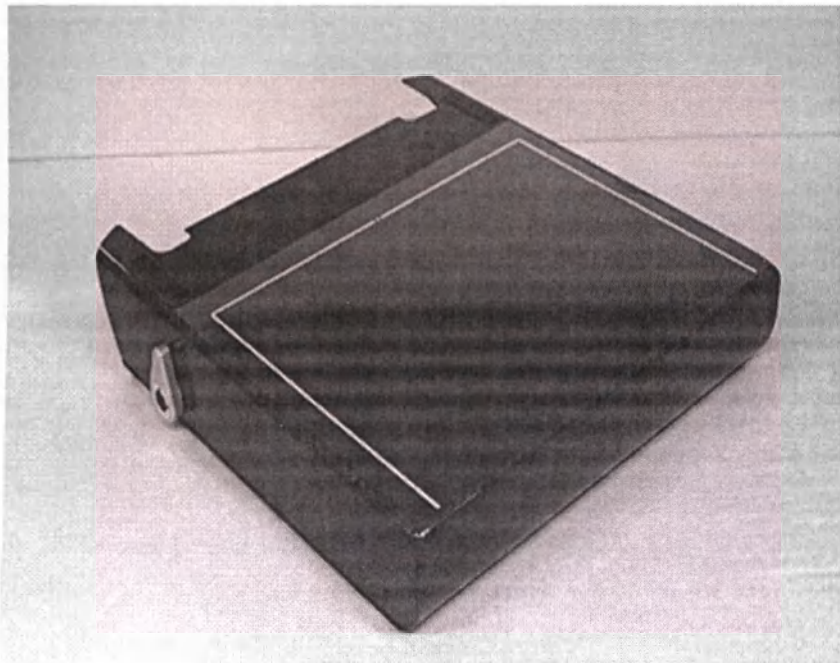


5. Лопатка компрессионная 24 x 30 см – 1 шт.

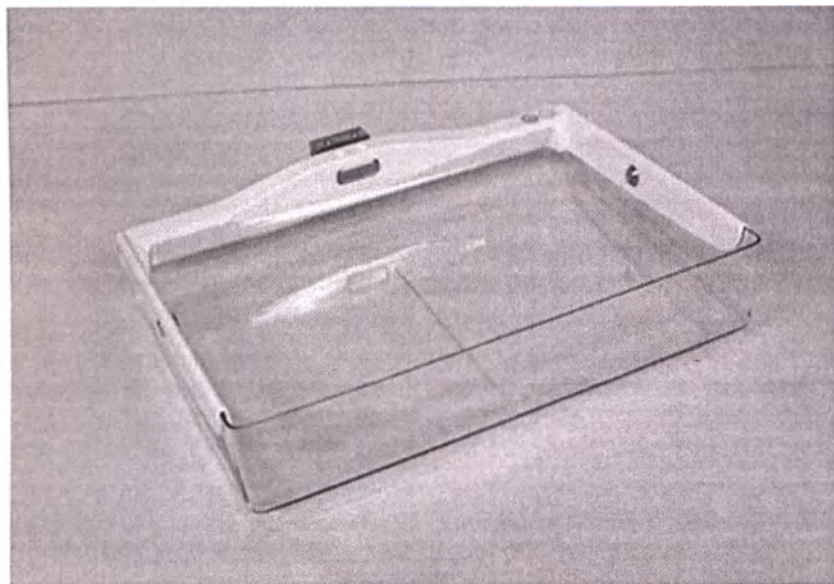

6. Верхний модуль системы позиционирования MaxView – 1 шт. (при необходимости)

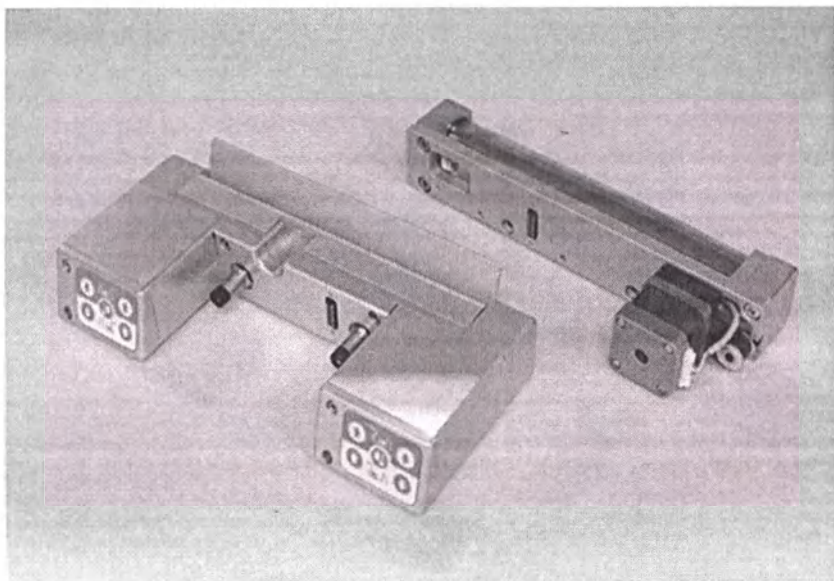

7. Нижний модуль системы позиционирования MaxView – 1 шт. (при необходимости)

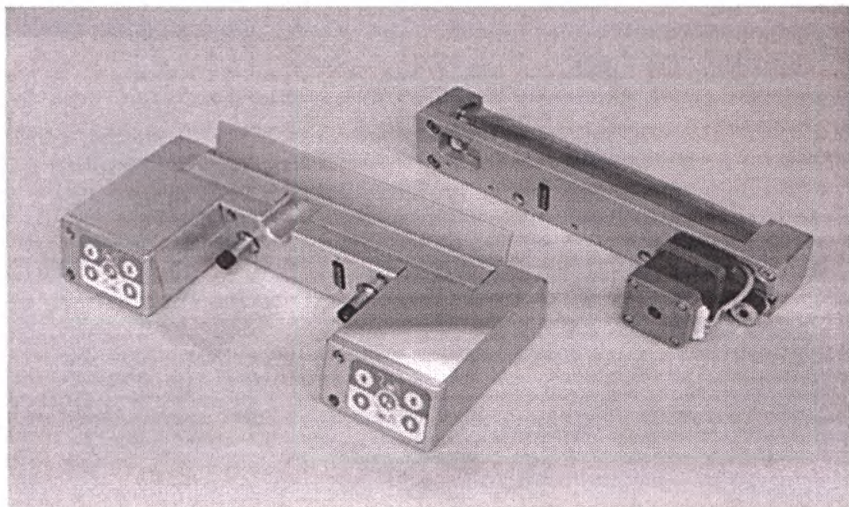

8. Рабочая станция получения изображений – 1 шт. (при необходимости)



9. Дисплей рабочей станции получения изображений – 1 шт. (при необходимости)



10. Блок педалей управления – 2 шт.




11. Кнопка включения экспозиции с кабелем – 1 шт.



12. Кабель – 3 шт.




13. Сетевой кабель – 1 шт.

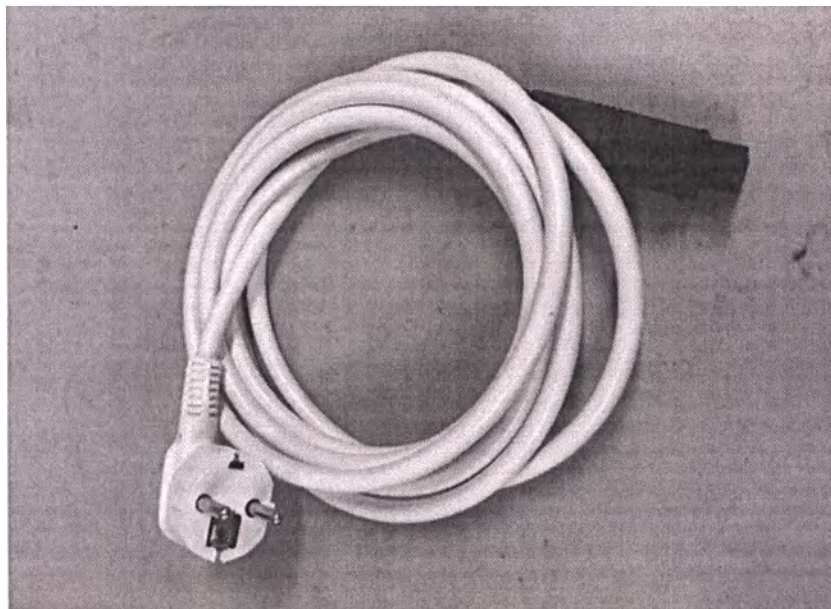


14. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

II. Planmed Clarity 3D в составе:


1. Трубка рентгеновская – 1 шт.

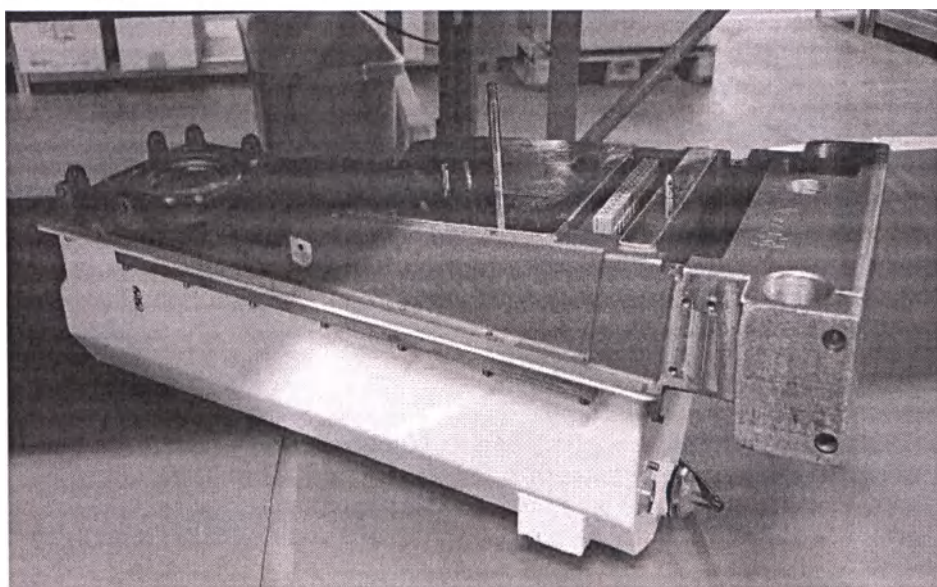


2. Детектор цифровой – 1 шт.

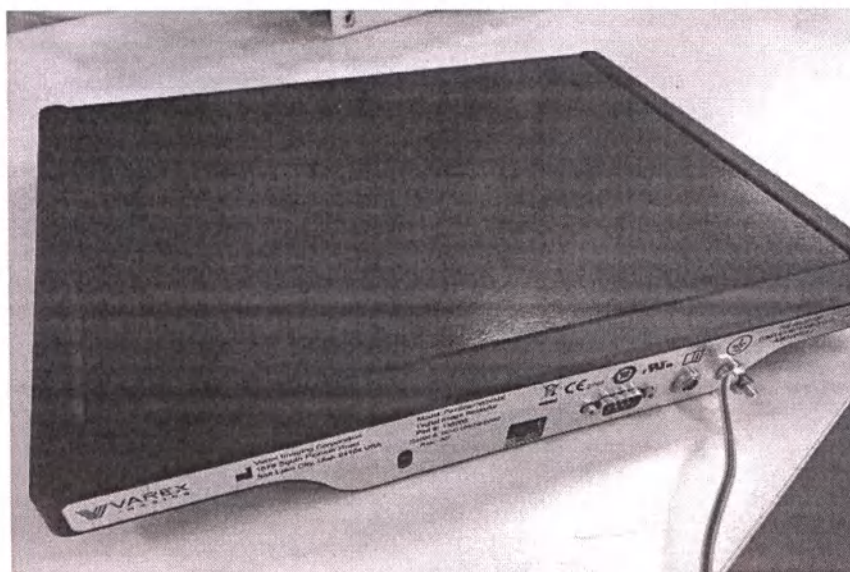


3. Коллиматор – не более 3 шт. (при необходимости)

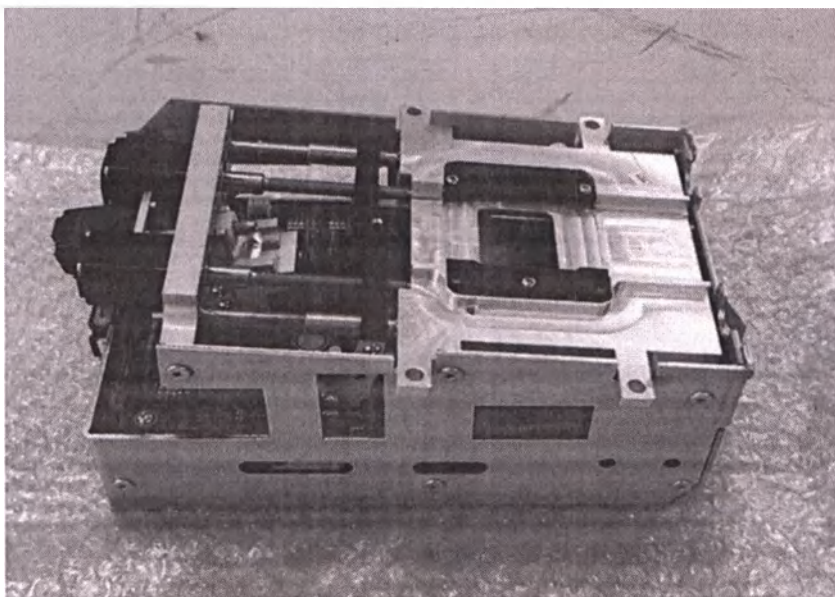


4. Решетка Букки 24 x 30 – 1 шт.

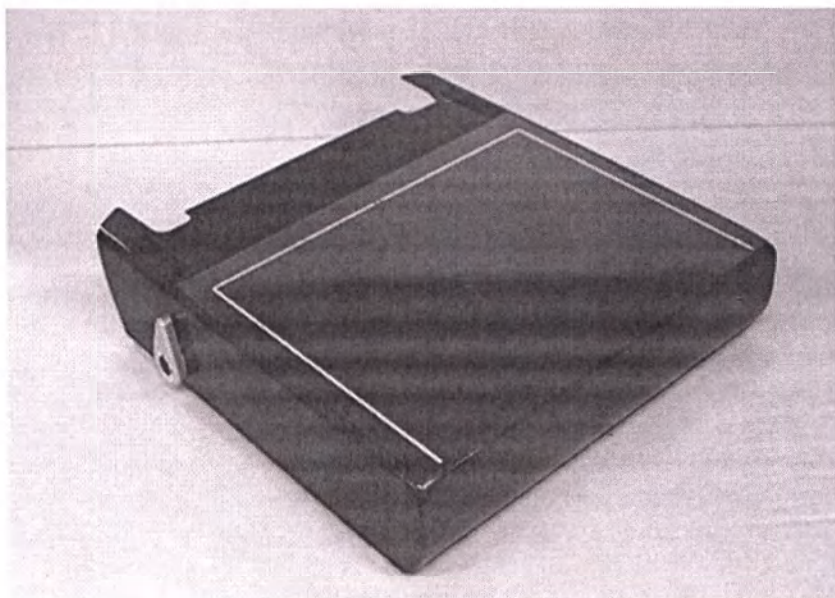


5. Платформа для томосинтеза – 1 шт.

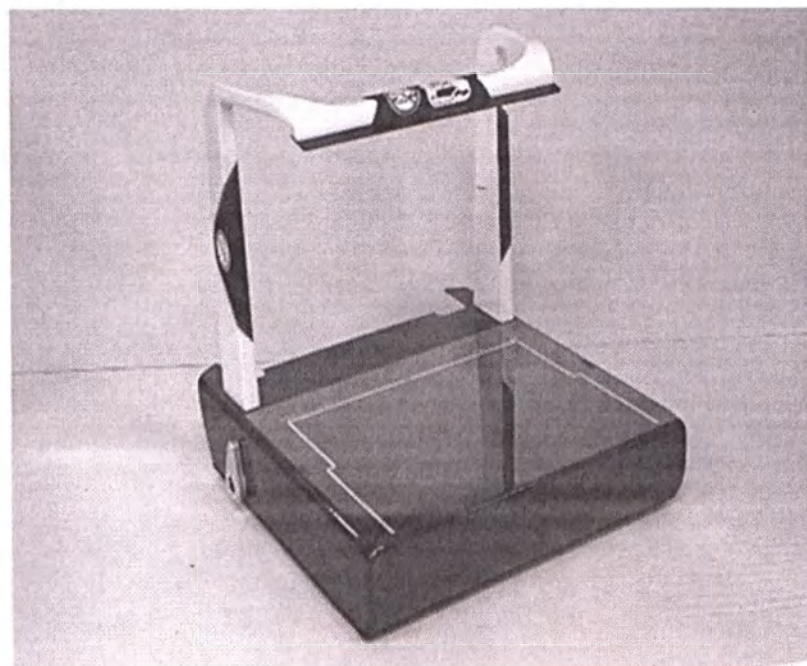


6. Лопатка компрессионная 24 x 30 см – 1 шт.

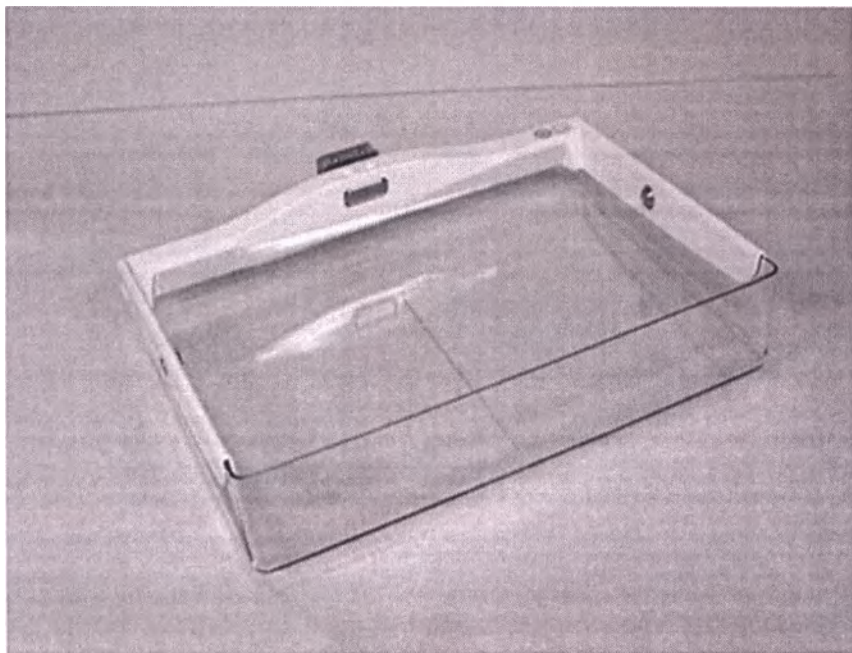


7. Лопатка компрессионная 24 x 33 для томосинтеза – 1 шт.

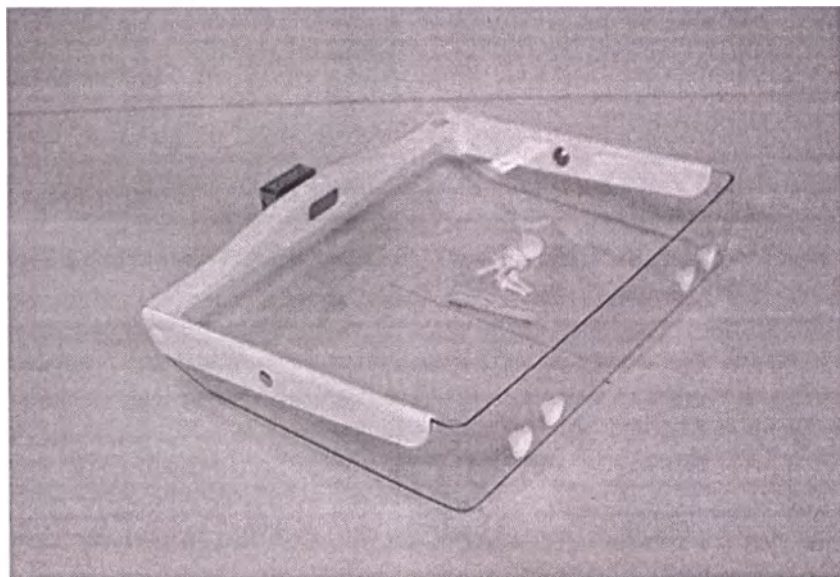


8. Верхний модуль системы позиционирования MaxView – 1 шт. (при необходимости)

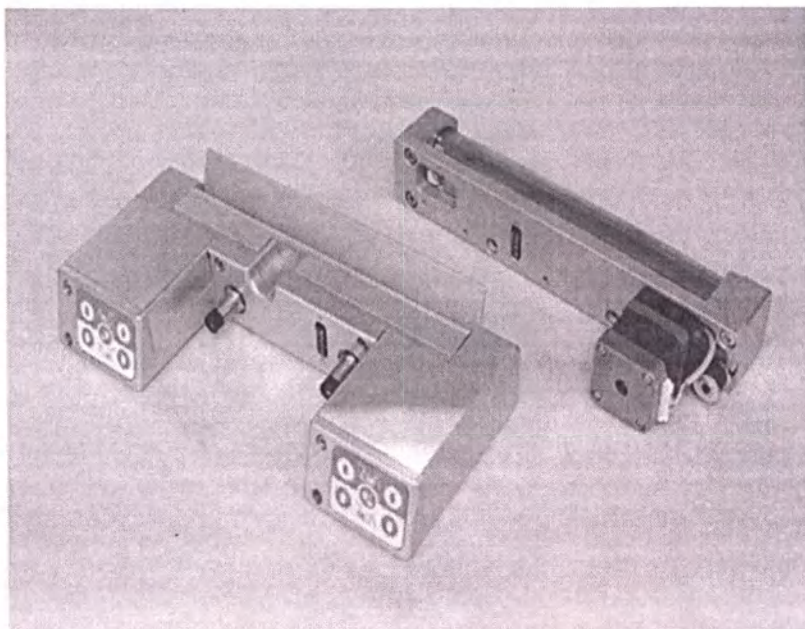

9. Нижний модуль системы позиционирования MaxView – 1 шт. (при необходимости)

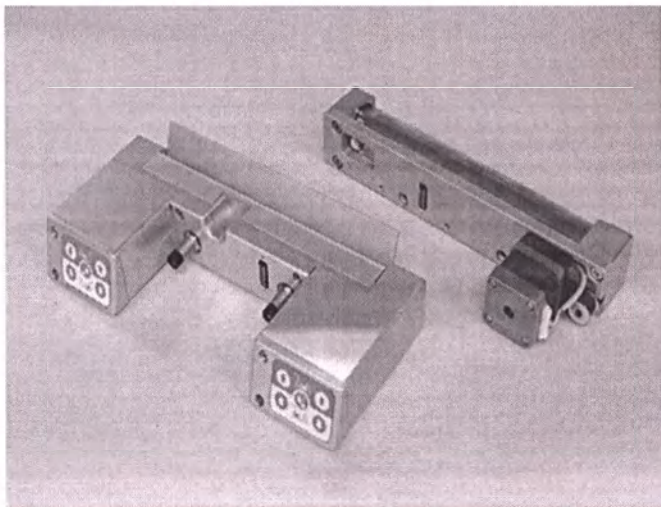

10. Рабочая станция получения изображений – 1 шт. (при необходимости)

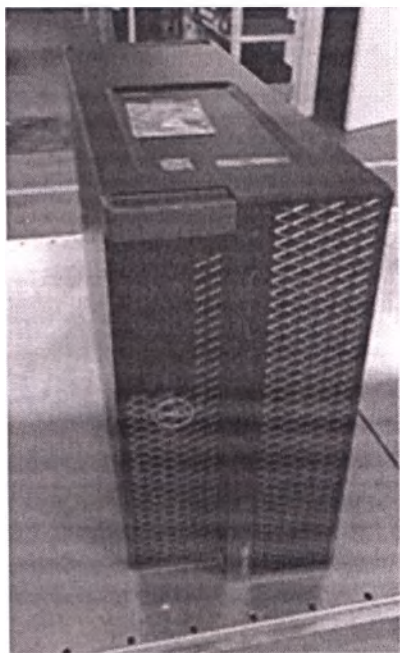


11. Дисплей рабочей станции получения изображений – 1 шт. (при необходимости)



12. Блок педалей управления – 2 шт.



13. Кнопка включения экспозиции с кабелем – 1 шт.

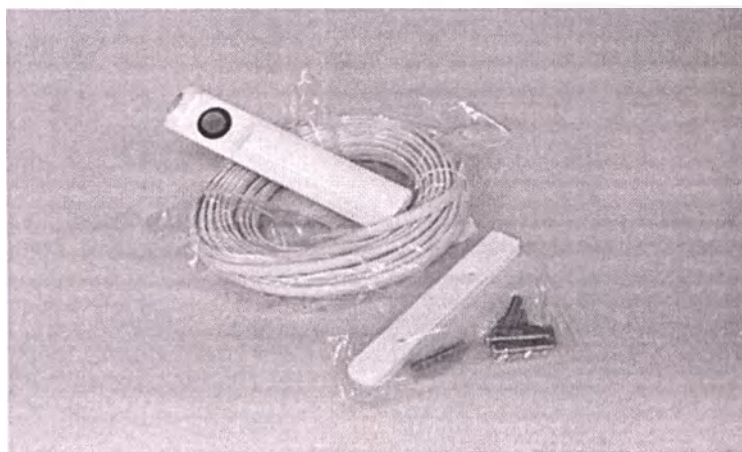

14. Кабель – 3 шт.




15. Сетевой кабель – 1 шт.




16. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Planmed Clarity S

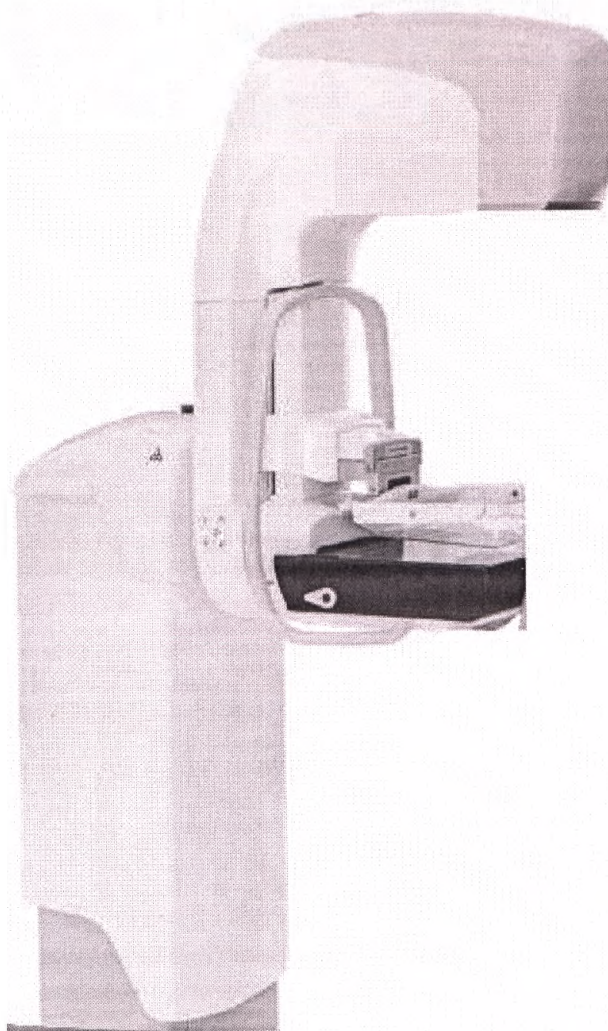


III. Planmed Clarity S в составе:


1. Трубка рентгеновская – 1 шт.

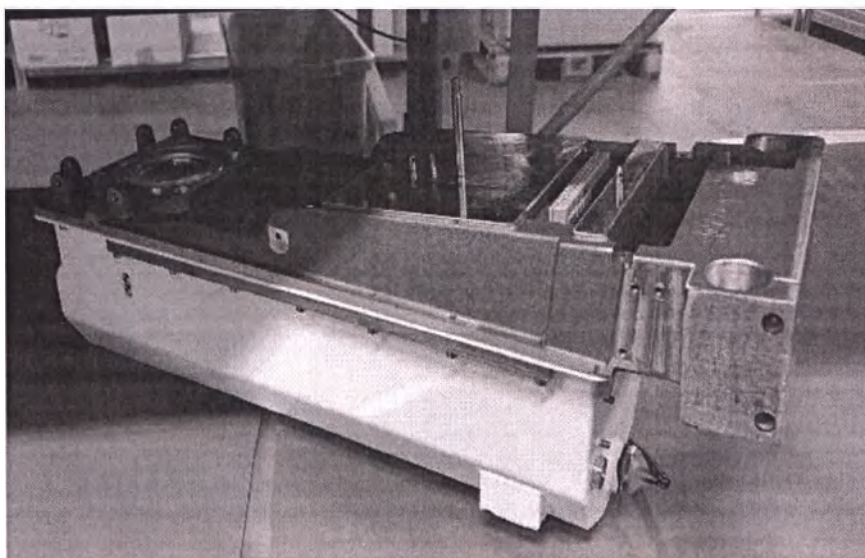


2. Детектор цифровой – 1 шт.

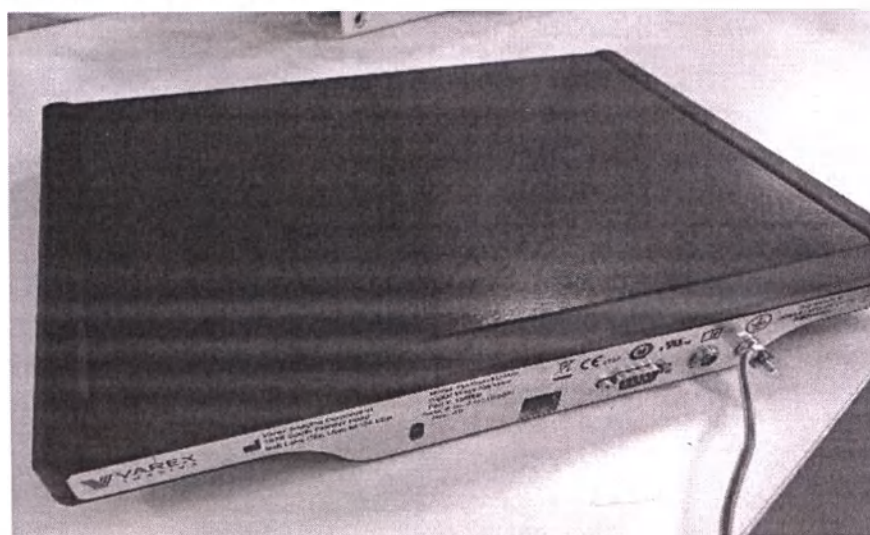

3. Коллиматор – не более 3 шт. (при необходимости)

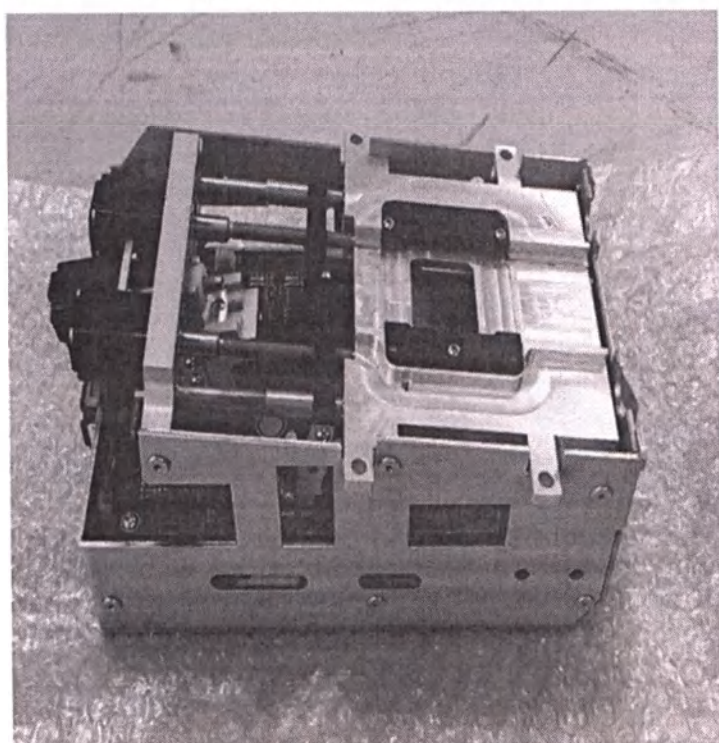

4. Решетка Букки 24 х 30 – 1 шт.

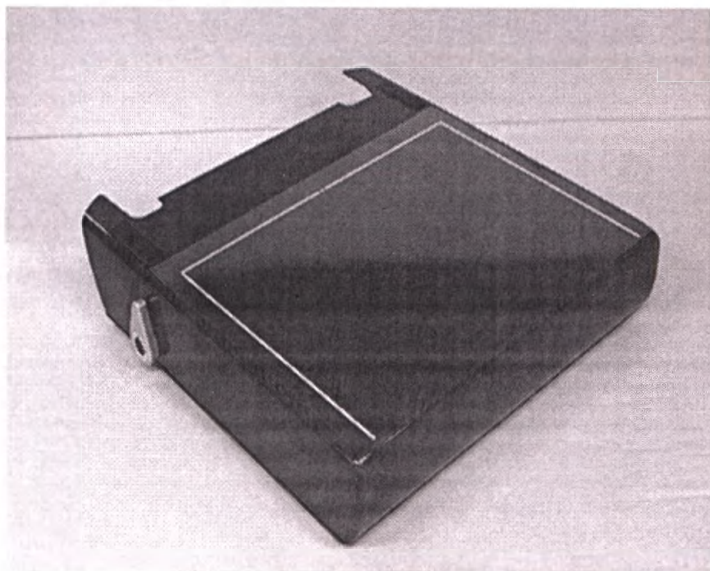

5. Рабочая станция получения изображений – 1 шт.




6. Дисплей рабочей станции получения изображений – 1 шт.



7. Блок педалей управления – 2 шт.




8. Кнопка включения экспозиции с кабелем – 1 шт.

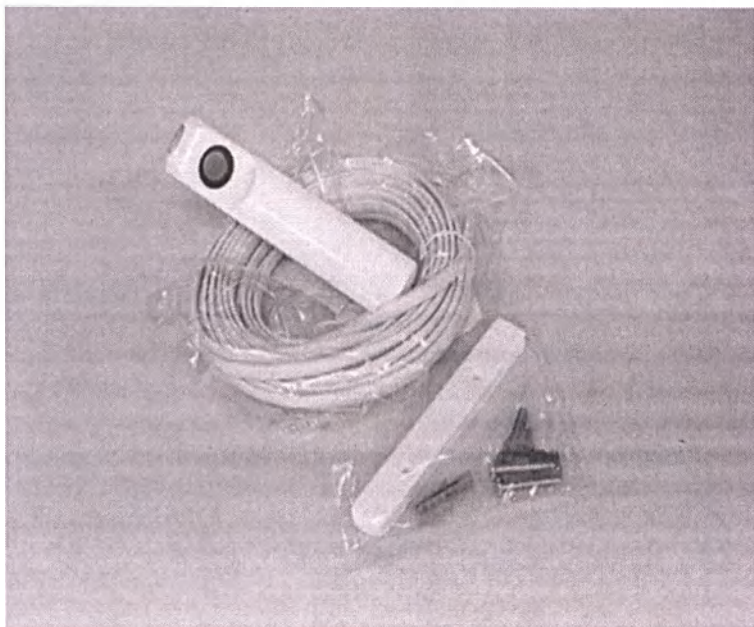

9. Кабель – 3 шт.




10. Сетевой кабель – 1 шт.

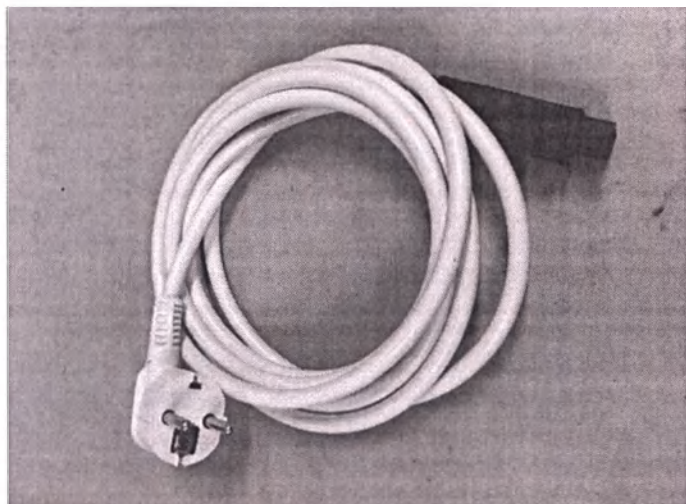


11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:


1. Платформа многофункциональная для увеличения 1.6х для 24 x 30 см – не более 3 шт.

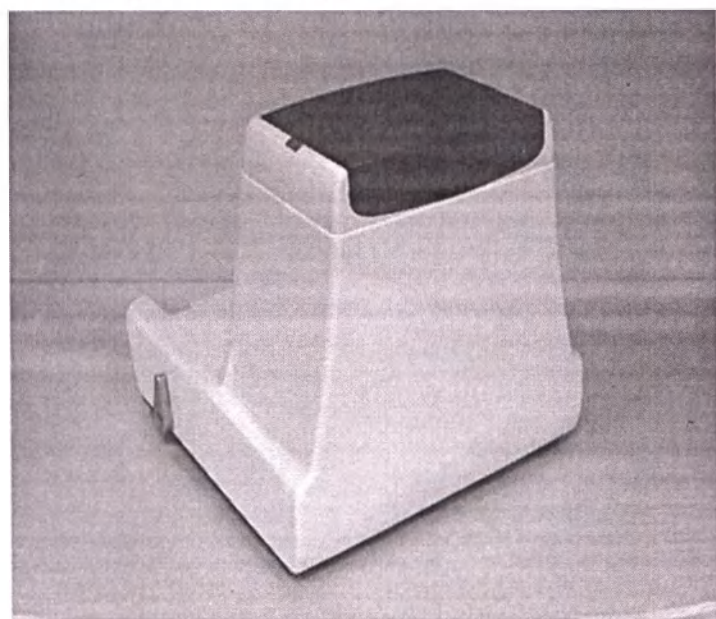


2. Платформа многофункциональная для увеличения 1.8х для 24 x 30 см – не более 3 шт.

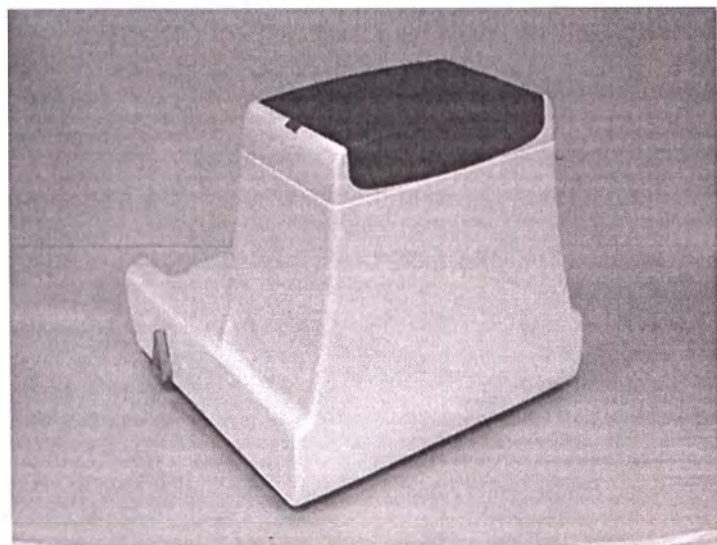


3. Лопатка компрессионная 19 x 23 см – не более 3 шт.

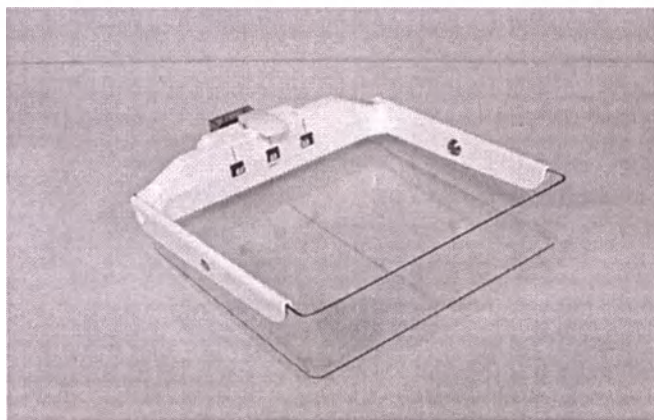


4. Лопатка компрессионная 24 x 30 см – не более 3 шт.

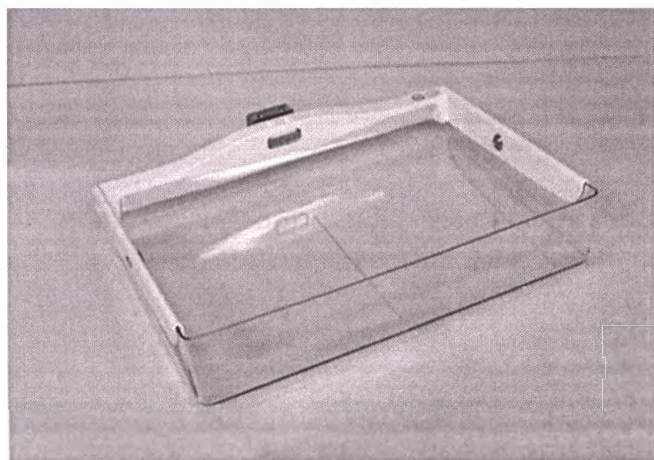

5. Лопатка компрессионная короткая глубокая с высоким бортом – не более 3 шт.

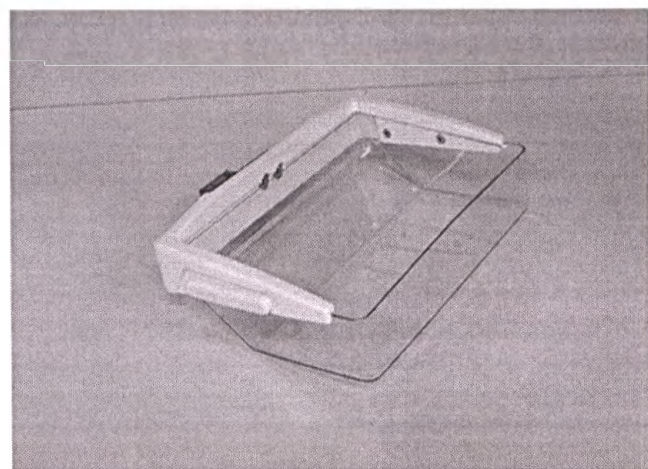

6. Лопатка перфорированная 19 x 23 см для биопсии – не более 3 шт.

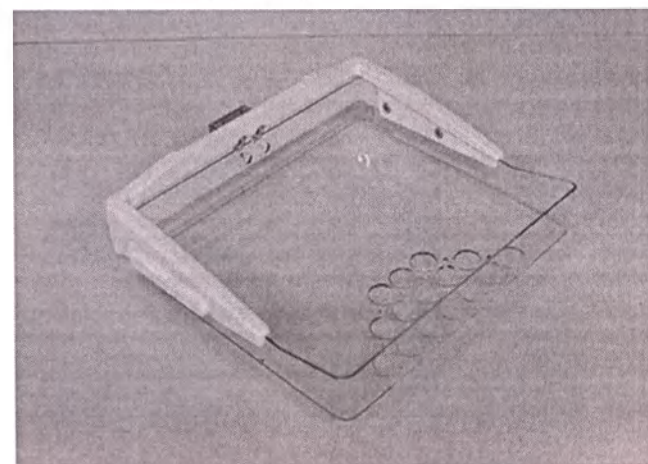


7. Платформа прямоугольная для биопсии – не более 3 шт.




8. Платформа для томосинтеза – не более 3 шт.




9. Лопатка безрамочная для увеличения 10 x 10 см – не более 3 шт.

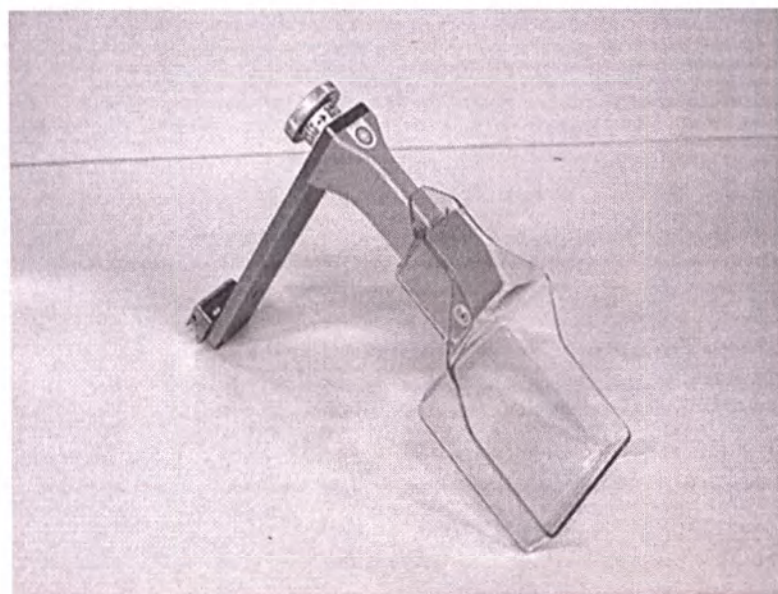

10. Лопатка точечная для увеличения 9 x 6 см – не более 3 шт.

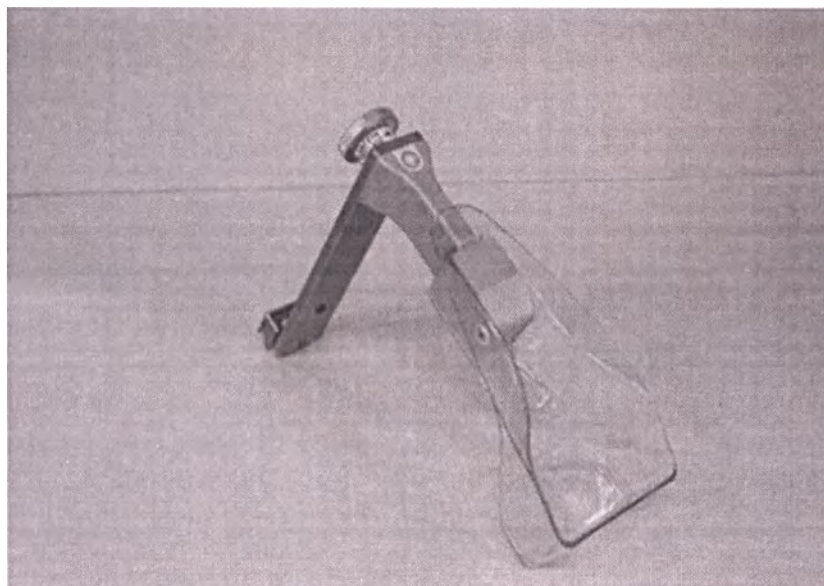


11. Лопатка контактная безрамочная 10 x 10 см – не более 3 шт.

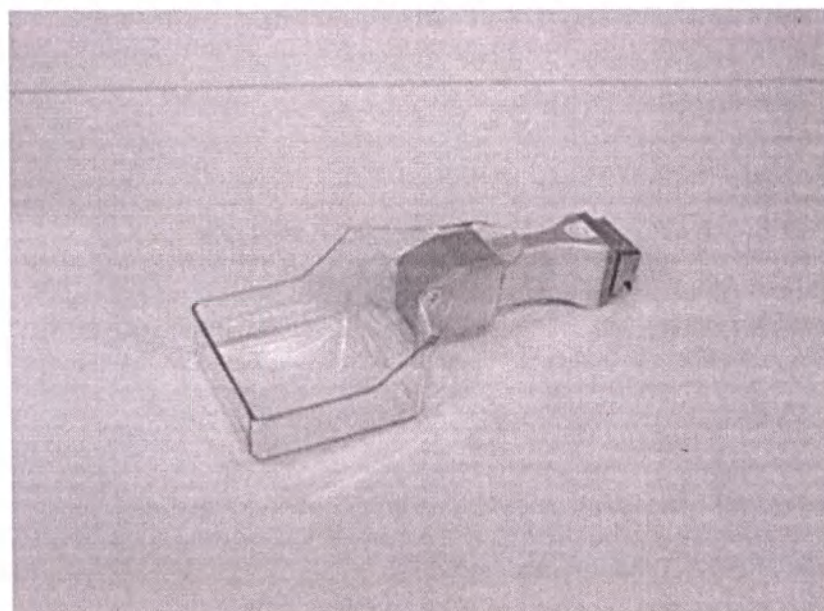


12. Лопатка точечная контактная 9 x 6 см – не более 3 шт.




13. Лопатка компрессионная 24 x 33 для томосинтеза – не более 3 шт.

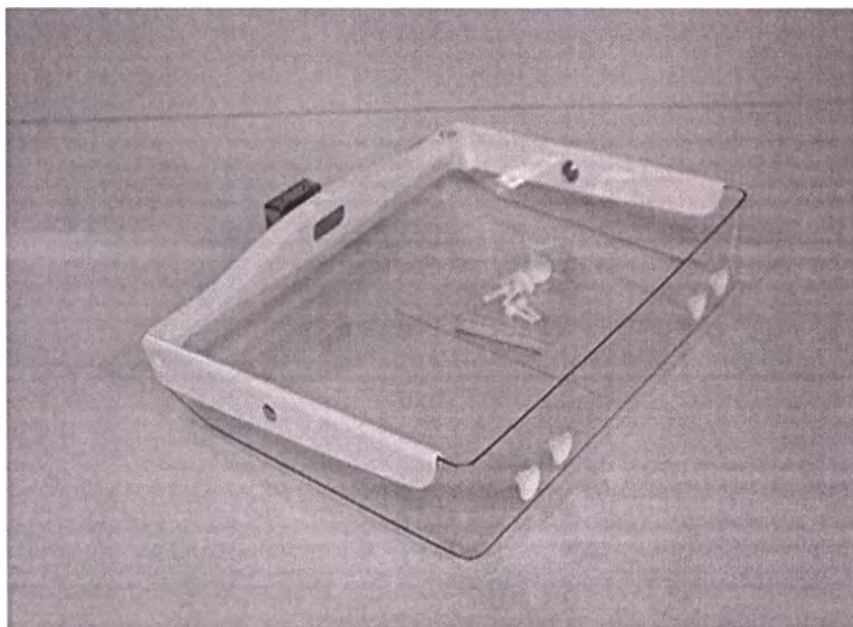


14. Верхний модуль системы позиционирования MaxView – не более 3 шт.

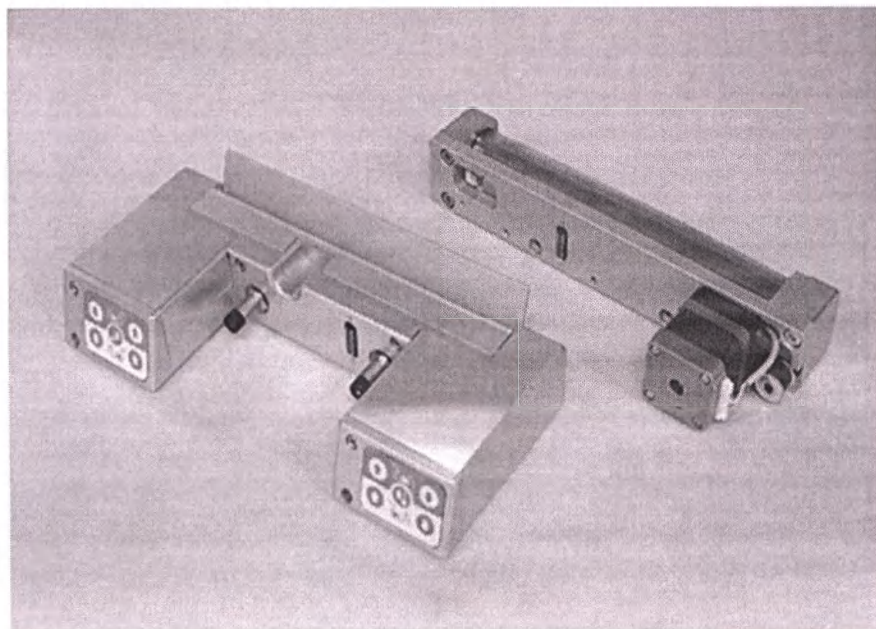


15. Нижний модуль системы позиционирования MaxView – не более 3 шт.

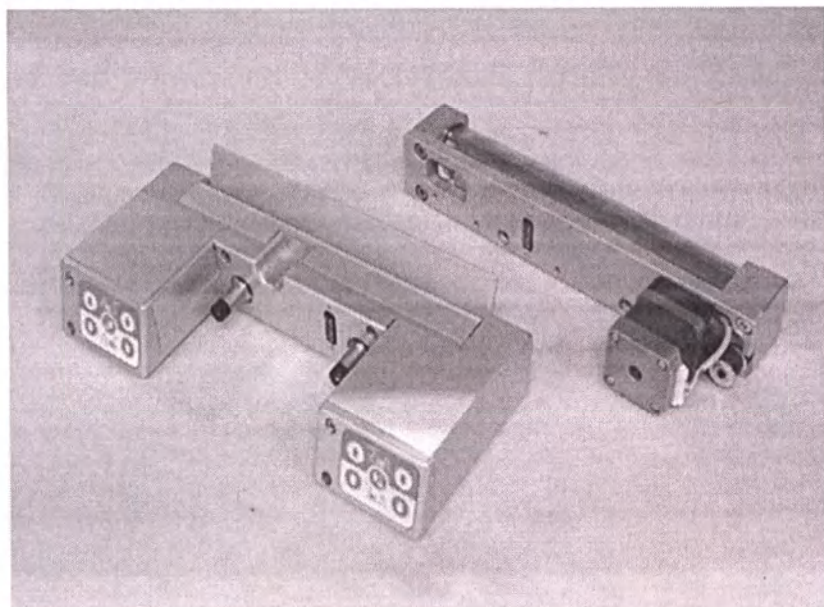

16. Пленка Max View, 24 x 30 см, верхняя и нижняя – не более 10 000 шт.

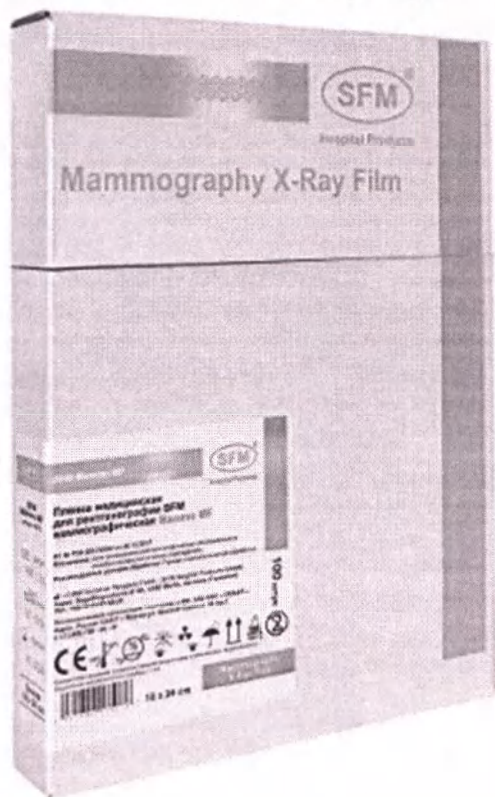


17. Свободное напольное основание – не более 3 шт.

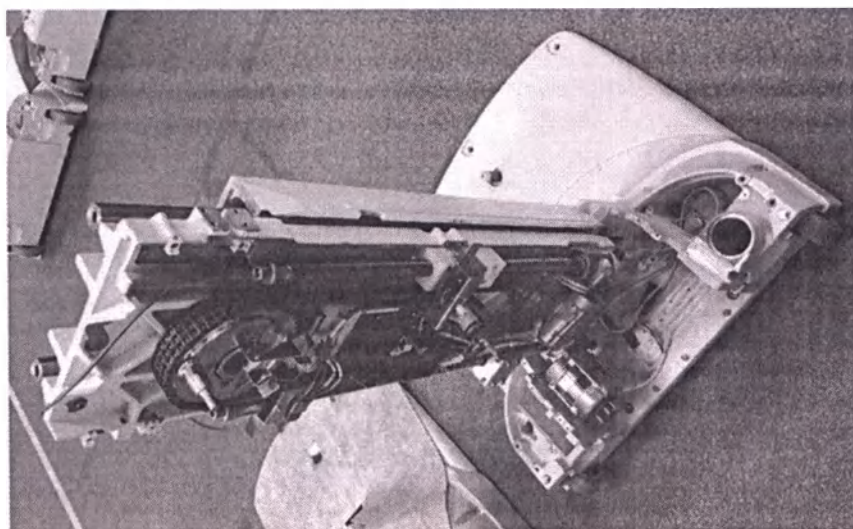


18. Рабочая станция получения изображений – не более 3 шт.




19. Дисплей рабочей станции получения изображений - не более 3 шт.

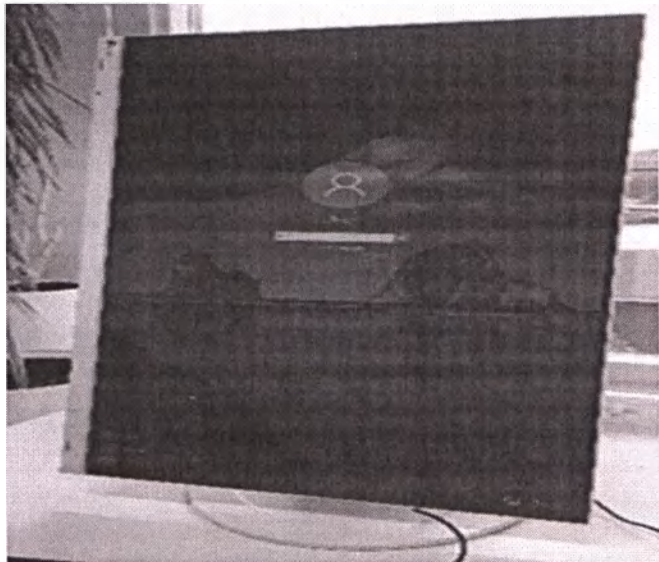


20. Стол для рабочего места получения изображения - не более 3 шт.

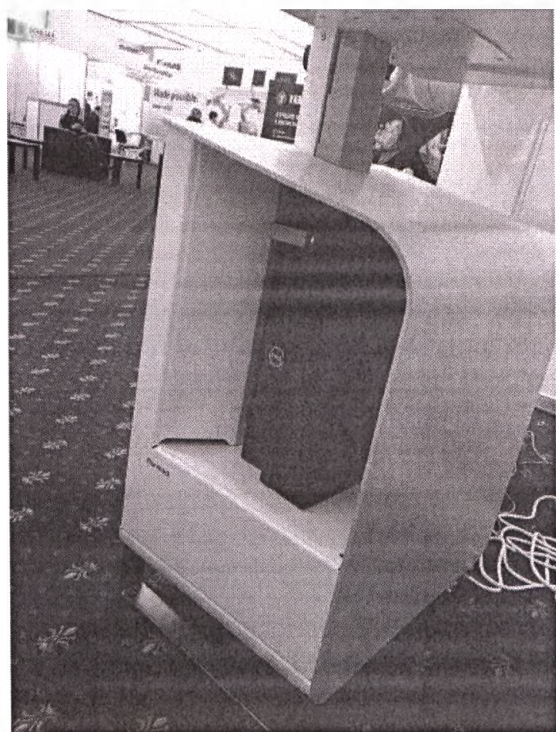


21. Трансформатор для рабочего места получения изображения - не более 3 шт.

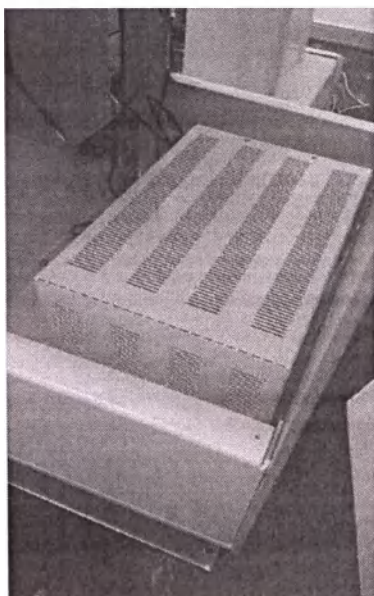


22. Рабочая станция просмотра изображения - не более 3 шт.

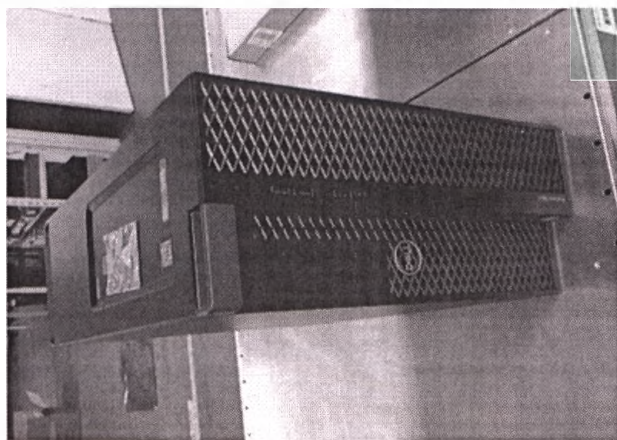


23. Мониторы специальные для рабочей станции просмотра изображения - не более 2 шт.

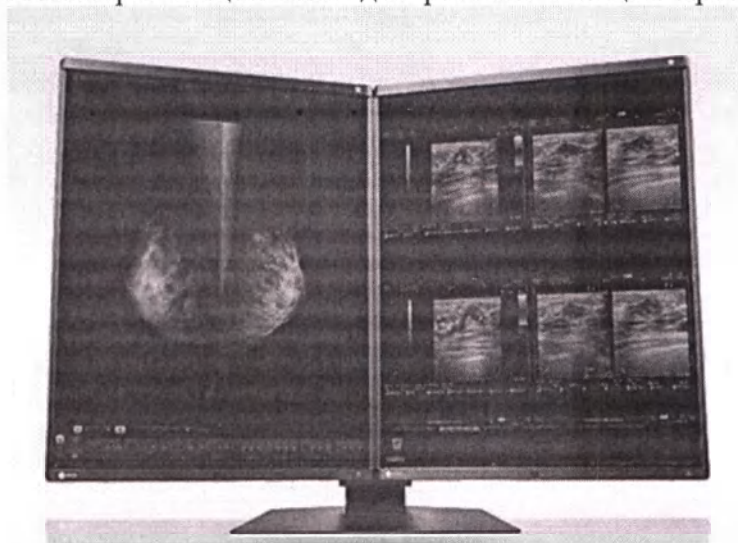


24. Монитор ЖК специальный - не более 2 шт.

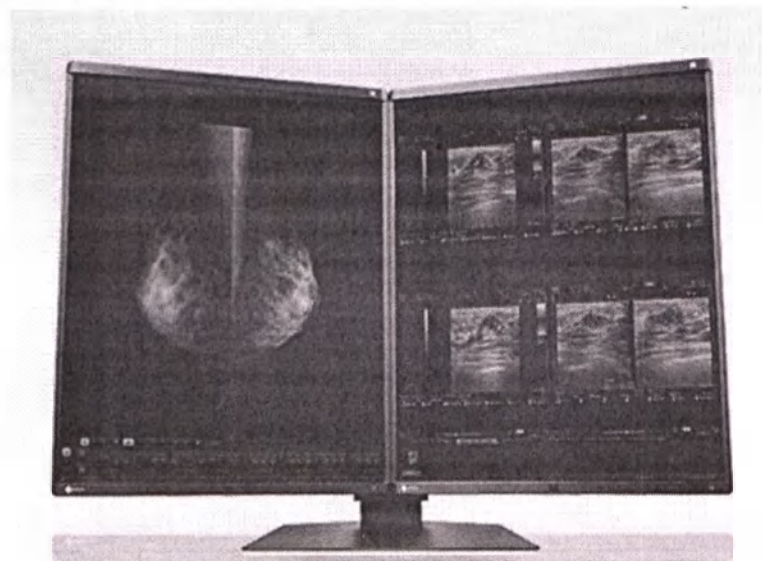



25. Защитная ширма (0,3 mm Pb) - не более 3 шт.

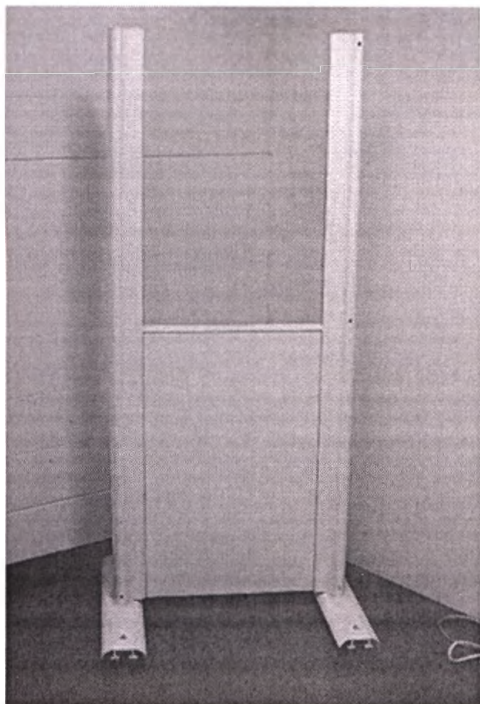


26. Защитная ширма (0,5 mm Pb) - не более 3 шт.

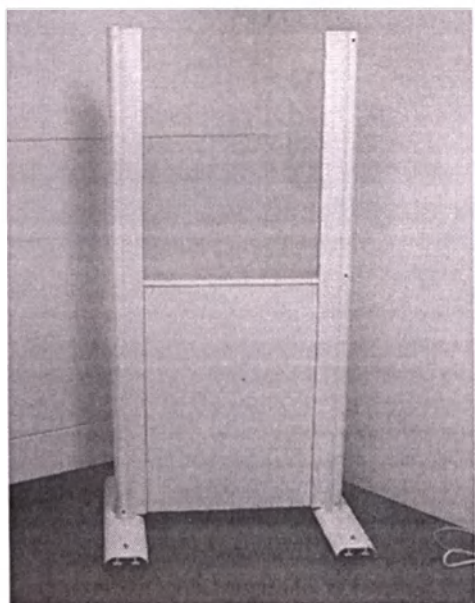


27. Фантом тестовый - не более 3 шт.

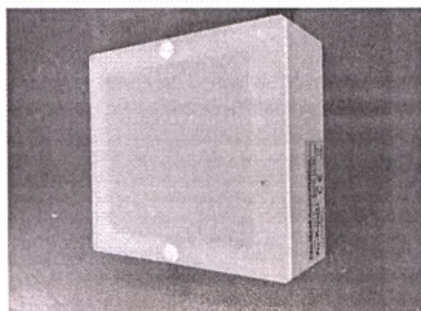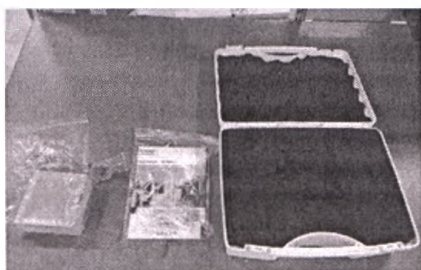


28. Фантом определения разрешения - не более 3 шт.

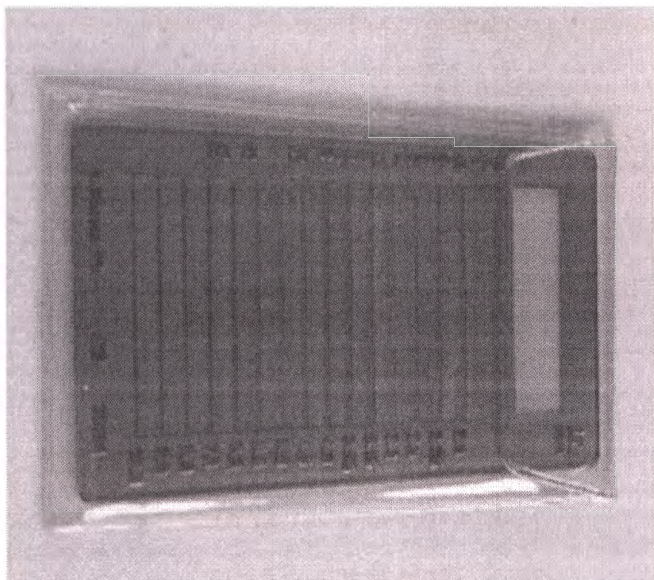


29. Алюминиевый тестовый фантом - не более 3 шт.

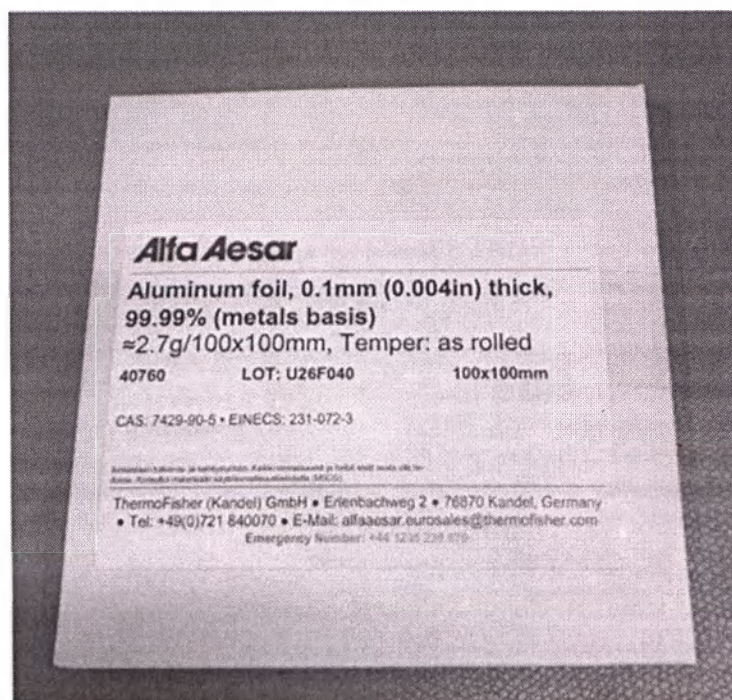


30. Кнопка включения экспозиции с кабелем - не более 3 шт.

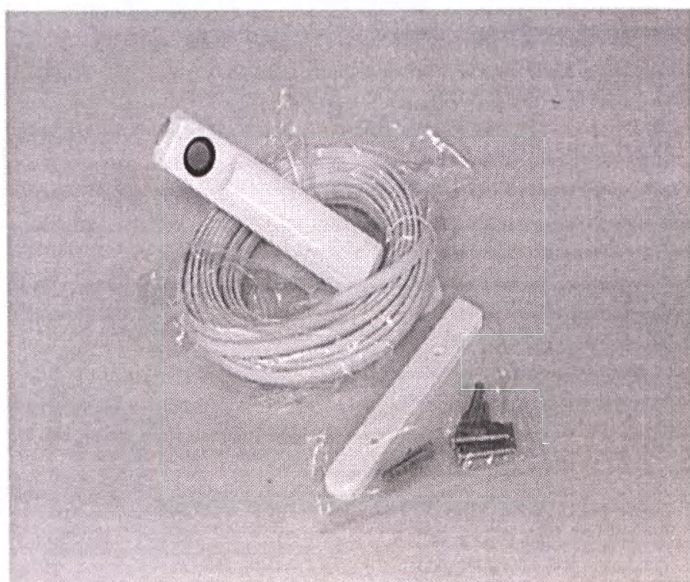


31. Компрессионный механизм - не более 3 шт.

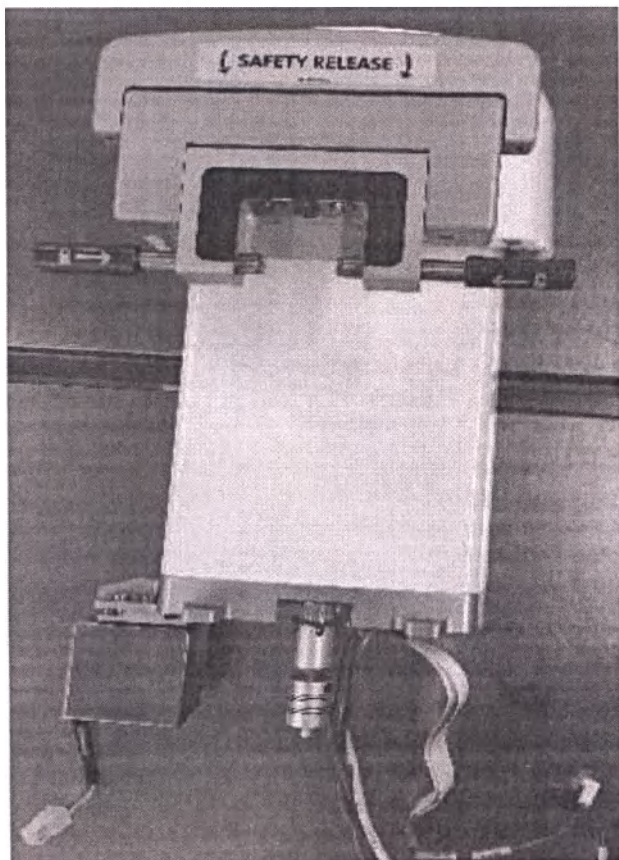

32. Дисплей основания - не более 3 шт.

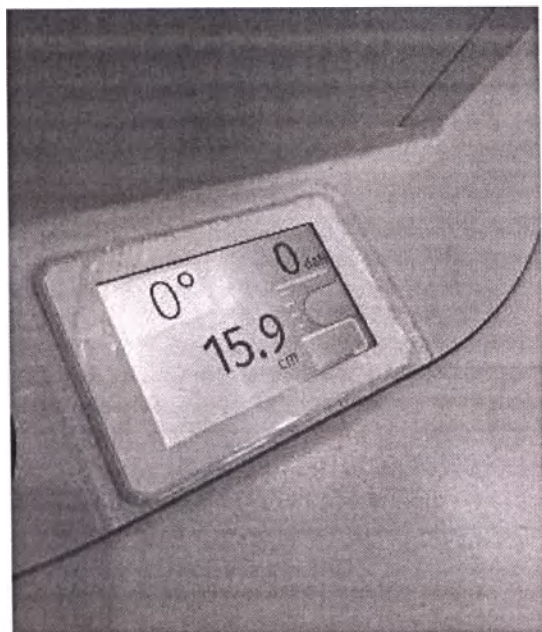


33. Компрессионный адаптер- не более 3 шт.

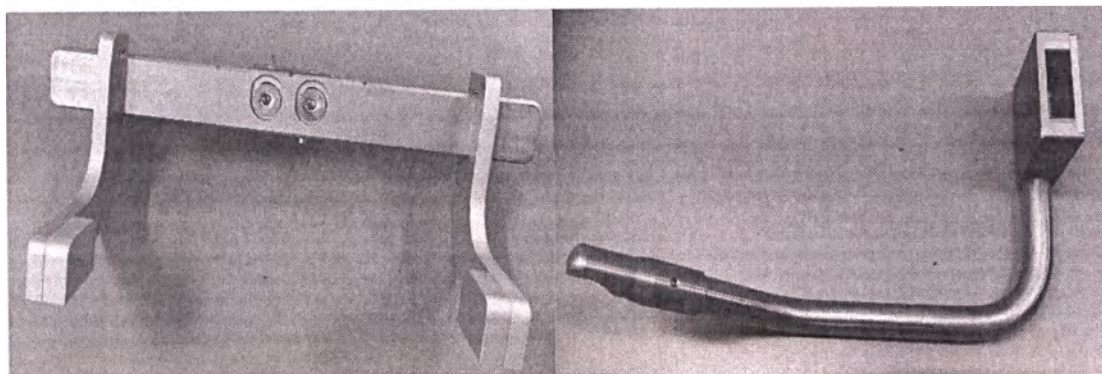


34. Блок педалей управления – не более 4 шт.



35. Предохранитель – не более 10 шт.

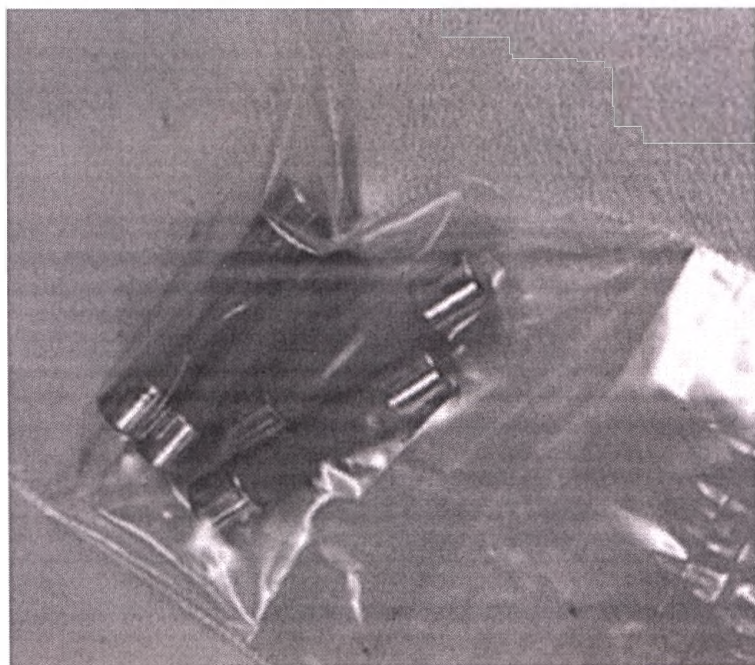

36. Щиток для защиты подбородка - не более 3 шт.

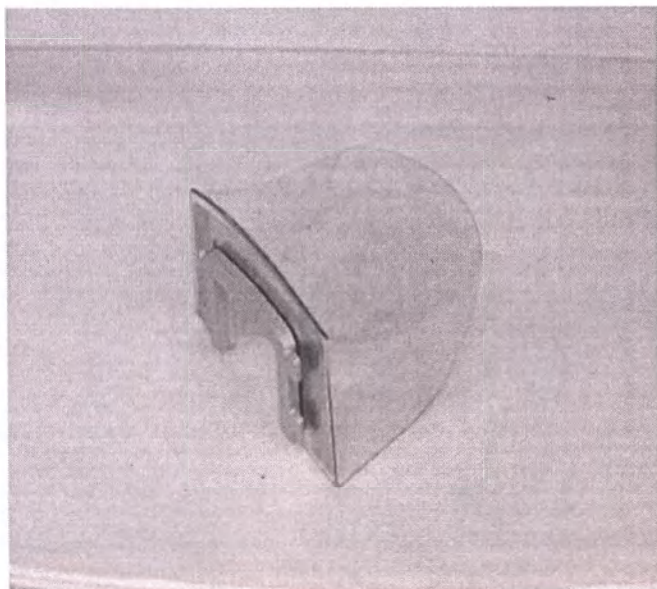


37. Тележка для хранения принадлежностей - не более 2 шт.




38. Стул для биопсии, моторизованный- не более 2 шт.




39. Фантом для стереотаксической биопсии - не более 3 шт.

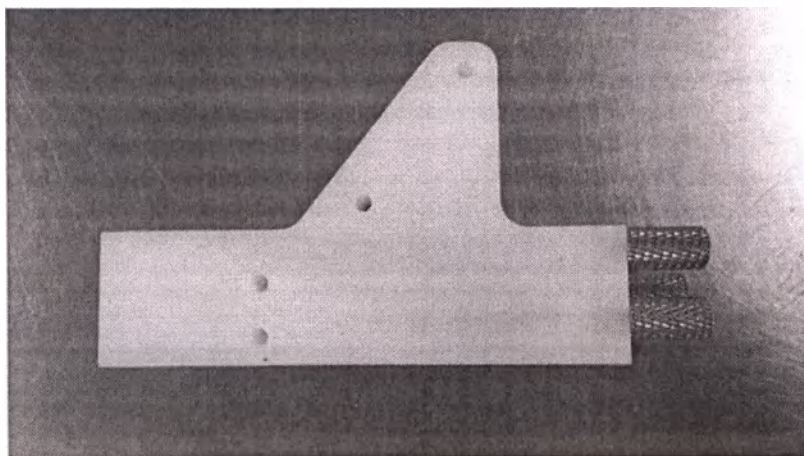


40. Цифровой стереотаксис - не более 3 шт.

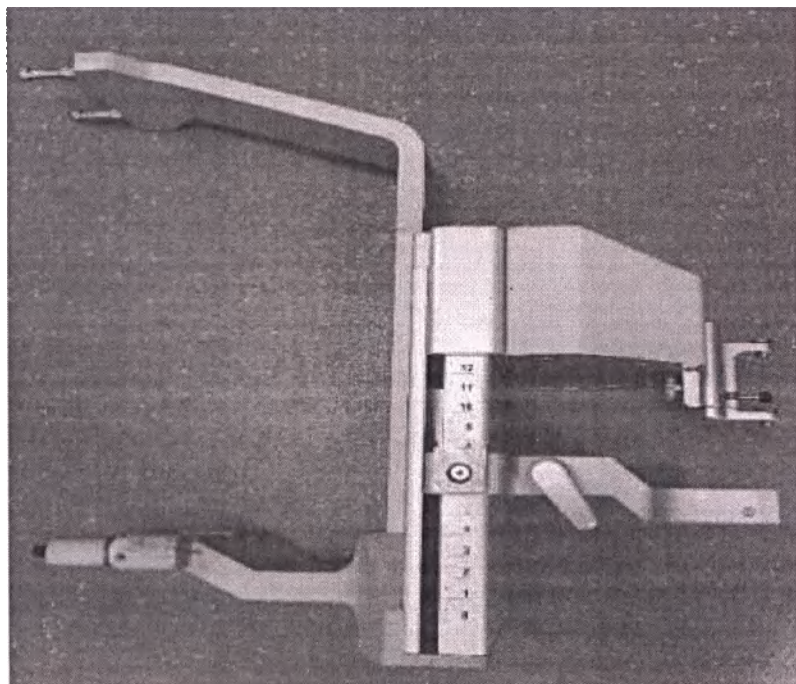


41. Горизонтальный адаптер бокового плеча - не более 3 шт.

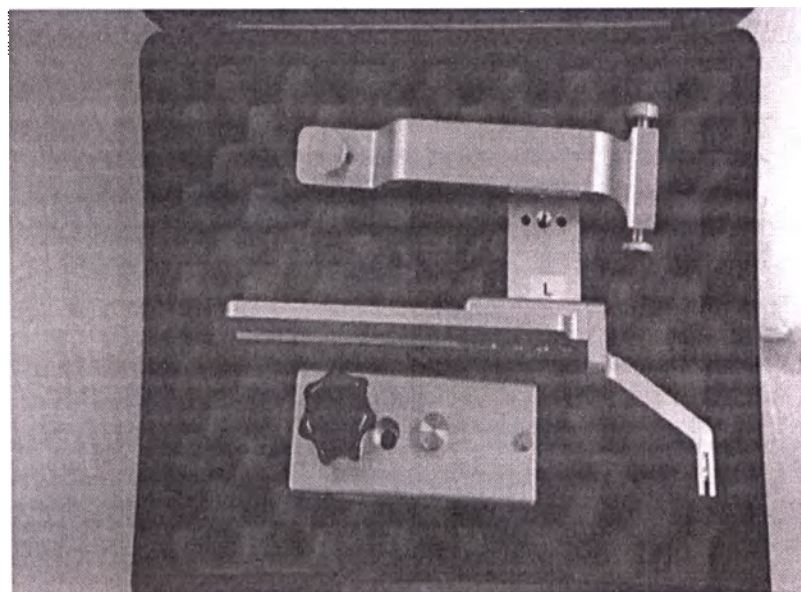


42. Боковое плечо многоразового основания системы биопсии - не более 3 шт.

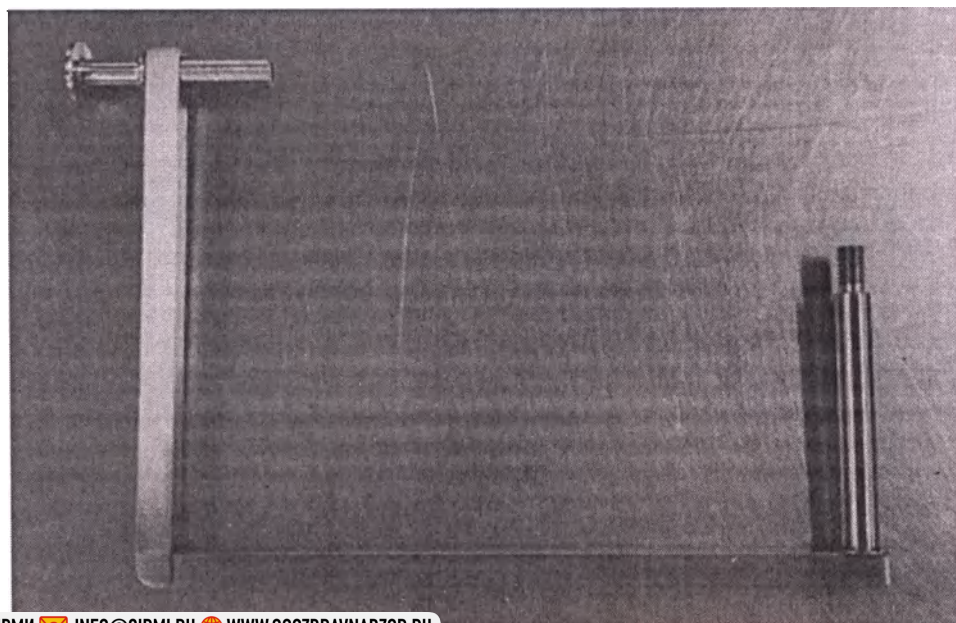

43. Держатель нижней иглы для бокового плеча основания системы биопсии - не более 3 шт.

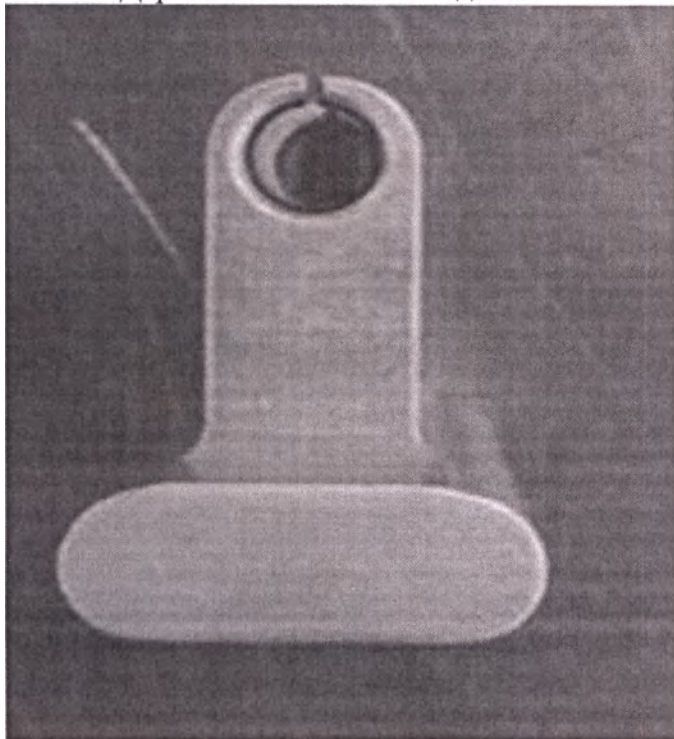


44. Лопатка компрессионная для бокового плеча - не более 3 шт.

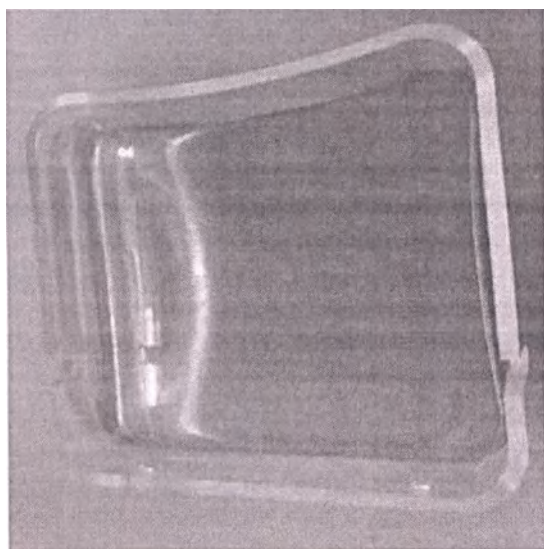

45. Блок Discot для передачи и визуализации медицинских изображений и документов.




46. Программное обеспечение для томосинтеза.

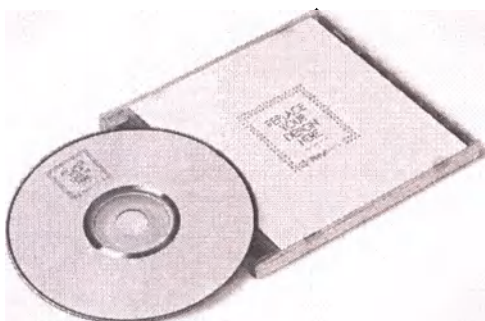


47. Программное обеспечение для синтетического 2D.



Маркировка

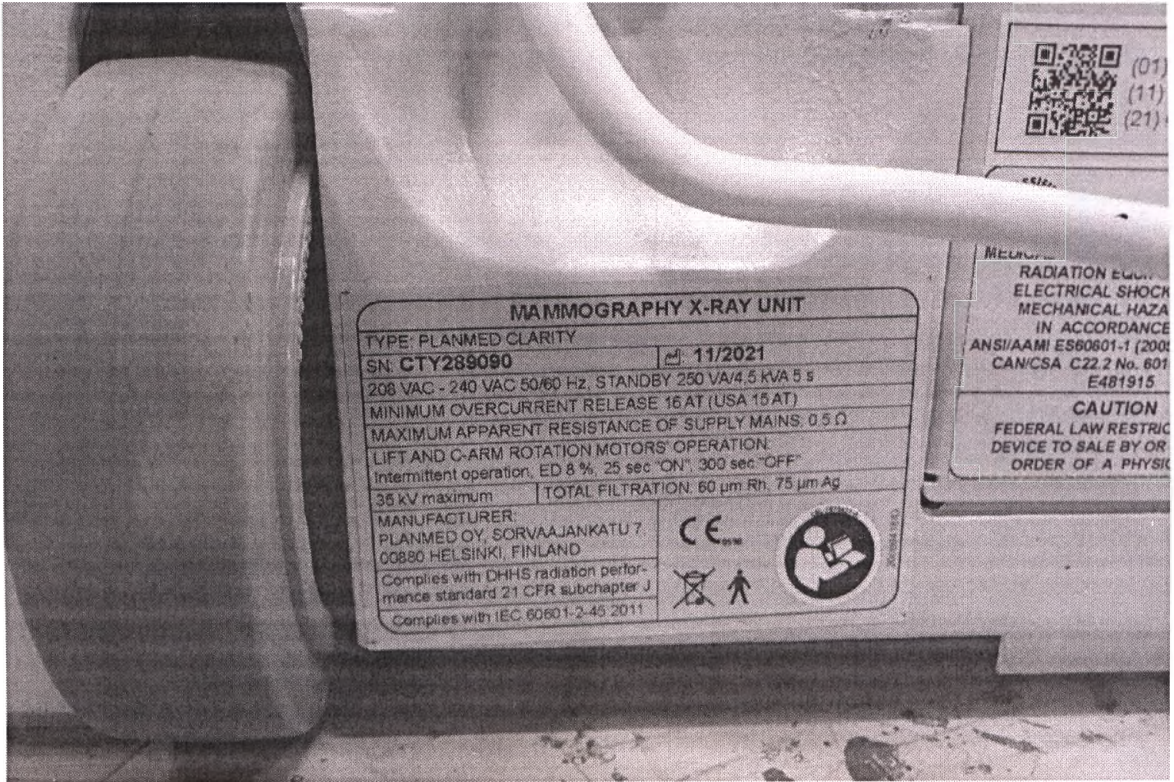

Упаковка (транспортная)

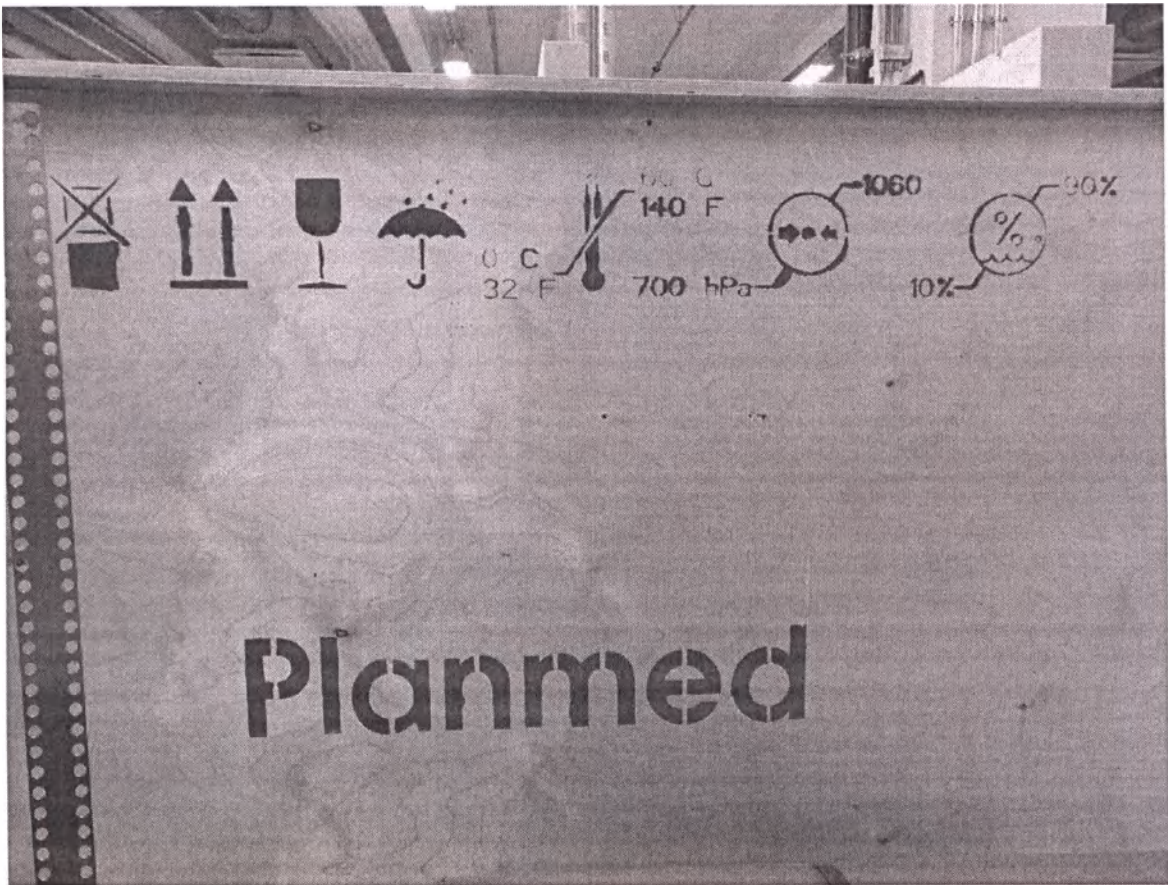

Генеральный директор
ООО «СаФайр-Мед»


Мирный Б.И.



« 11 » апреля 2023 года

3 л. лист