

Фотографические изображения

**«Раствор для предварительной промывки для модулей
иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутыль,
объем 2,0 л, – 2 шт.»**

Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутыль, объем 2,0 л, – 2 шт. (лицевая сторона картонной коробки)

PreClean II M

cobas e analyzers

CONTENT

2 x 2 L

REF 06908953190

For USA:

CONTENT Rx only

COBAS and COBAS E
are trademarks of Roche.

Sodium chloride 20 mmol/L; detergent ≤ 0.1 %

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE**

15-25 °C 

 dialog.roche.com

05

06908953190



cobas[®]

Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутылка, объем 2,0 л, – 2 шт.
(лицевая сторона картонной коробки)

PreClean II M

cobas e analyzers

CONTENT

2 x 2 L

REF 06908853190

For USA:

CONTENT Rx only

COBAS and COBAS E
are trademarks of Roche.

Sodium chloride 20 mmol/L; detergent $\leq 0.1 \%$

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE**

 15-25 °C 

 dialog.roche.com

0644508001(1)

05



cobas[®]

Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутыль, объем 2,0 л, – 2 т. (боковая сторона картонной коробки)

PreClean II M

cobas e analyzers

REF (240)06908853190

UDI



LOT (10)70742601



2024-11-30



2023-01-25


GTIN (01)07613336102220

05



Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутыль, объем 2,0 л – 2 шт.
Регистрационное удостоверение № P3H 2022/17129 от 13.05.2022г.
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» (Роиш Диагностика ГмбХ), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Издание предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Роиш Диагностика Рус» (ООО «Роиш Диагностика Рус»), 107031 Москва, Трубная площадь, д.21 тел. +7 495 229-09-99, факс +7 495 229-62-64 E-mail: russia@roche.com, reception_dia@roche.com
Кат. номер 06908853190


Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутылка, объем 2,0 л, – 2 т. (общий вид)

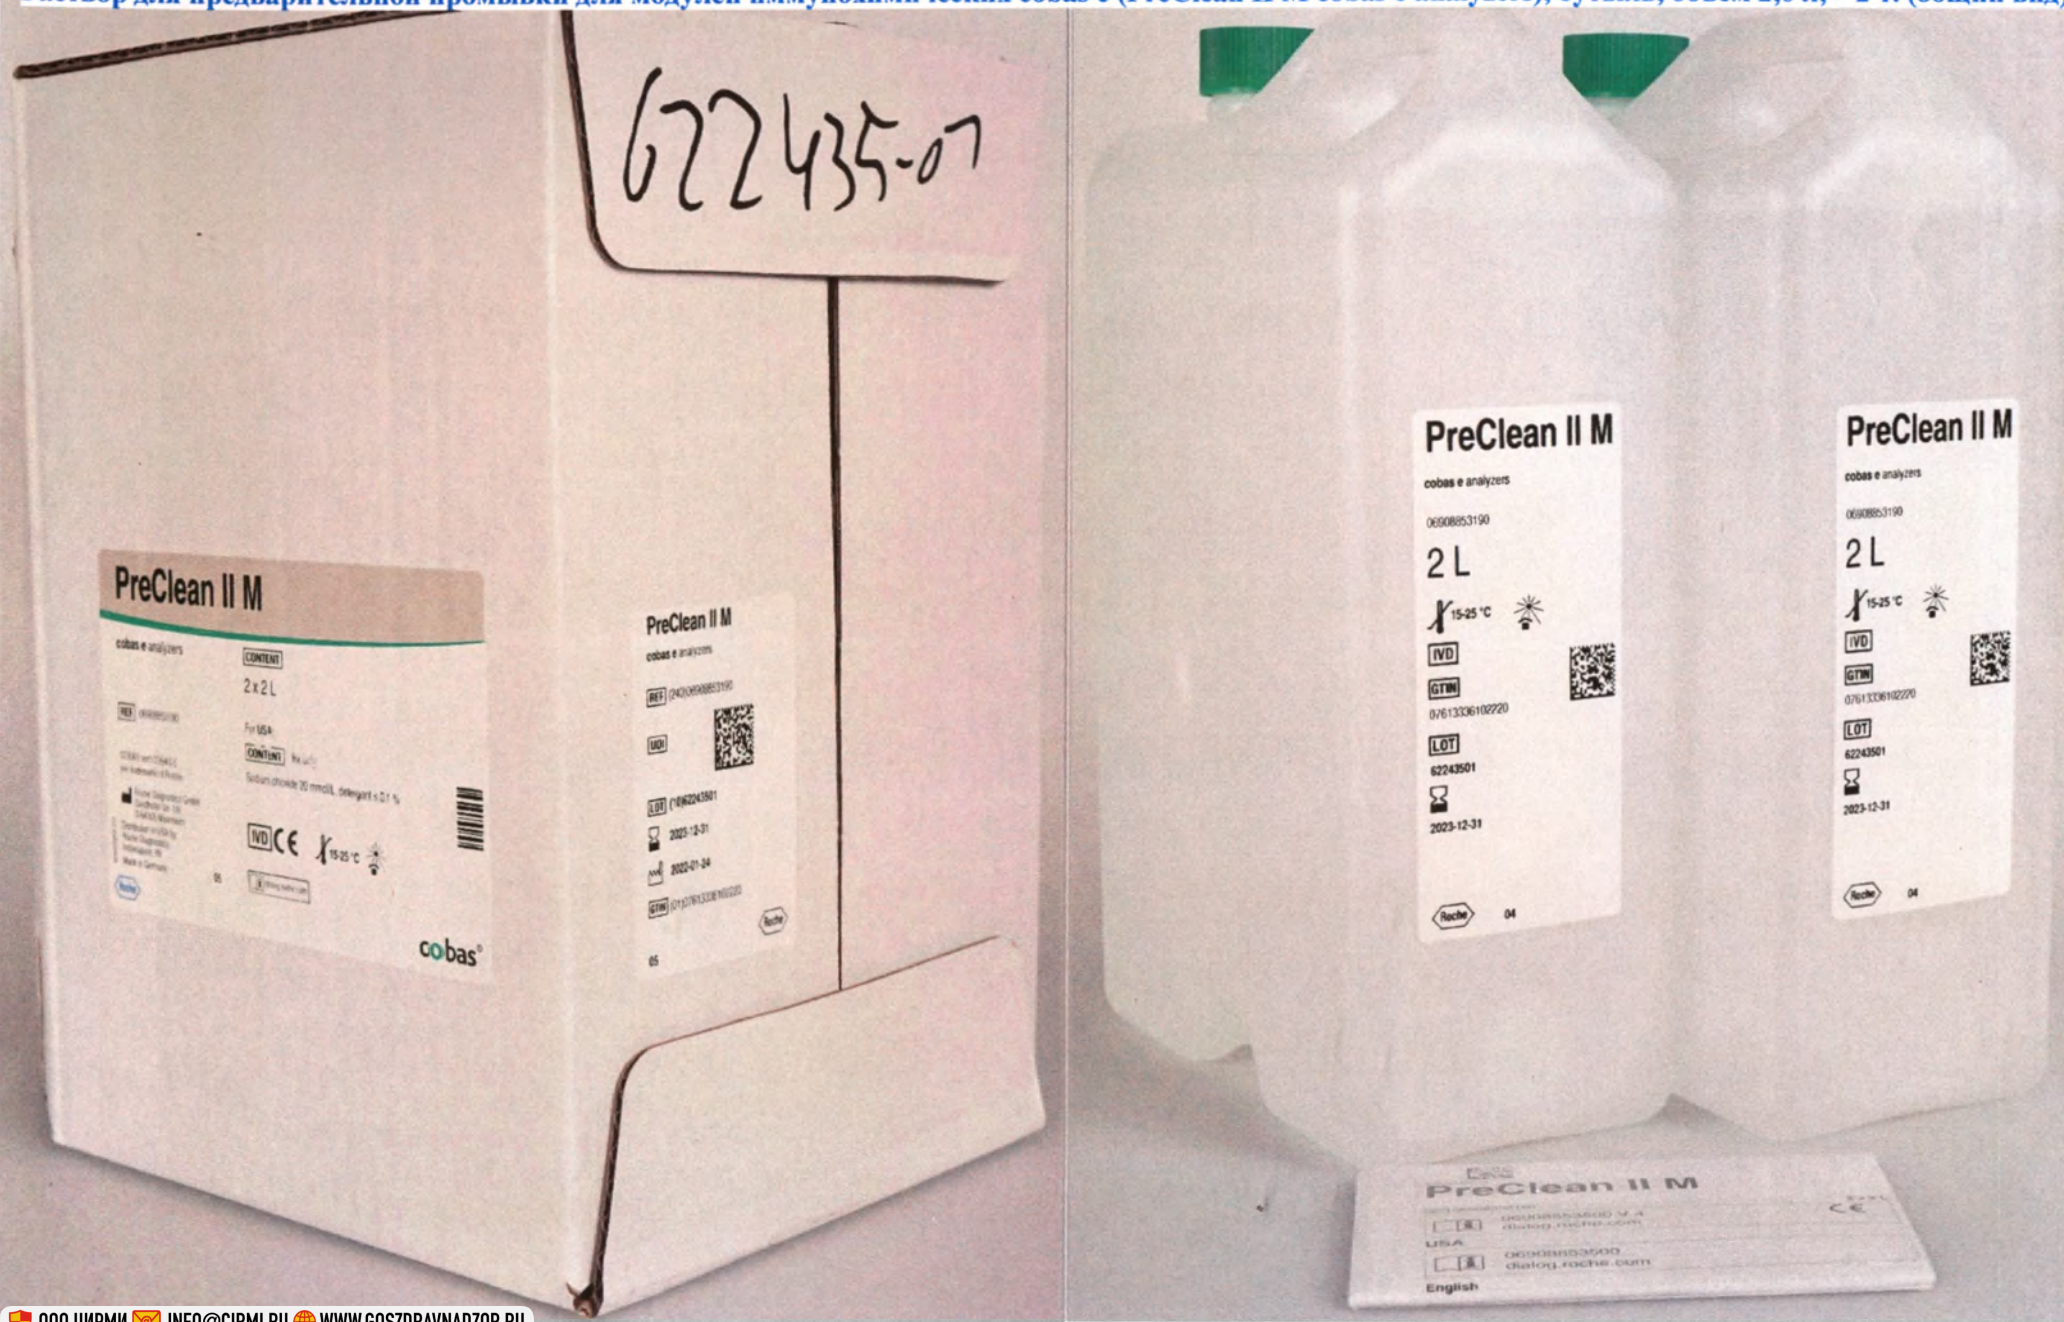

Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутыль, объем 2,0 л, – 2 т. (маркировка на русском языке)

Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутыль, объем 2,0 л, – 2 шт.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17129 от 13.05.2022г.
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com
Кат. номер 06908853190

Раствор для предварительной промывки для модулей иммунохимических cobas e (PreClean II M cobas e analyzers), бутылъ, обьём 2,0 л, – 2 шт. (маркировка бутылки)

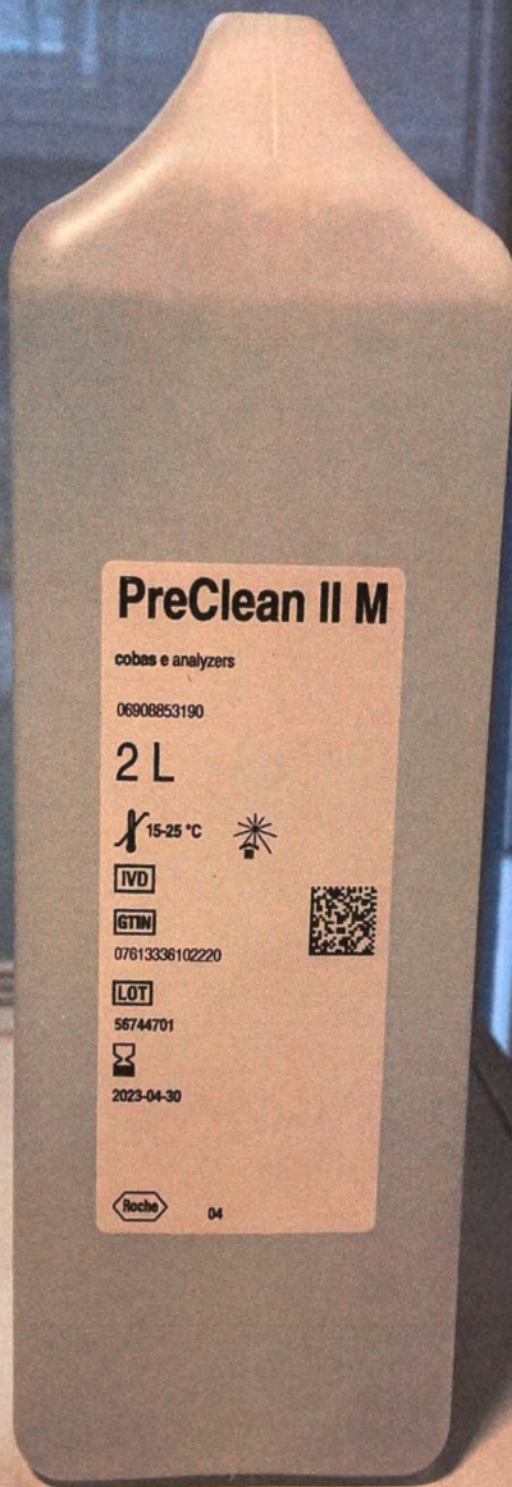

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
7 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.

Евсеев И.Т.