



Руководитель группы

ООО «Сименс Здоровоохранение»


И.И. Левитский

«11» сентября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Маммографический аппарат МАММОМАТ Inspiration с принадлежностями»

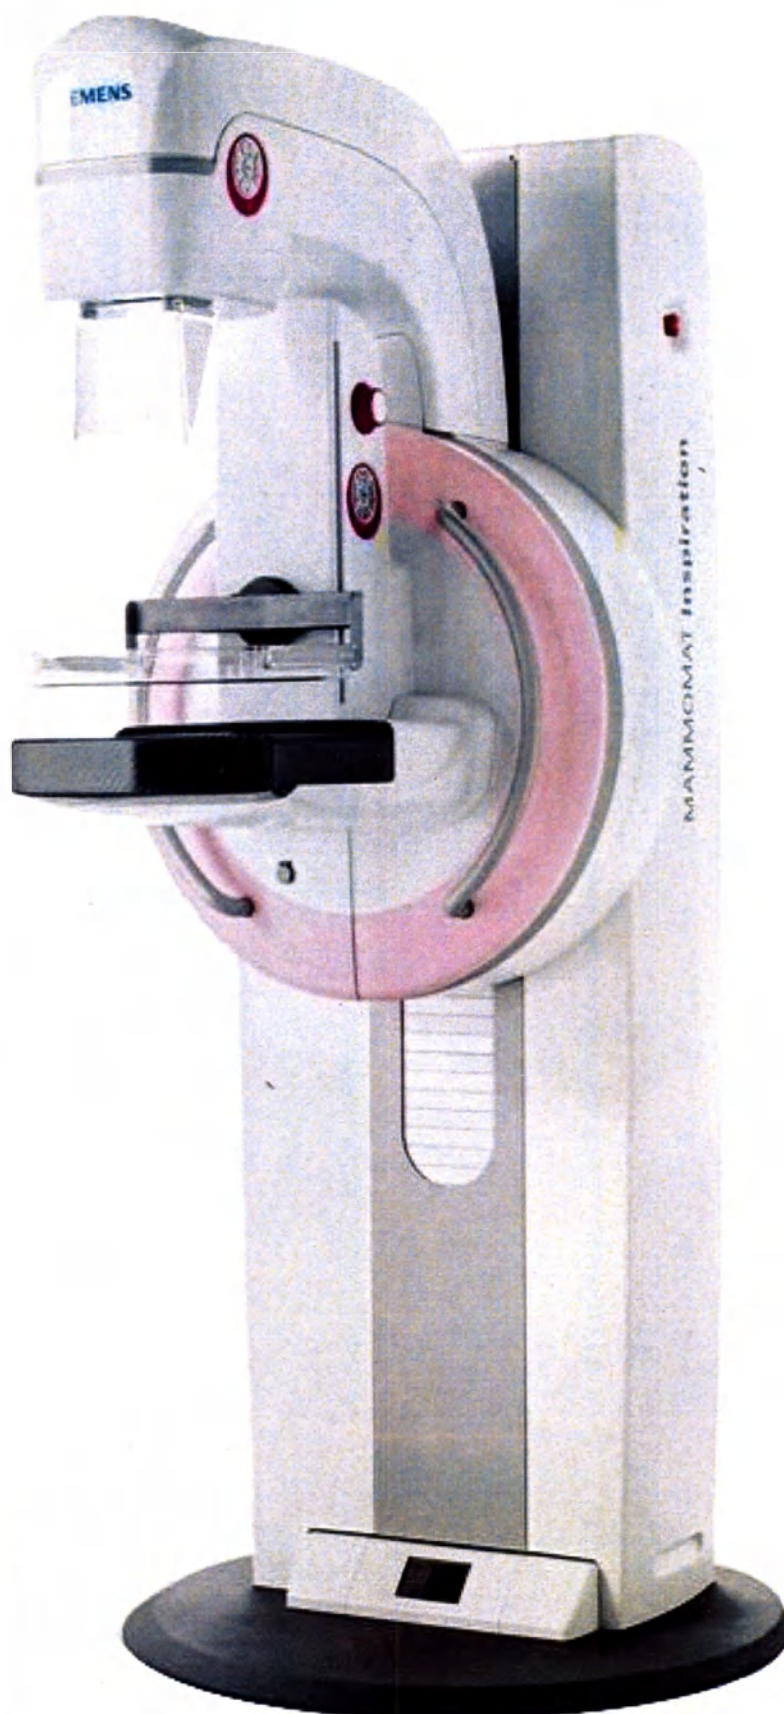

1. Стойка с вращающимся маммографическим штативом, цифровым детектором, рентгеновской трубкой, кожухом, генератором и панелями управления.



Стойка: панель управления




2. Рабочая станция рентгенолаборанта, варианты исполнения:

- Рабочая станция рентгенолаборанта стандартная в составе: блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, мышь специальная, стол оператора специальный, комплект соединительных кабелей, базовое программное обеспечение.



2. Рабочая станция рентгенолаборанта, варианты исполнения:


- Рабочая станция рентгенолаборанта с возможностью работы в режиме томосинтеза в составе: блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, мышь специальная, стол оператора специальный, комплект соединительных кабелей, базовое программное обеспечение.

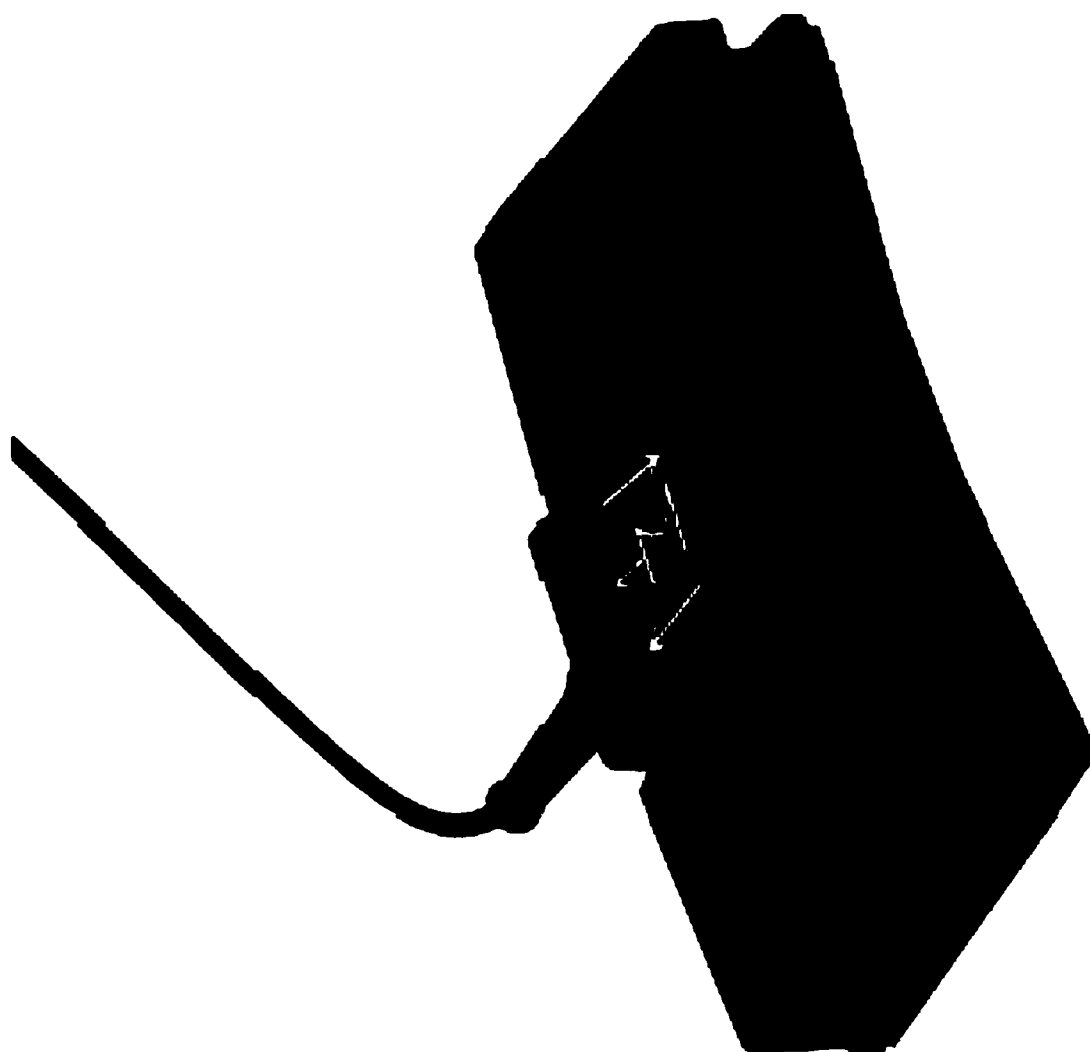

3. Педали управления, 2 шт.



4. Пластина компрессионная стандартная 24x30 см, высота края 7 см (при необходимости).

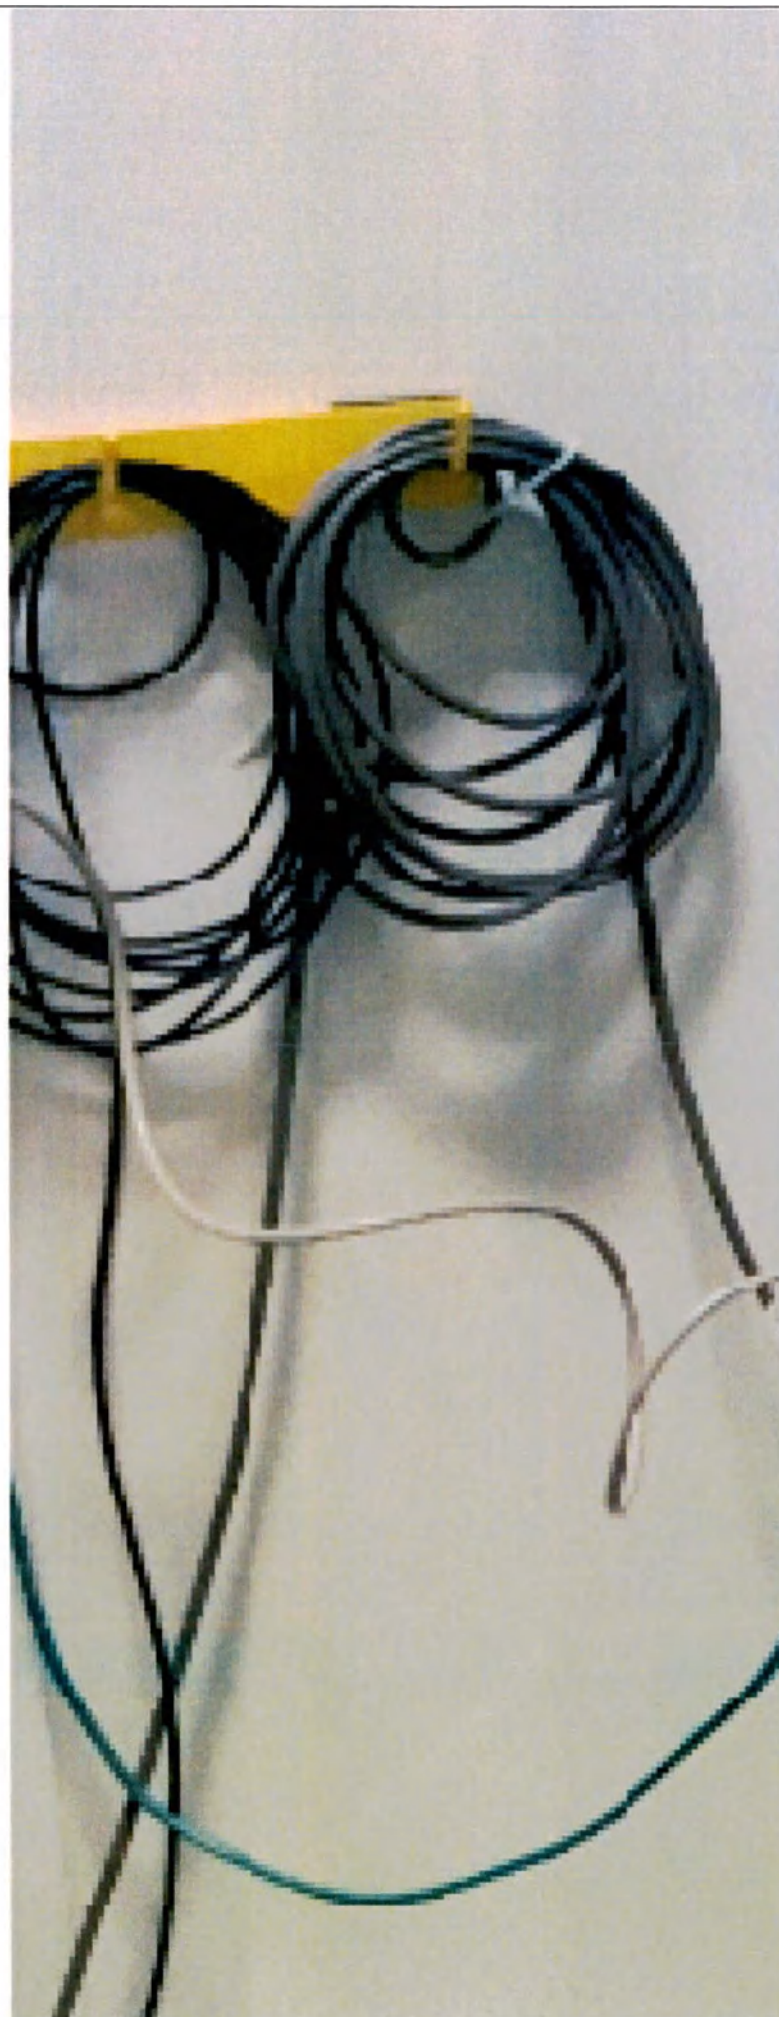

5. Комплект кабелей соединительных.

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare


MAMMOMAT Inspiration

Руководство пользователя

VB61 или выше

6. Документация пользователя на русском языке.


Принадлежности:

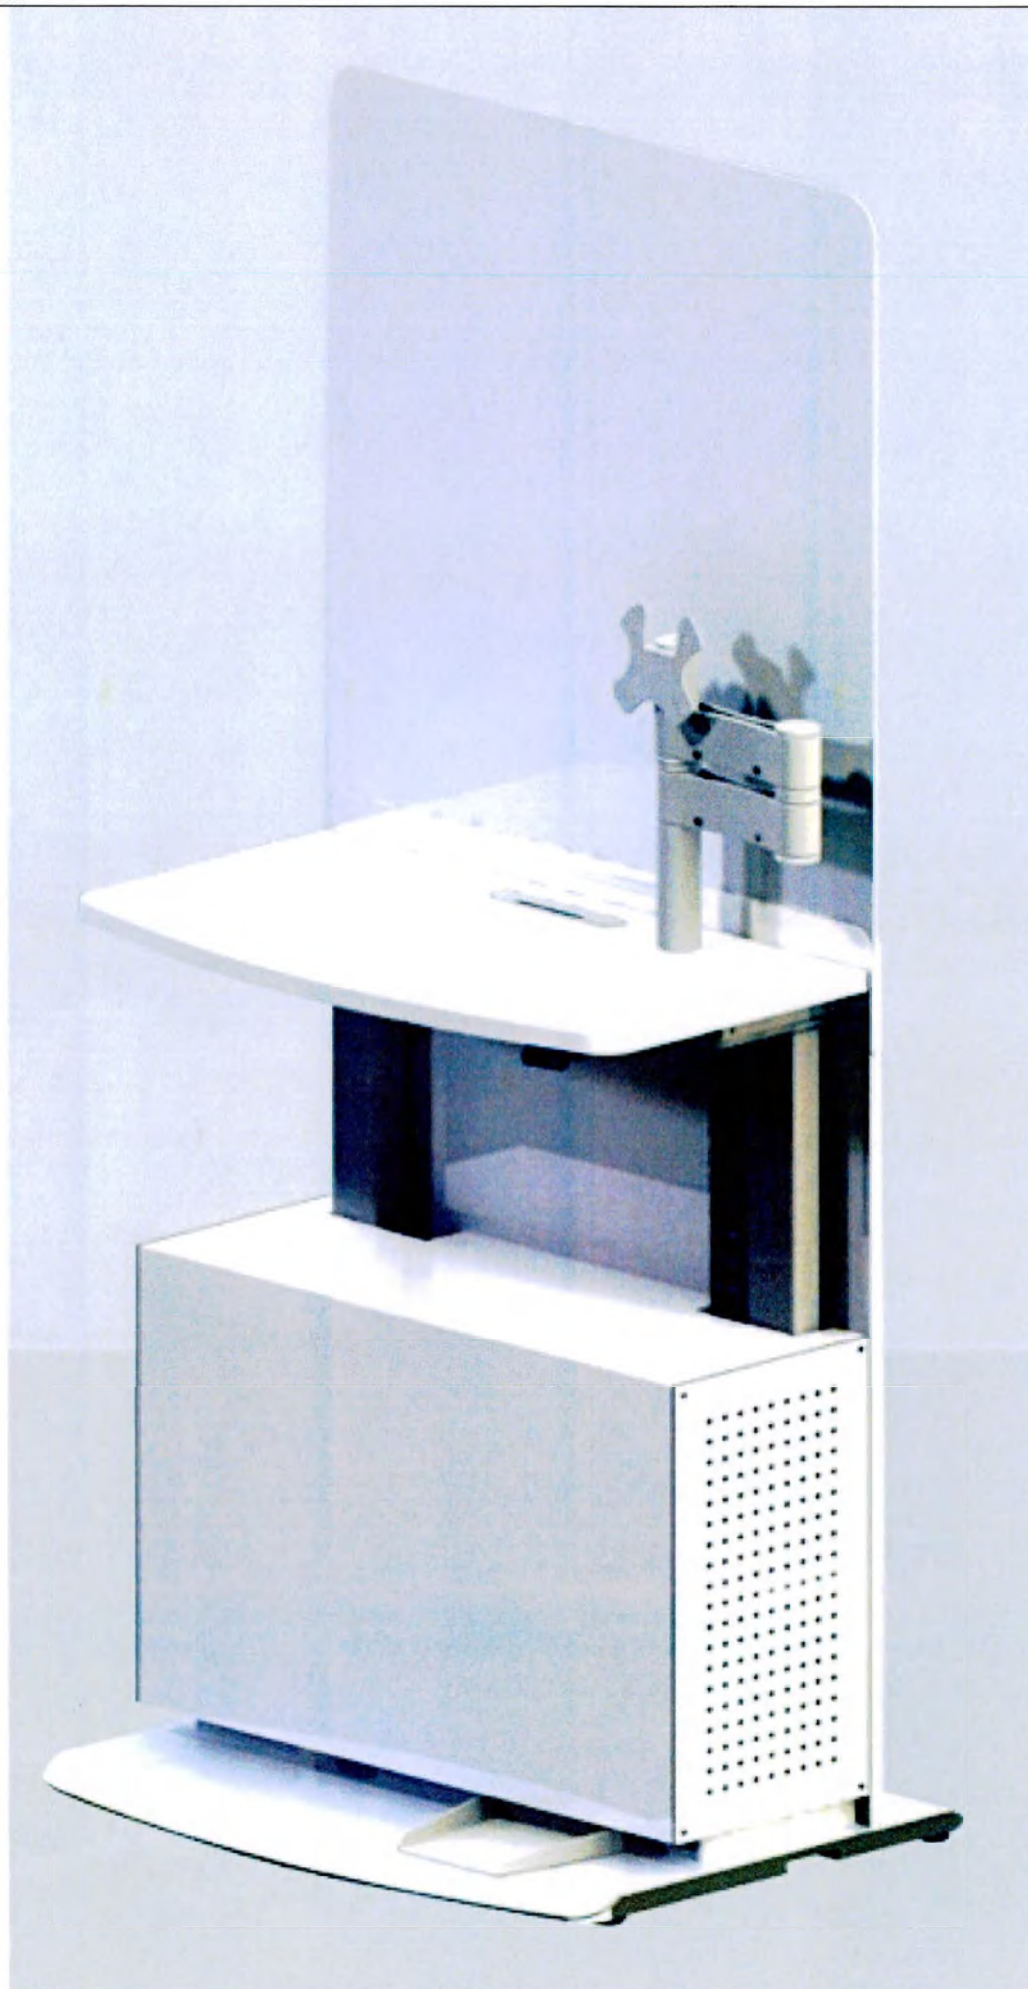


1. Стол оператора с экраном для защиты от рентгеновского излучения.



2. Лоток для клавиатуры для консоли оператора, не более 5 шт.

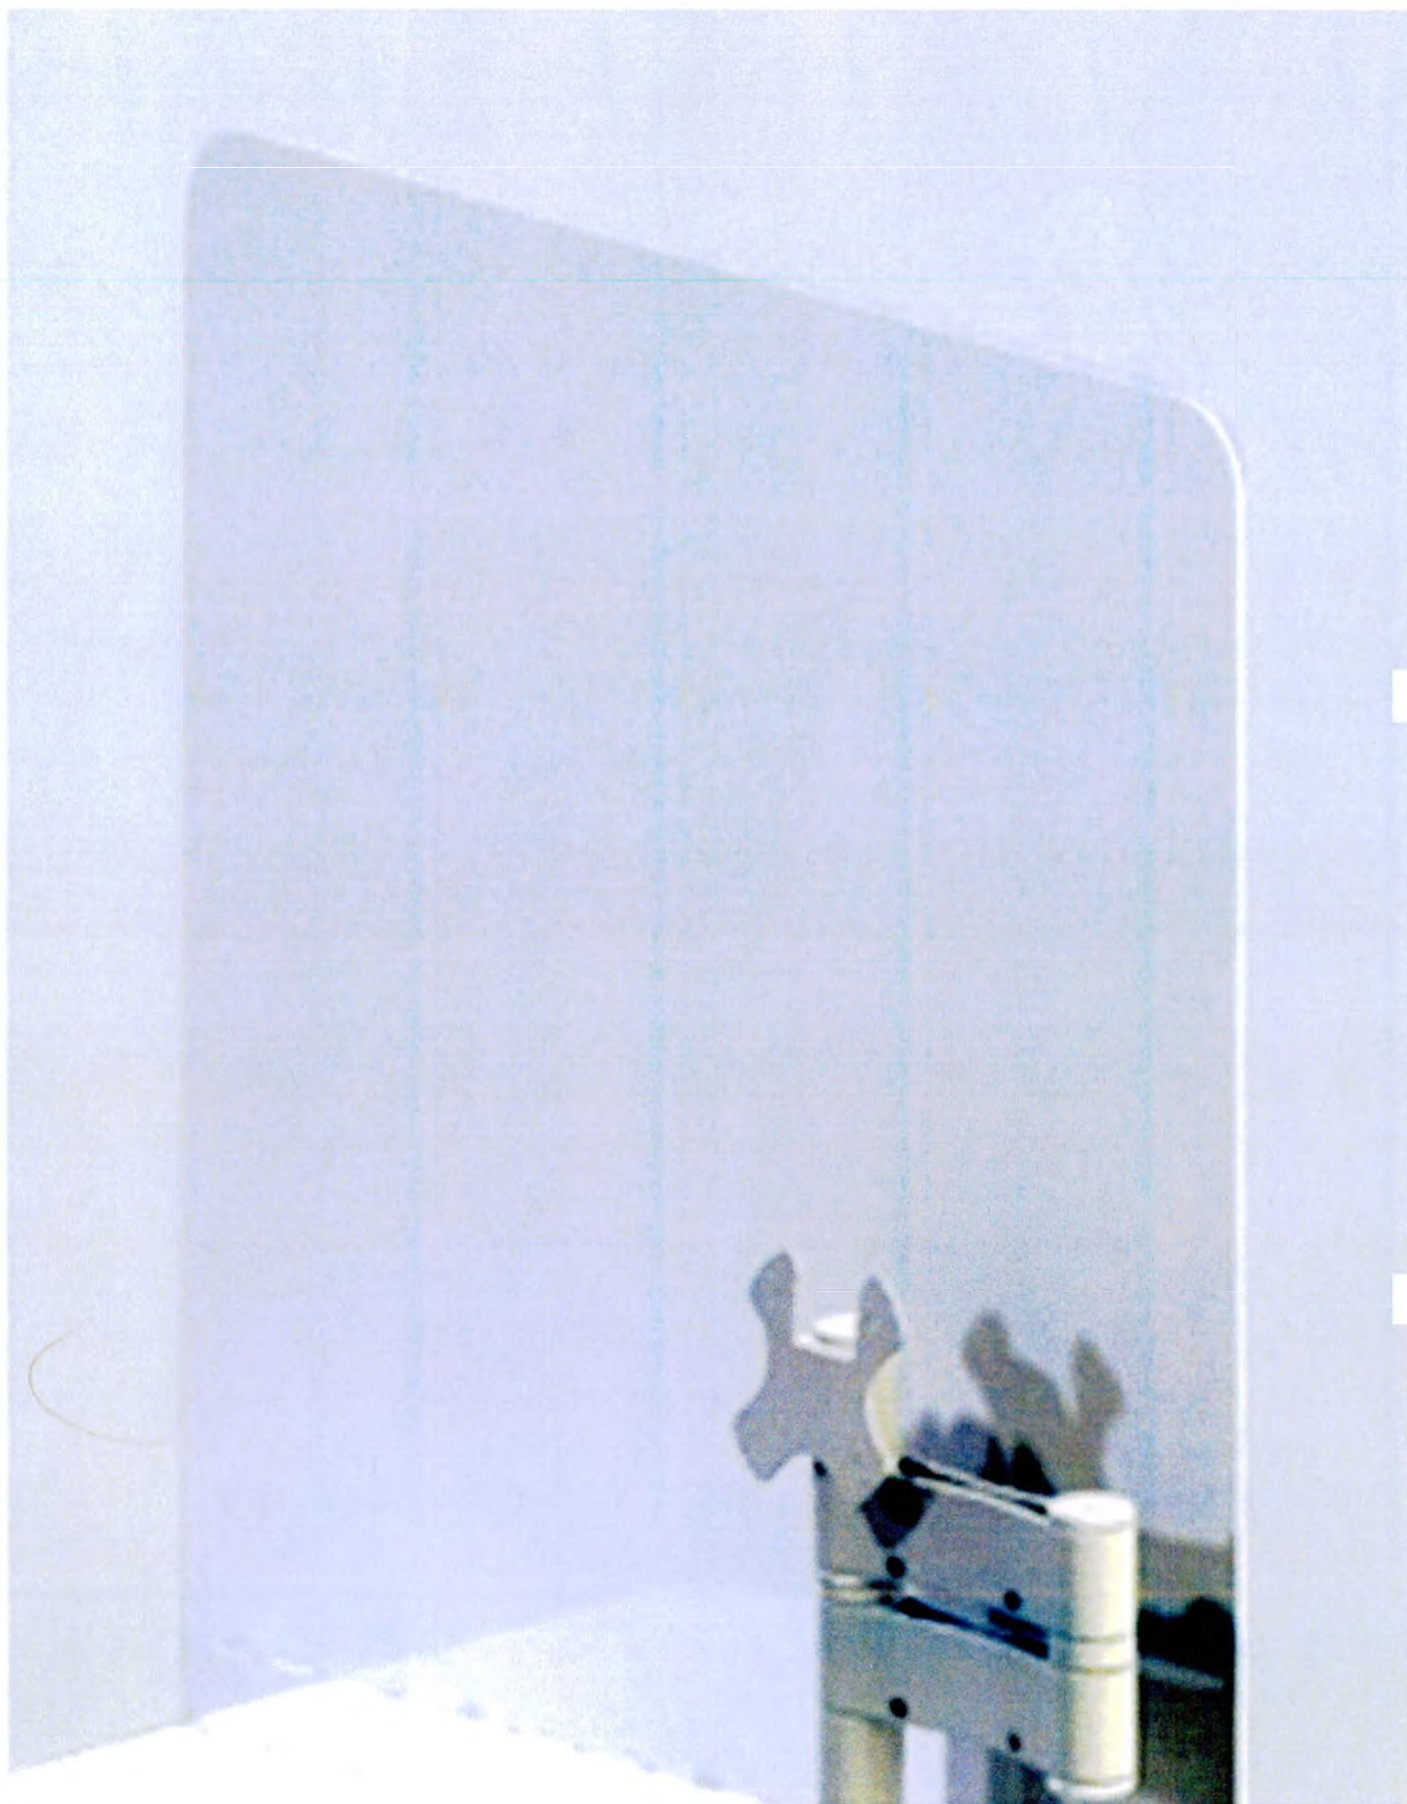

3. Дополнительный экран для защиты от рентгеновского излучения.

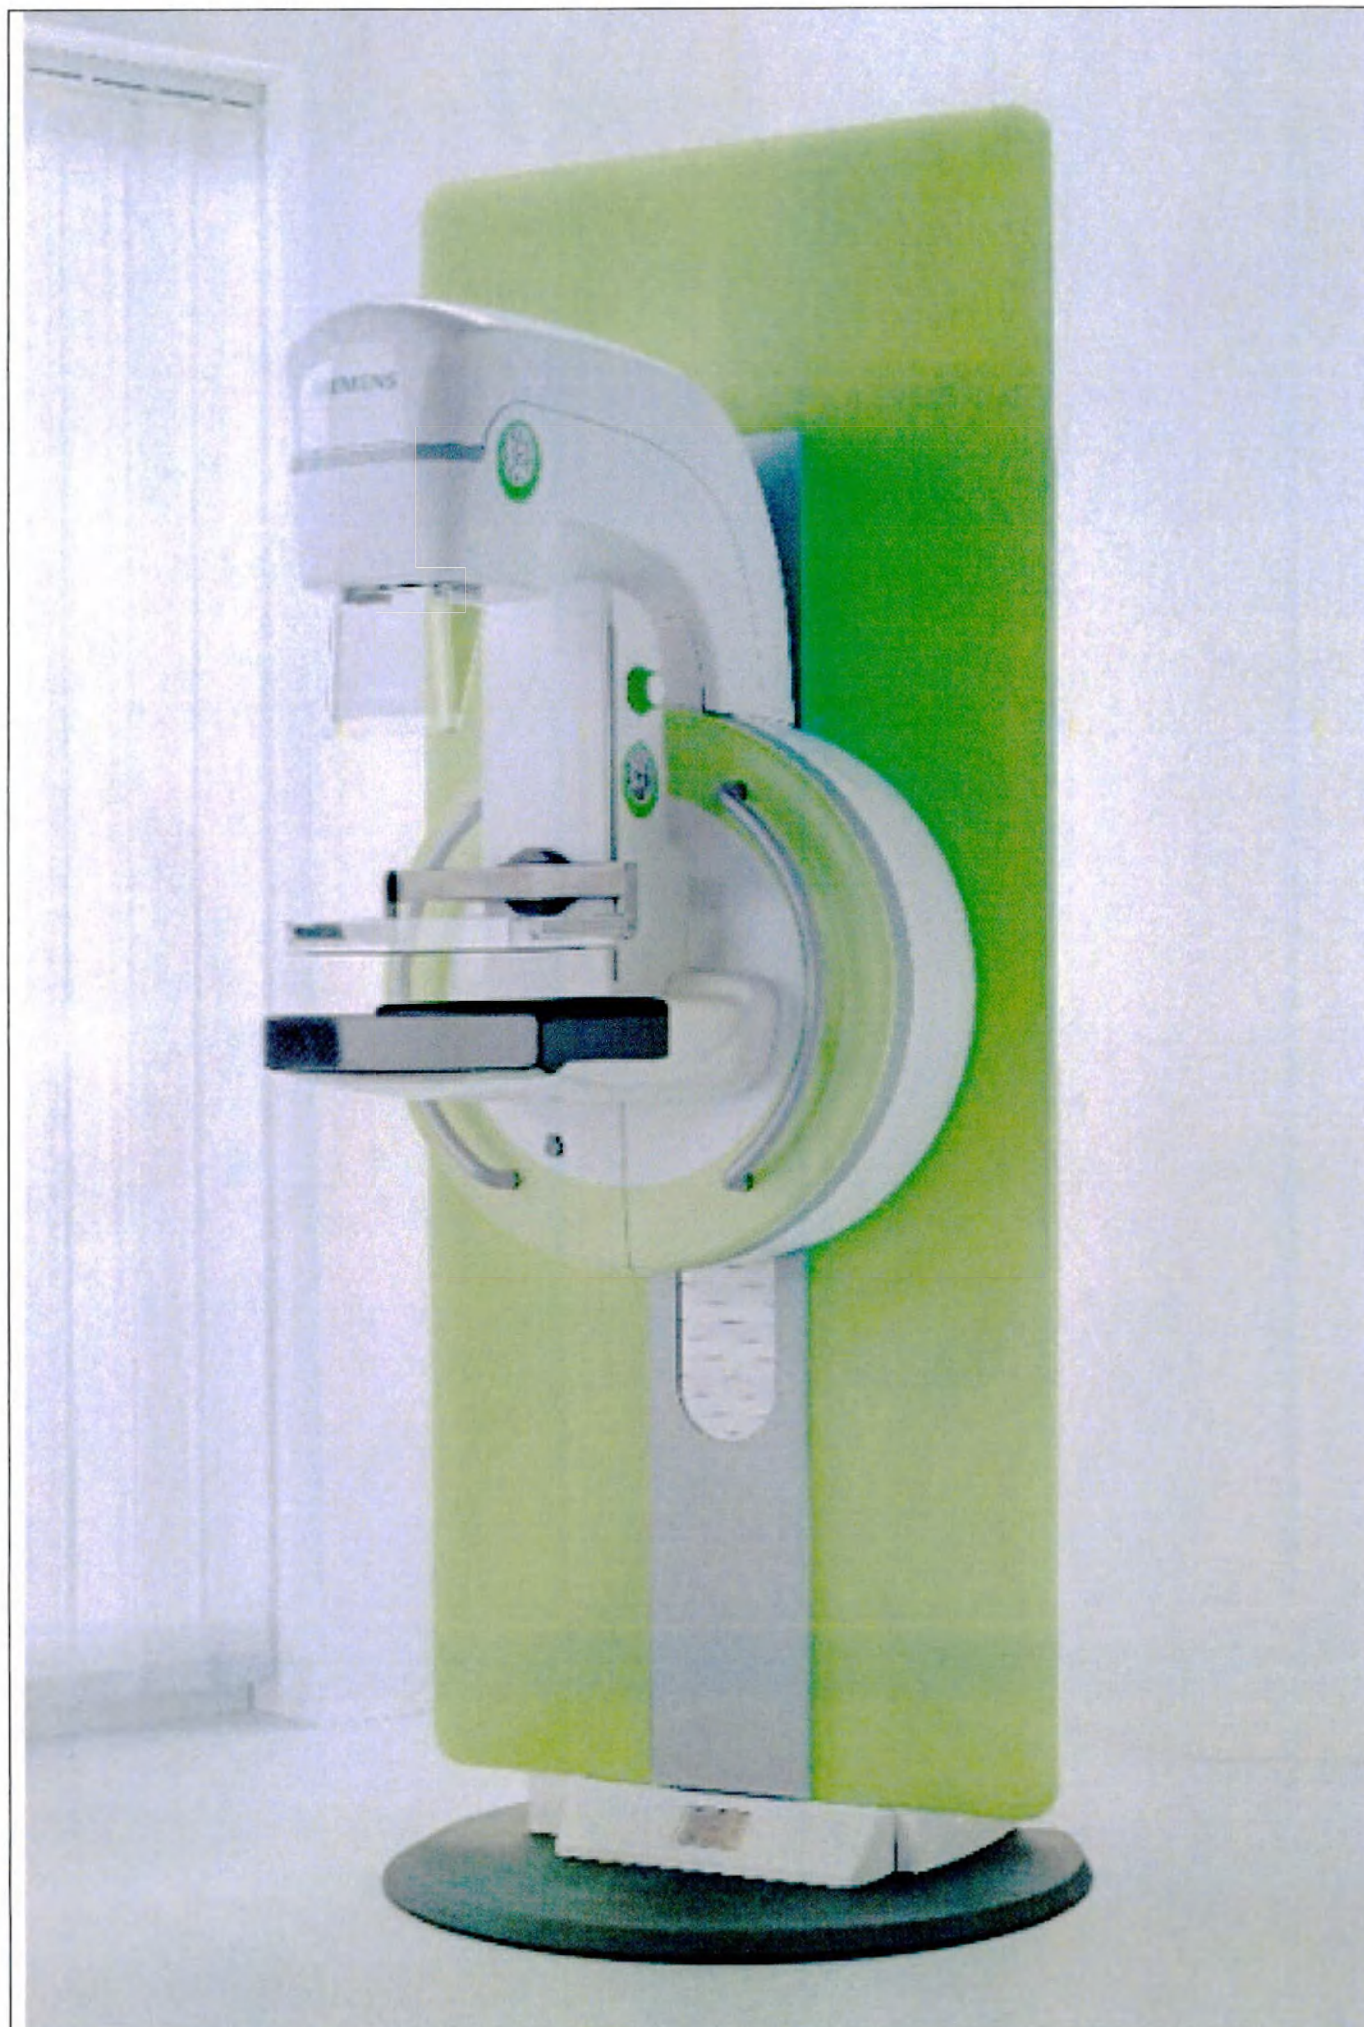


4. Кожух зеленого цвета.



5. Кожух серебристого цвета.




6. Лицензия временная на программный режим томосинтеза.

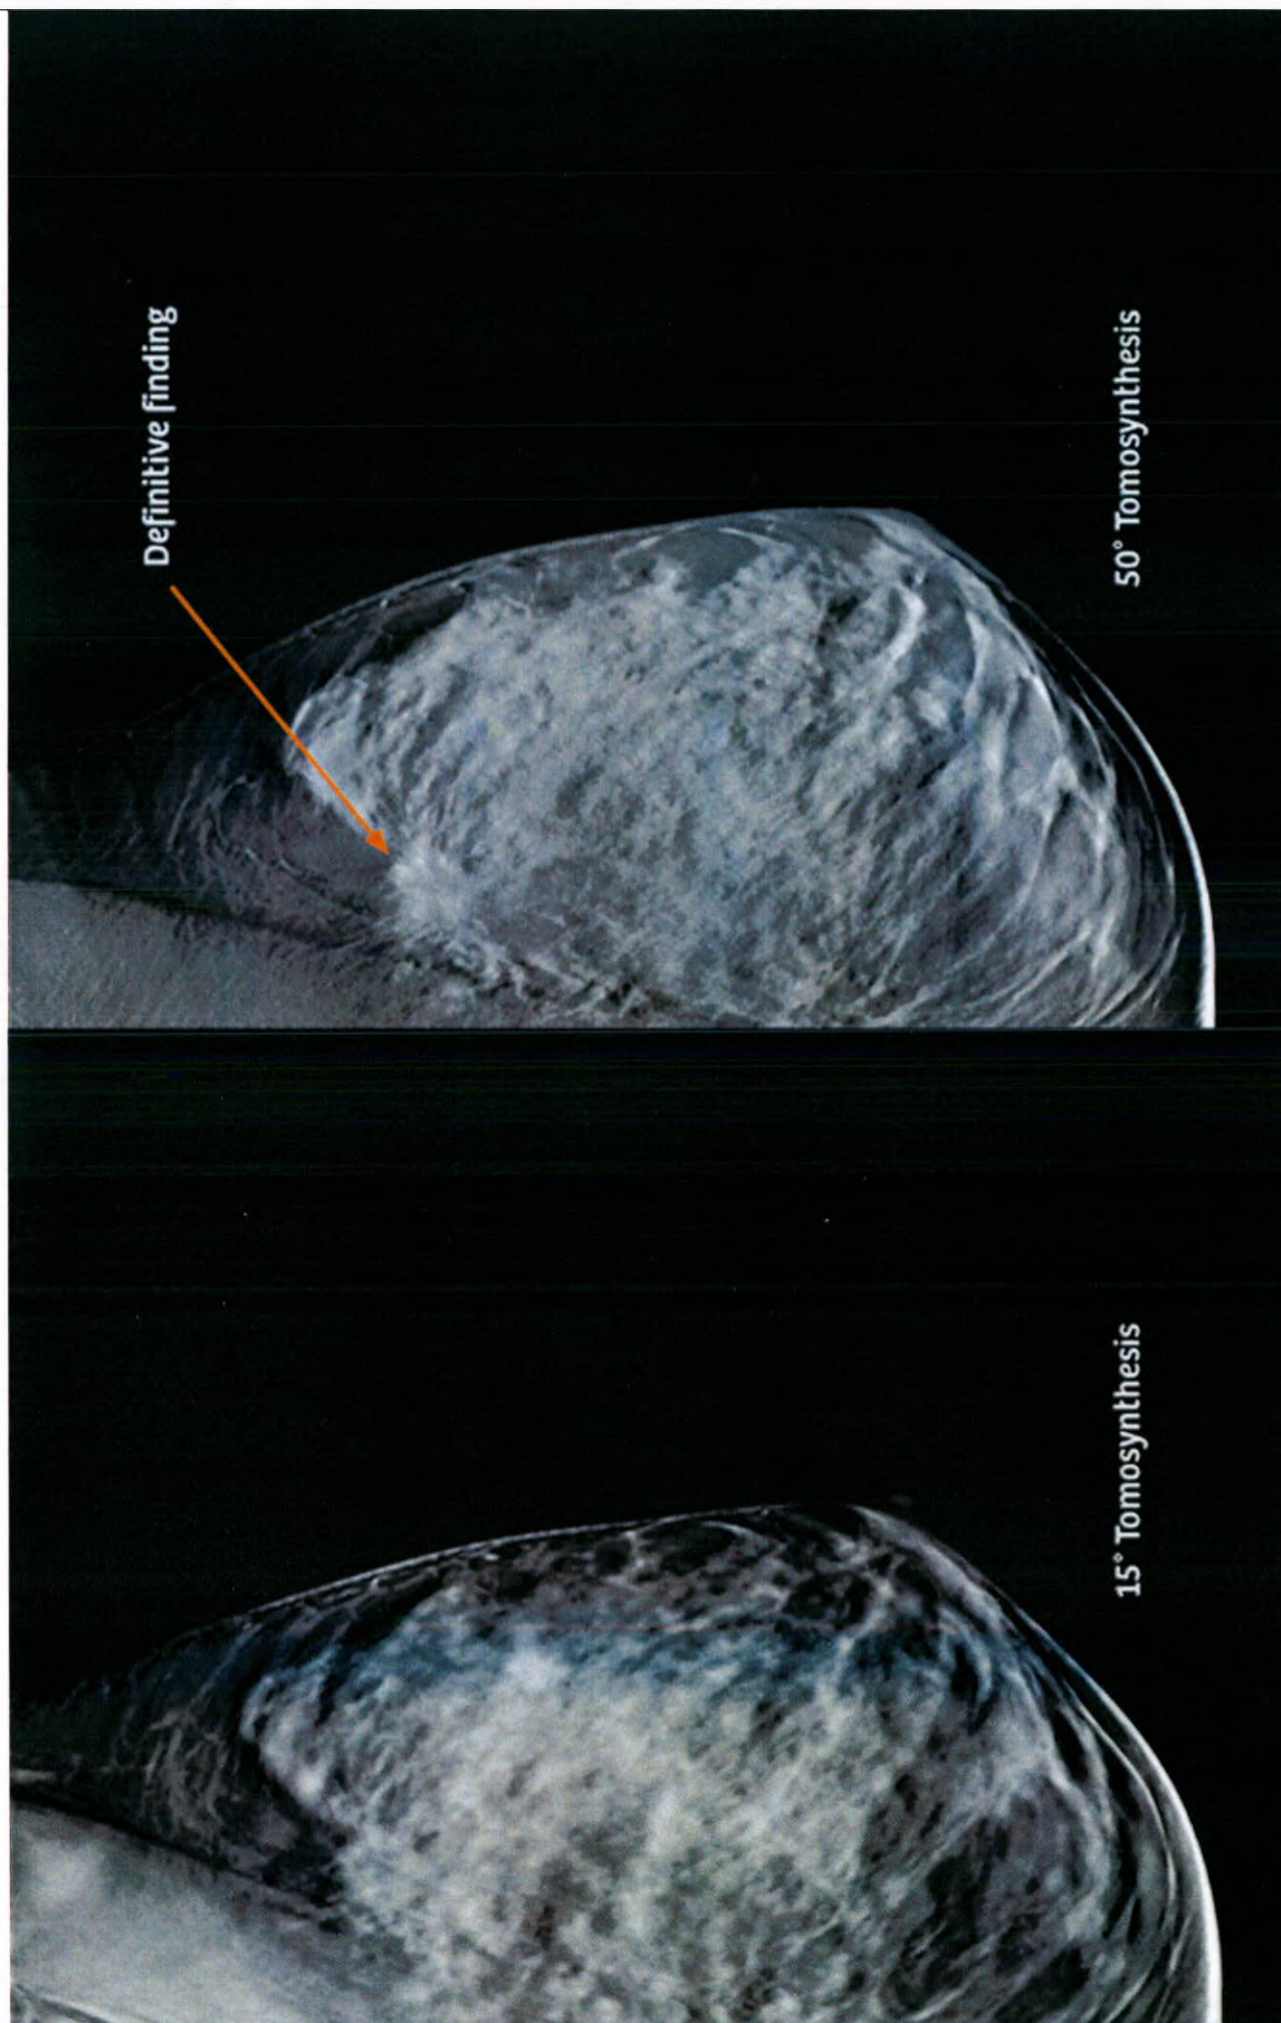

7. Лицензионный ключ для программного режима томосинтеза высокого разрешения.




8. Пластина компрессионная для томосинтеза.

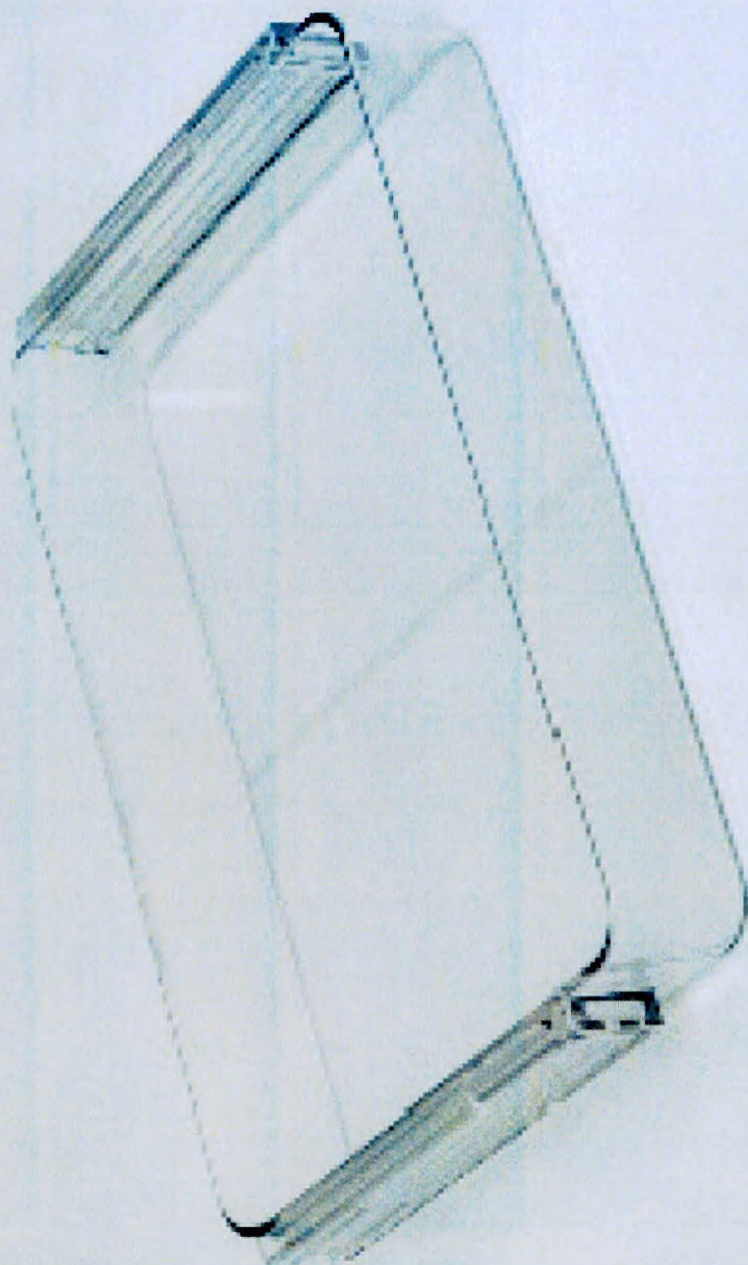


9. Вставка для пластины компрессионной для томосинтеза, не более 5 шт.




10. Приставка биопсийная.

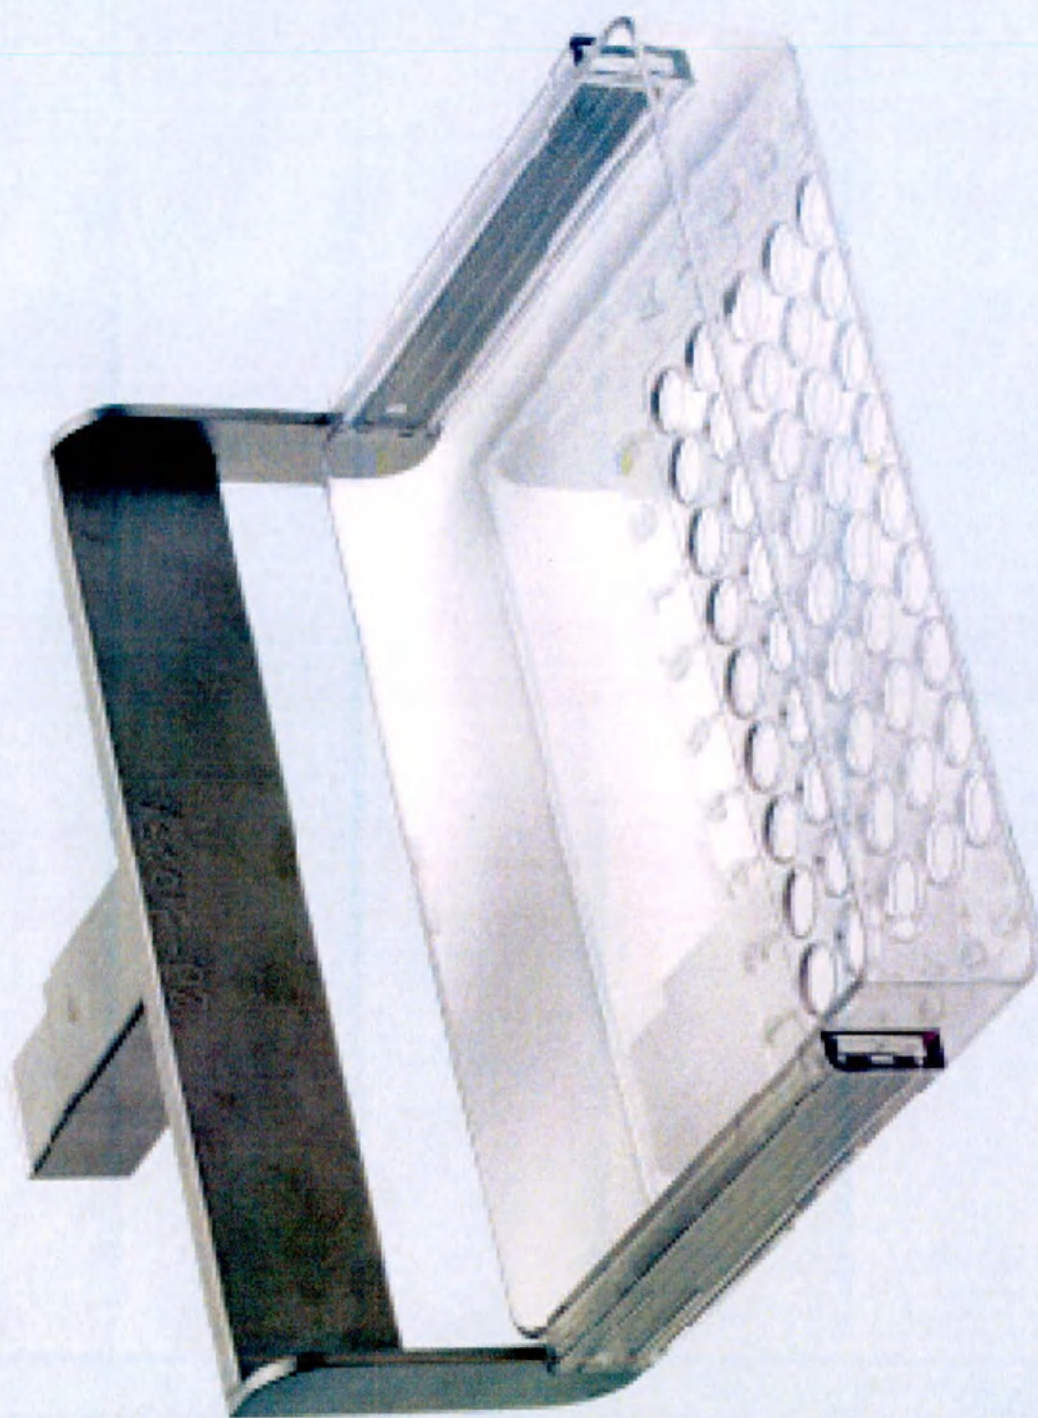

11. Пластина компрессионная для биопсии.

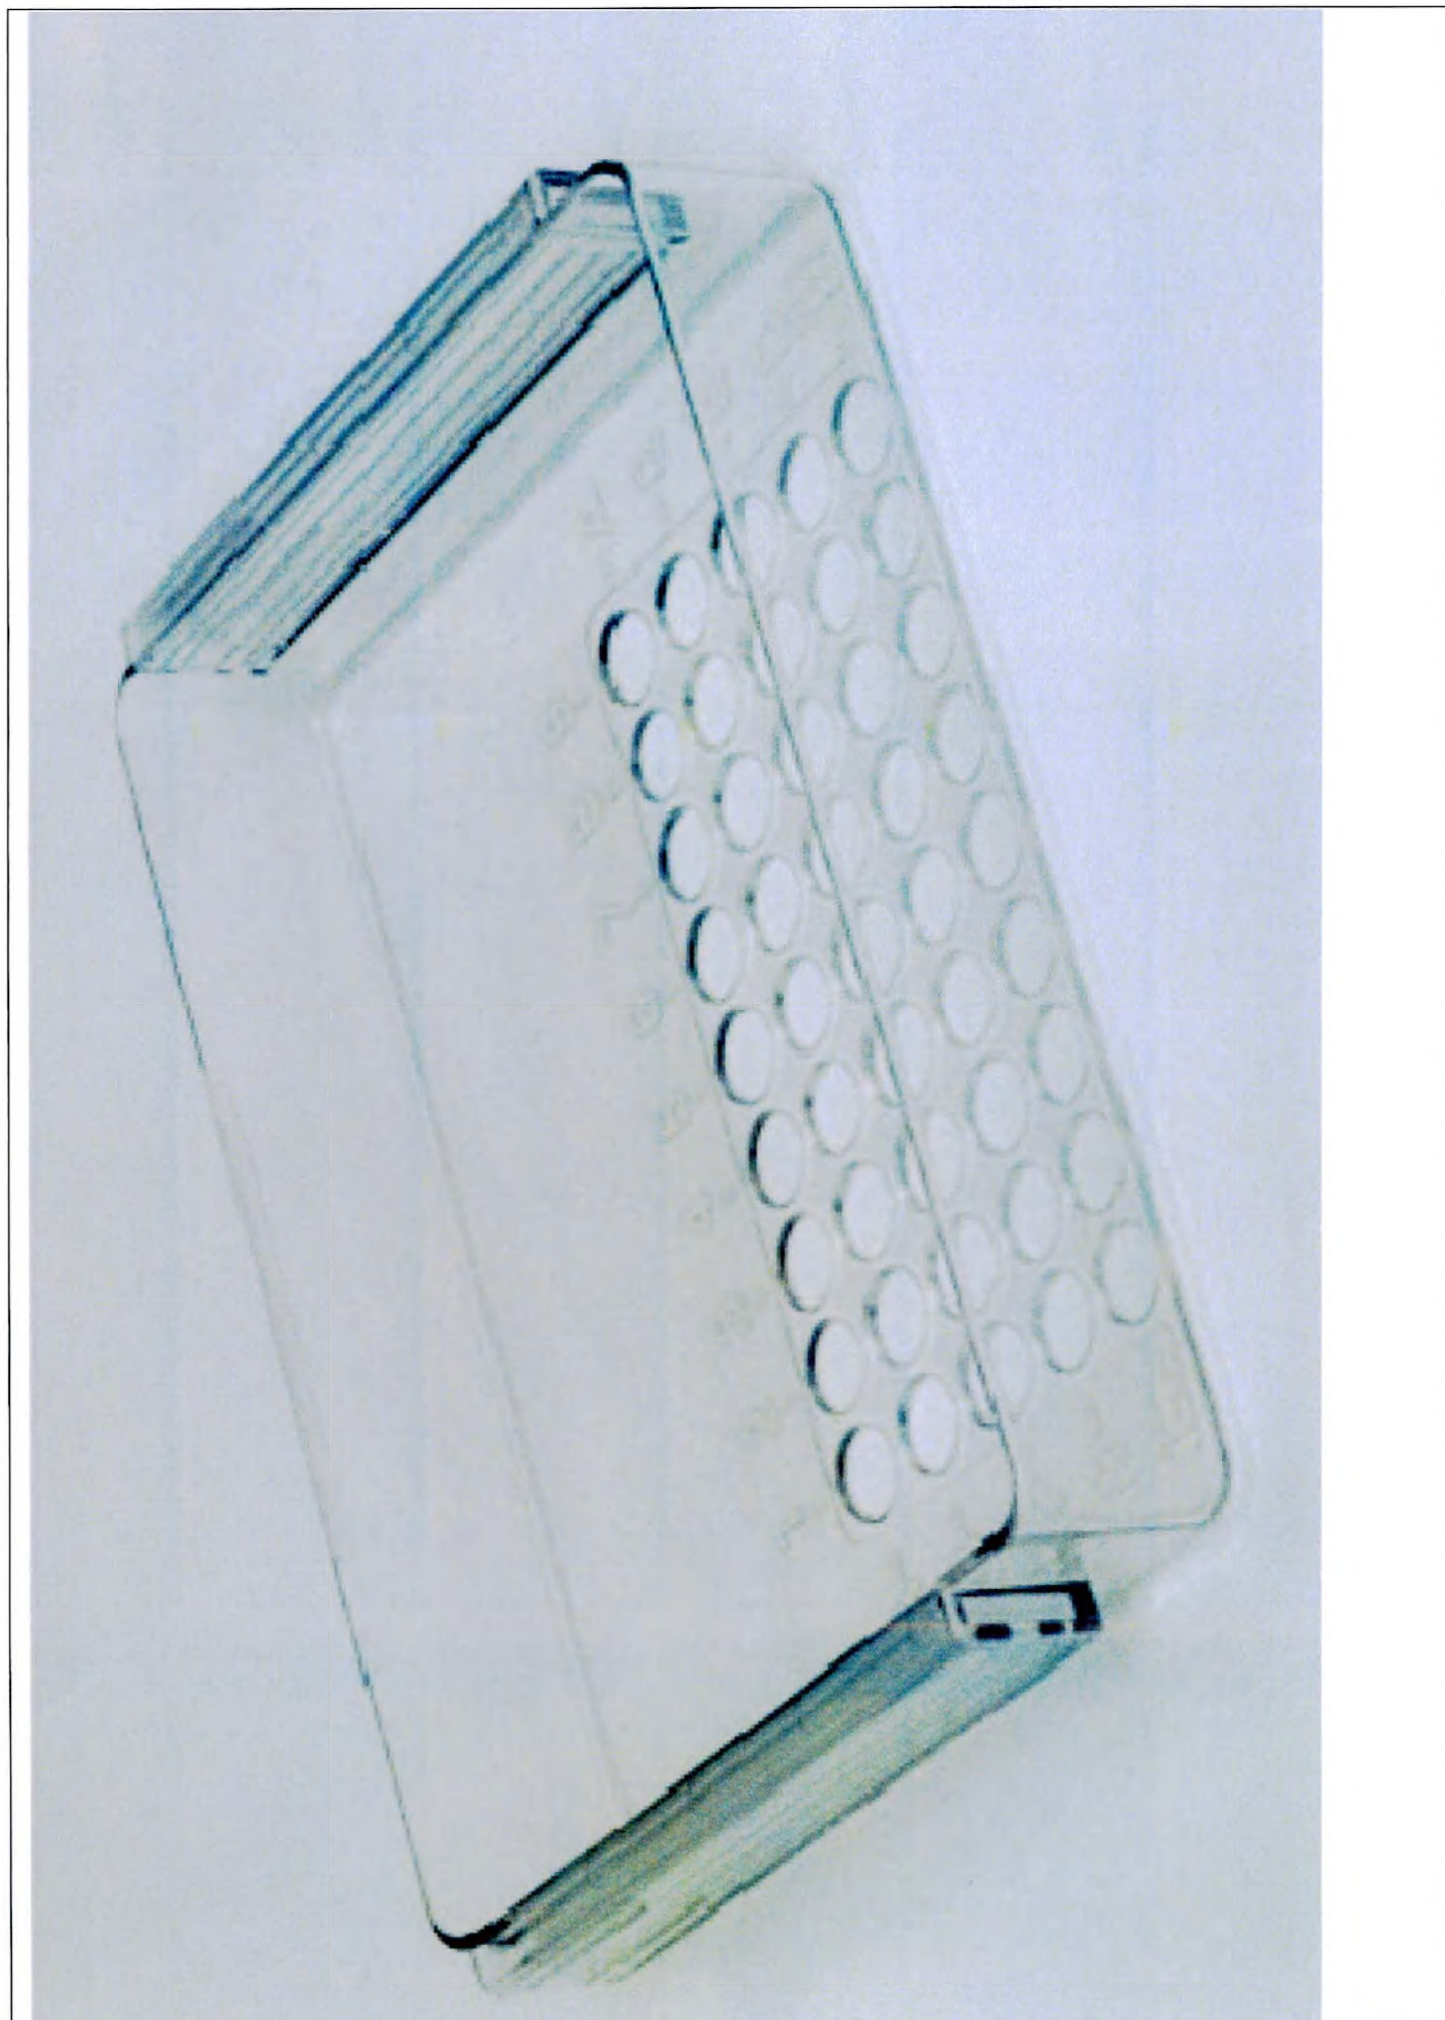


12. Вставка для пластины компрессионной для биопсии, не более 5 шт.

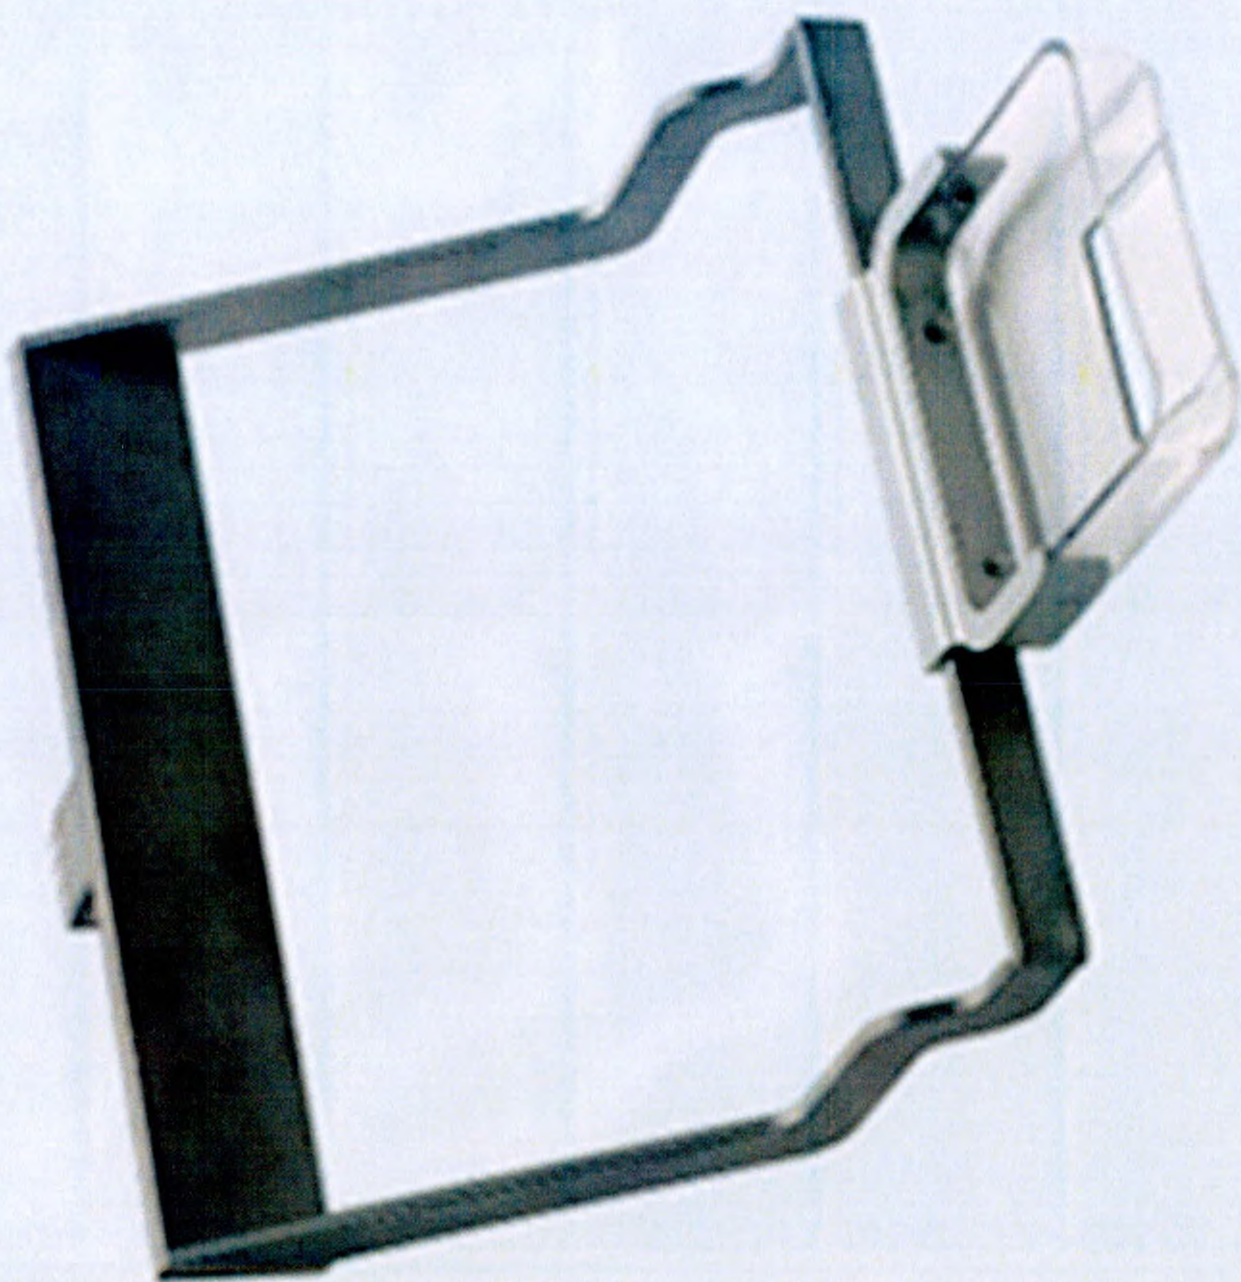


13. Пластина компрессионная для стереотаксической биопсии.




14. Вставка для компрессионной пластины для стереотаксической биопсии, не более 5 шт.

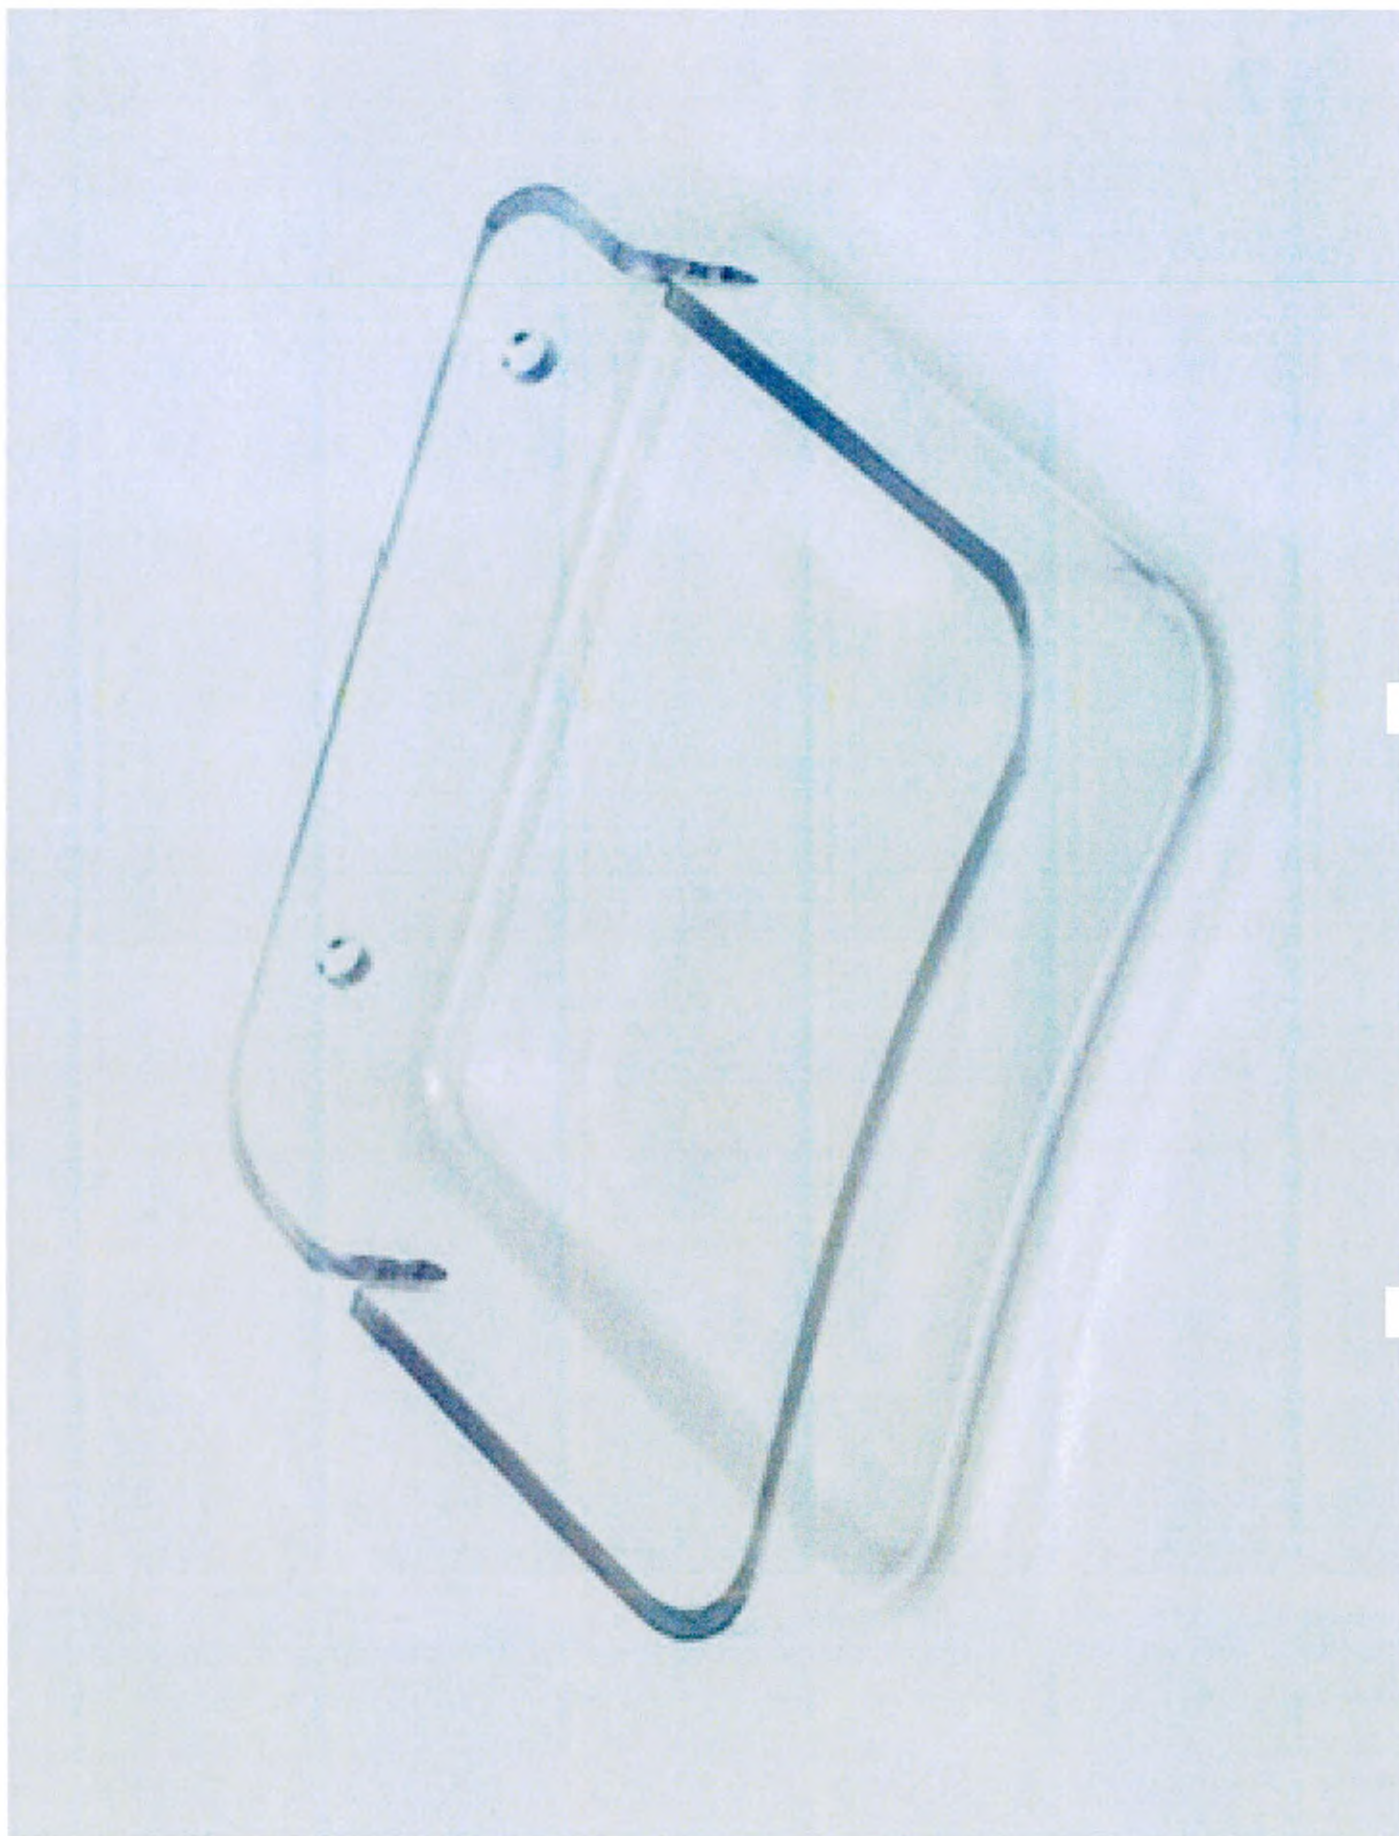


15. Вставка для компрессионной пластины для стереотаксической биопсии (горизонтальное направление иглы), не более 10 шт.

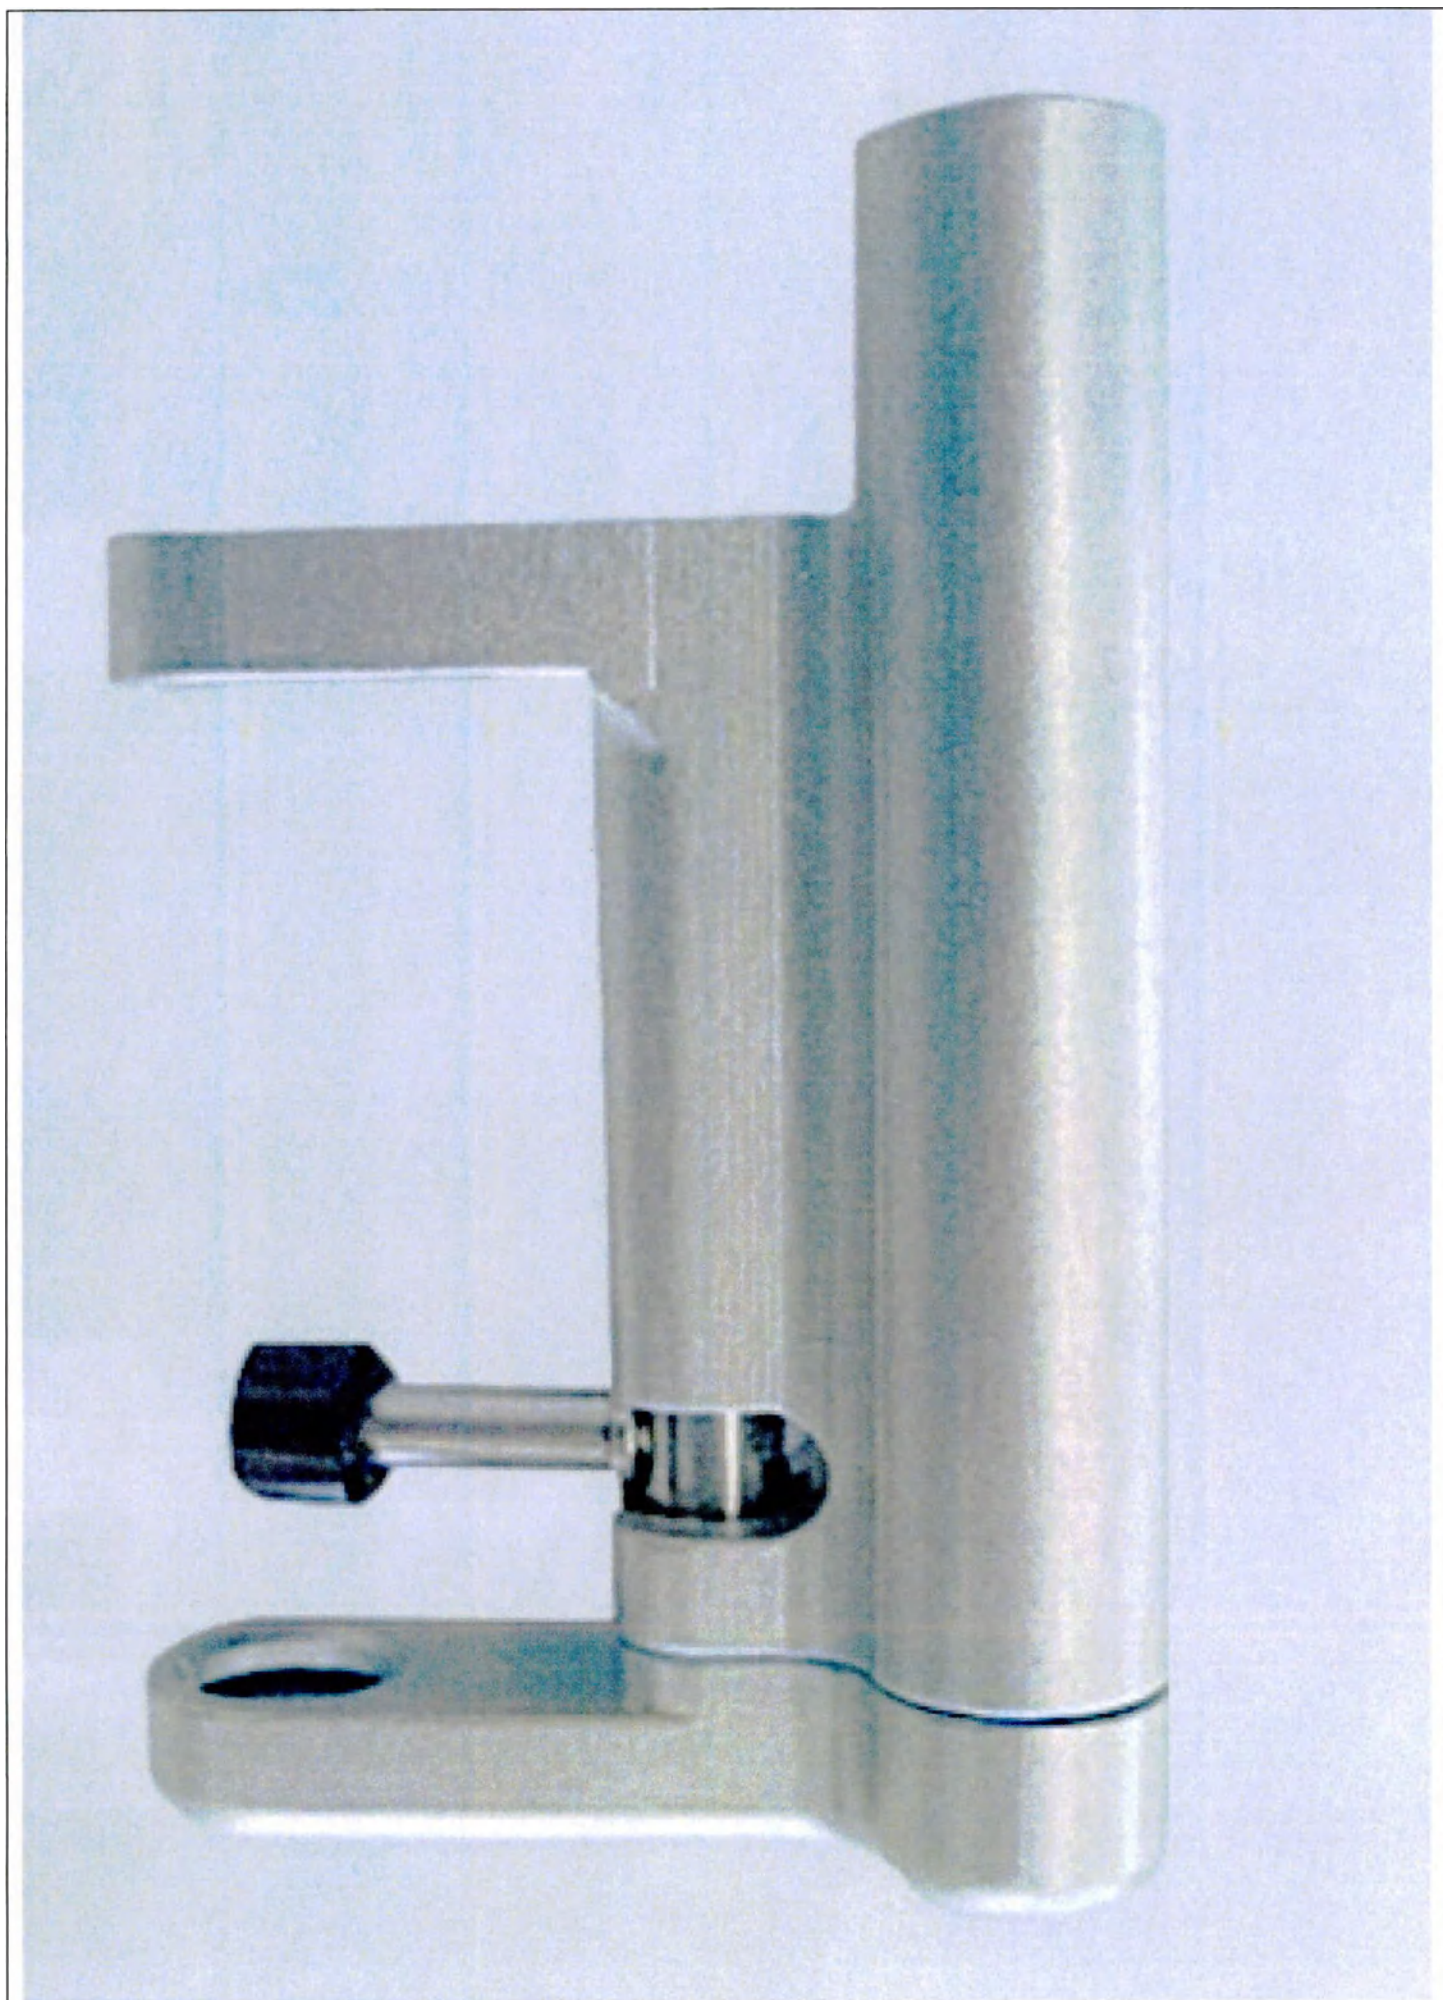


16. Держатели игл для биопсии горизонтальные и/или вертикальные, не более 10 шт.

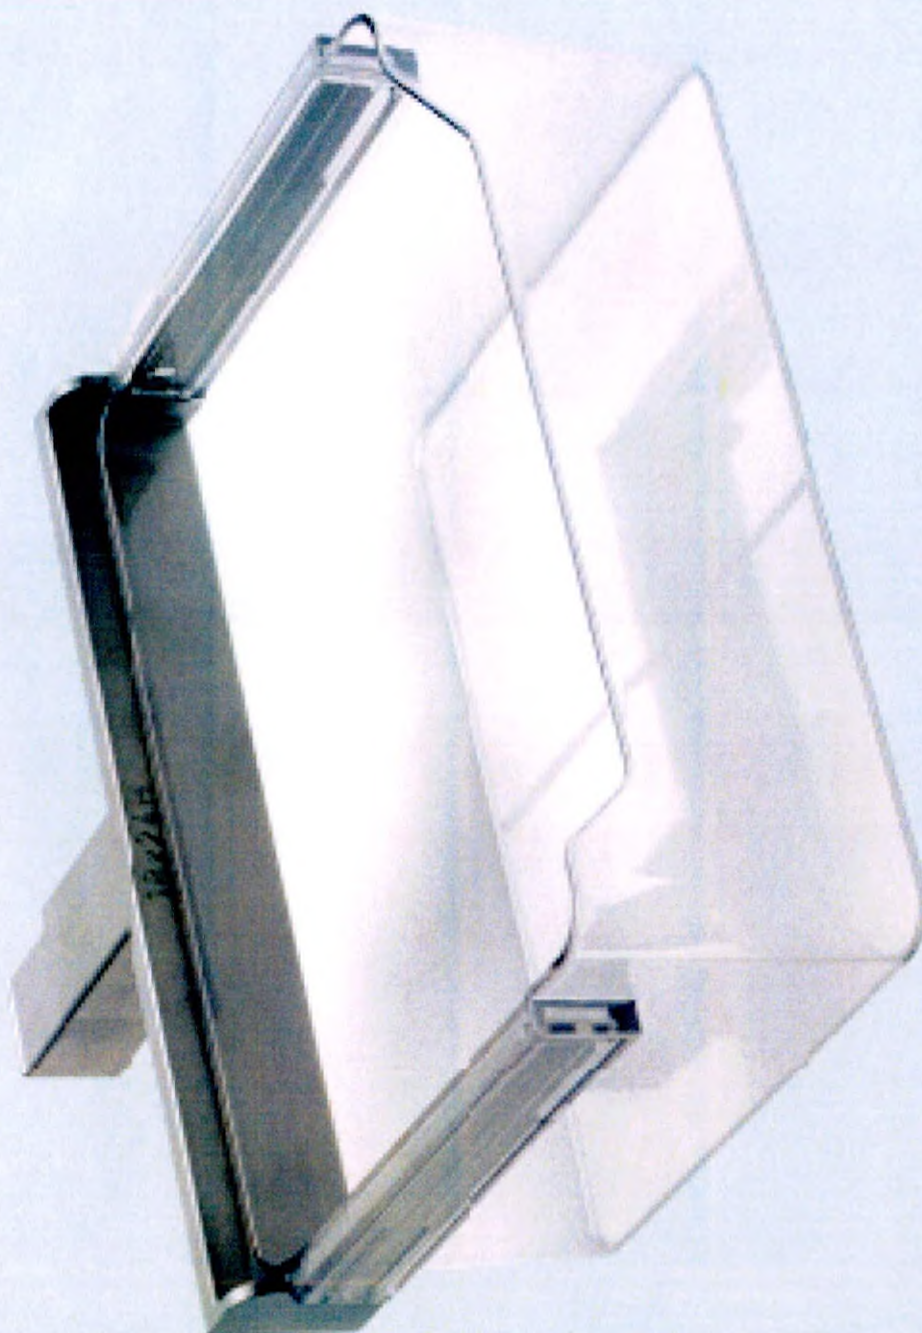


17. Пластина компрессионная стандартная 18x24 см, высота края 7 см.

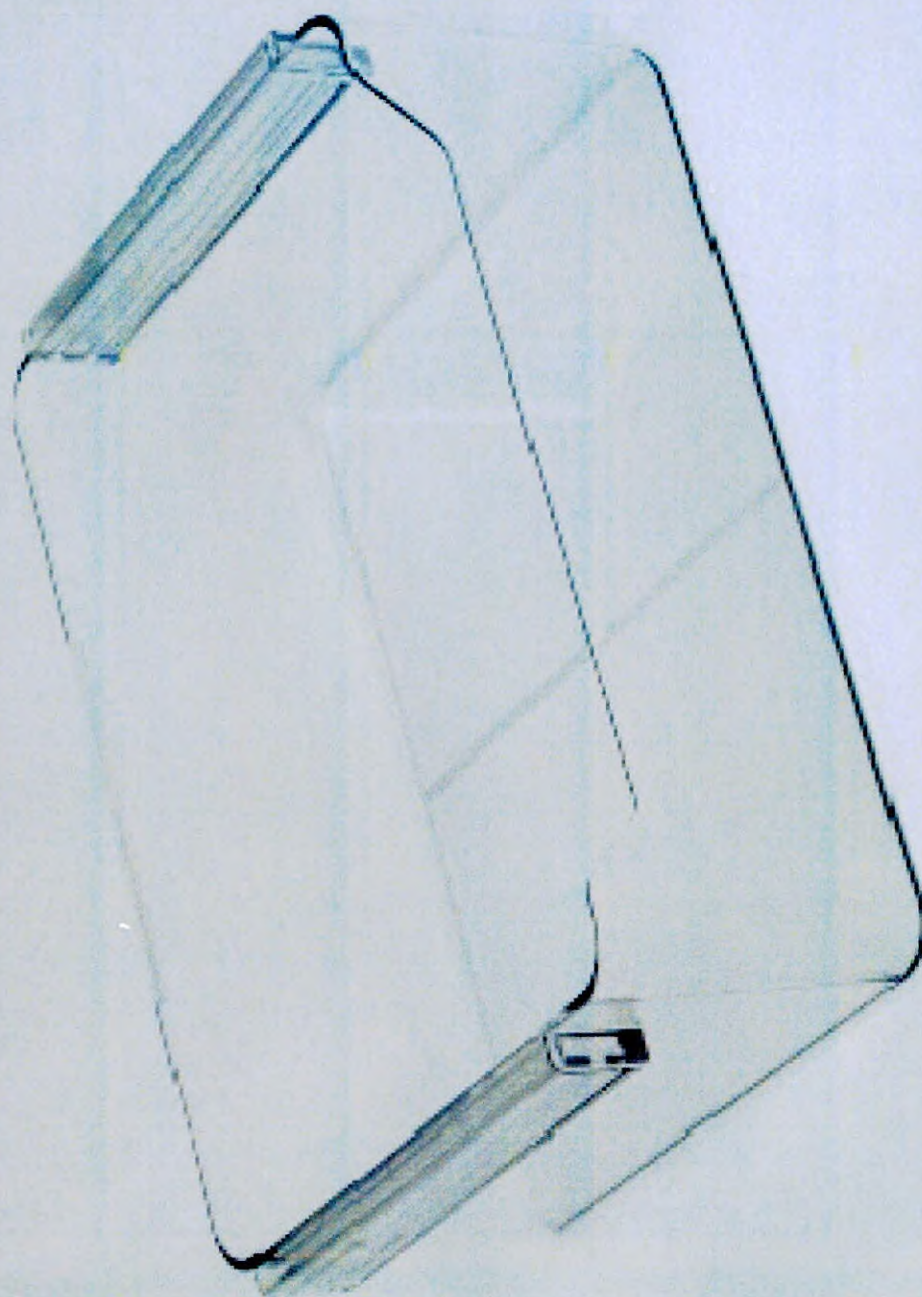

18. Вставка для компрессионной пластины 18 x 24 см, с высоким краем, не более 5 шт.

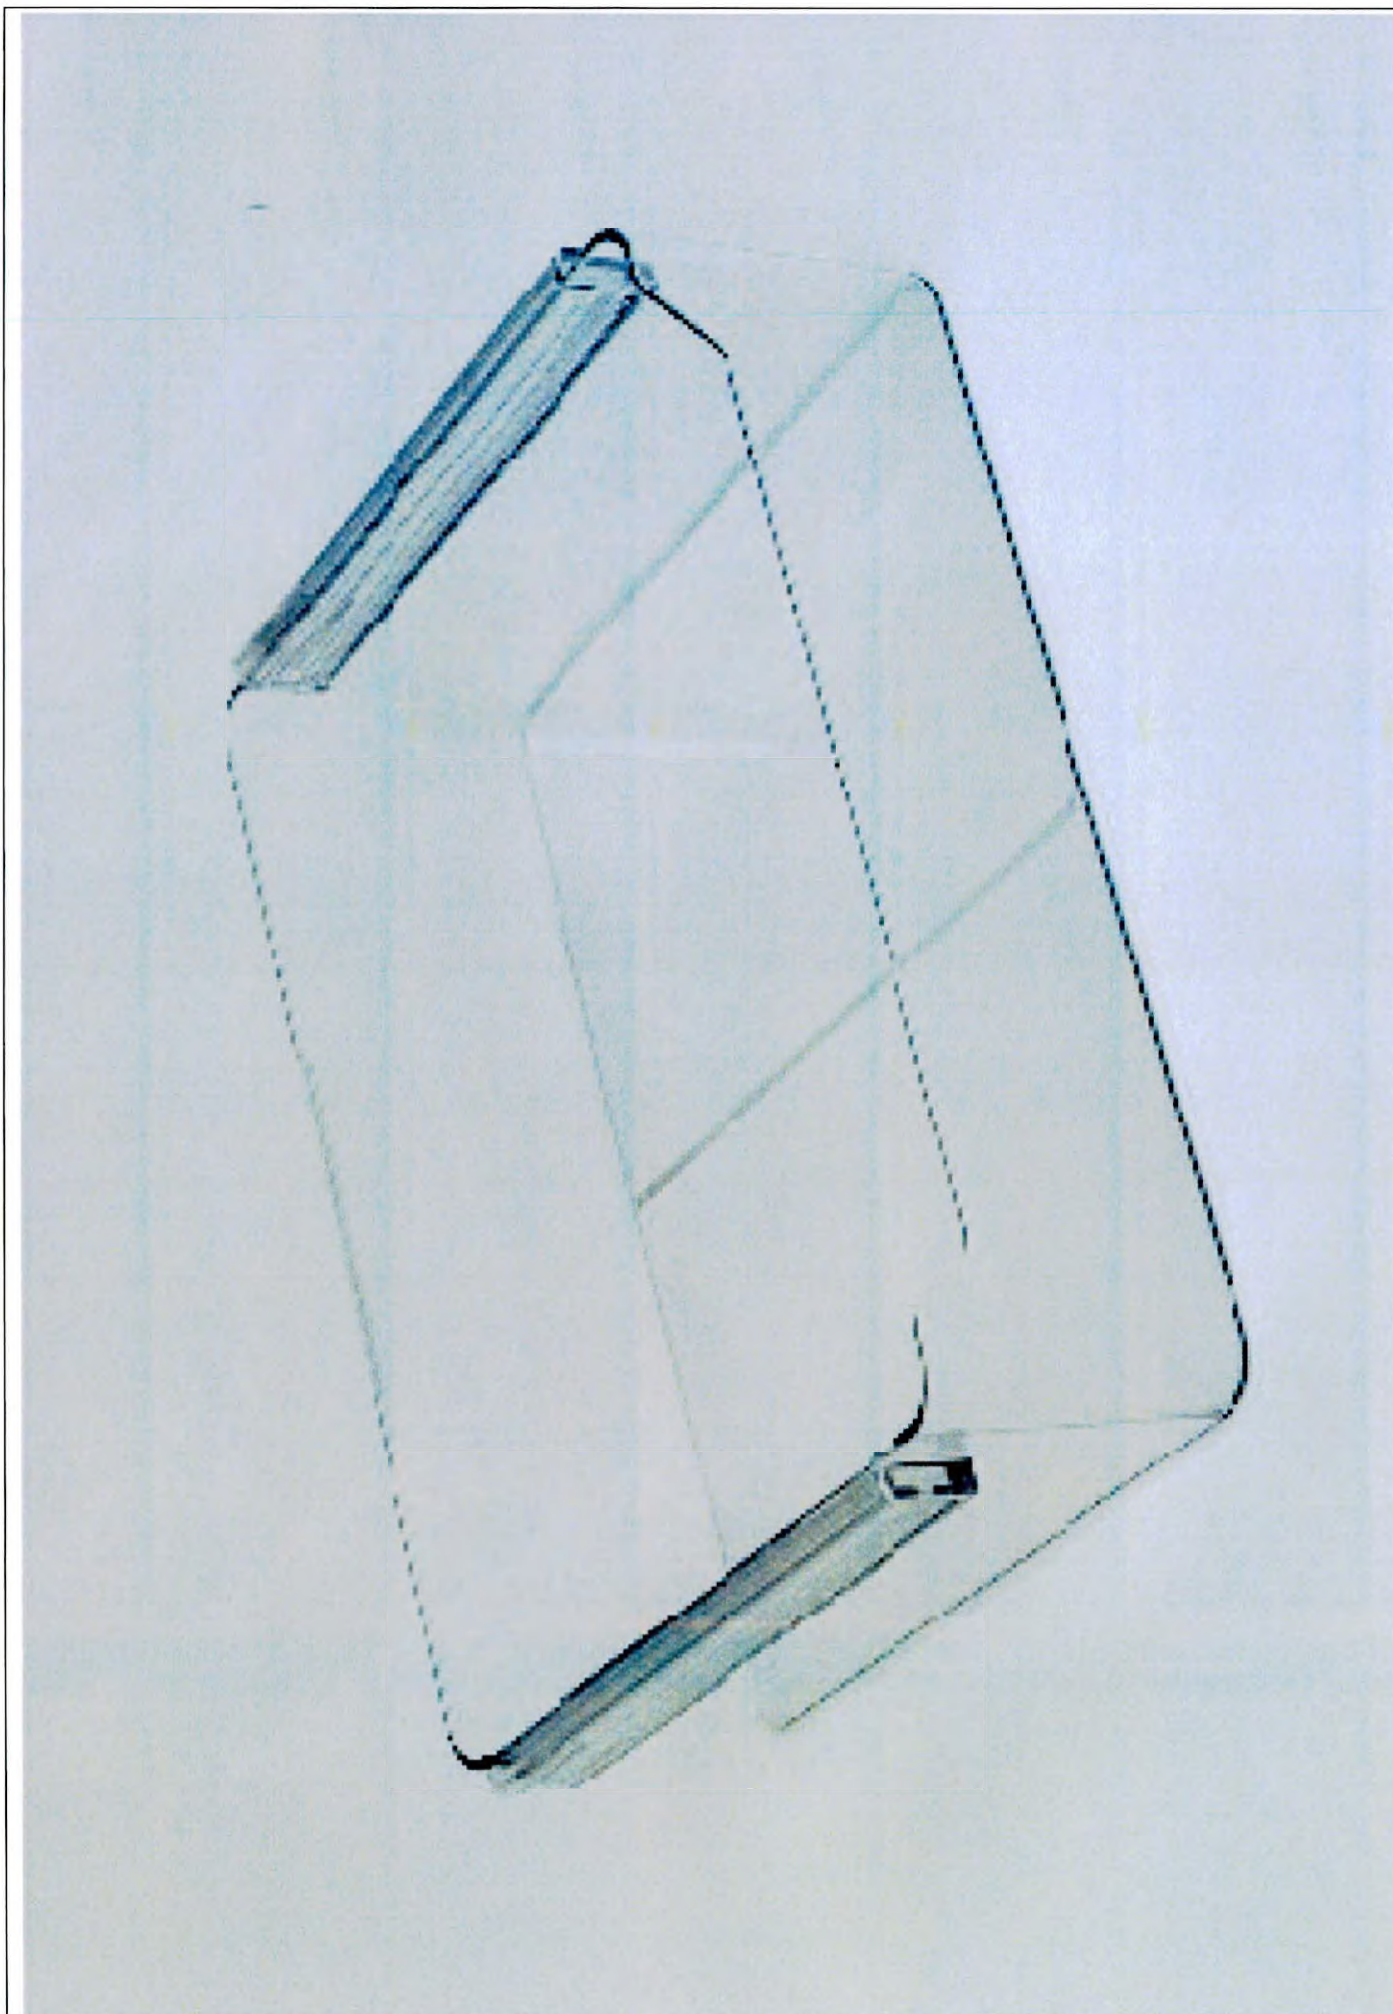


19. Вставка для компрессионной пластины 24 x 30 см. с высоким краем, не более 5 шт.

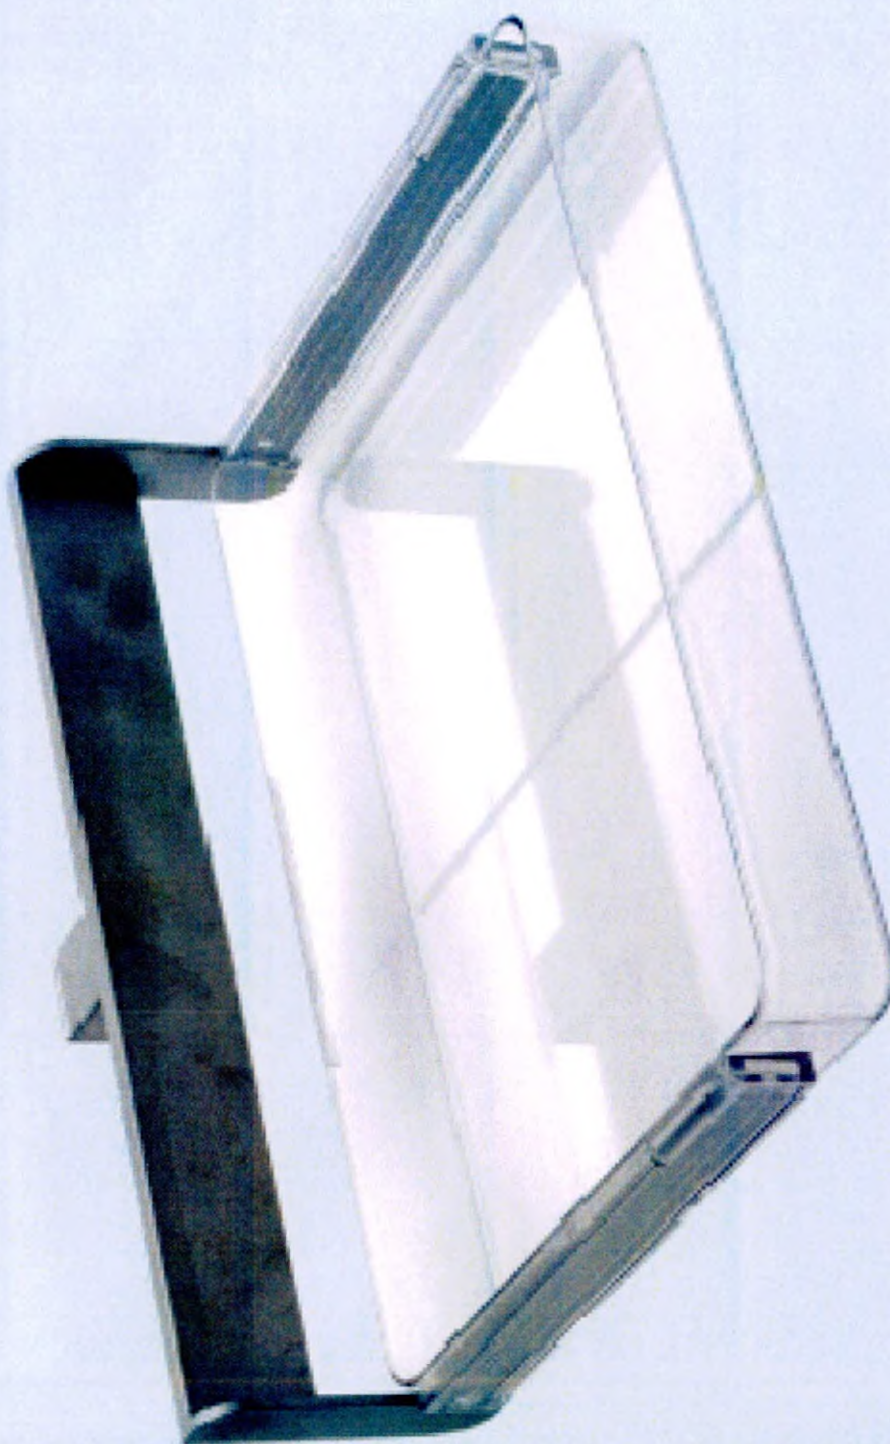


20. Пластина компрессионная стандартная 18x24 см, высота края 4 см.




21. Вставка для компрессионной пластины 18x24 см с низким краем, не более 5 шт.

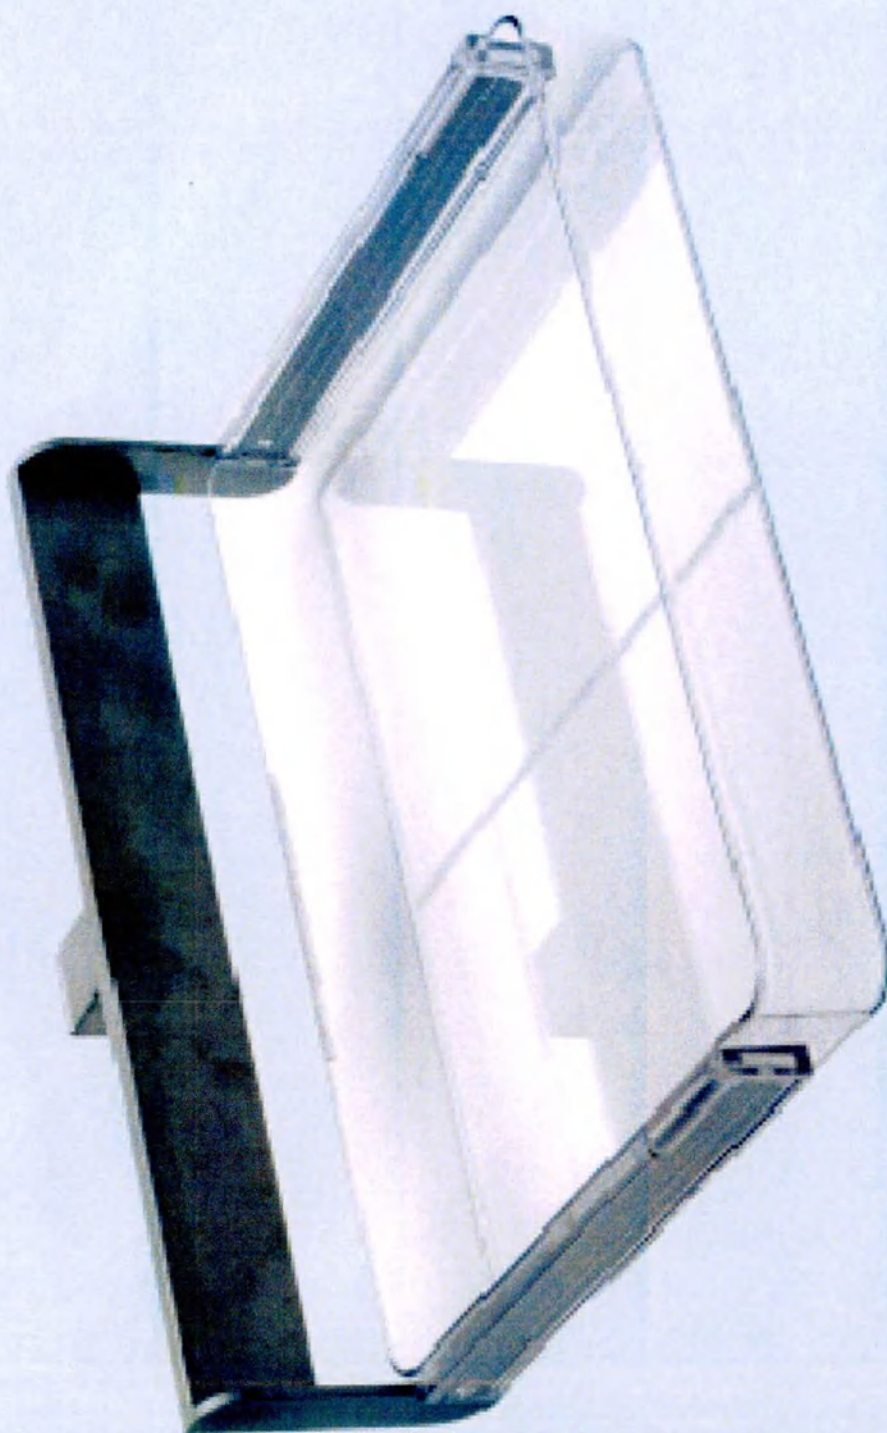


22. Пластина компрессионная стандартная 24x30 см, высота края 4 см.

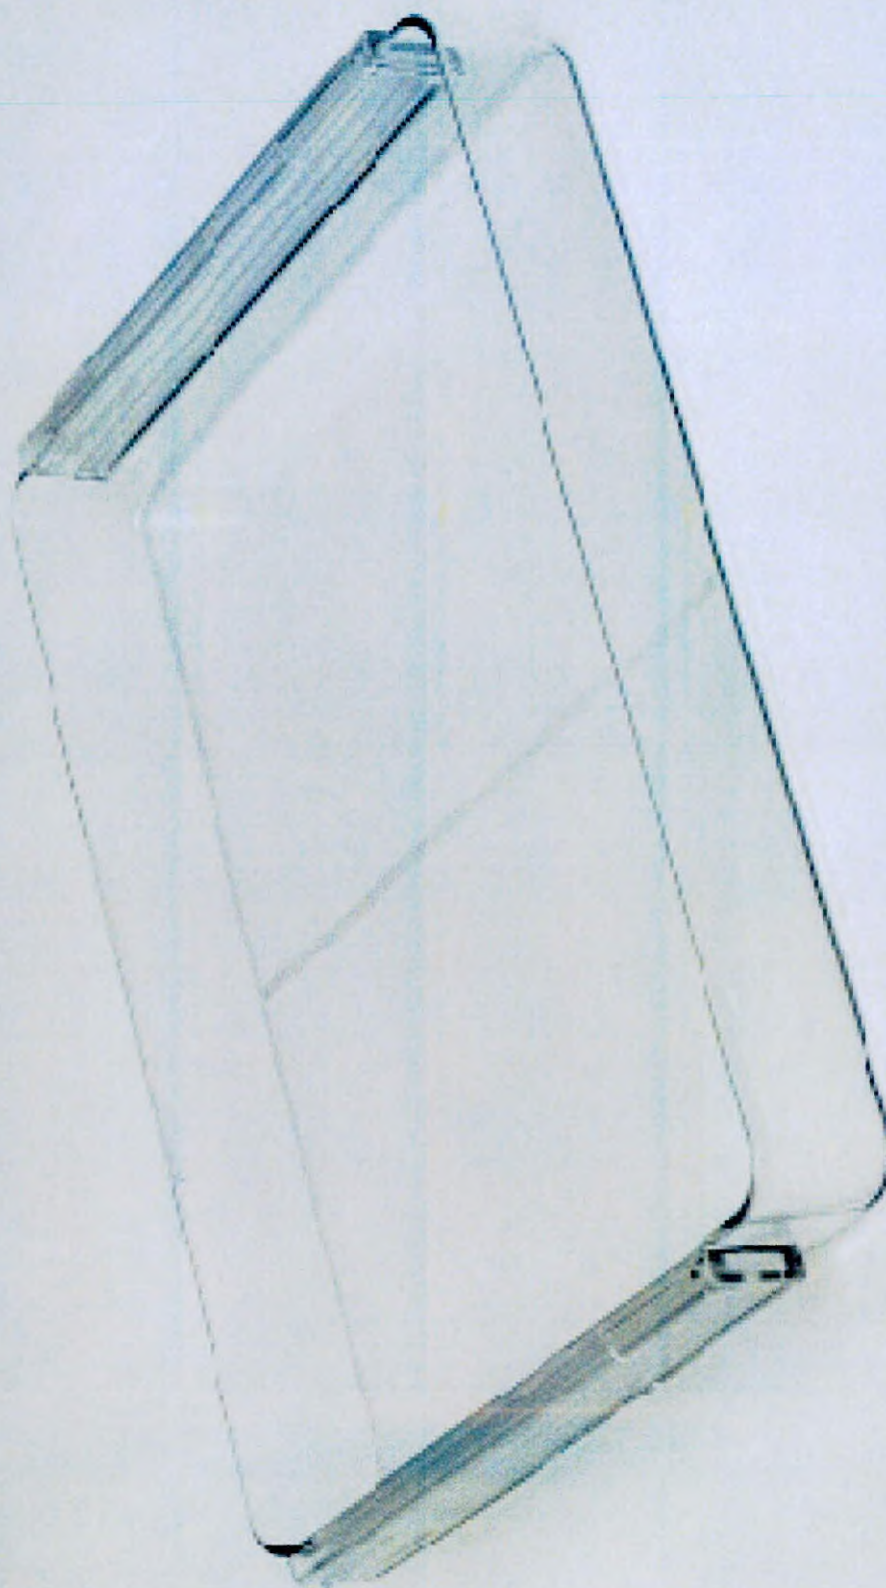


23. Вставка для компрессионной пластины 24х30 см с низким краем, не более 5 шт.

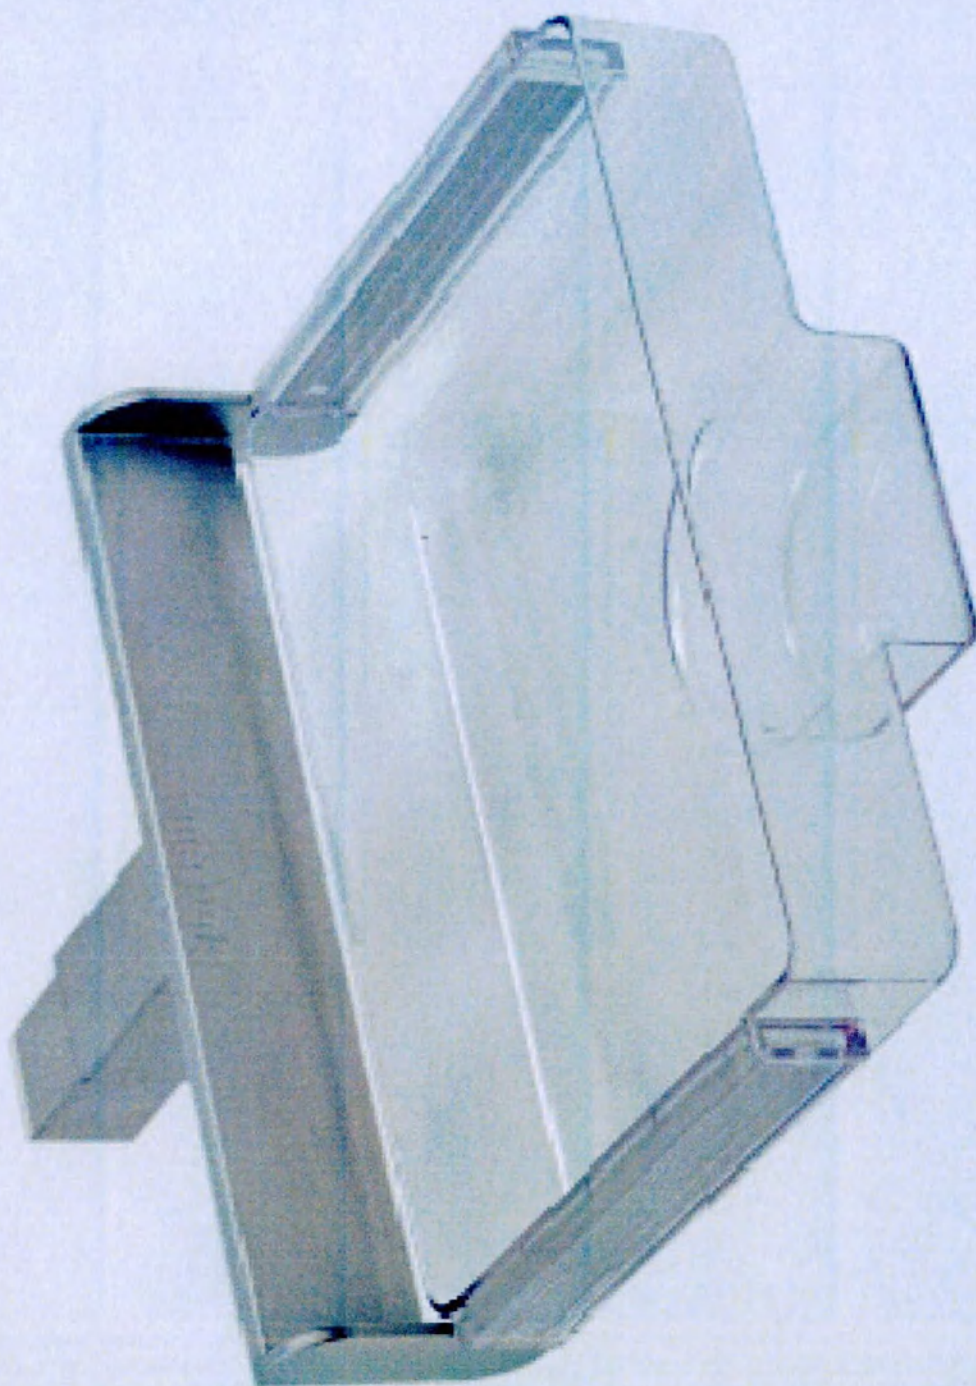


24. Пластина компрессионная для прицельных снимков 18x24 см.

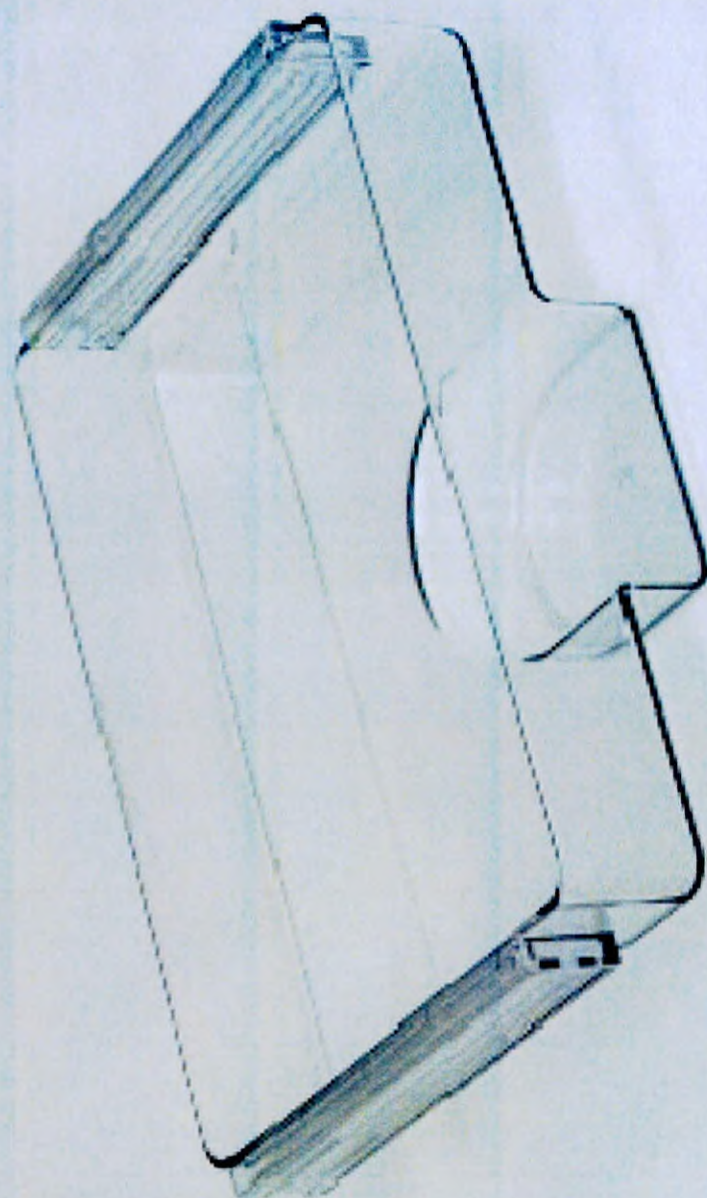


25. Вставка для компрессионной пластины для прицельных снимков 18x24 см, не более 5 шт.

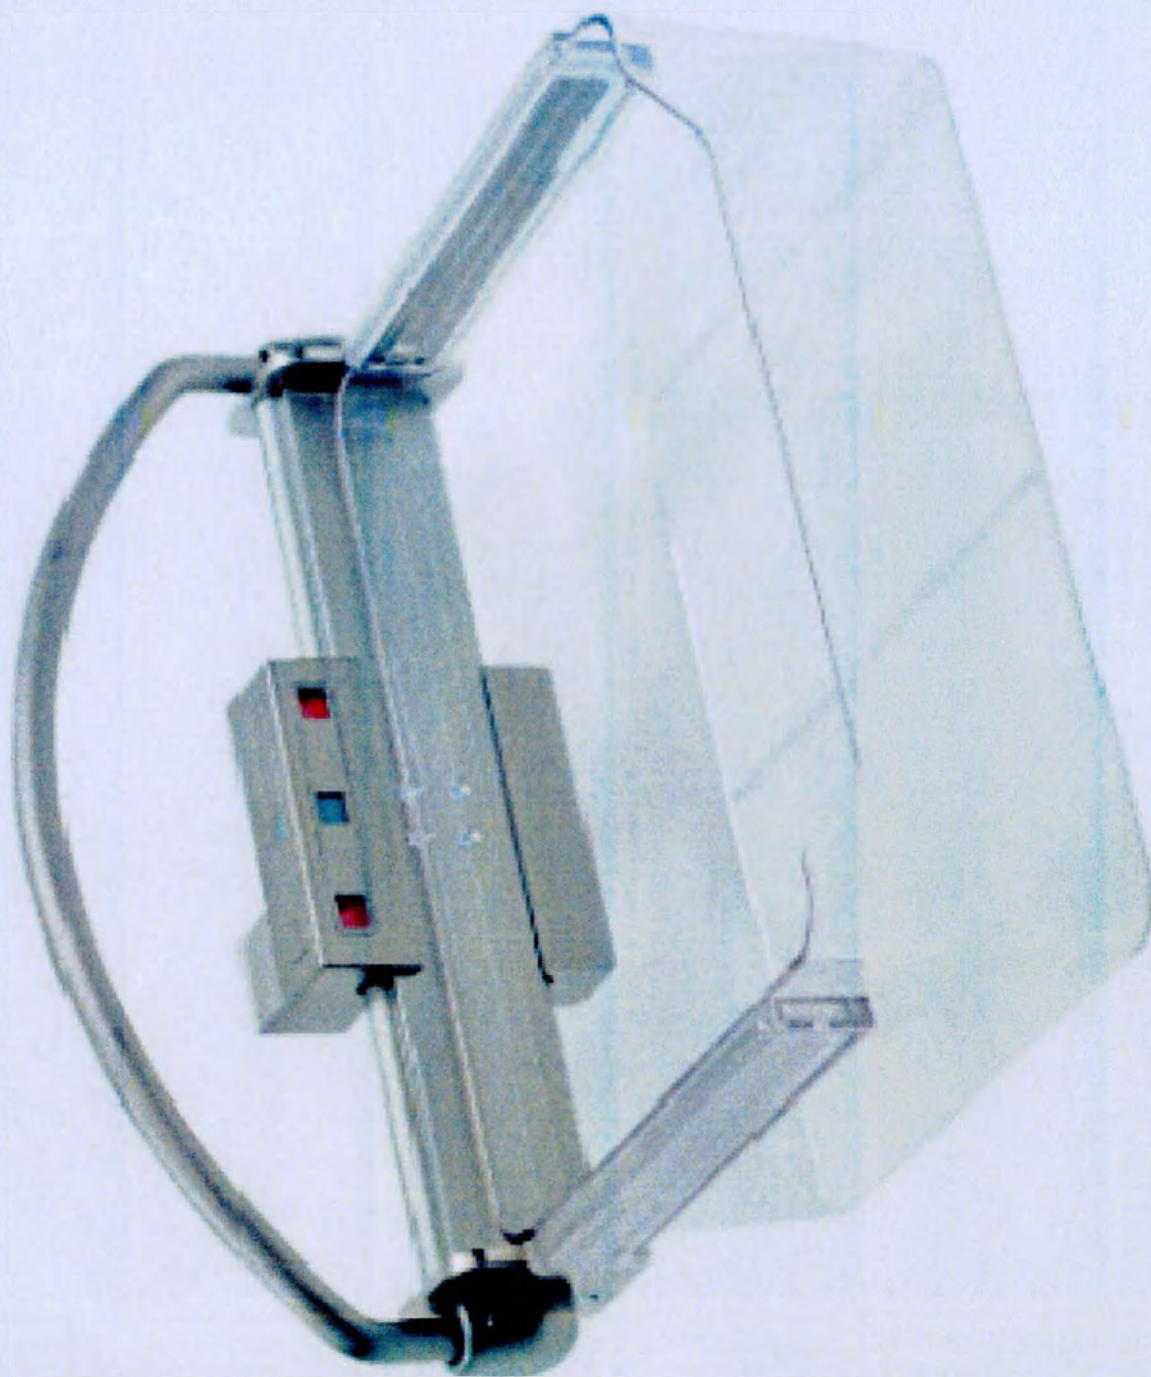

26. Пластина компрессионная сдвигающаяся 18 x 24 см с высоким краем.

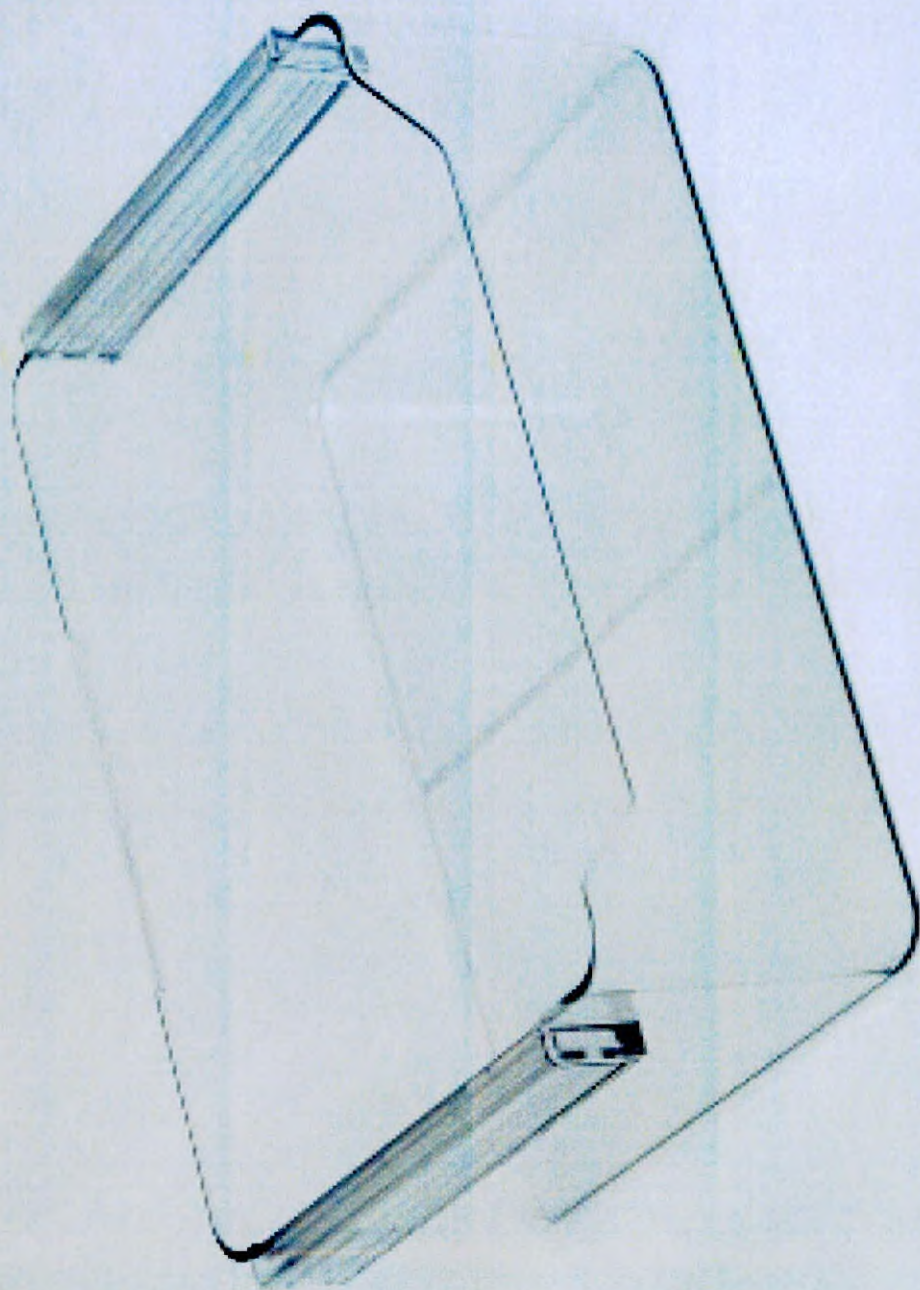


27. Вставка для компрессионной сдвигающейся пластины 18 x 24 см с высоким краем, не более 5 шт.

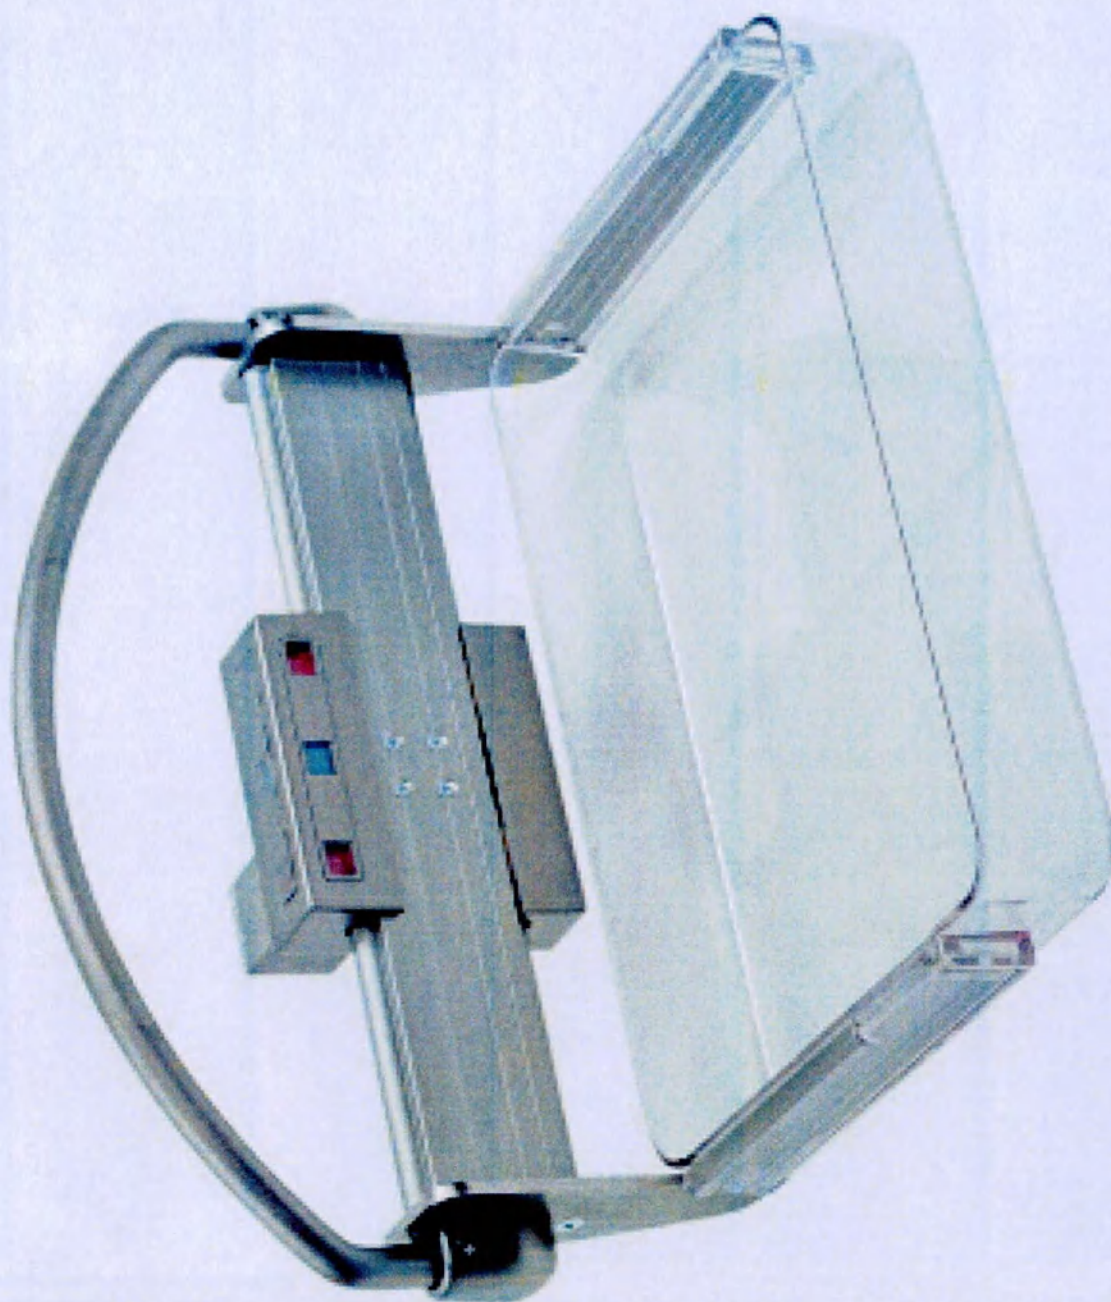


28. Пластина компрессионная сдвигающаяся 18 x 24 см с низким краем.




29. Вставка для компрессионной сдвигающейся пластины 18 x 24 см с низким краем, не более 5 шт.

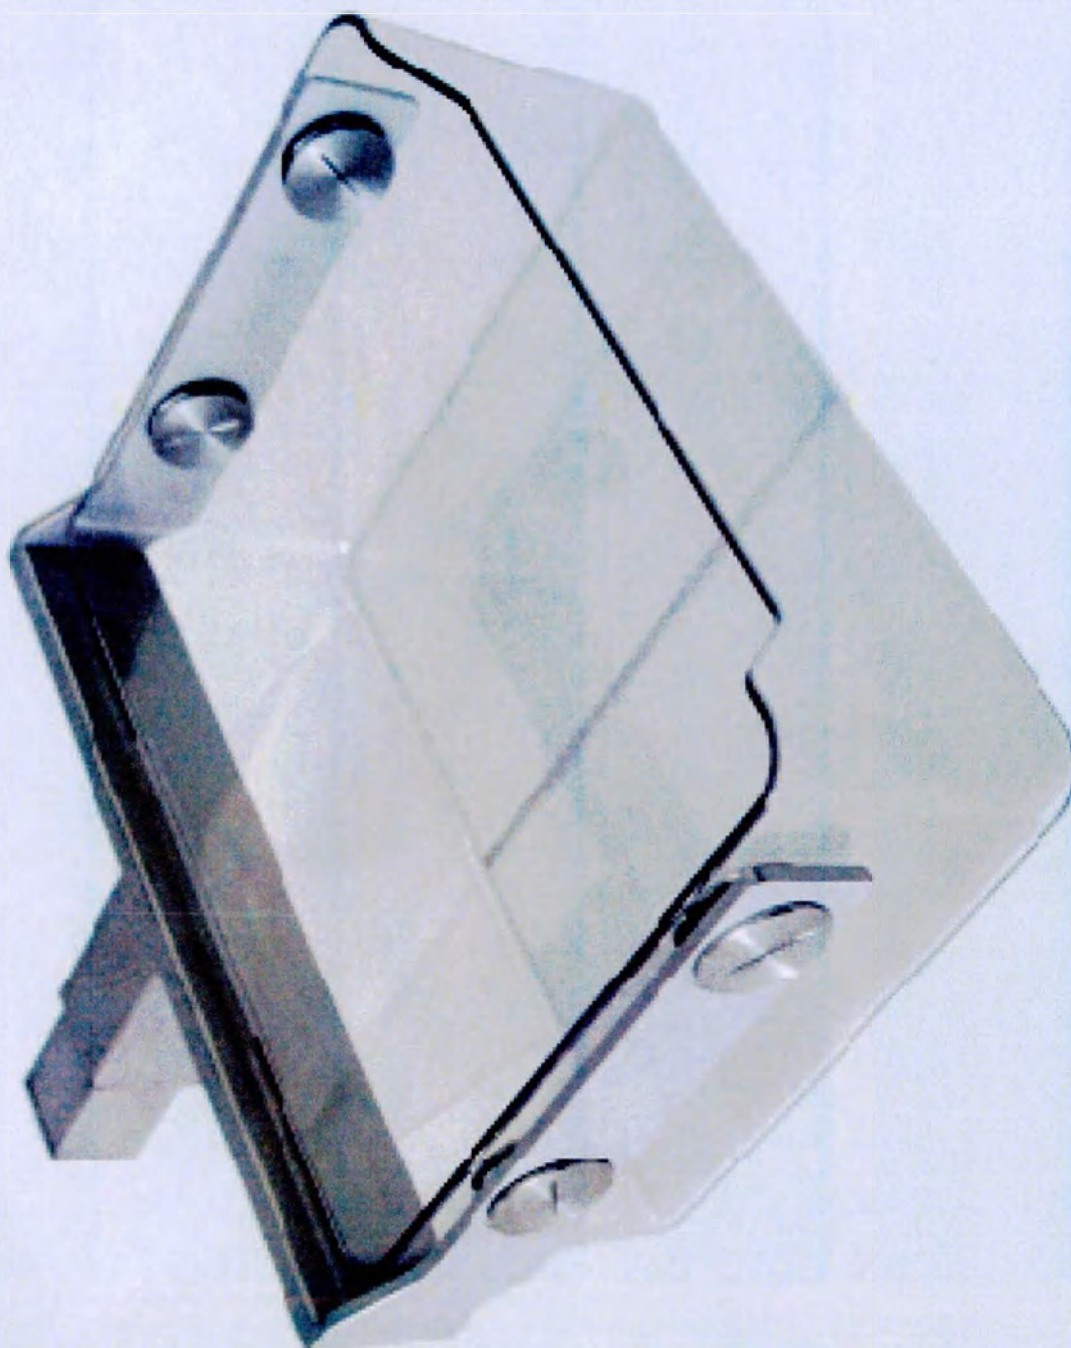


30. Пластина компрессионная гибкая 18x24 см, высота края 7 см.

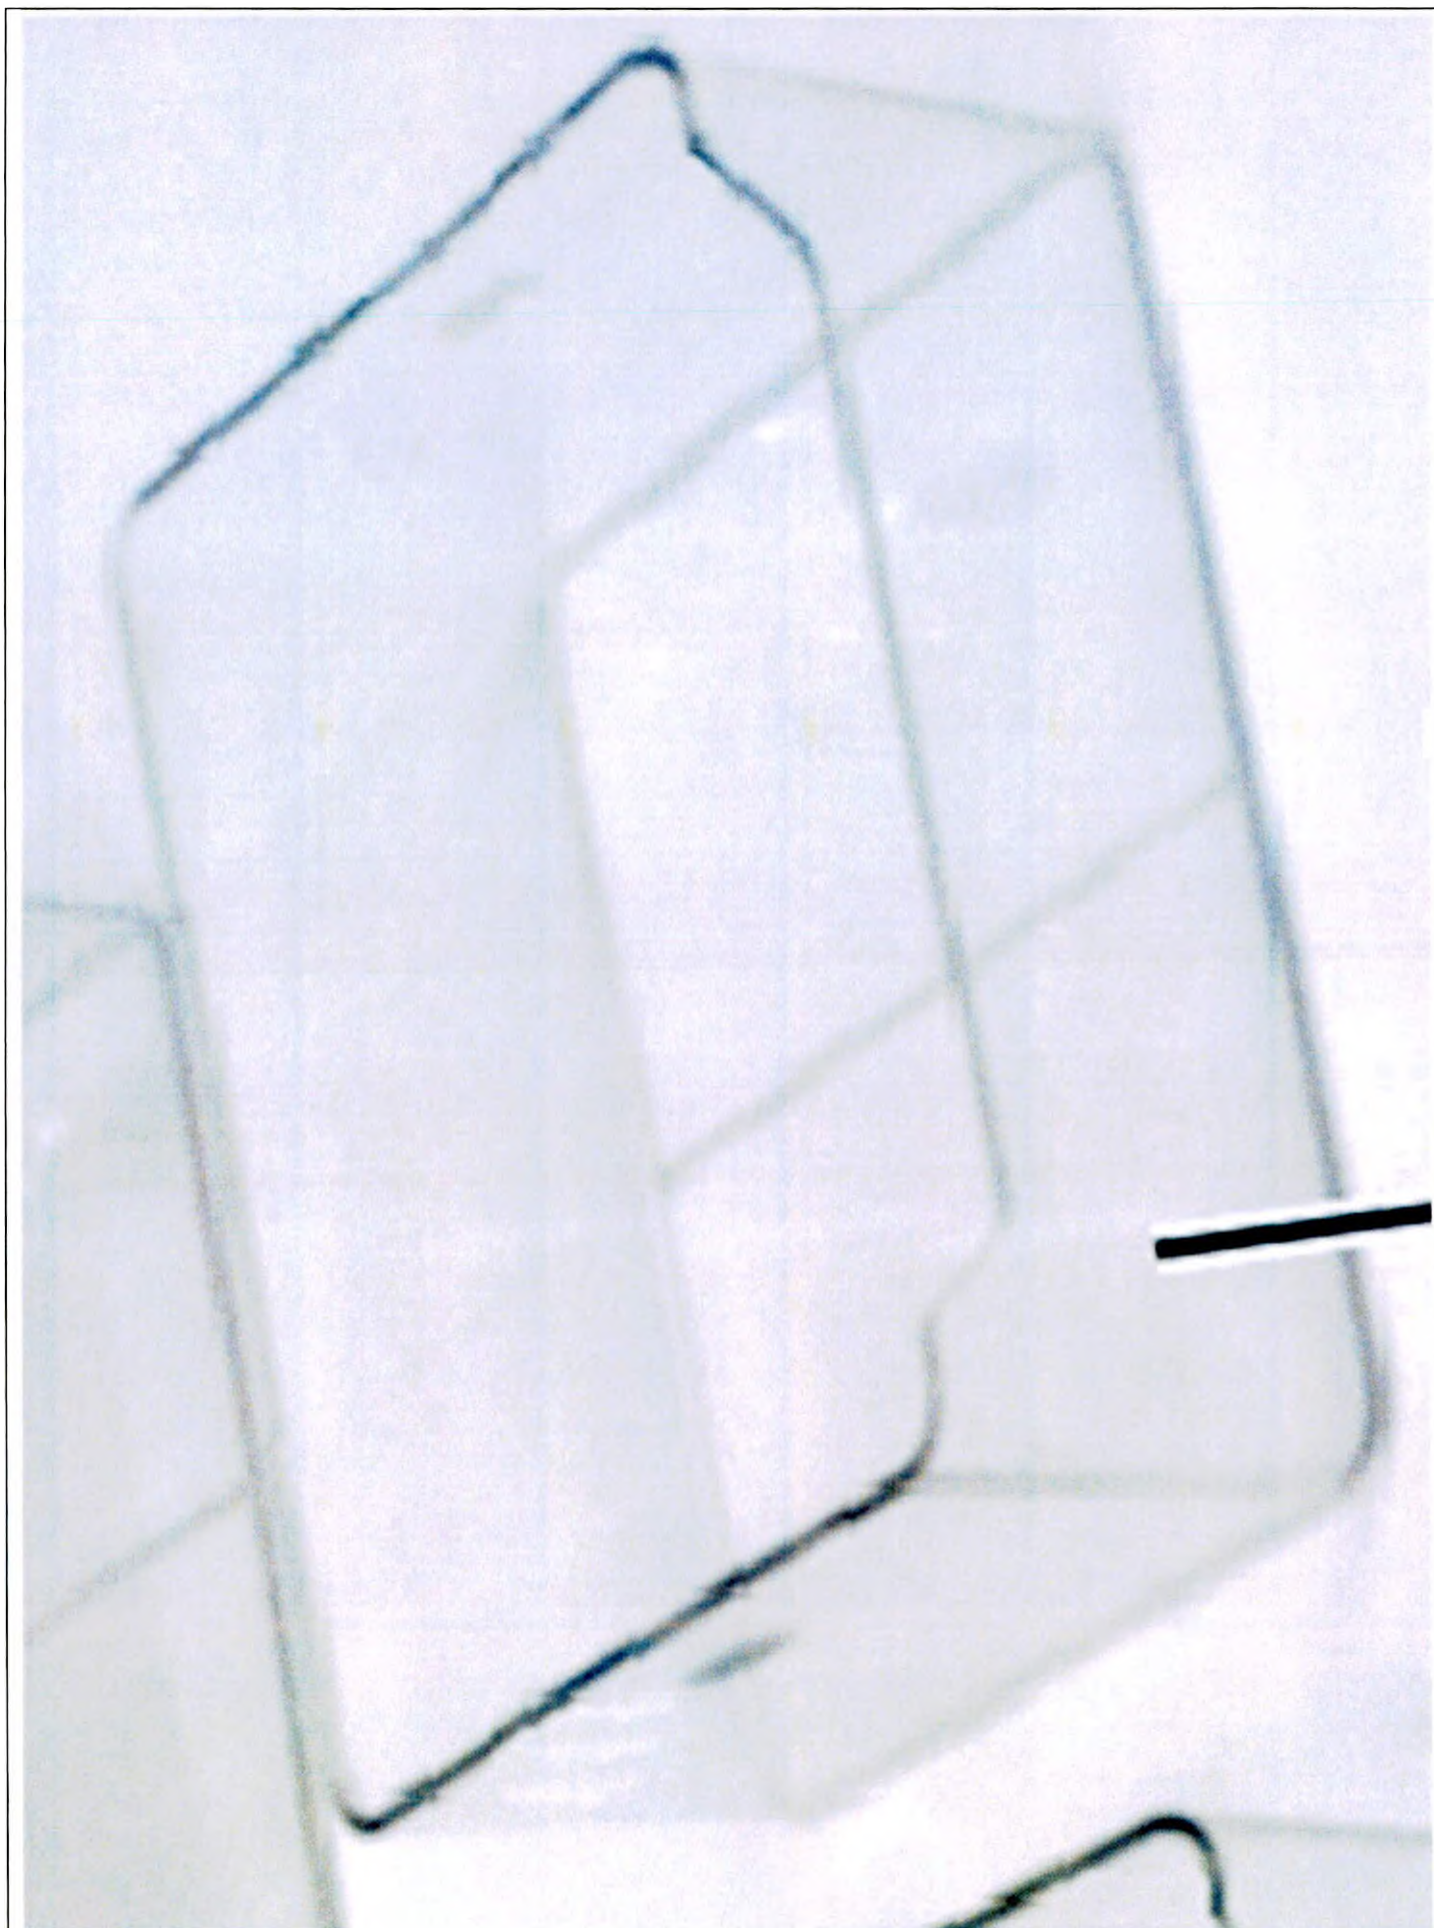


31. Вставка для компрессионной пластины гибкой 18х24 см, с высоким краем (не более 5 шт.).

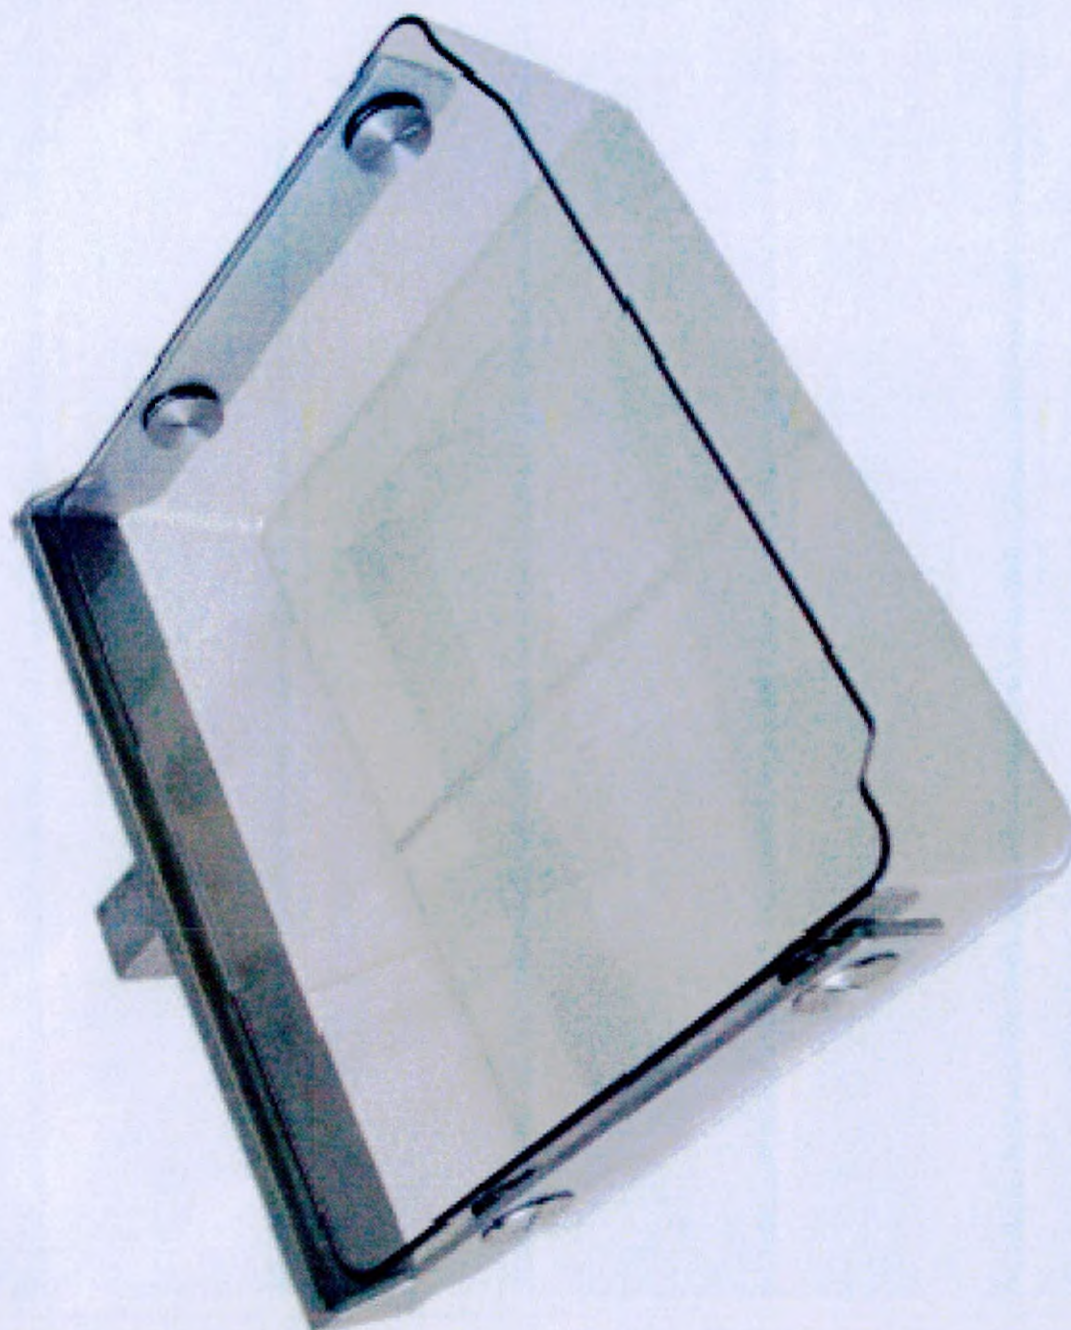


32. Пластина компрессионная гибкая 24x30 см, высота края 7 см.

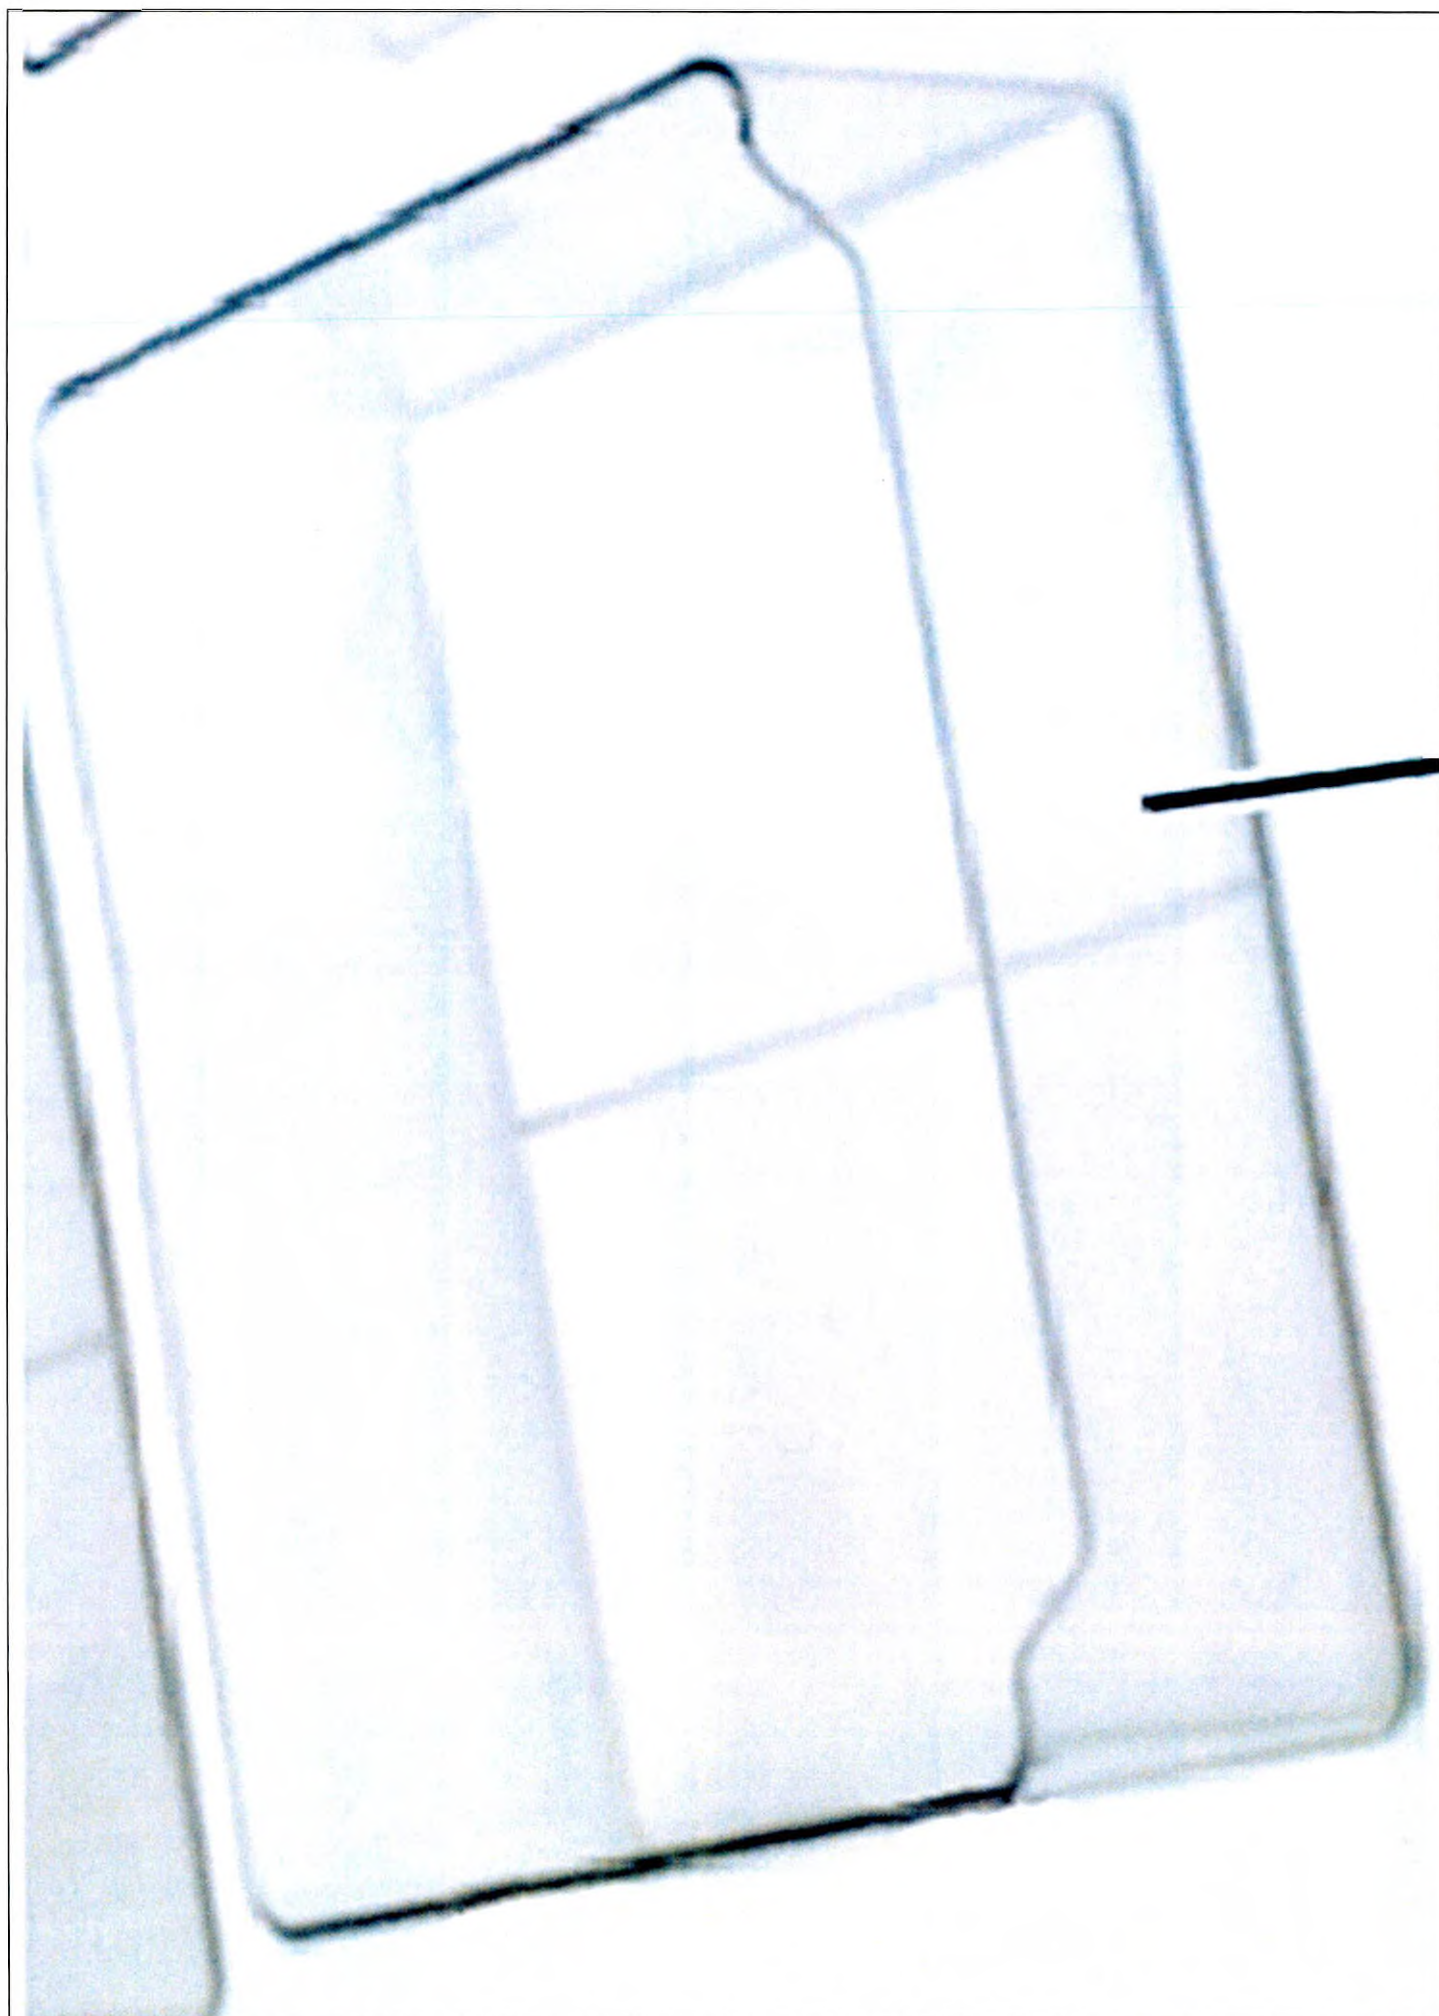


33. Вставка для компрессионной пластины гибкой 24х30 см, с высоким краем (не более 5 шт.).

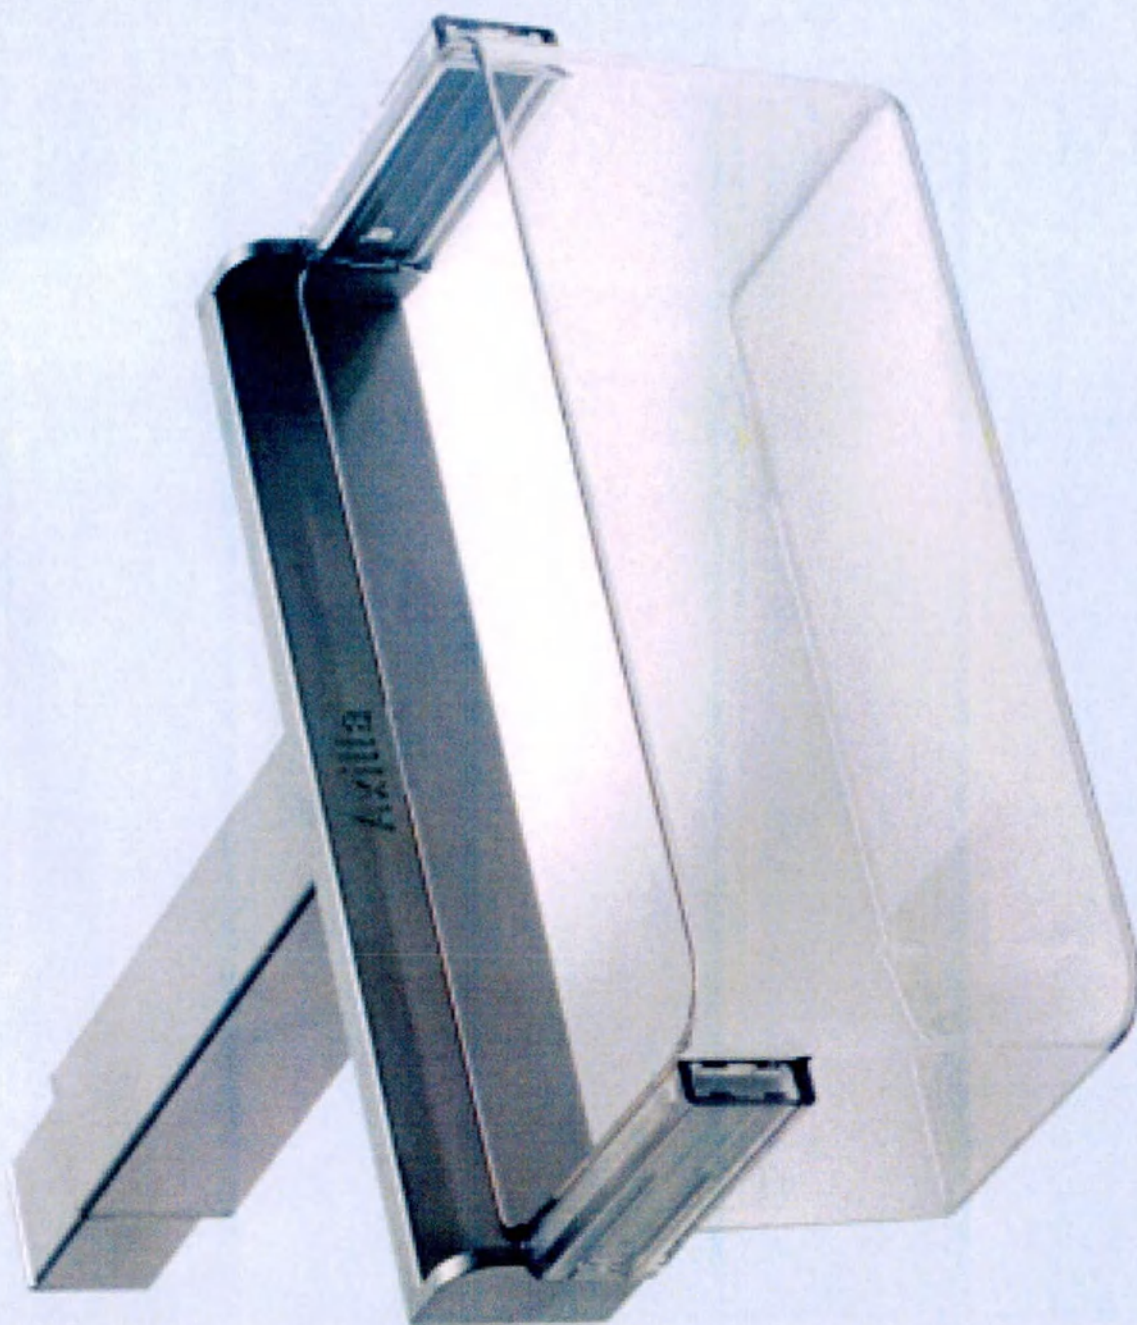


34. Пластина компрессионная для аксиллярных проекций 8x20 см, не более 5 шт.

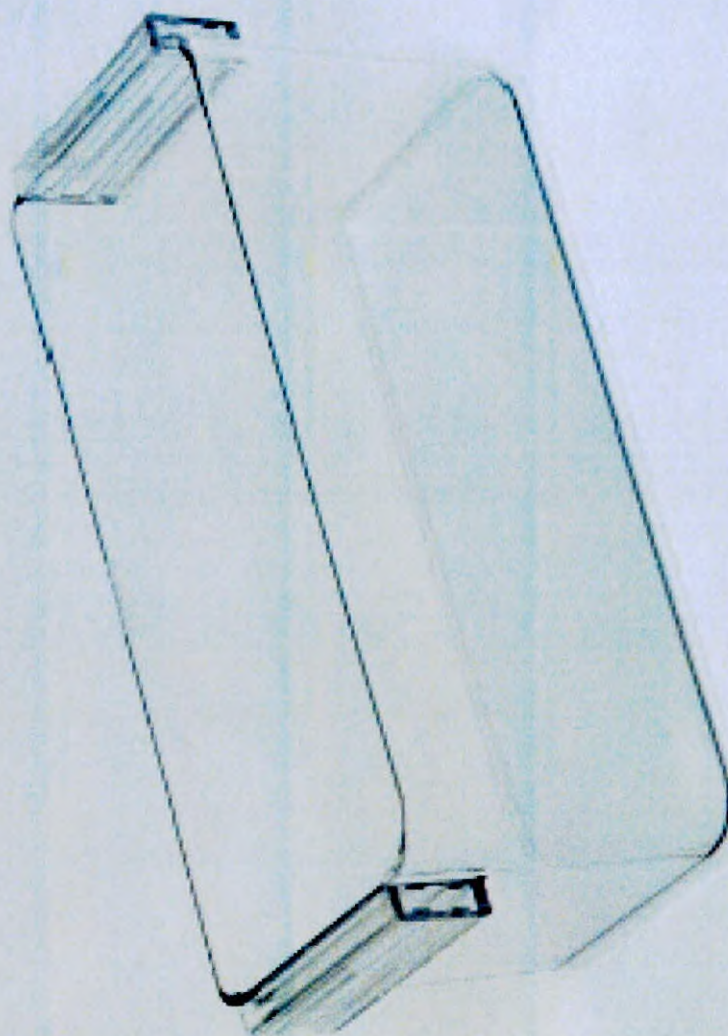


35. Вставка для компрессионной пластины для аксиллярных проекций 8x20 см, не более 5 шт.

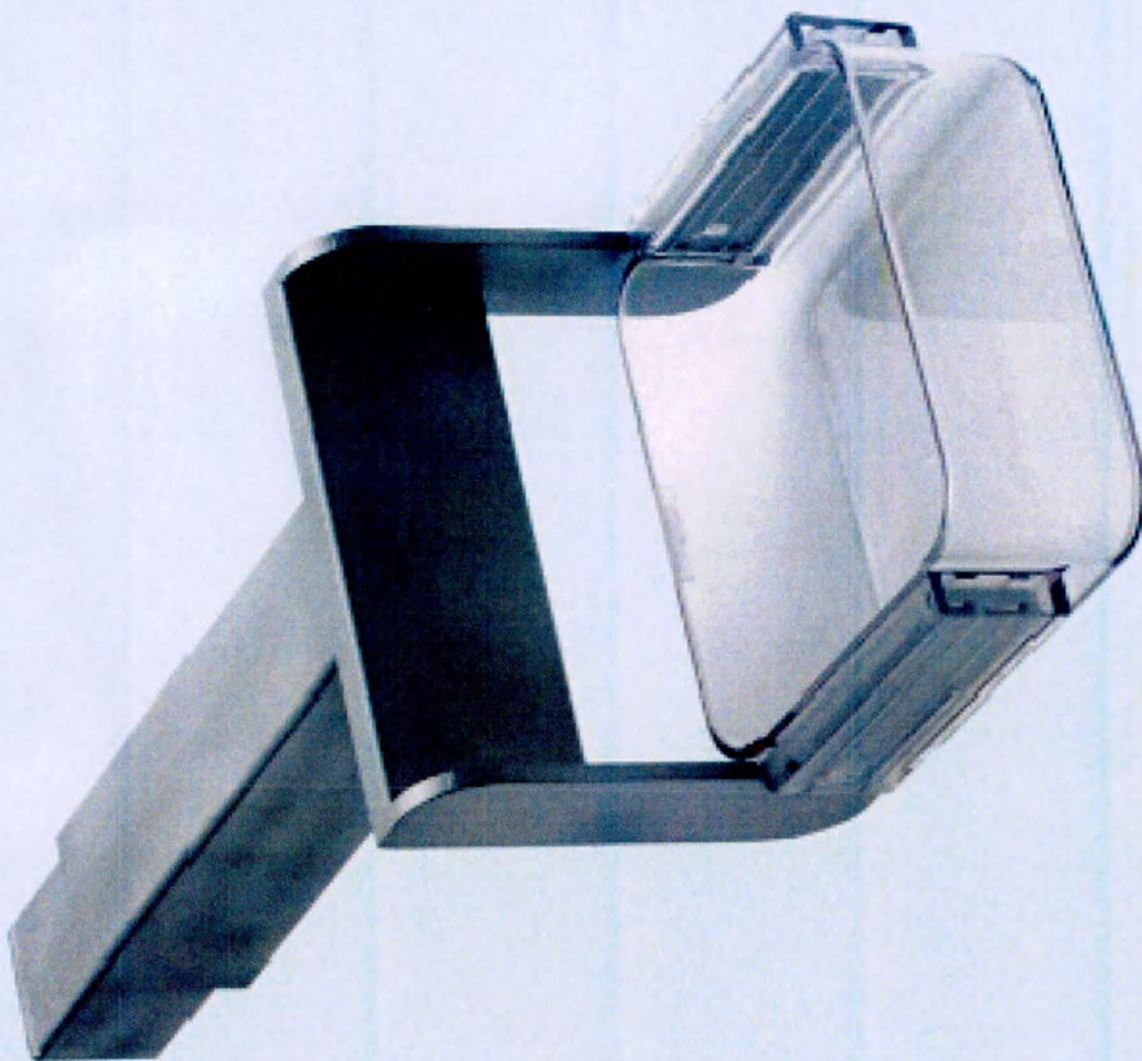


36. Пластина компрессионная для прицельных снимков 9х9 см.

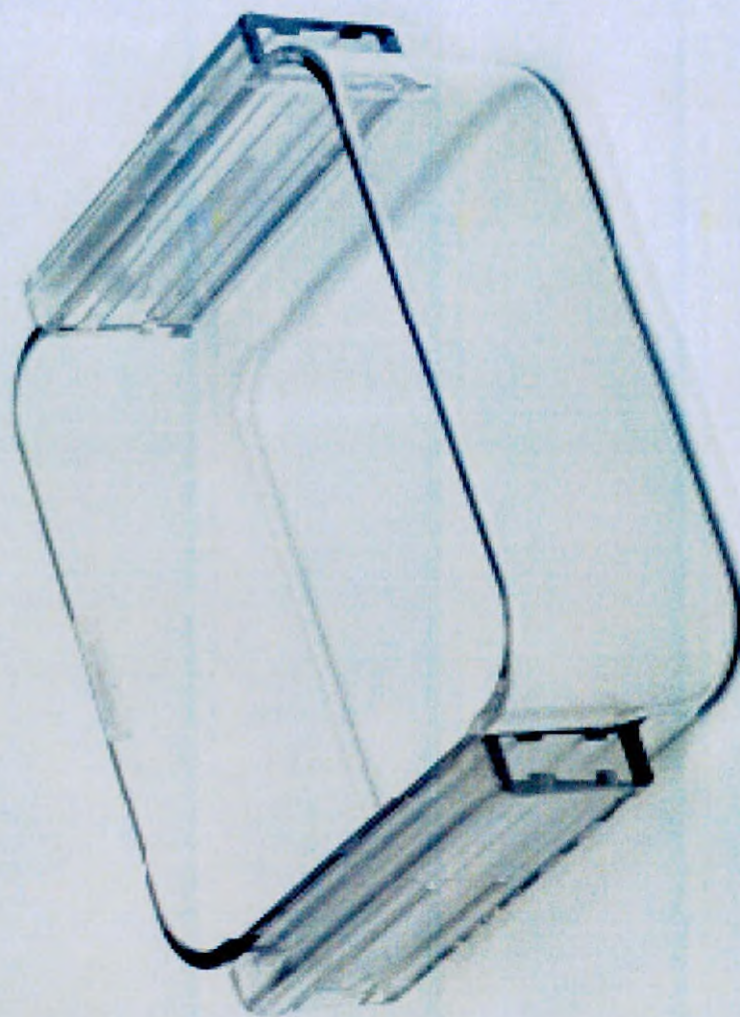

37. Вставка для компрессионной пластины для прицельных снимков 9х9 см, не более 5 шт.

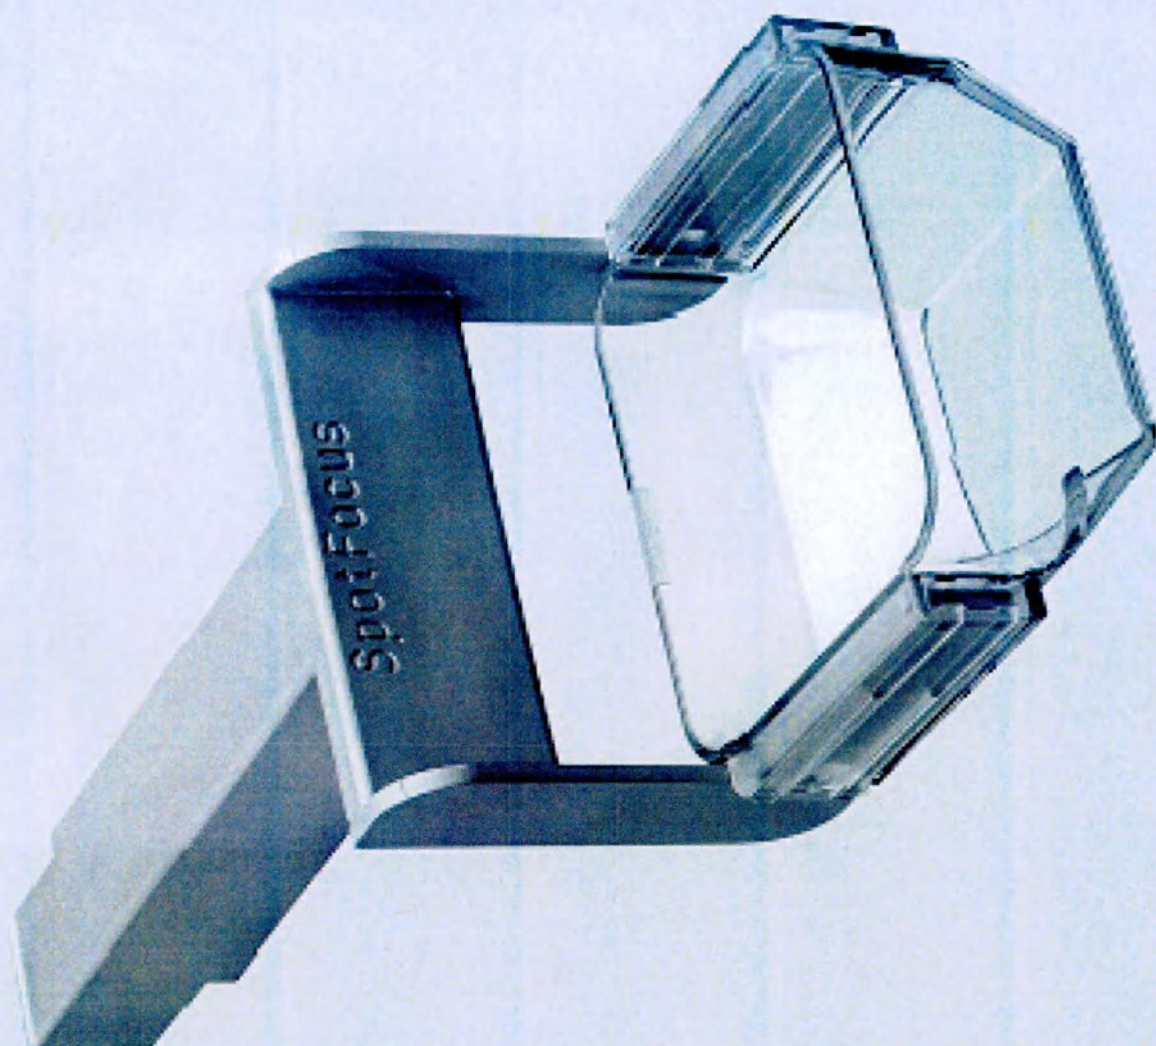

38. Пластина компрессионная для прицельных снимков 6х6 см.

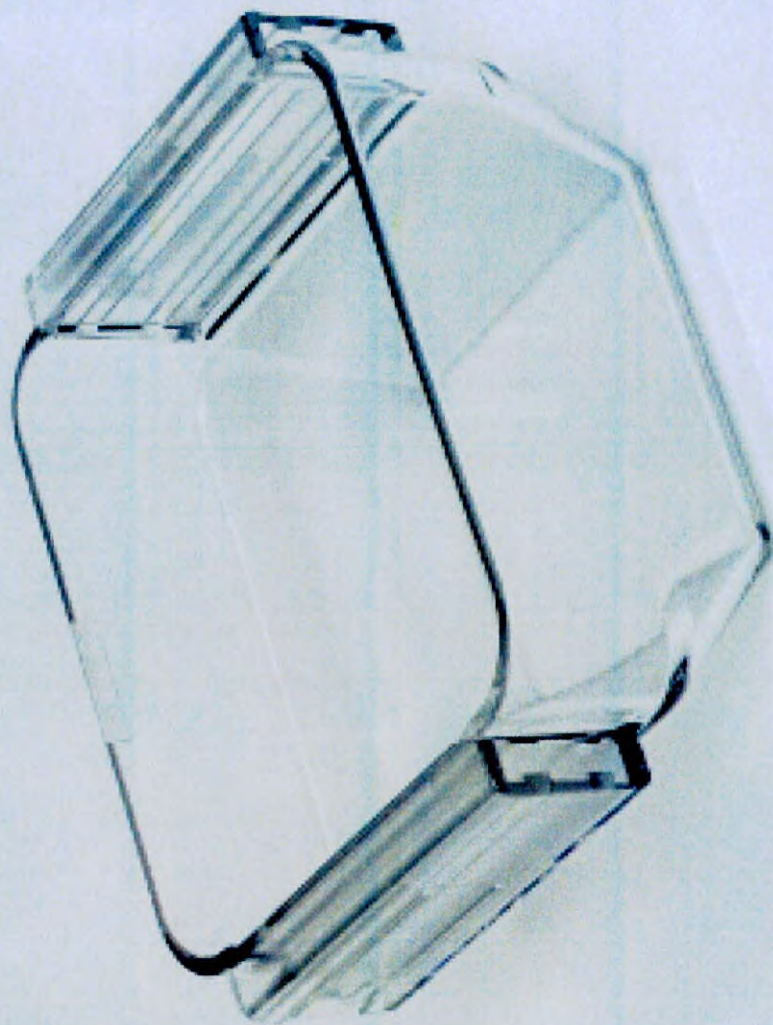


39. Вставка для компрессионной пластины для прицельных снимков 6х6 см, не более 5 шт.




40. Выключатель экспозиции ножной.




41. Выключатель экспозиции ручной.

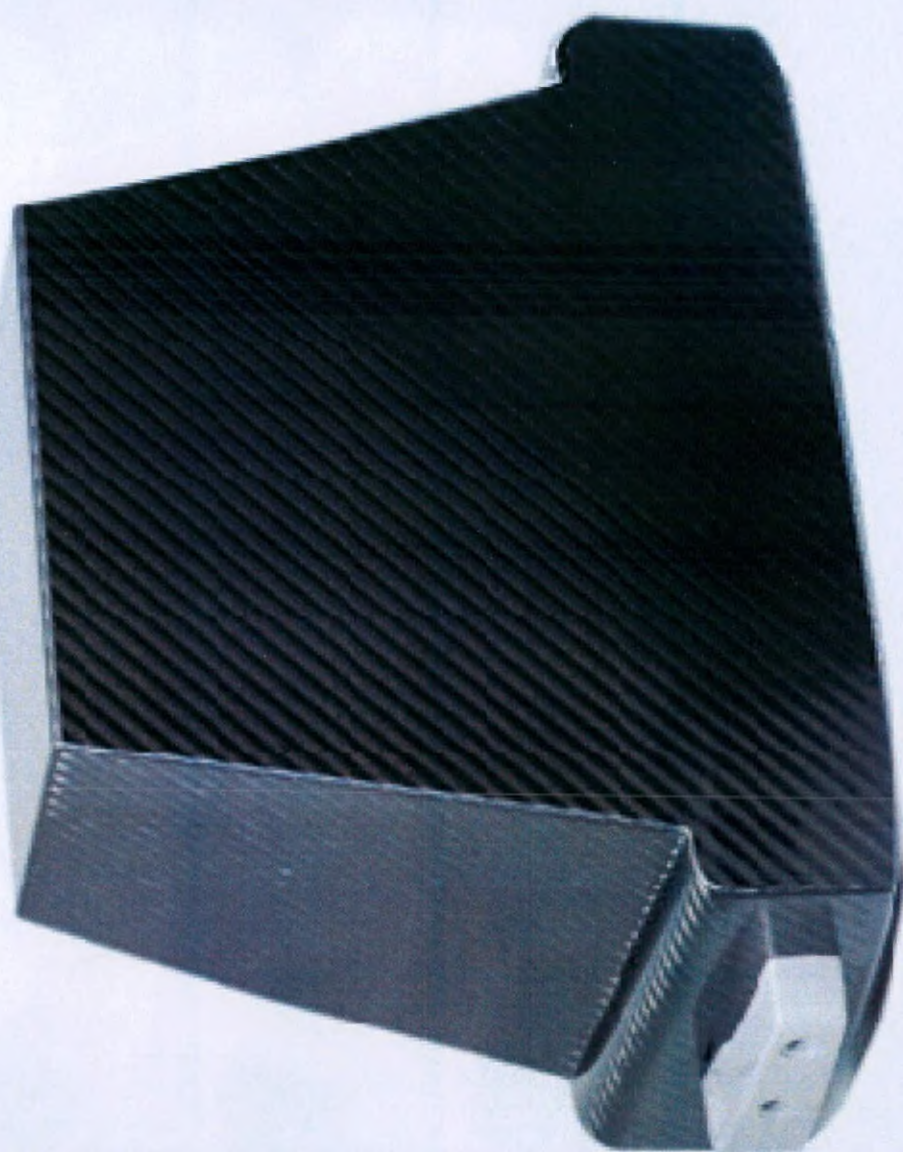

42. Столик увеличительный 1,8.

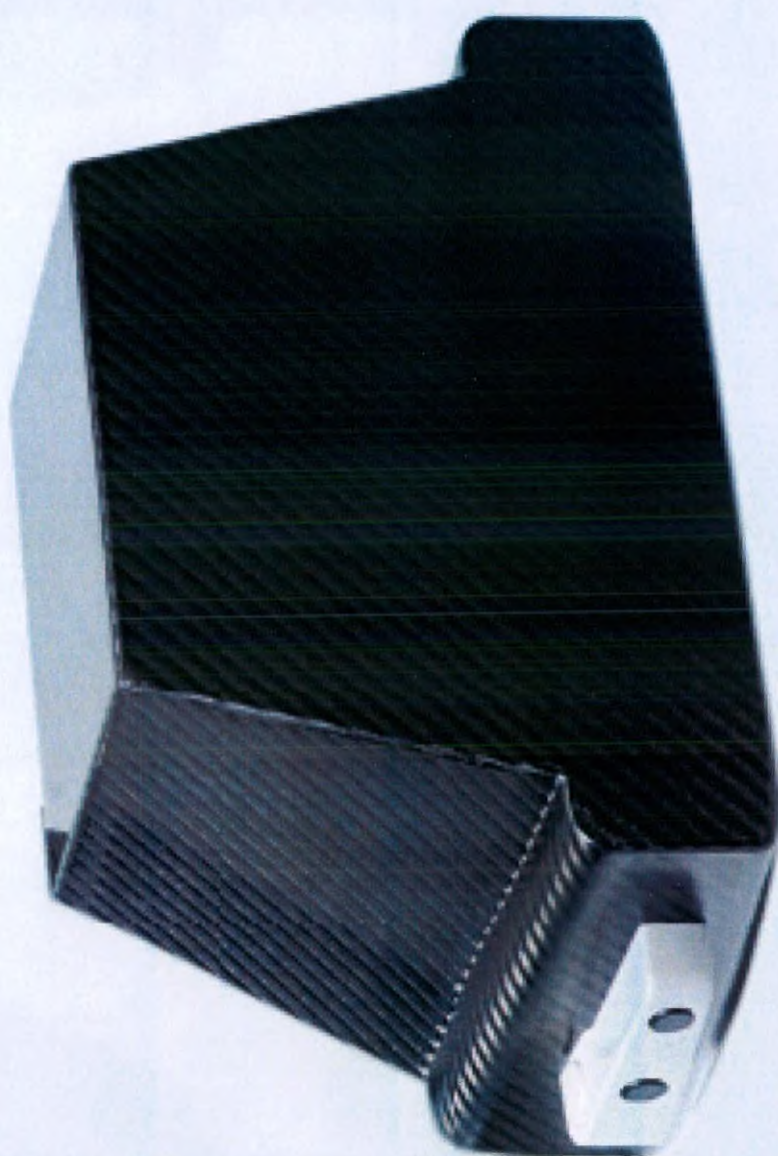

43. Столик увеличительный 1,5.

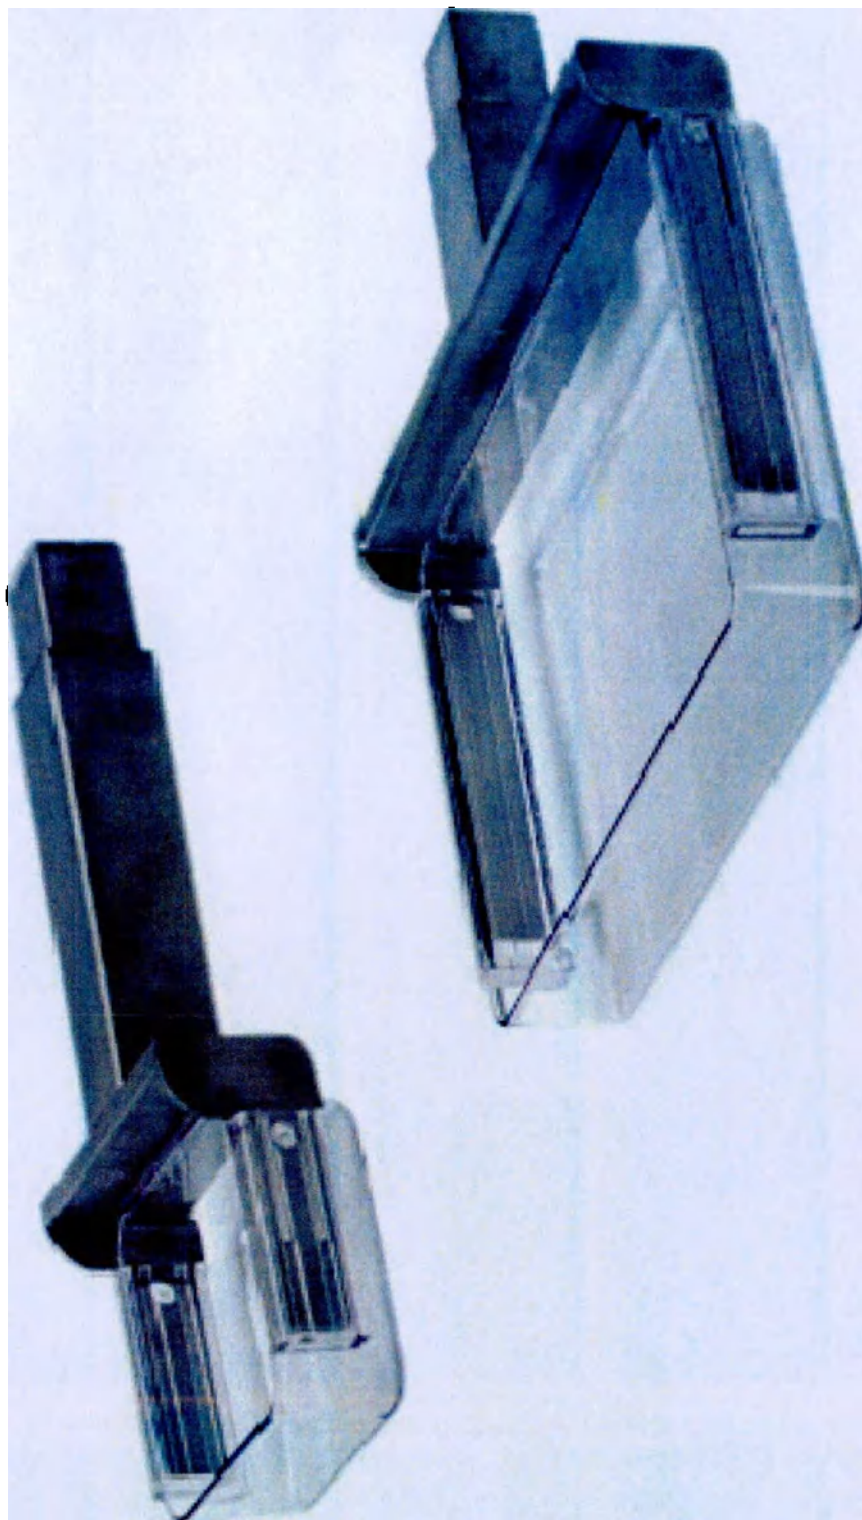


44. Набор компрессионных пластин, в составе (2 шт. в наборе):

- Пластина компрессионная для съемки с увеличением 16х20 см;
- Пластина компрессионная для прицельной съемки с увеличением 9х9 см.




45. Вставка для компрессионной пластины для съемки с увеличением 9х9 см, не более 10 шт.

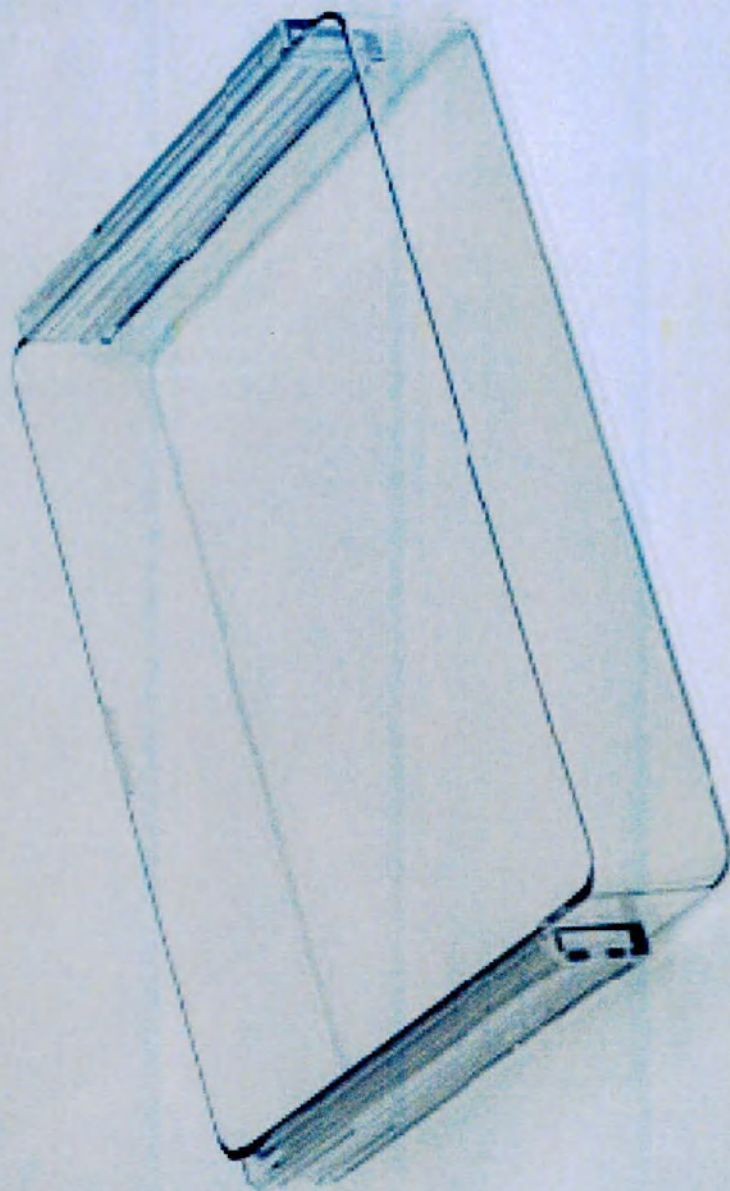


46. Вставка для компрессионной пластины для съемки с увеличением 16х20 см, не более 10 шт.



47. Пластина компрессионная для прицельной съемки с увеличением 6х6 см.

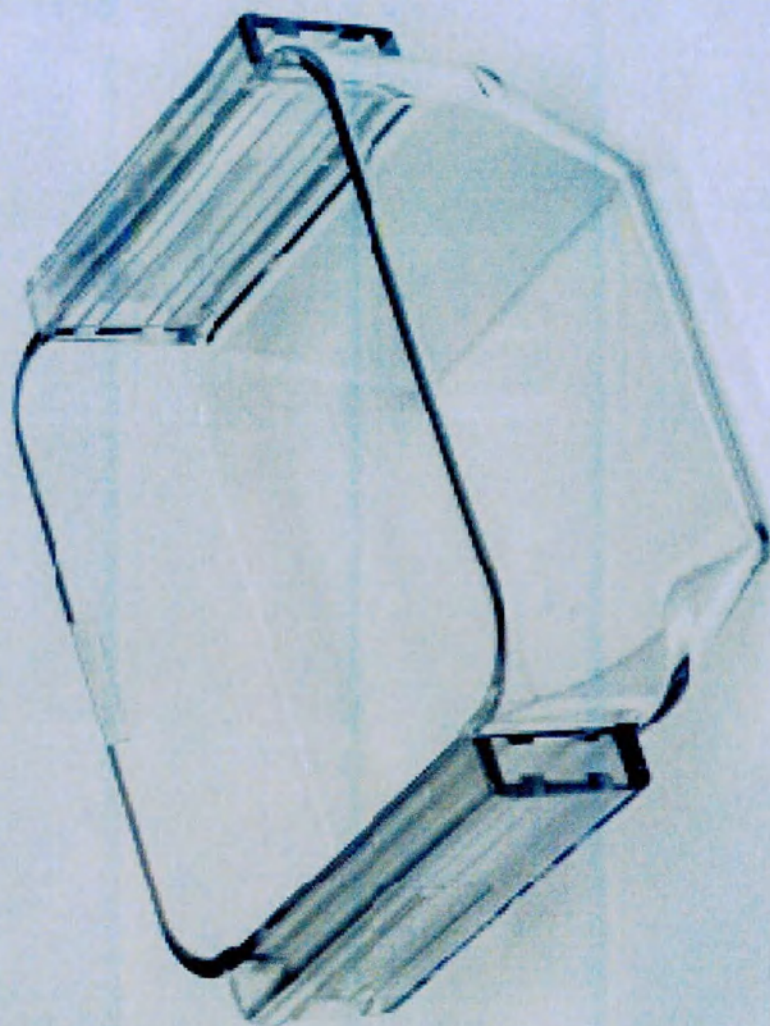



48. Вставка для компрессионной пластины для прицельной съемки 6х6, не более 10 шт.

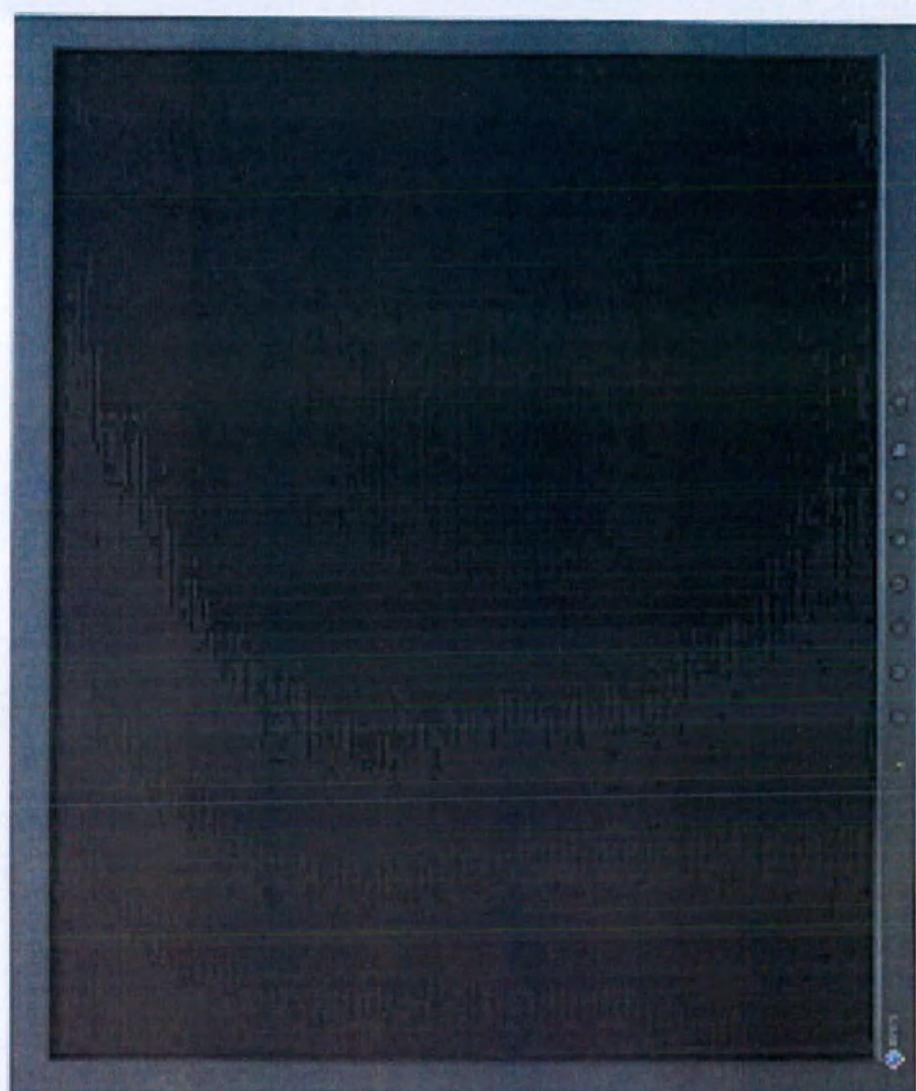


49. Монитор.




50. Монитор специальный высокого разрешения.

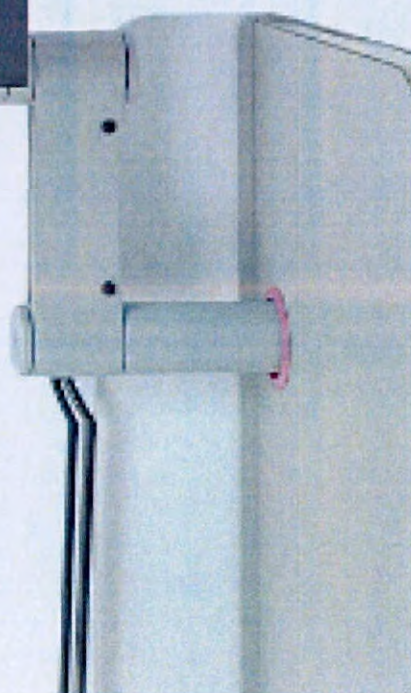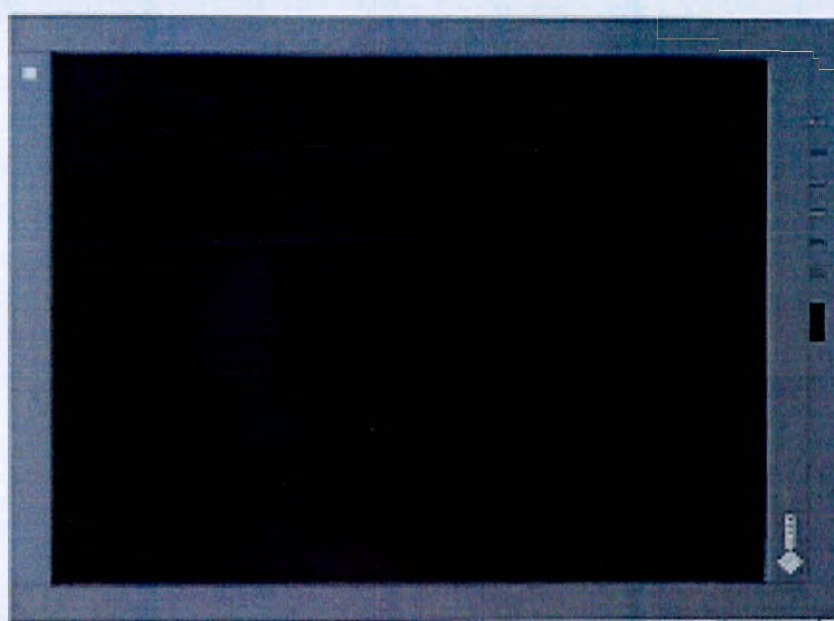


51. Монитор специальный дополнительный.

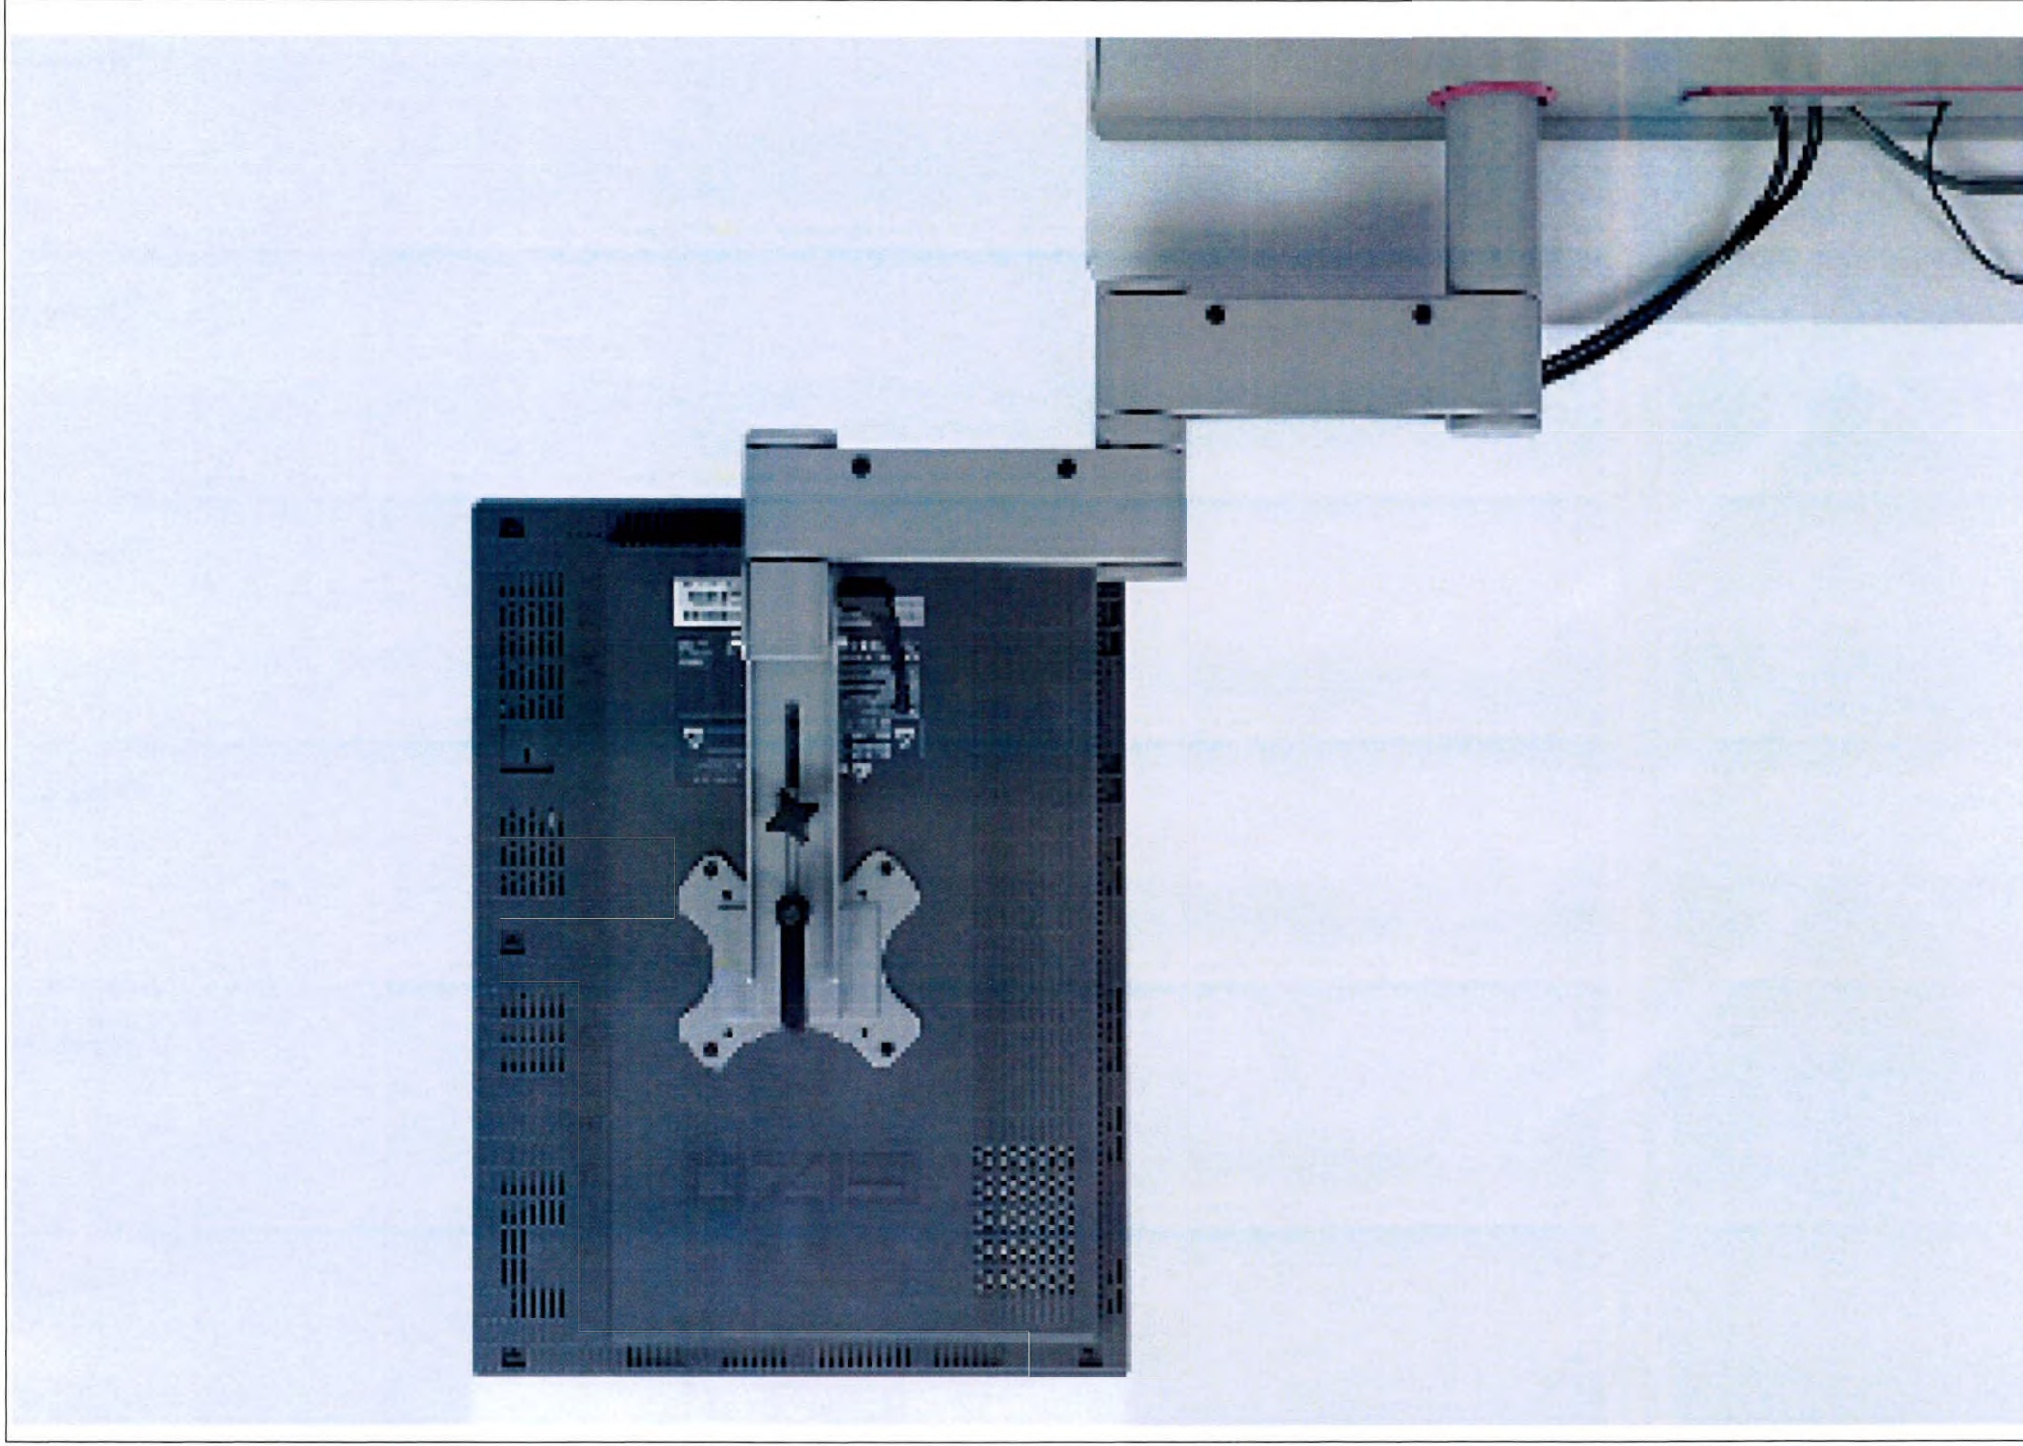


52. Держатель второго монитора.

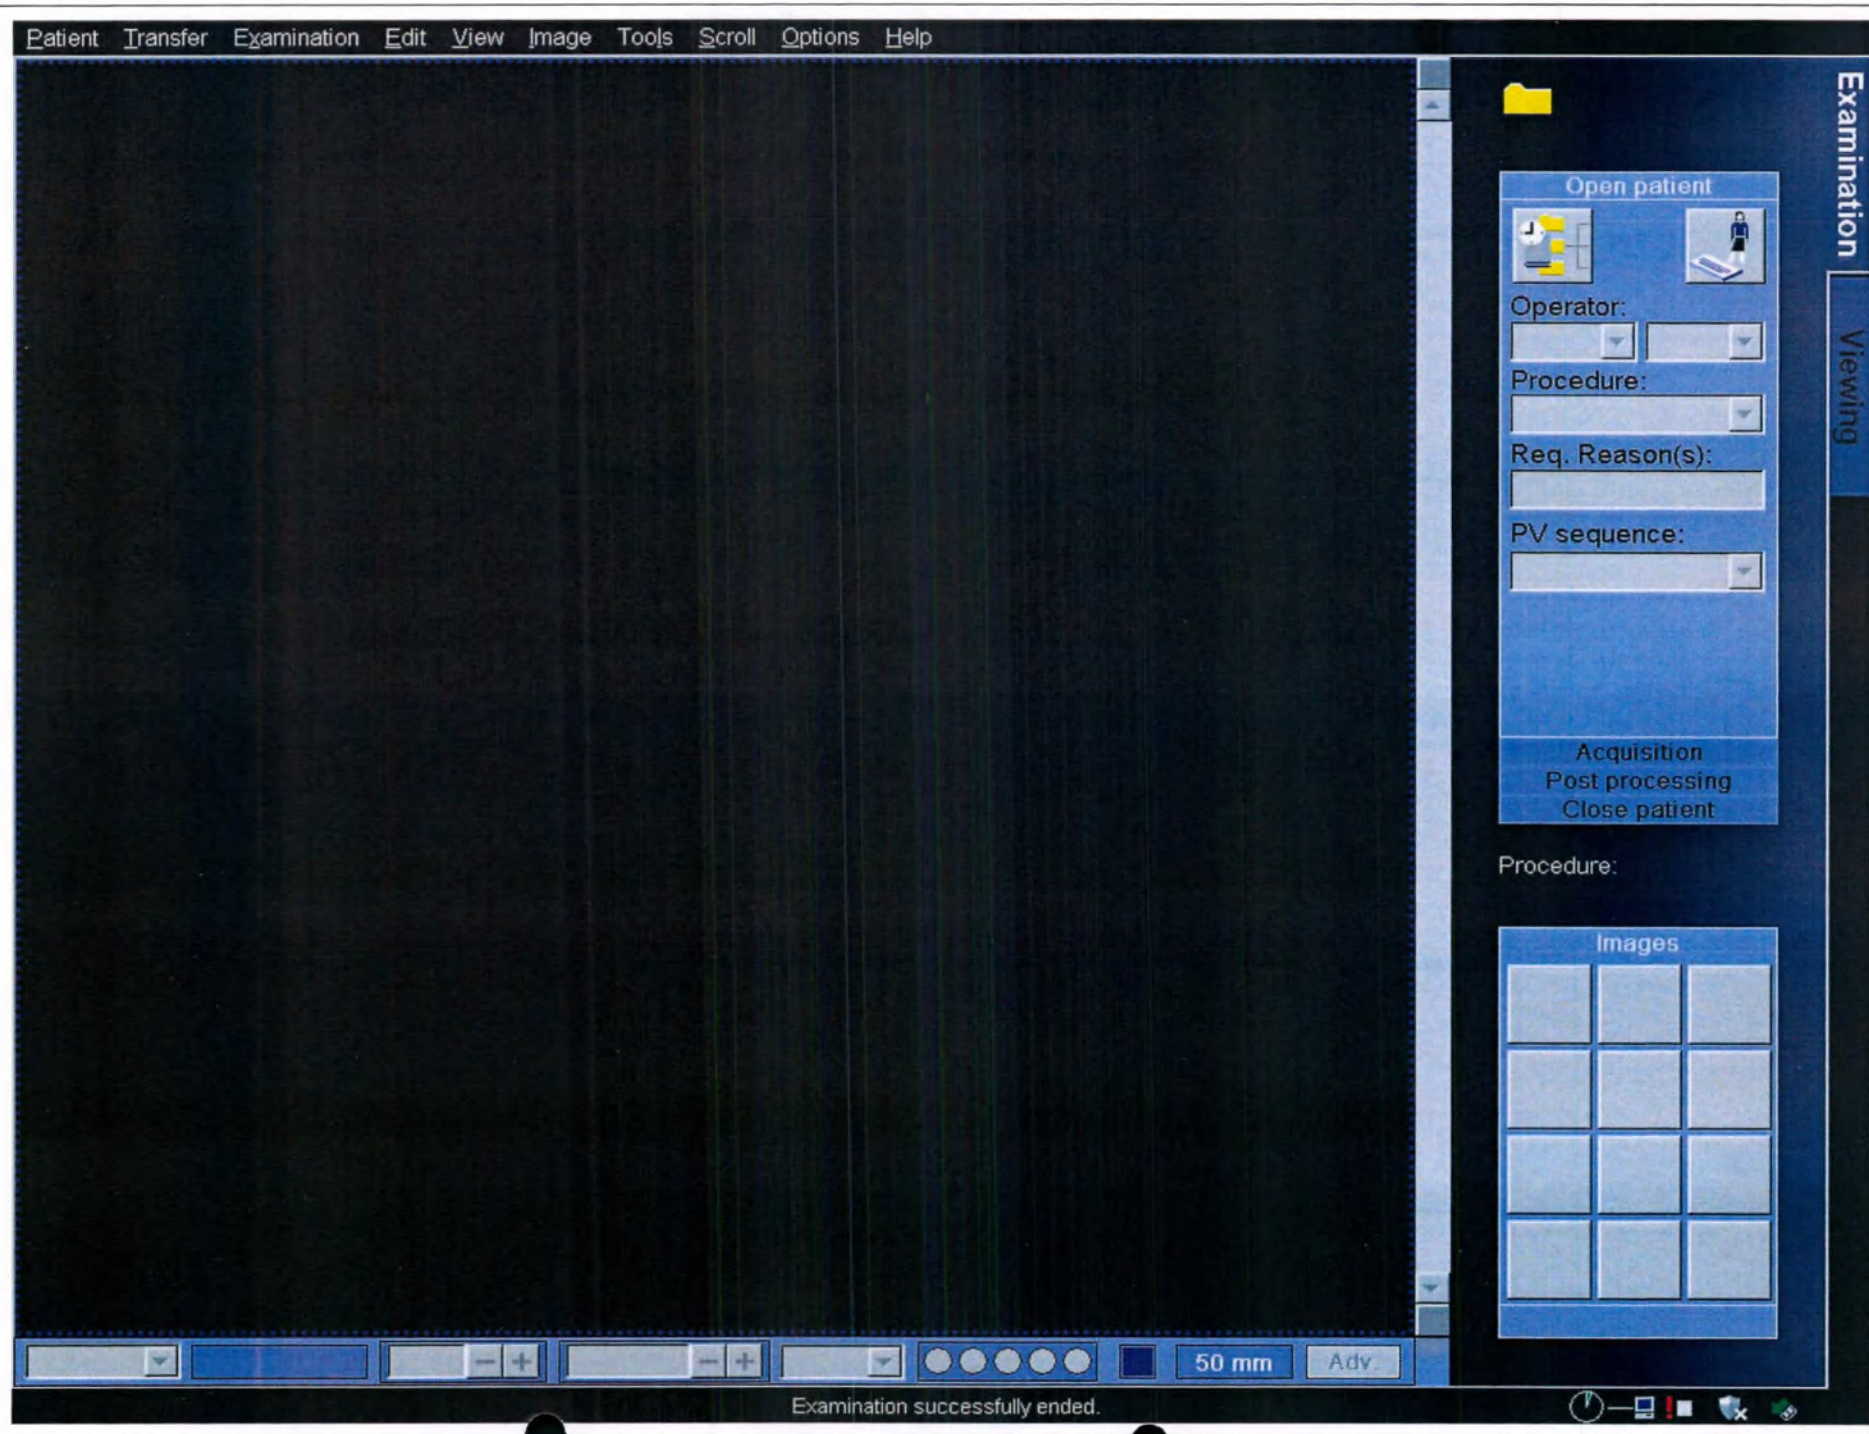

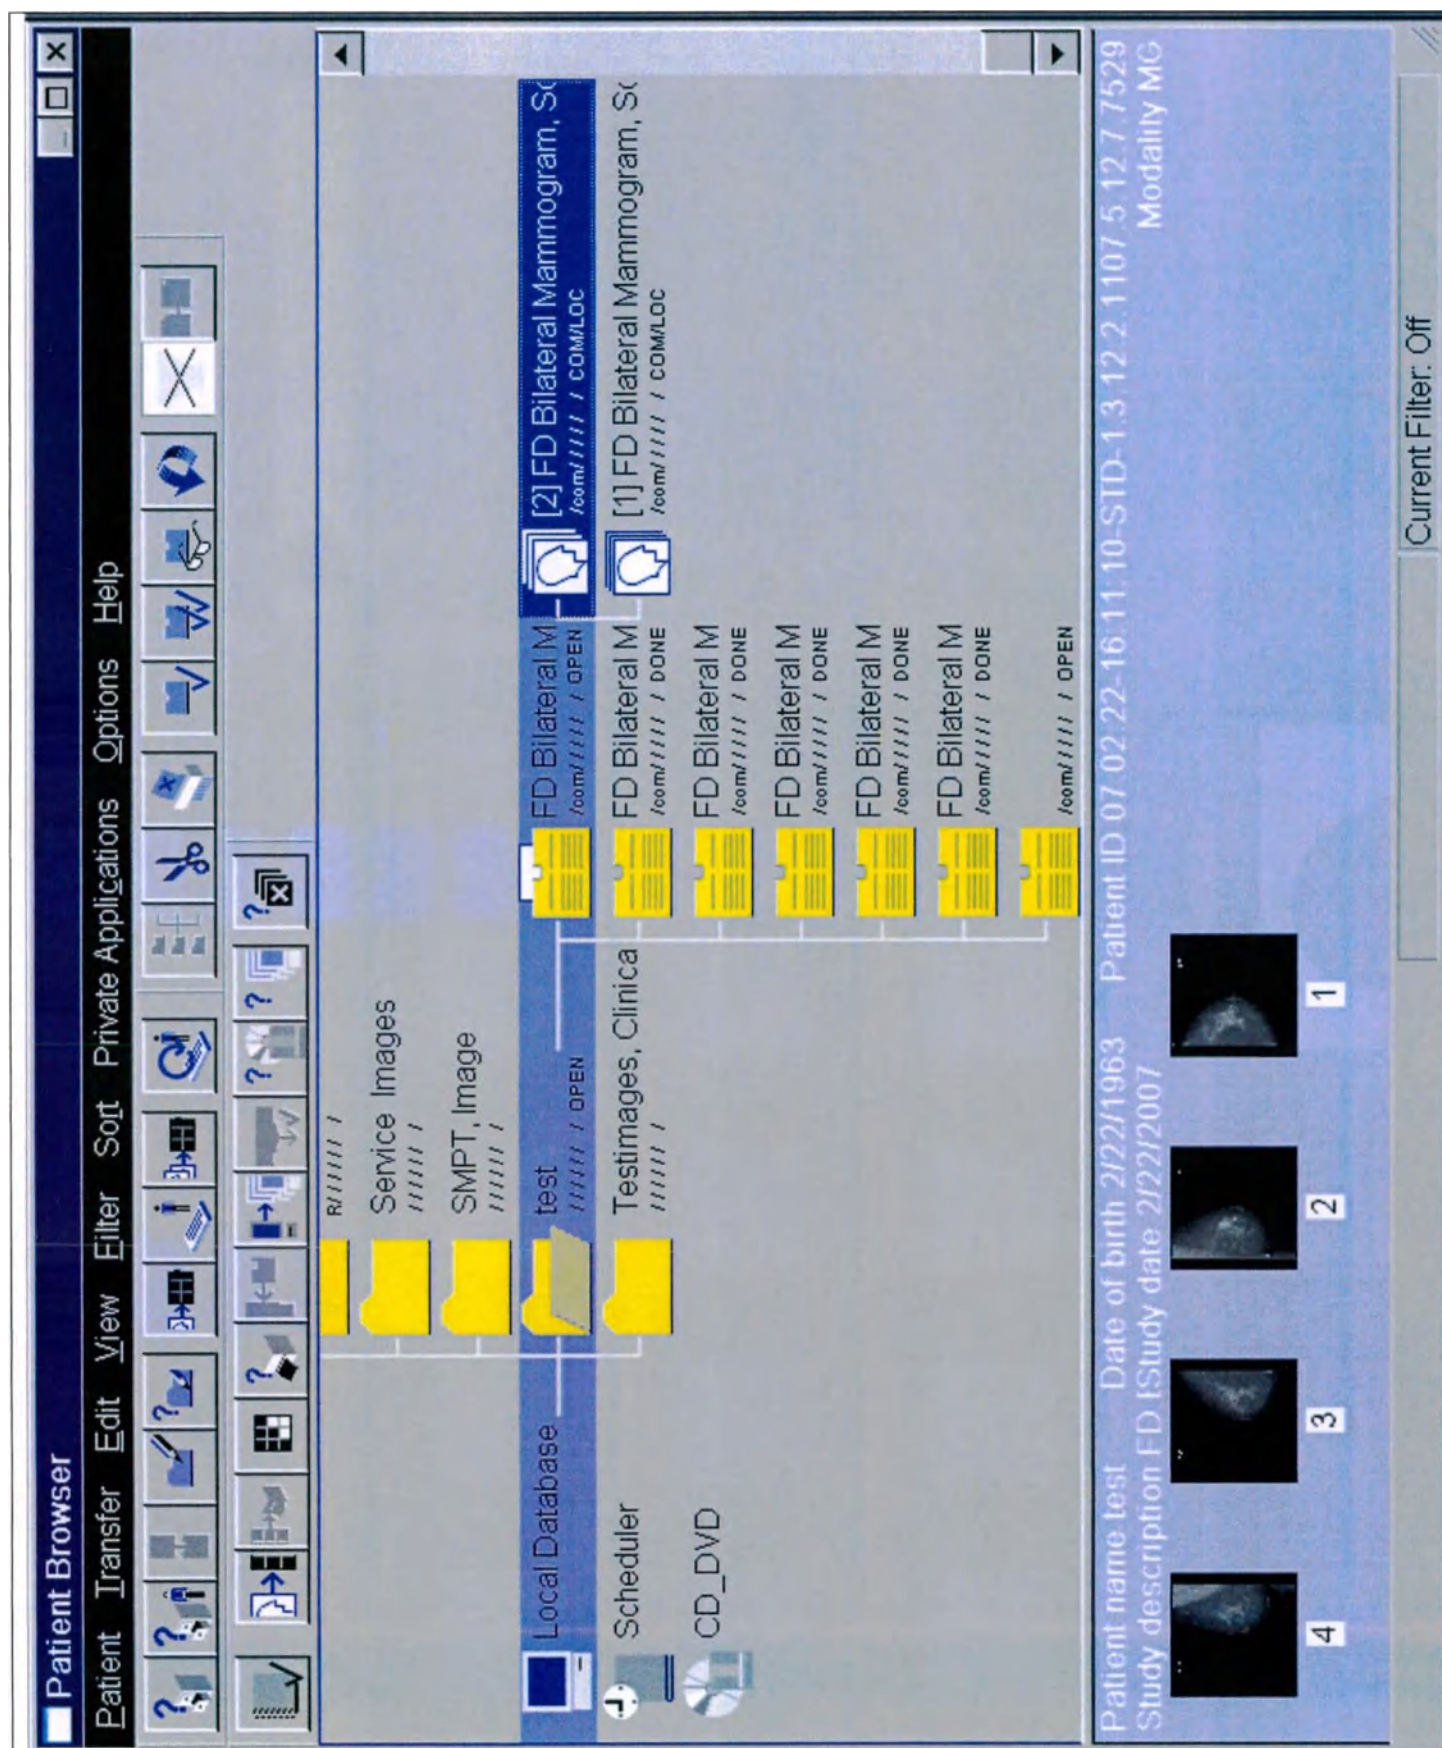

54. Программный режим (расширенный) подключения виртуальной машины к рабочей станции системы сбора данных.

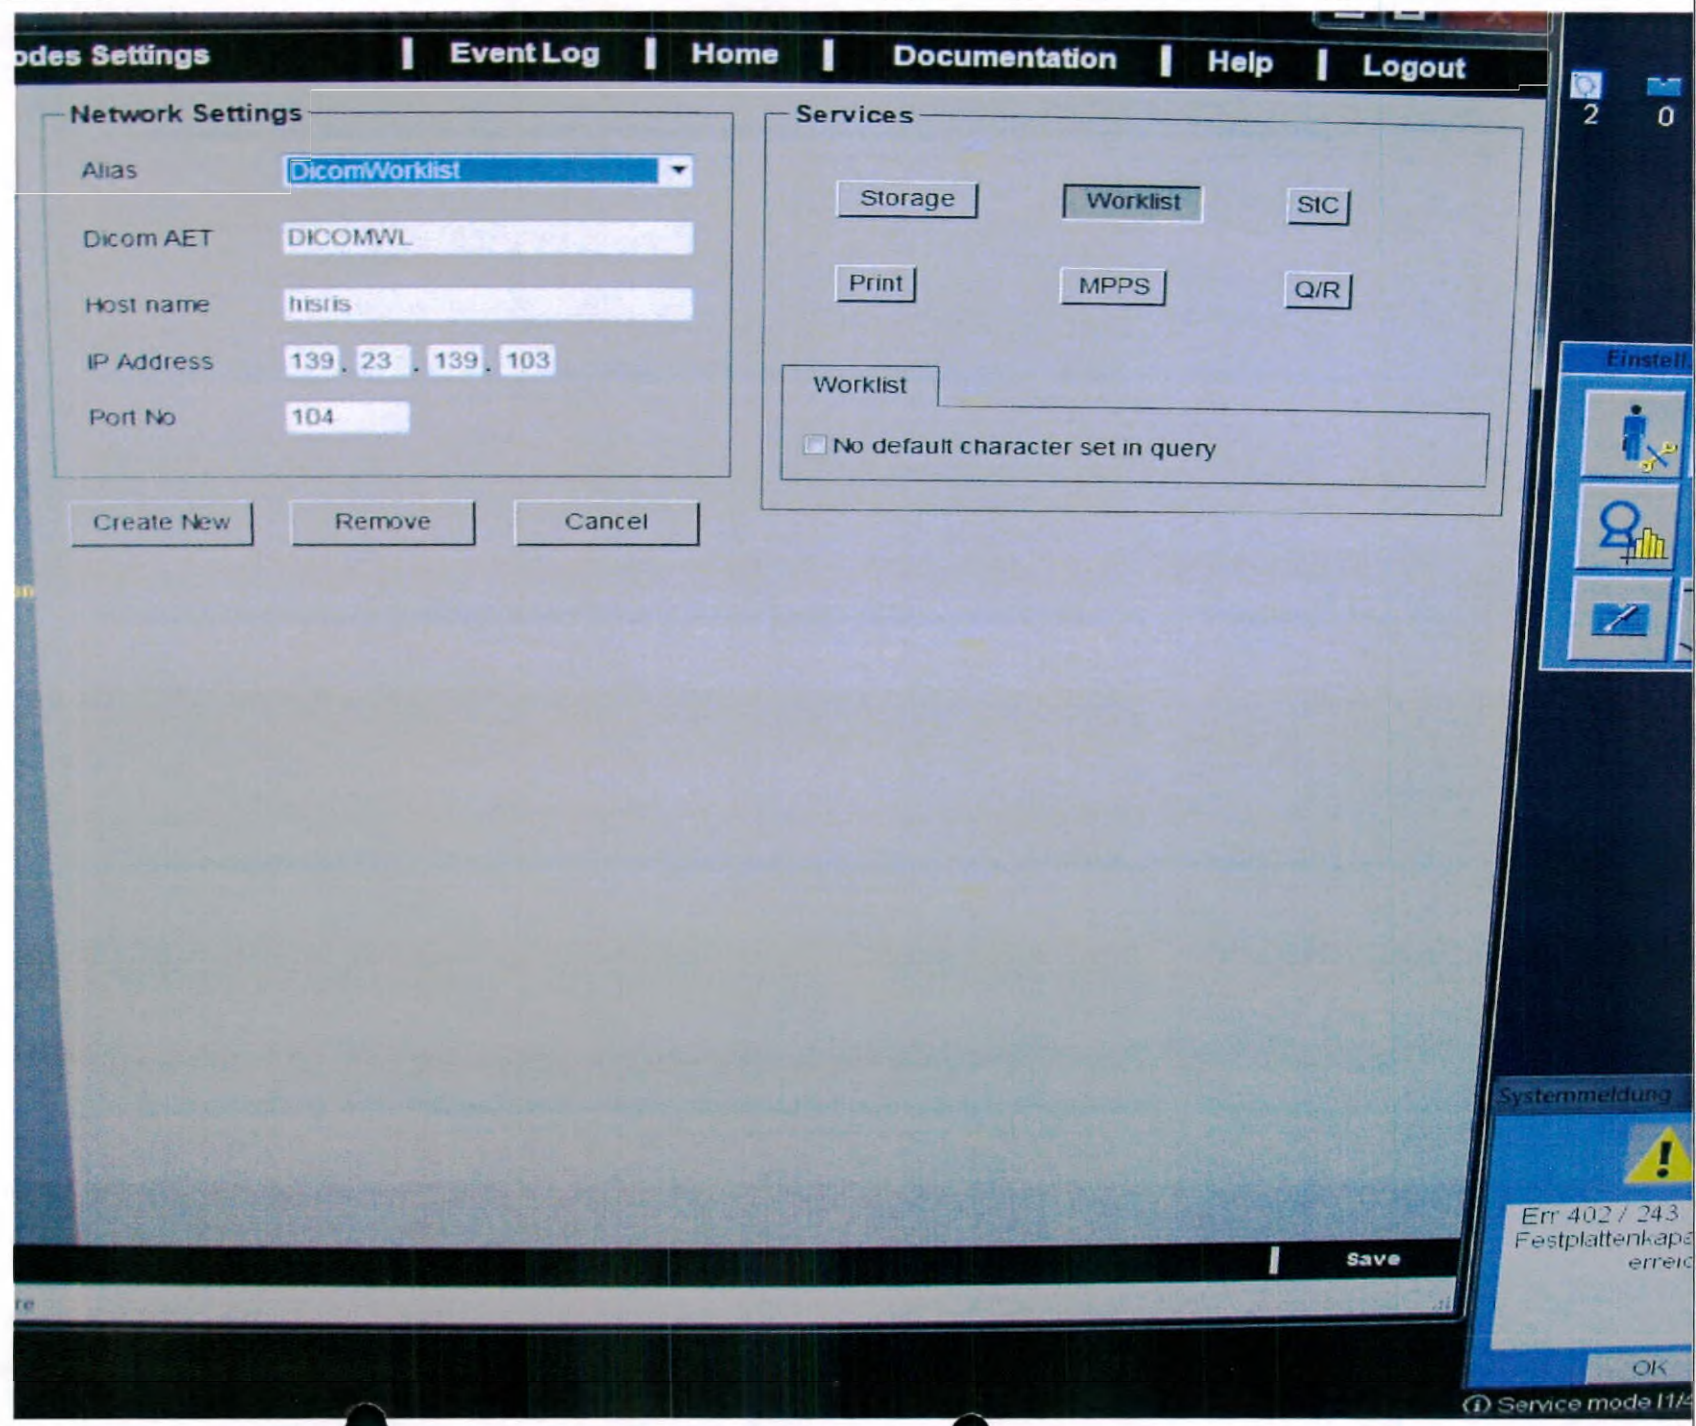




56. Держатель компрессионных пластин настенный, не более 5 шт.




57. Экран световой декоративный.



58. Экран рентгенозащитный.

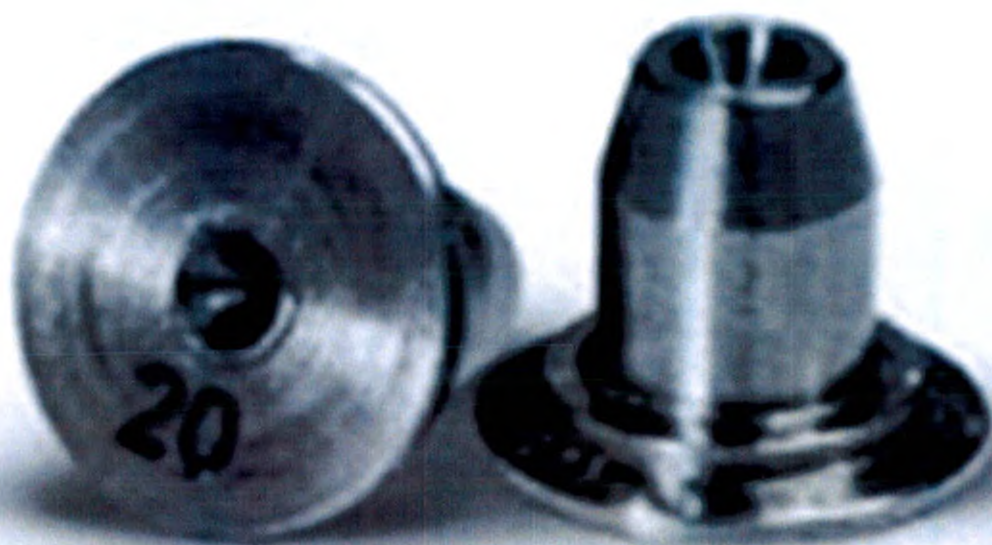



59. Втулки для биопсии многоразовые, не более 100 шт.

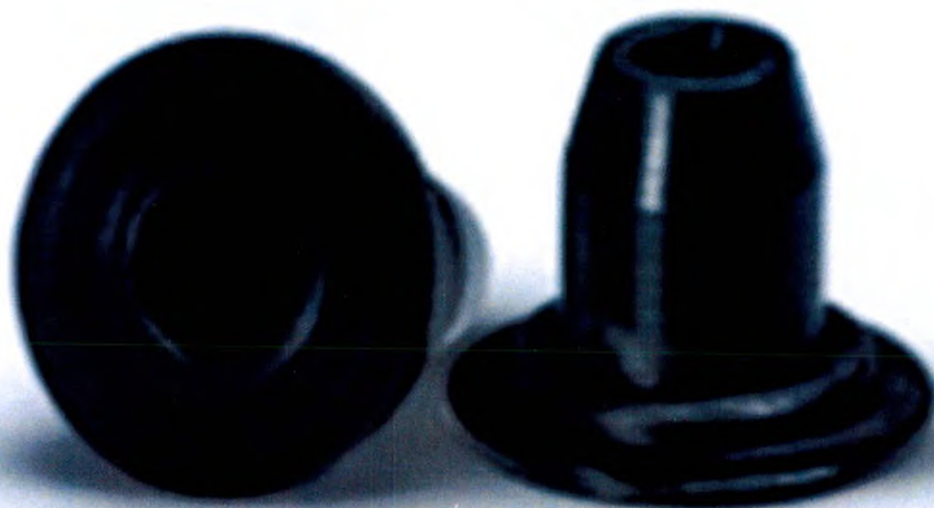

60. Втулки для биопсии одноразовые, не более 1000 шт.



61. Устройство бесперебойного питания специальное, не более 3 шт.

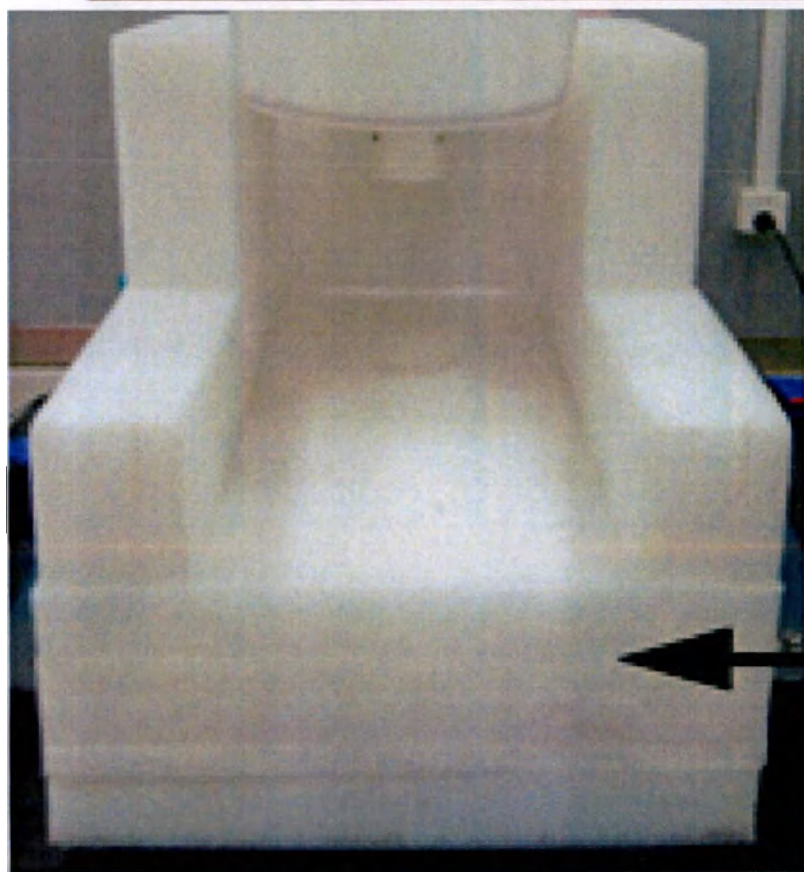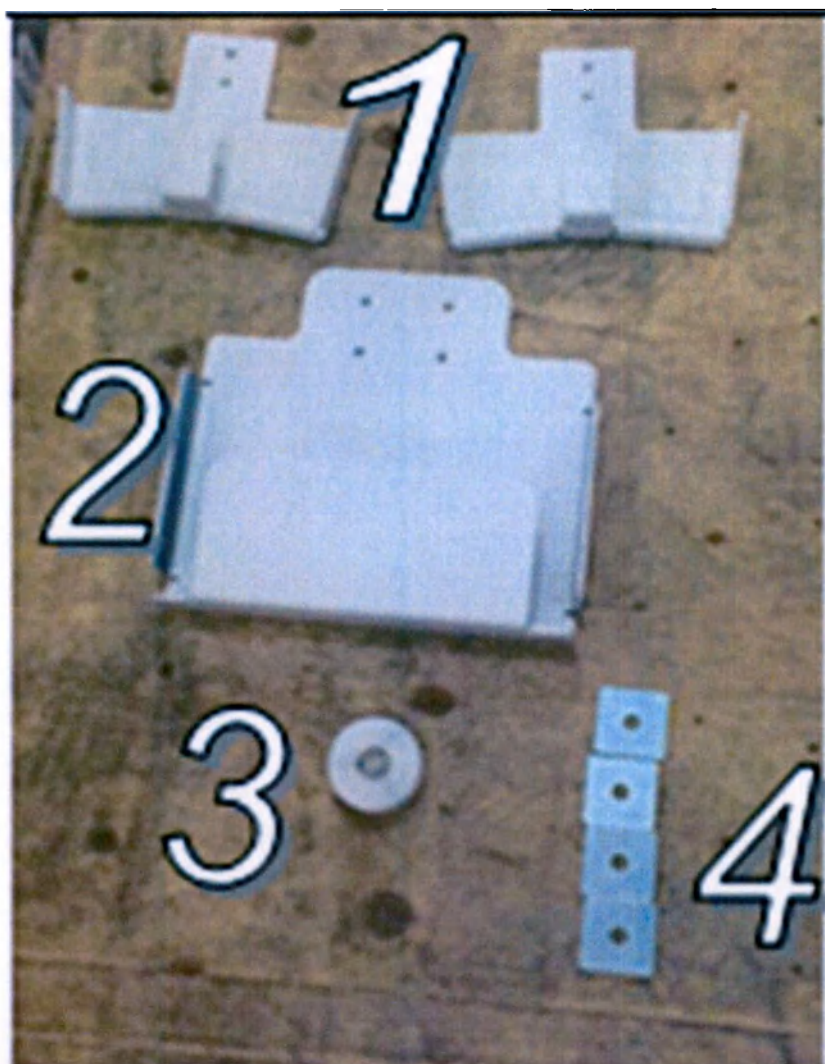

62. Устройство для установки маммографа в транспорте, не более 30 шт.

1: Держатель ножного переключателя; 2: Держатель консоли; 3: Нейлоновый блок; 4: Нижняя крепежная пластина; 5: Пенная форма

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

MAMMOMAT Inspiration


Руководство пользователя
VB61 или выше



64. Сателлитные консоли управления, не более 2 шт.:

- Системный блок.
- Клавиатура.
- Мышь.
- Мониторы, не более 4 шт.



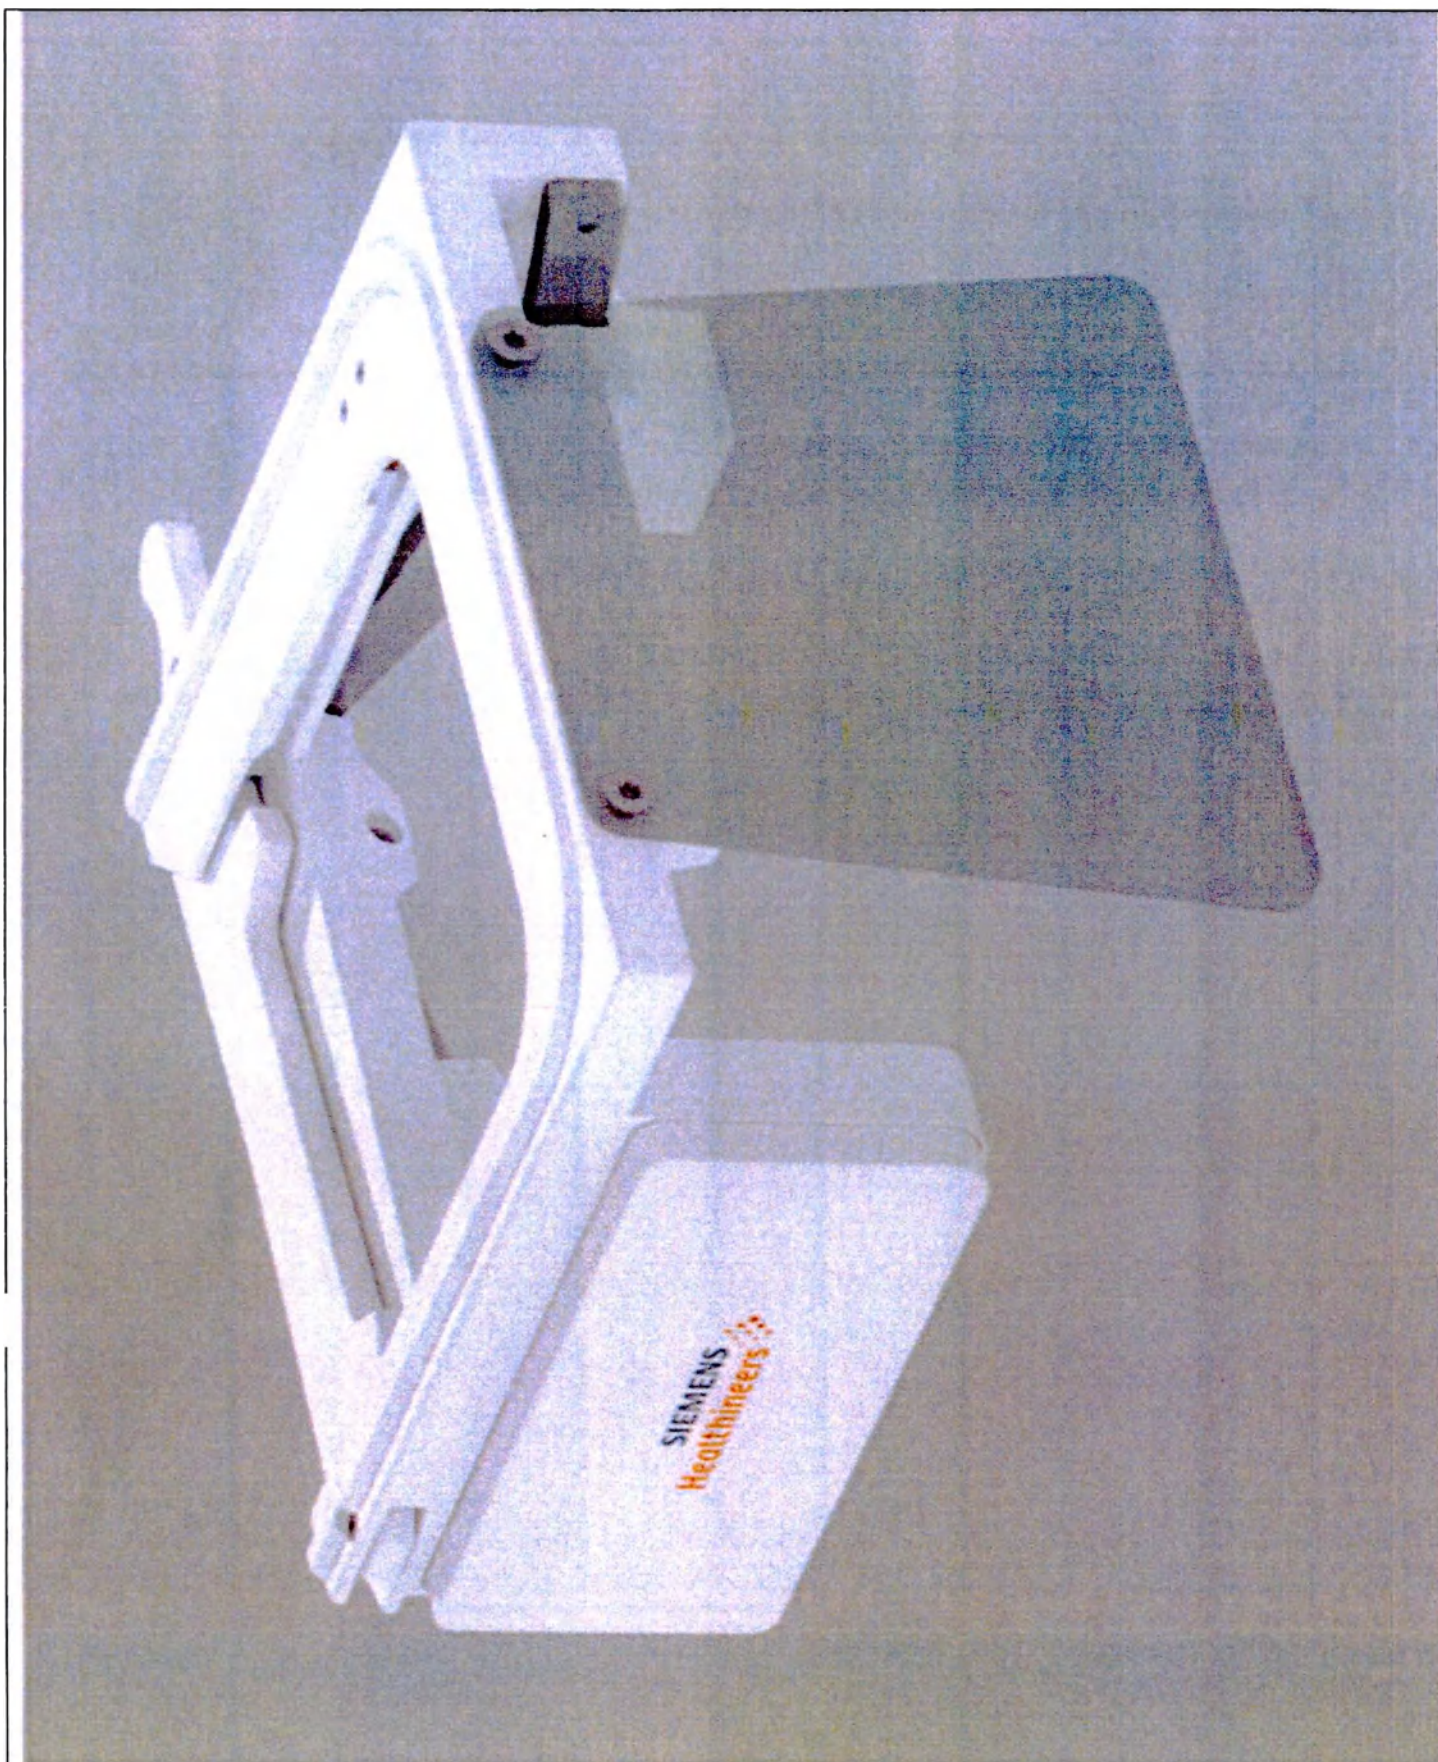

65. Устройство наведения лазерное.

Маркировка:

**Маммографический аппарат MAMMOMAT Inspiration
с принадлежностями**

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/03827 от xx.xx.xxxx

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~1P/N/PE 208/220/230/240/277 В

50/60 Гц

7,5 кВА / 0,5 кВА

~2P/N/PE 208/220/230/240/277/400 В

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

Всего прошито и пронумеровано
39 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

