




**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов
для иммунохроматографического одновременного определения
антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021**


Внешняя маркировка набора реагентов

Вариант исполнения 1

Вариант комплектации в пакете полиэтиленовом с замком

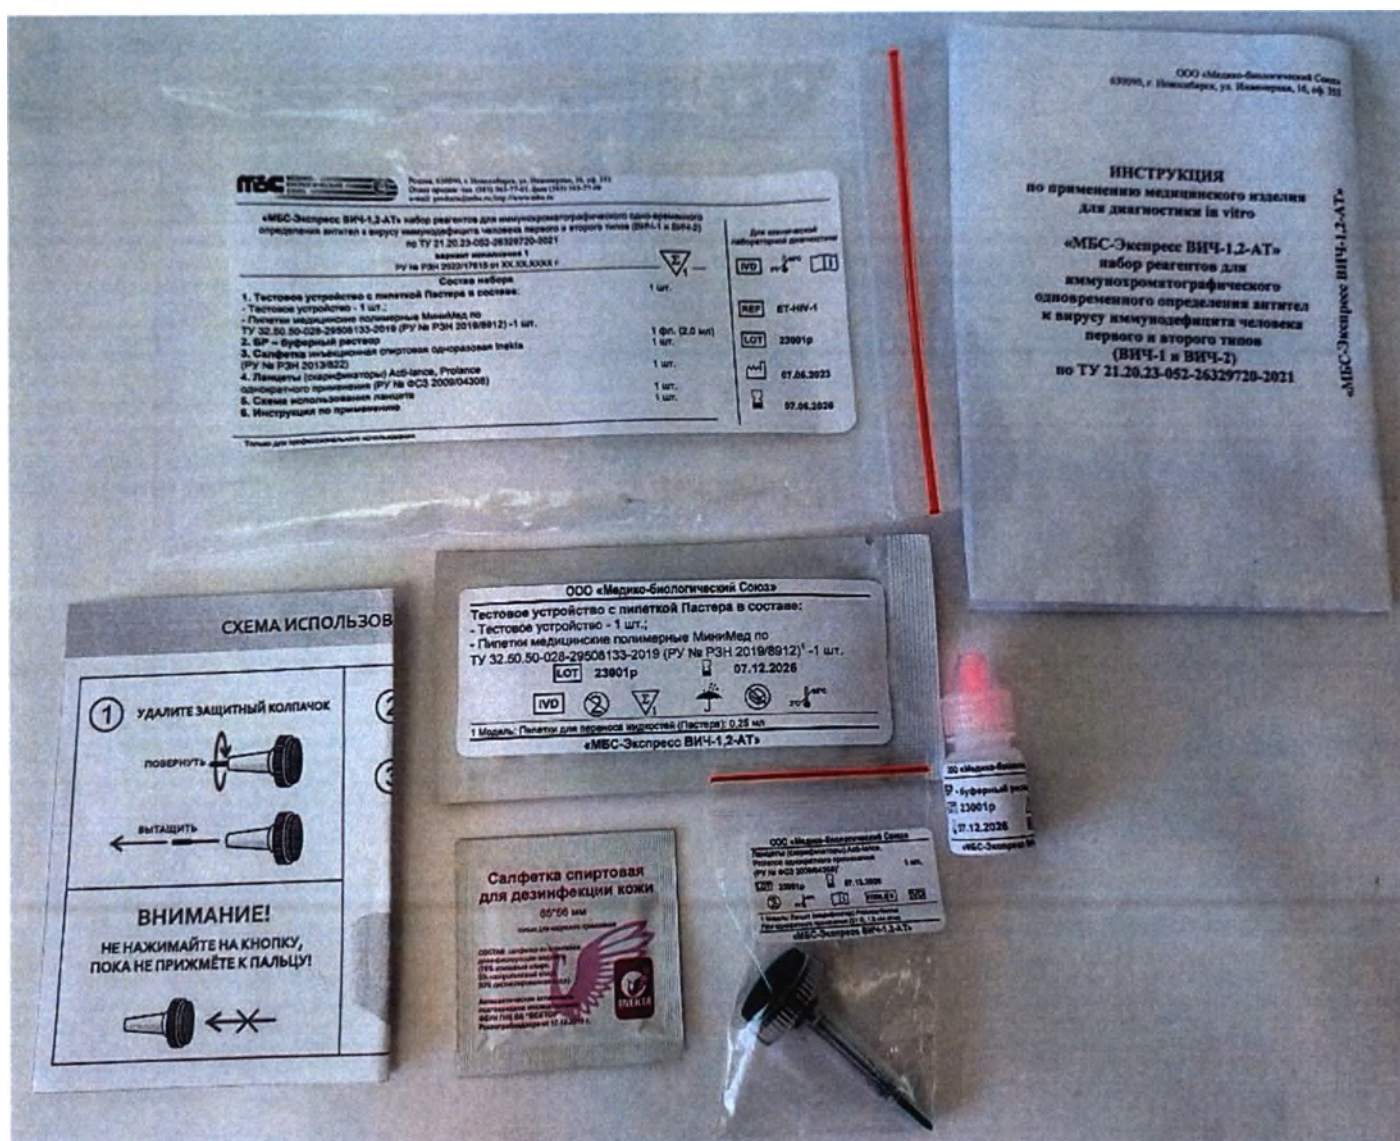

Бюджетный Союз
16, оф. 353



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021

вариант исполнения 1

ПУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

Тес
- Те
- Пв
ТУ:

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
 - Тестовое устройство - 1 шт.;
 - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.
2. БР – буферный раствор
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inecta (ПУ № РЗН 2013/822)
4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308)
5. Схема использования ланцета
6. Инструкция по применению

1 Мо



1 шт.

1 фл. (2,0 мл)
1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Для клинической
лабораторной диагностики



REF ET-HIV-1

LOT 23001p





07.06.2023



07.06.2026

Только для профессионального использования

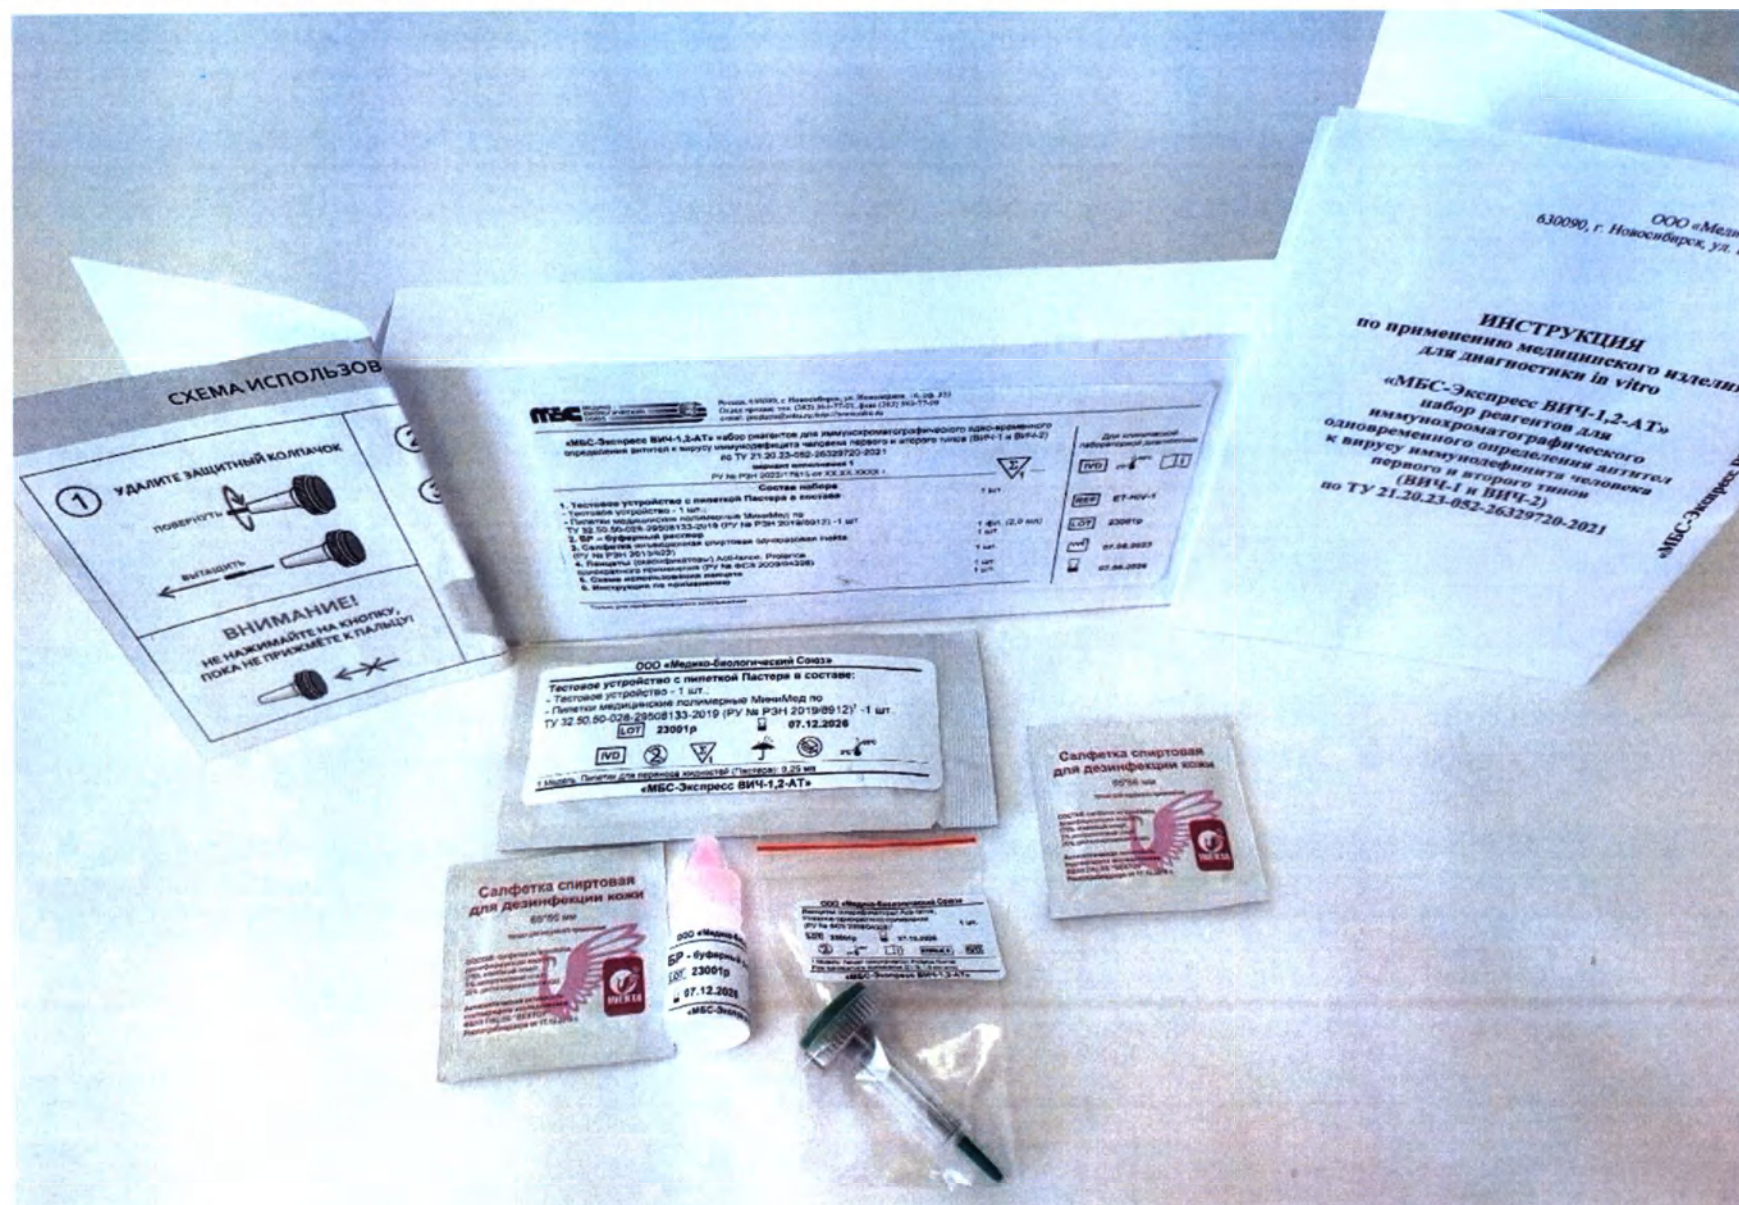



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021

вариант исполнения 1

ПУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)

4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308)

5. Схема использования ланцета

6. Инструкция по применению



1 шт.

1 фл. (2,0 мл)

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Для клинической
лабораторной диагностики



REF ET-HIV-1

LOT 23001p


07.06.2023

07.06.2026

Только для профессионального использования



7



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021

вариант исполнения 2
 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пилеткой Пастера в составе:	20 шт.
- Тестовое устройство - 1 шт.;	
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-026-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.	
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.
4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.
5. Схема использования ланцета	1 шт.
6. Инструкция по применению	1 шт.

Для клинической лабораторной диагностики

IVD

REF ET-HIV-20

LOT 23003p

07.06.2023

07.06.2026



Только для профессионального использования

или

Брендирующая пачка/коробка

МБС МЕДИКО -
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
СОЮЗ




Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одновременного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения 2
РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пилеткой Пастера в составе:	20 шт.
- Тестовое устройство - 1 шт.;	
- Пилетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-28508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.	
2. БР - буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Ineda (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.
4. Ланцеты (скарификаторы) Asc-Iapov, Prolapov однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.
5. Схема использования ланцеты	1 шт.
6. Инструкция по применению	1 шт.

Только для профессионального использования



REF ET-HIV-20

LOT 23003p

07.06.2023

07.06.2026

IVD

Для клинической лабораторной диагностики







Небредированная пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbc.ru; http://www.mbc.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021

вариант исполнения 3
 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.
- Тестовое устройство - 1 шт.;	
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.	
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inektia (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.
4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance одноразового применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	25 шт.
5. Схема использования ланцета	1 шт.
6. Инструкция по применению	1 шт.

Только для профессионального использования

Для клинической лабораторной диагностики



REF ET-HIV-25

LOT 23005p

07.06.2023

07.06.2026

или

Брендированная пачка/коробка




Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одновременного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-28328720-2021
вариант исполнения 3
РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.
- Тестовое устройство - 1 шт.;	
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508153-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.	
2. БР - буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.
4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, ProLance одноразового применения (РУ № ФСЗ 2009/04306)	25 шт.
5. Схема использования ланцета	1 шт.
6. Инструкция по применению	1 шт.

Только для профессионального использования



REF ET-HIV-25

LOT 23005p


07.06.2023

07.06.2026

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



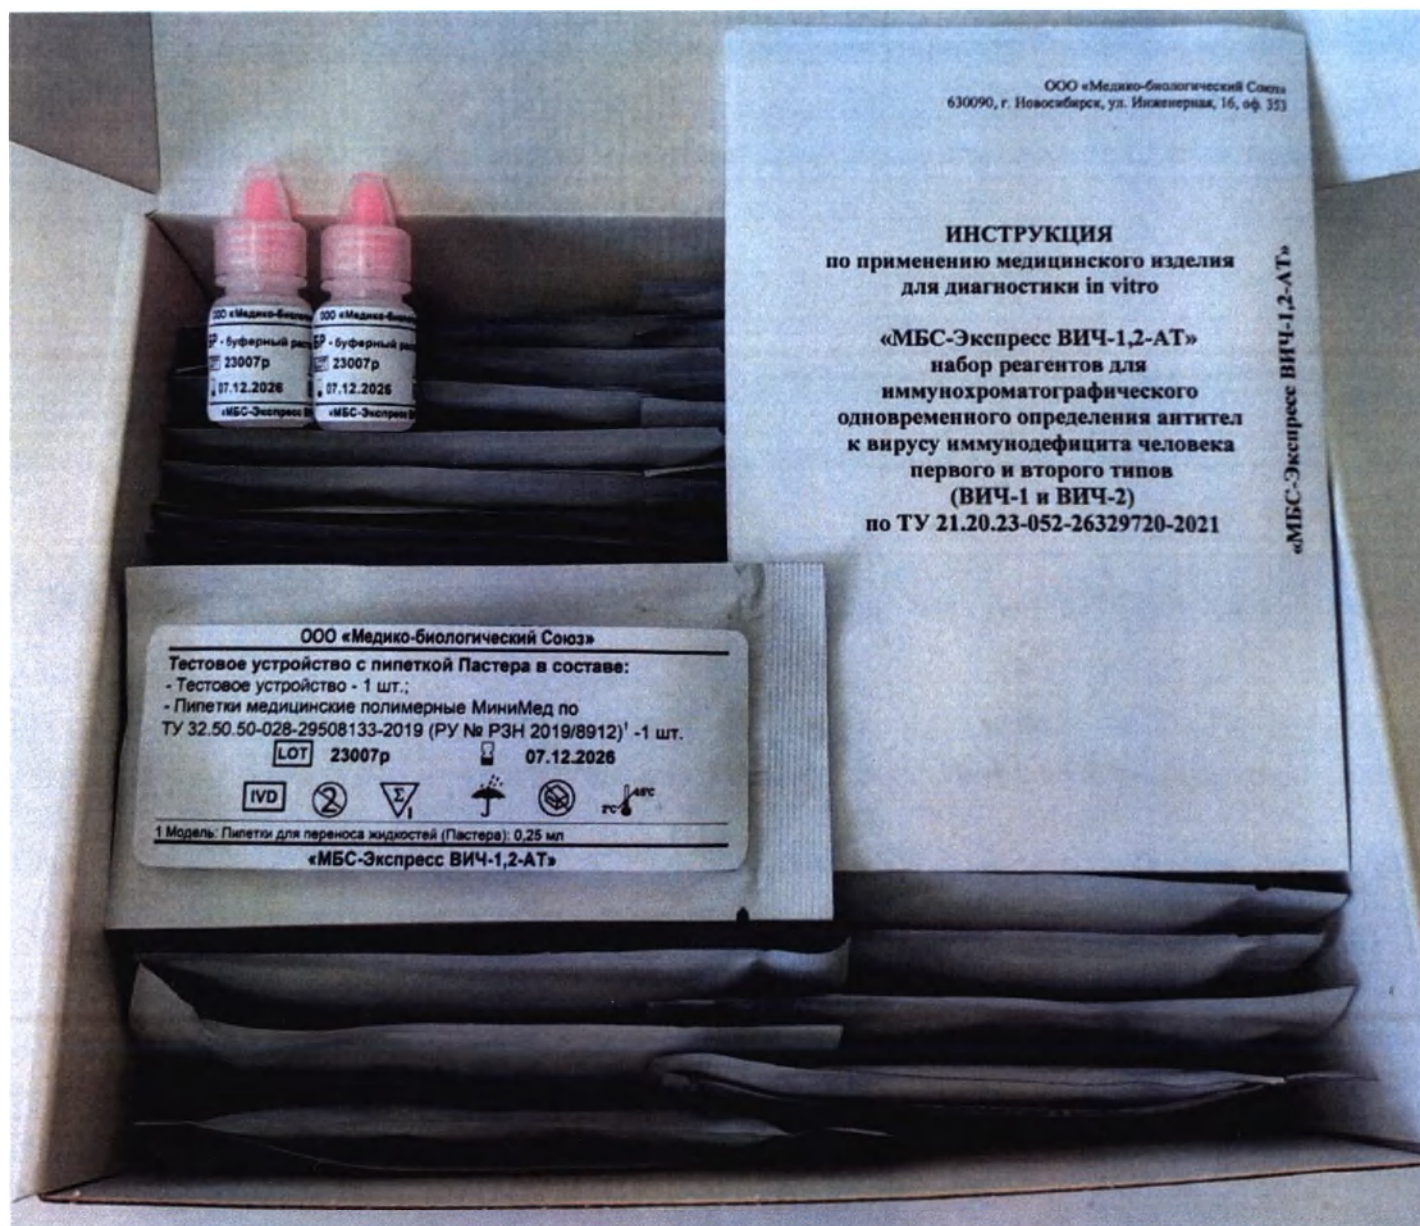

МБС МЕДИКО -
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
СОЮЗ



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения 4
РУ № РЗН 2022/17815 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
2. БР – буферный раствор
3. Инструкция по применению

40 шт.

2 фл. (по 2,0 мл)
1 шт.

2°C



REF ET-HIV-40

LOT 23007p

07.06.2023

07.06.2026

IVD

Для клинической лабораторной диагностики









Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения 5
РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор
3. Инструкция по применению

50 шт.

2 фл. (по 2,0 мл)
1 шт.



REF ET-HIV-50

LOT 23009p

08.06.2023

08.06.2026


IVD

Для клинической лабораторной диагностики



Вариант исполнения 6



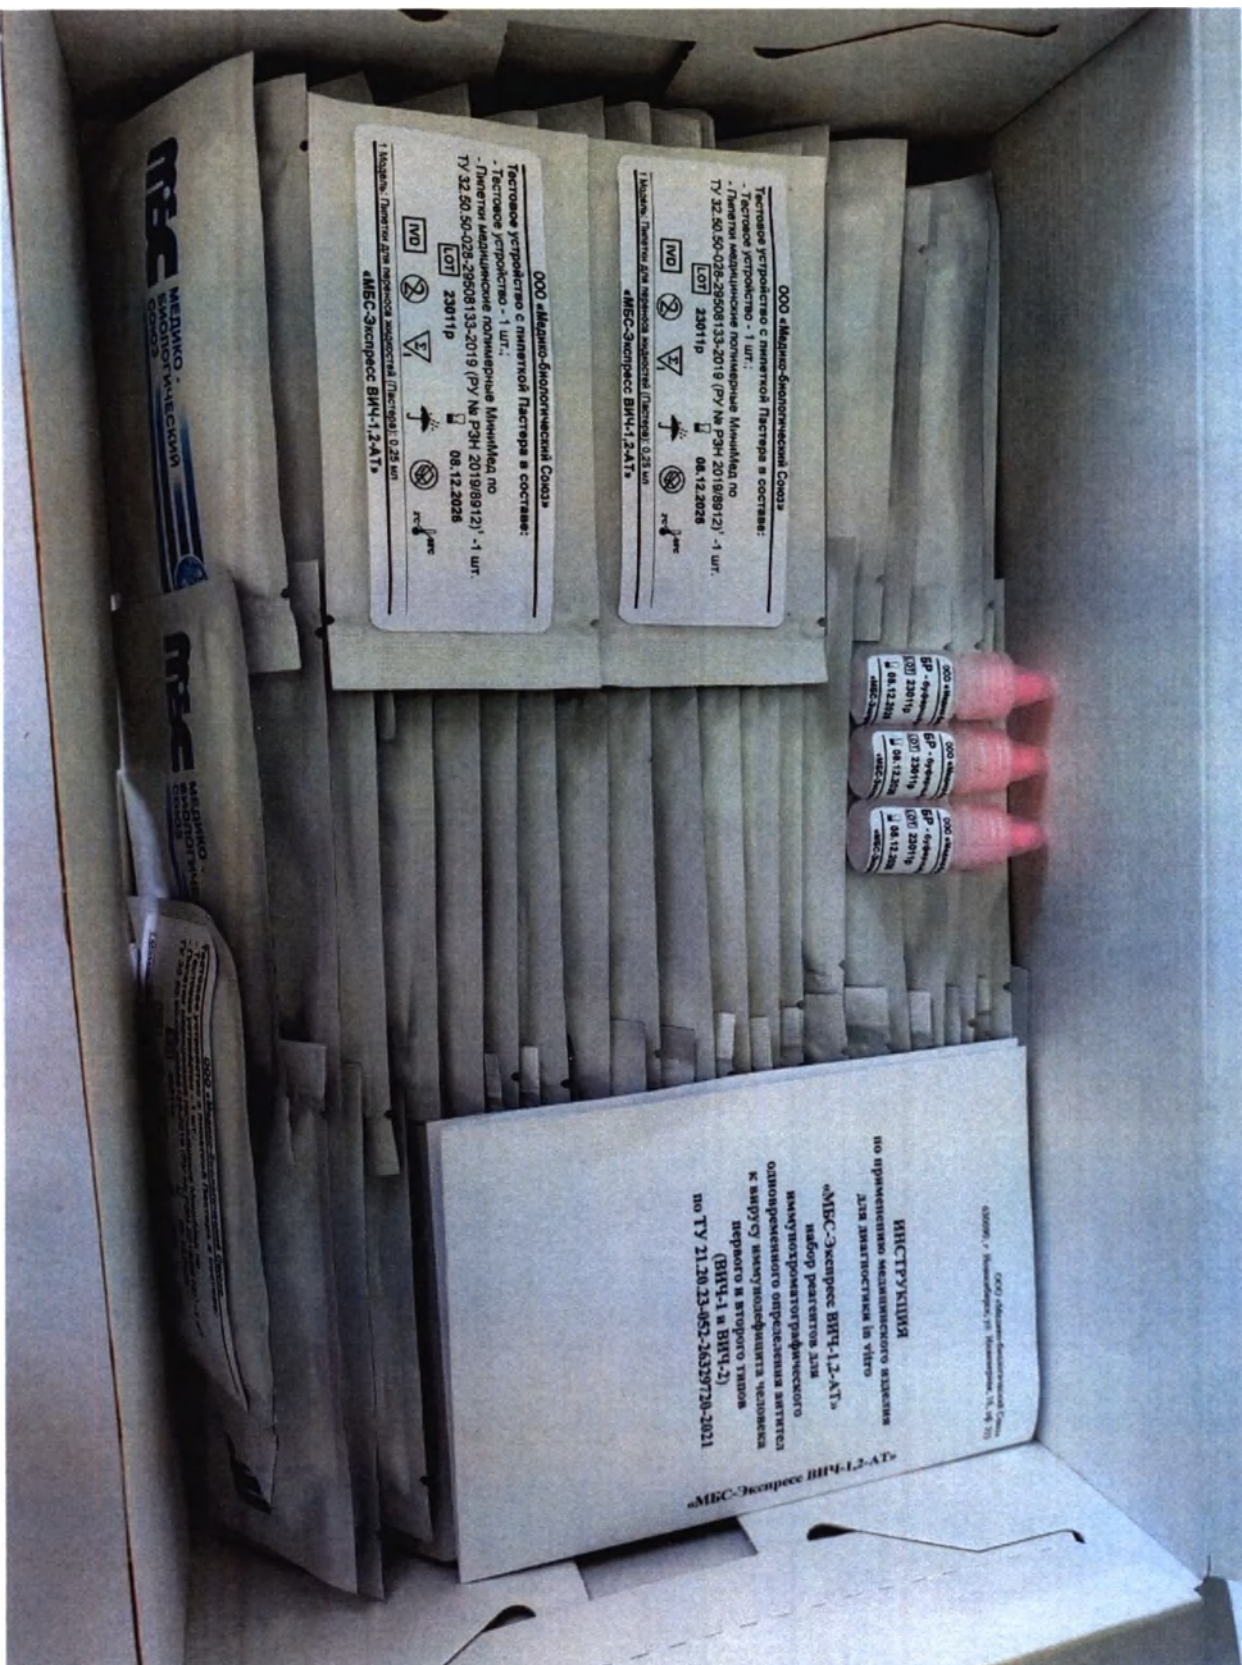

ООО «Медино-биологический Союз»
г. Москва, Пашковская ул. д. 10, стр. 10
ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
для диагностики in vitro
«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»
набор реагентов для
иммунохроматографического
одновременного определения антител
к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-065-2639720-2021
«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»

ООО «Медино-биологический Союз»
Тестовое устройство с индикаторной Пастеризационной
- Тестовое устройство - 1 шт.
- Пастеризационная пастеризационная Пастеризационная
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (Р/У № РЭН 2019/0912) - 1 шт.
LOT 23011P 08.12.2028
1. Материал: Пастеризационная пастеризационная (Пастеризационная) 0.25 мн
«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»

ООО «Медино-биологический Союз»
Тестовое устройство с индикаторной Пастеризационной
- Тестовое устройство - 1 шт.
- Пастеризационная пастеризационная Пастеризационная
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (Р/У № РЭН 2019/0912) - 1 шт.
LOT 23011P 08.12.2028
1. Материал: Пастеризационная пастеризационная (Пастеризационная) 0.25 мн
«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения Б
РУ № РЗН 2022/176125 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:


- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

3. Инструкция по применению

100 шт.

3 фл. (по 2,0 мл)
1 шт.



REF ET-HIV-100

LOT 23011p

08.06.2023

08.06.2026

Только для профессионального использования

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Внутренняя маркировка набора реагентов

Тестовое устройство с пипеткой Пастера

Варианты исполнения 1-6

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:



- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ -1 шт.

LOT

23003p



07.12.2026




1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»




«БР» - буферный раствор

Варианты исполнения 1-6

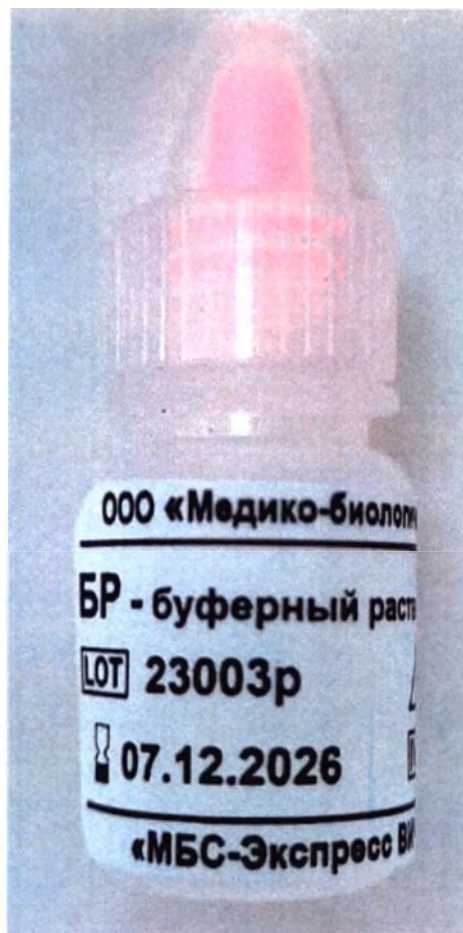

Ланцет

Вариант исполнения 1

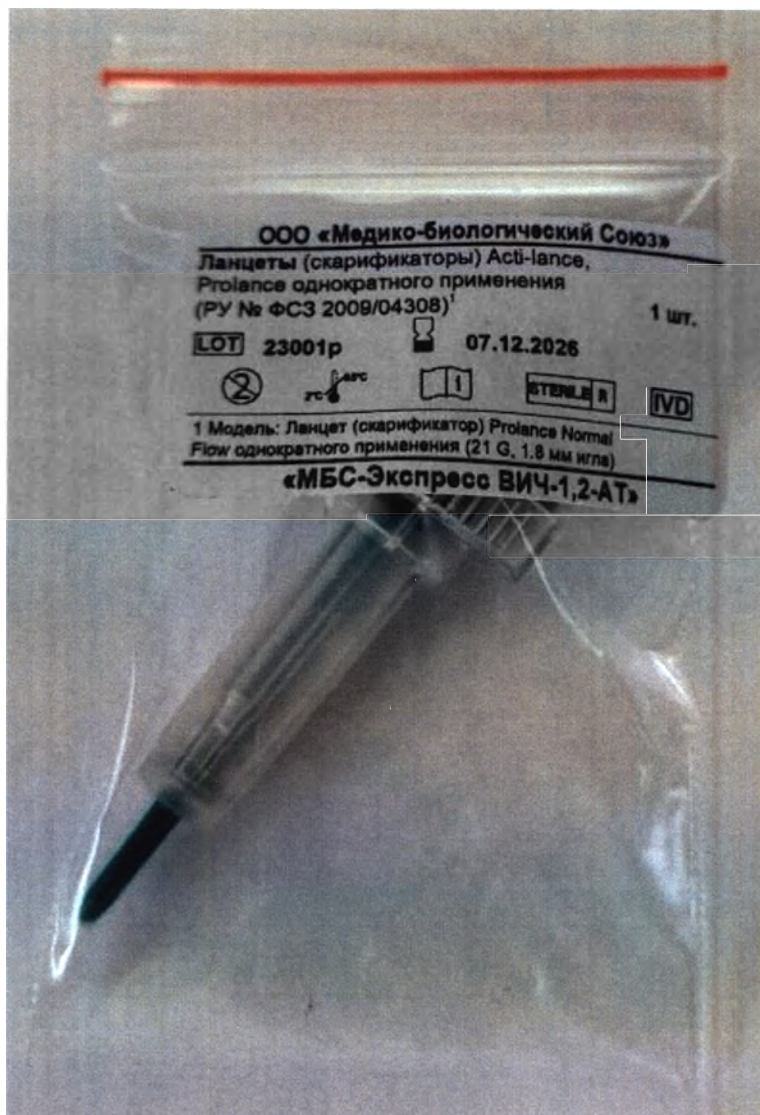






Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822) (упаковка от производителя МИ)

Вариант исполнения 1-3



Лицевая сторона салфетки инъекционной спиртовой одноразовой Inekta (РУ № РЗН 2013/822)

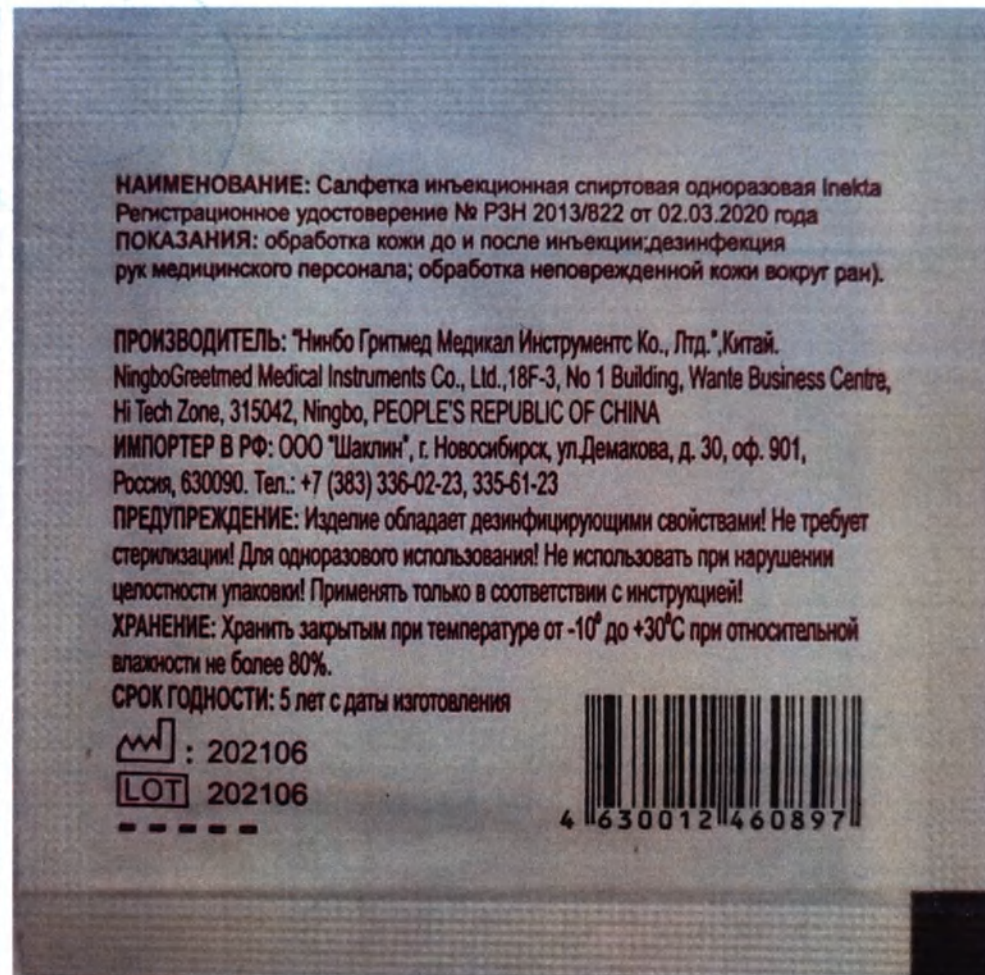

Обратная сторона салфетки инъекционной спиртовой одноразовой Inekta (РУ № РЗН 2013/822)



Прошито пронумеровано скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» _____ М.В.Лосев

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«01» июня 2023 г.



Образцы маркировки медицинского изделия


с изменением № 1

**«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для
иммунохроматографического одновременного определения антител
к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021**

Внешняя маркировка

Вариант исполнения 1

Небрендированная пачка/коробка/пакет

		Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	
«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021 вариант исполнения 1 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.			
Состав набора			
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	1 шт.	Для клинической лабораторной диагностики 	
- Тестовое устройство - 1 шт.; - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-28508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.		 ET-HIV-1	
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)	 XXXXX	
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	1 шт.	 XX.XX.XXXX	
4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	1 шт.	 XX.XX.XXXX	
5. Схема использования ланцета	1 шт.		
6. Инструкция по применению	1 шт.		
Только для профессионального использования			

Вариант исполнения 2

Небрендированная пачка/коробка

 Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021 вариант исполнения 2 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г. Состав набора <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">20 шт.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Тестовое устройство - 1 шт.;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.</td> </tr> <tr> <td>2. БР – буферный раствор</td> <td style="text-align: right;">1 фл. (2,0 мл)</td> </tr> <tr> <td>3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)</td> <td style="text-align: right;">20 шт.</td> </tr> <tr> <td>4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)</td> <td style="text-align: right;">20 шт.</td> </tr> <tr> <td>5. Схема использования ланцета</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>6. Инструкция по применению</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> </table> Только для профессионального использования	1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	20 шт.	- Тестовое устройство - 1 шт.;		- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.		2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)	3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.	4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.	5. Схема использования ланцета	1 шт.	6. Инструкция по применению	1 шт.
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	20 шт.																
- Тестовое устройство - 1 шт.;																	
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.																	
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)																
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.																
4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.																
5. Схема использования ланцета	1 шт.																
6. Инструкция по применению	1 шт.																



Для клинической лабораторной диагностики





REF

 ET-HIV-20

LOT

 XXXXX

 XX.XX.XXXX

 XX.XX.XXXX

ИЛИ

Брендированная пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одновременного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021 вариант исполнения 2 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г. Состав набора <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">20 шт.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Тестовое устройство - 1 шт.;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.</td> </tr> <tr> <td>2. БР – буферный раствор</td> <td style="text-align: right;">1 фл. (2,0 мл)</td> </tr> <tr> <td>3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)</td> <td style="text-align: right;">20 шт.</td> </tr> <tr> <td>4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)</td> <td style="text-align: right;">20 шт.</td> </tr> <tr> <td>5. Схема использования ланцета</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>6. Инструкция по применению</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> </table> Только для профессионального использования	1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	20 шт.	- Тестовое устройство - 1 шт.;		- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.		2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)	3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.	4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.	5. Схема использования ланцета	1 шт.	6. Инструкция по применению	1 шт.	   REF ET-HIV-20 LOT XXXXX  XX.XX.XXXX  XX.XX.XXXX
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	20 шт.																
- Тестовое устройство - 1 шт.;																	
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.																	
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)																
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.																
4. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.																
5. Схема использования ланцета	1 шт.																
6. Инструкция по применению	1 шт.																

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 3

Небрендированная пачка/коробка

 МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ	Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021 вариант исполнения 3 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г. Состав набора <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">25 шт.</td> </tr> <tr> <td>- Тестовое устройство - 1 шт.;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. БР – буферный раствор</td> <td style="text-align: right;">1 фл. (2,0 мл)</td> </tr> <tr> <td>3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)</td> <td style="text-align: right;">25 шт.</td> </tr> <tr> <td>4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)</td> <td style="text-align: right;">25 шт.</td> </tr> <tr> <td>5. Схема использования ланцета</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>6. Инструкция по применению</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> </table> Только для профессионального использования	1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.	- Тестовое устройство - 1 шт.;		- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.		2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)	3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.	4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	25 шт.	5. Схема использования ланцета	1 шт.	6. Инструкция по применению	1 шт.
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.																	
- Тестовое устройство - 1 шт.;																		
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.																		
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)																	
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.																	
4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	25 шт.																	
5. Схема использования ланцета	1 шт.																	
6. Инструкция по применению	1 шт.																	

Для клинической лабораторной диагностики





REF

ET-HIV-25

LOT

XXXXX




XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

ИЛИ

Брендированная пачка/коробка




Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического одновременного определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021 вариант исполнения 3 РУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г. Состав набора <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">25 шт.</td> </tr> <tr> <td>- Тестовое устройство - 1 шт.;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. БР – буферный раствор</td> <td style="text-align: right;">1 фл. (2,0 мл)</td> </tr> <tr> <td>3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)</td> <td style="text-align: right;">25 шт.</td> </tr> <tr> <td>4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)</td> <td style="text-align: right;">25 шт.</td> </tr> <tr> <td>5. Схема использования ланцета</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> <tr> <td>6. Инструкция по применению</td> <td style="text-align: right;">1 шт.</td> </tr> </table> Только для профессионального использования	1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.	- Тестовое устройство - 1 шт.;		- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.		2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)	3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.	4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	25 шт.	5. Схема использования ланцета	1 шт.	6. Инструкция по применению	1 шт.	2°C 35°C   REF ET-HIV-25 LOT XXXXX  XX.XX.XXXX  XX.XX.XXXX
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.																
- Тестовое устройство - 1 шт.;																	
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) -1 шт.																	
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)																
3. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.																
4. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	25 шт.																
5. Схема использования ланцета	1 шт.																
6. Инструкция по применению	1 шт.																

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 4
Брендированная пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения 4
ПУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:

40 шт.

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

2 фл. (по 2,0 мл)

3. Инструкция по применению

1 шт.



REF ET-HIV-40

LOT XXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 5
Брендирующая пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения 5
ПУ № РЗН 2022/17615 от XX.XX.XXXX г.



Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера

50 шт.

в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

2 фл. (по 2,0 мл)

3. Инструкция по применению

1 шт.

REF ET-HIV-50

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX


XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования



Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 6
Брендируемая пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для иммунохроматографического
одно-временного определения антител к вирусу иммунодефицита человека
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021
вариант исполнения 6
РУ № РЗН 2022/176125 от XX.XX.XXXX г.



Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:

100 шт.

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

3 фл. (по 2,0 мл)

3. Инструкция по применению

1 шт.

REF ET-HIV-100

LOT XXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования



Для клинической лабораторной диагностики

Внутренняя маркировка
Варианты исполнения 1, 2, 3, 4, 5 и 6

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ -1 шт.

LOT XXXXX **XX.XX.XXXX**

IVD     

1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»

ООО «Медико-биологический Союз»

БР - буферный раствор 2,0 мл

LOT XXXXX **XX.XX.XXXX**

  **IVD**

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»

ООО «Медико-биологический Союз»

**Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance,
Prolance однократного применения
(ПУ № ФСЗ 2009/04308)¹** X шт.


LOT XXXXX **XX.XX.XXXX**

   **STERILE R** **IVD**

1 Модель: Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1.8 мм игла)

«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ»


Маркировка тестового устройства

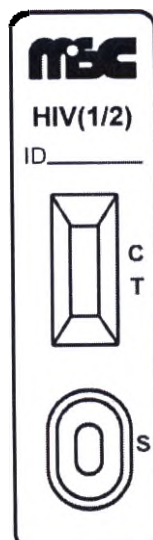

Маркировка транспортной тары



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru



**«МБС-Экспресс ВИЧ-1,2-АТ» набор реагентов для
 иммунохроматографического одновременного определения антител к вирусу
 иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2)
 по ТУ 21.20.23-052-26329720-2021**

Кат. №	ЕТ-НIV-XXX
Серия	XXXXX
Дата изготовления	XX.XX.XXXX
Срок годности	XX.XX.XXXX
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг



Срочный груз

Не бросать

Не замораживать!

Прощито пронумеровано скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

